

Генеральный директор
ООО «БиомерьеРус»
Бердникова Н.В.
«20» августа 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Прибор для приготовления питательных сред
MASTERCLAVE (МАСТЕРКЛАВ)» с принадлежностями.**


Генеральный директор
ООО «БиомерьеРус»
_____ Бердникова Н.В.

«____» _____ 2021 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Прибор для приготовления питательных сред MASTERCLAVE
(МАСТЕРКЛАВ)» с принадлежностями.




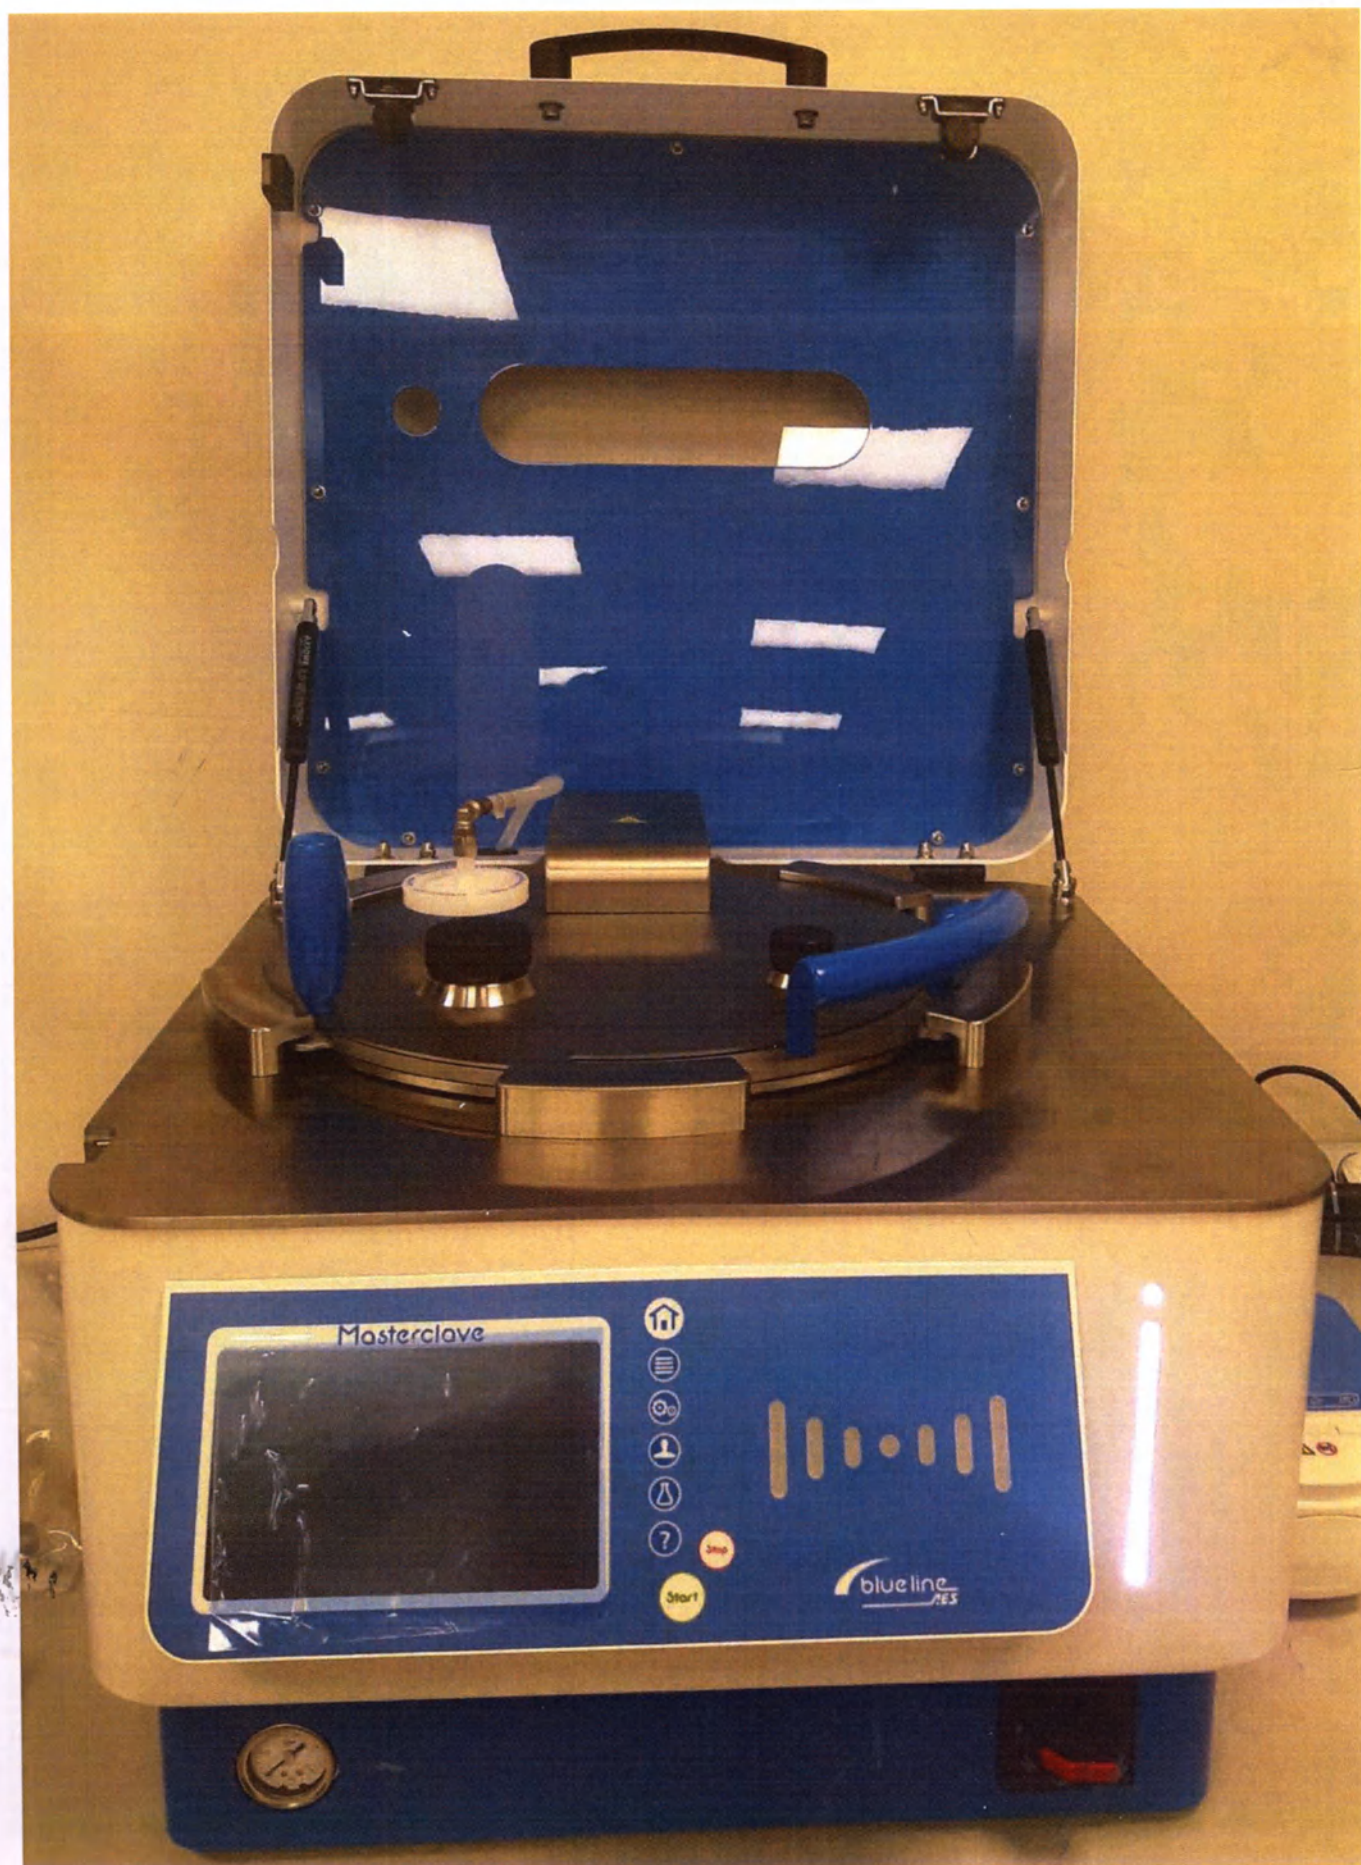



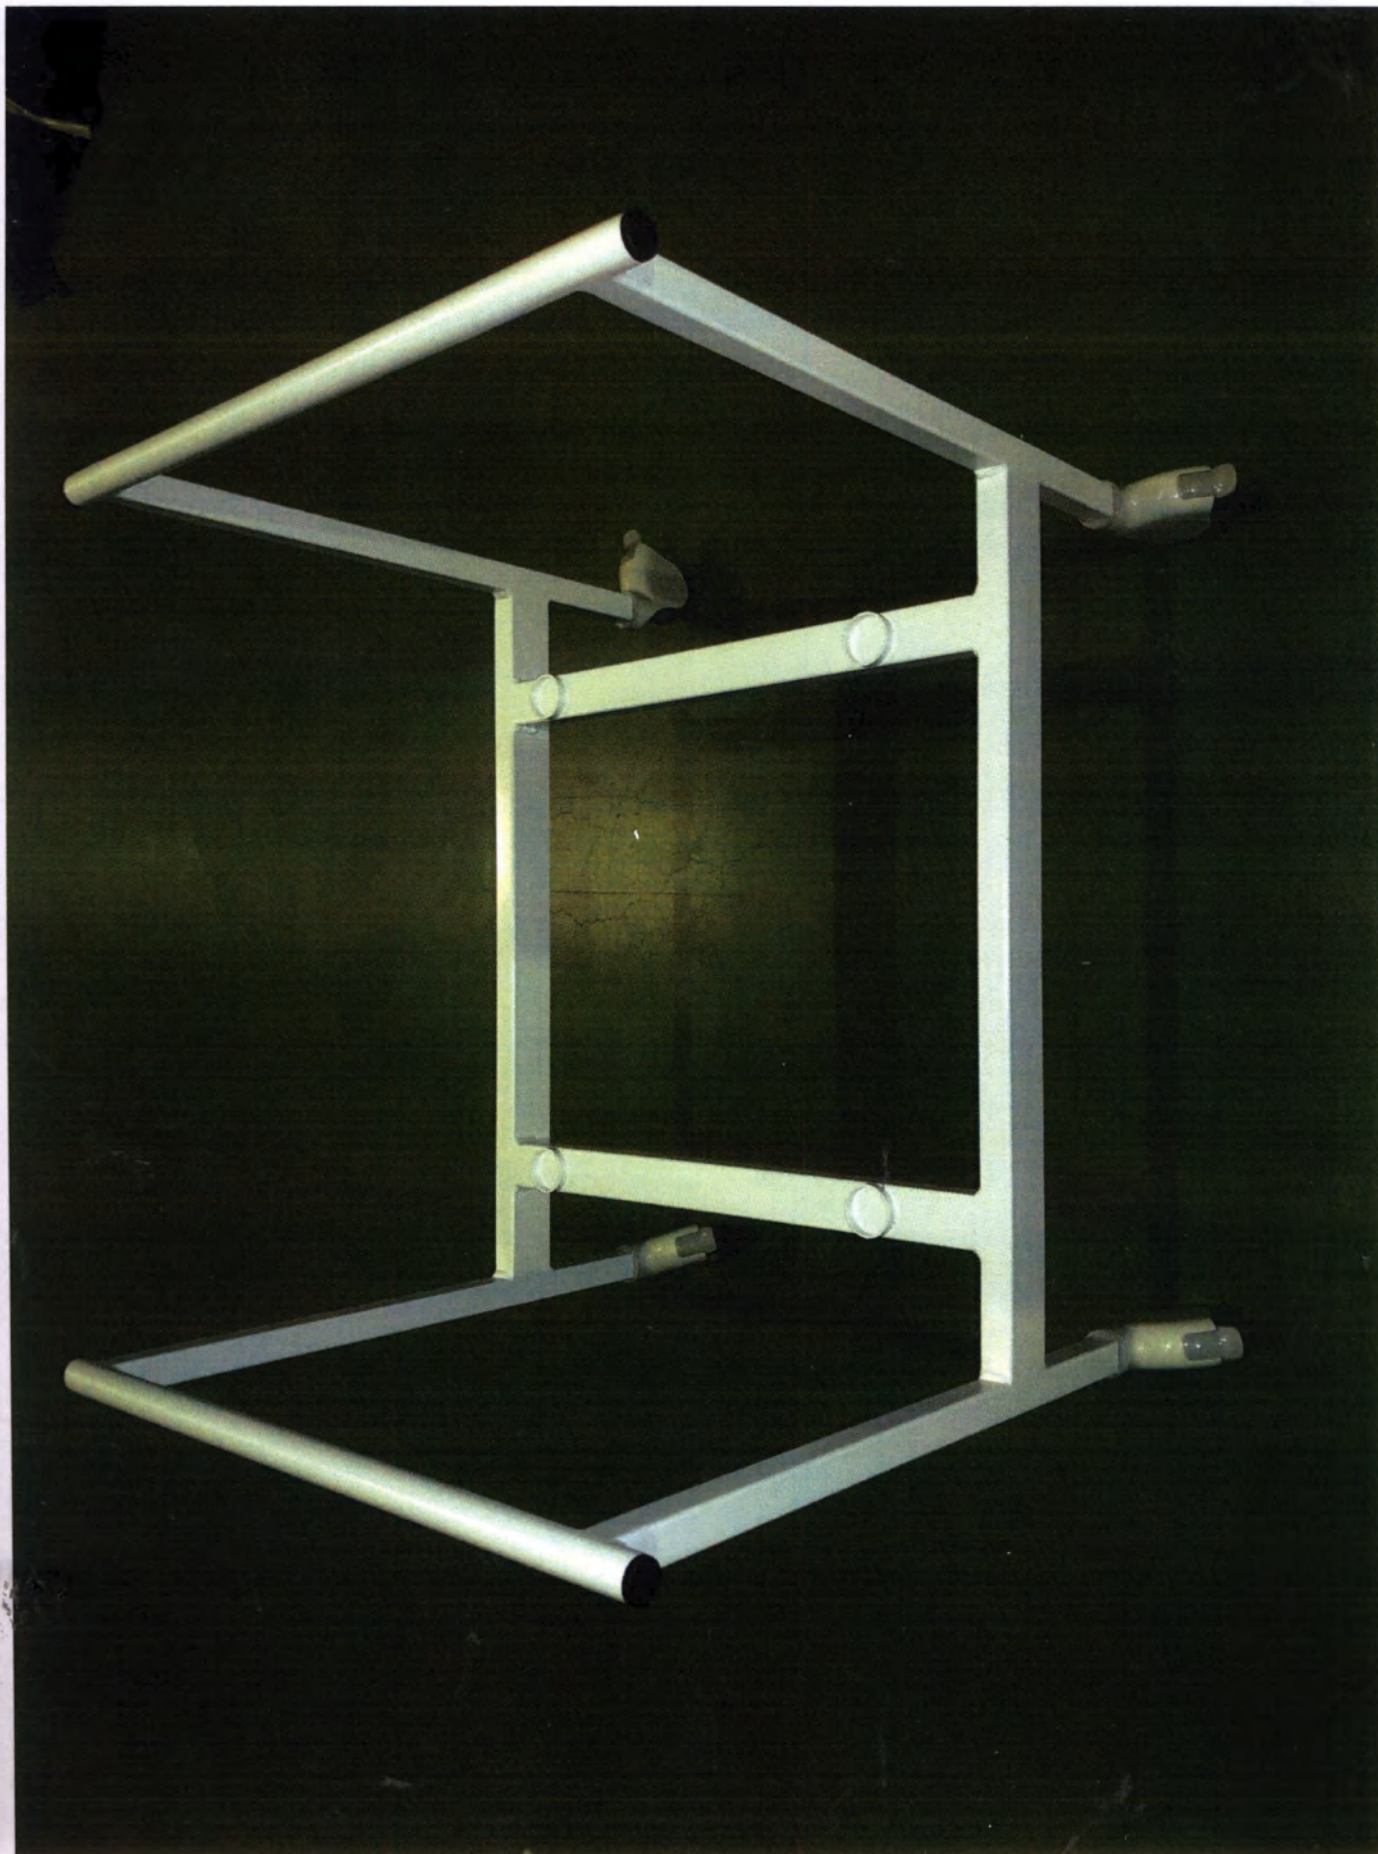



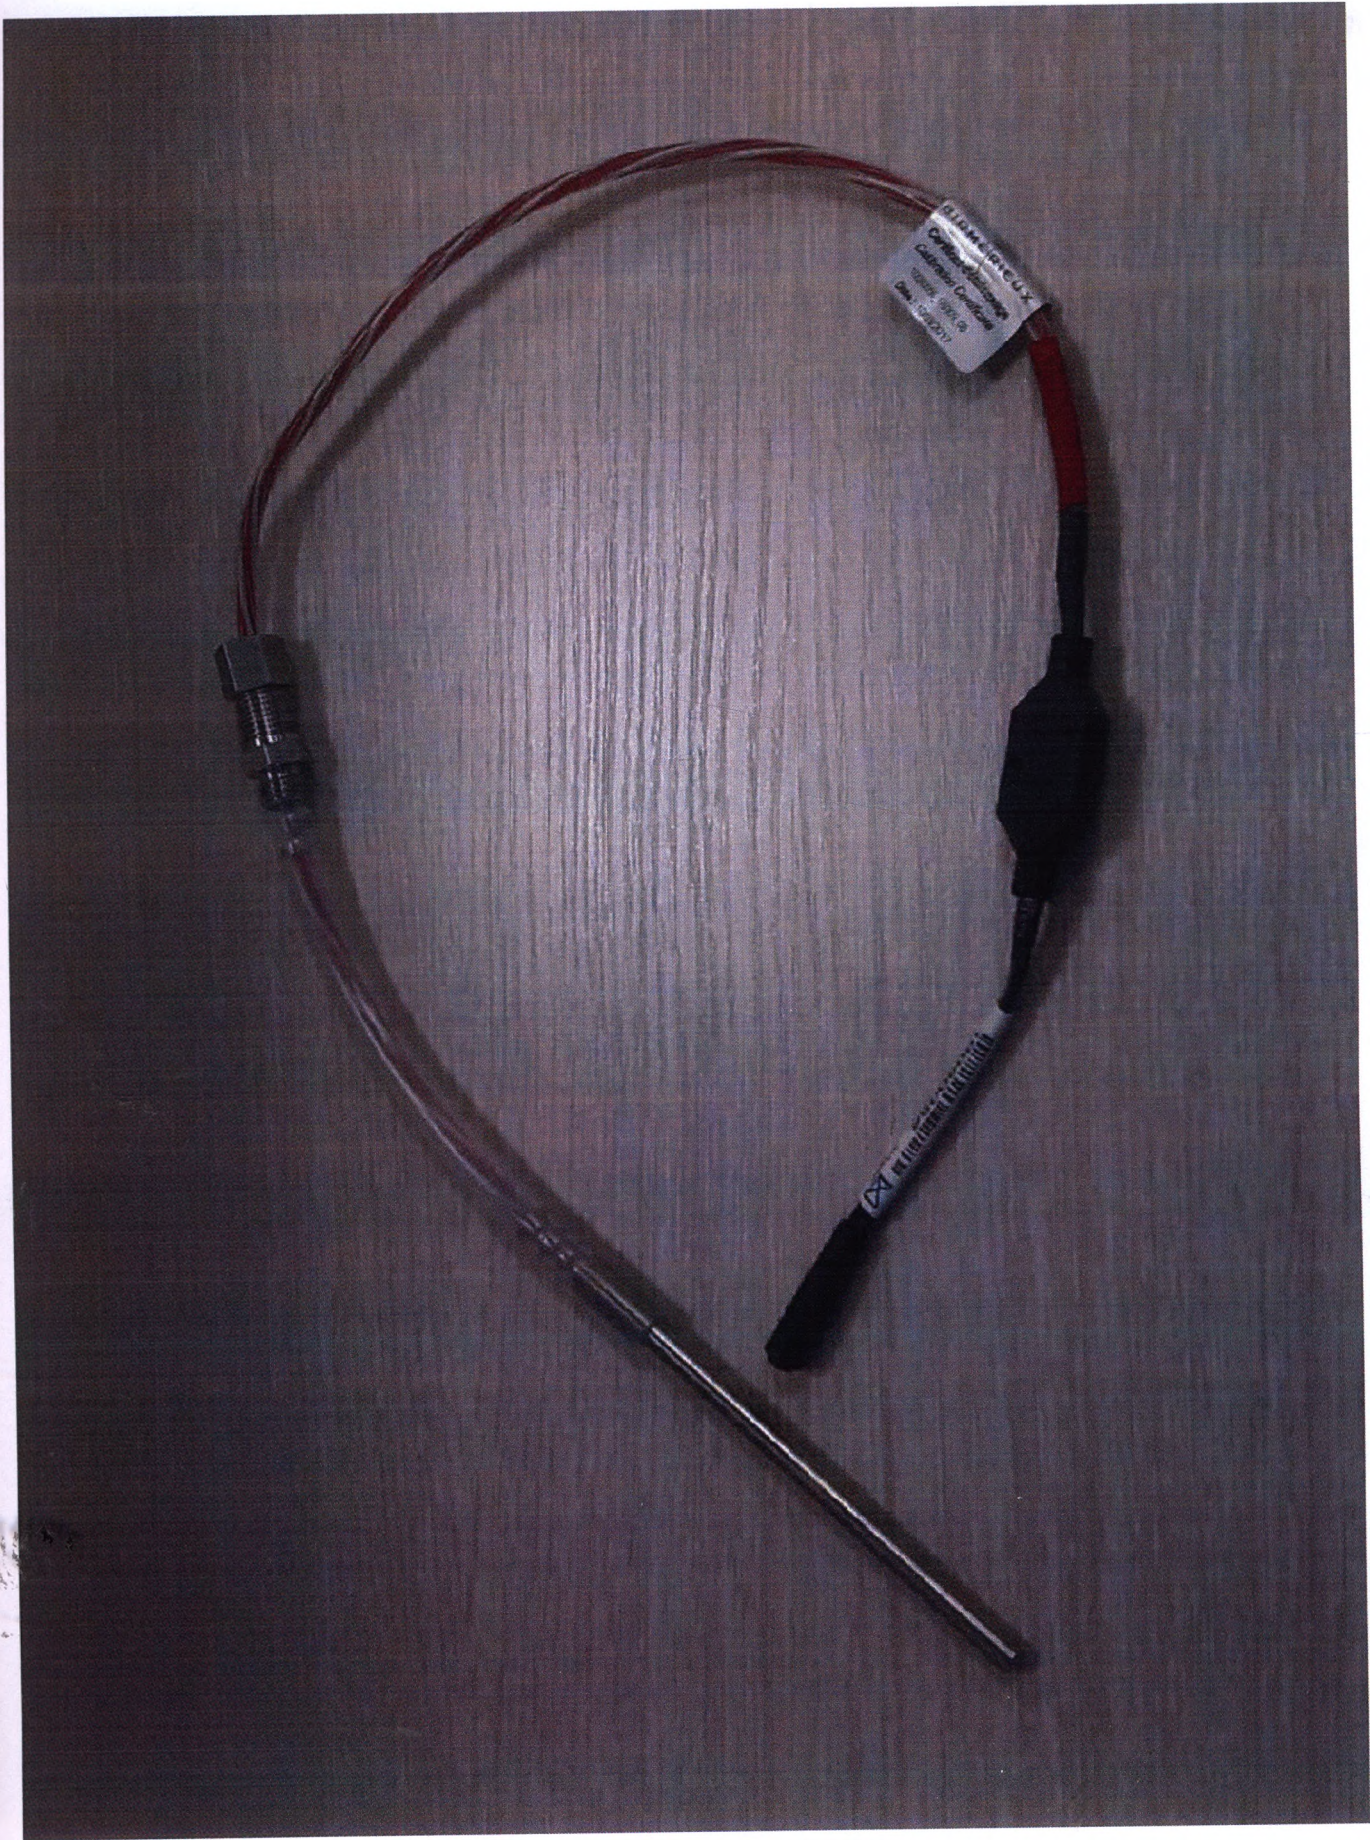











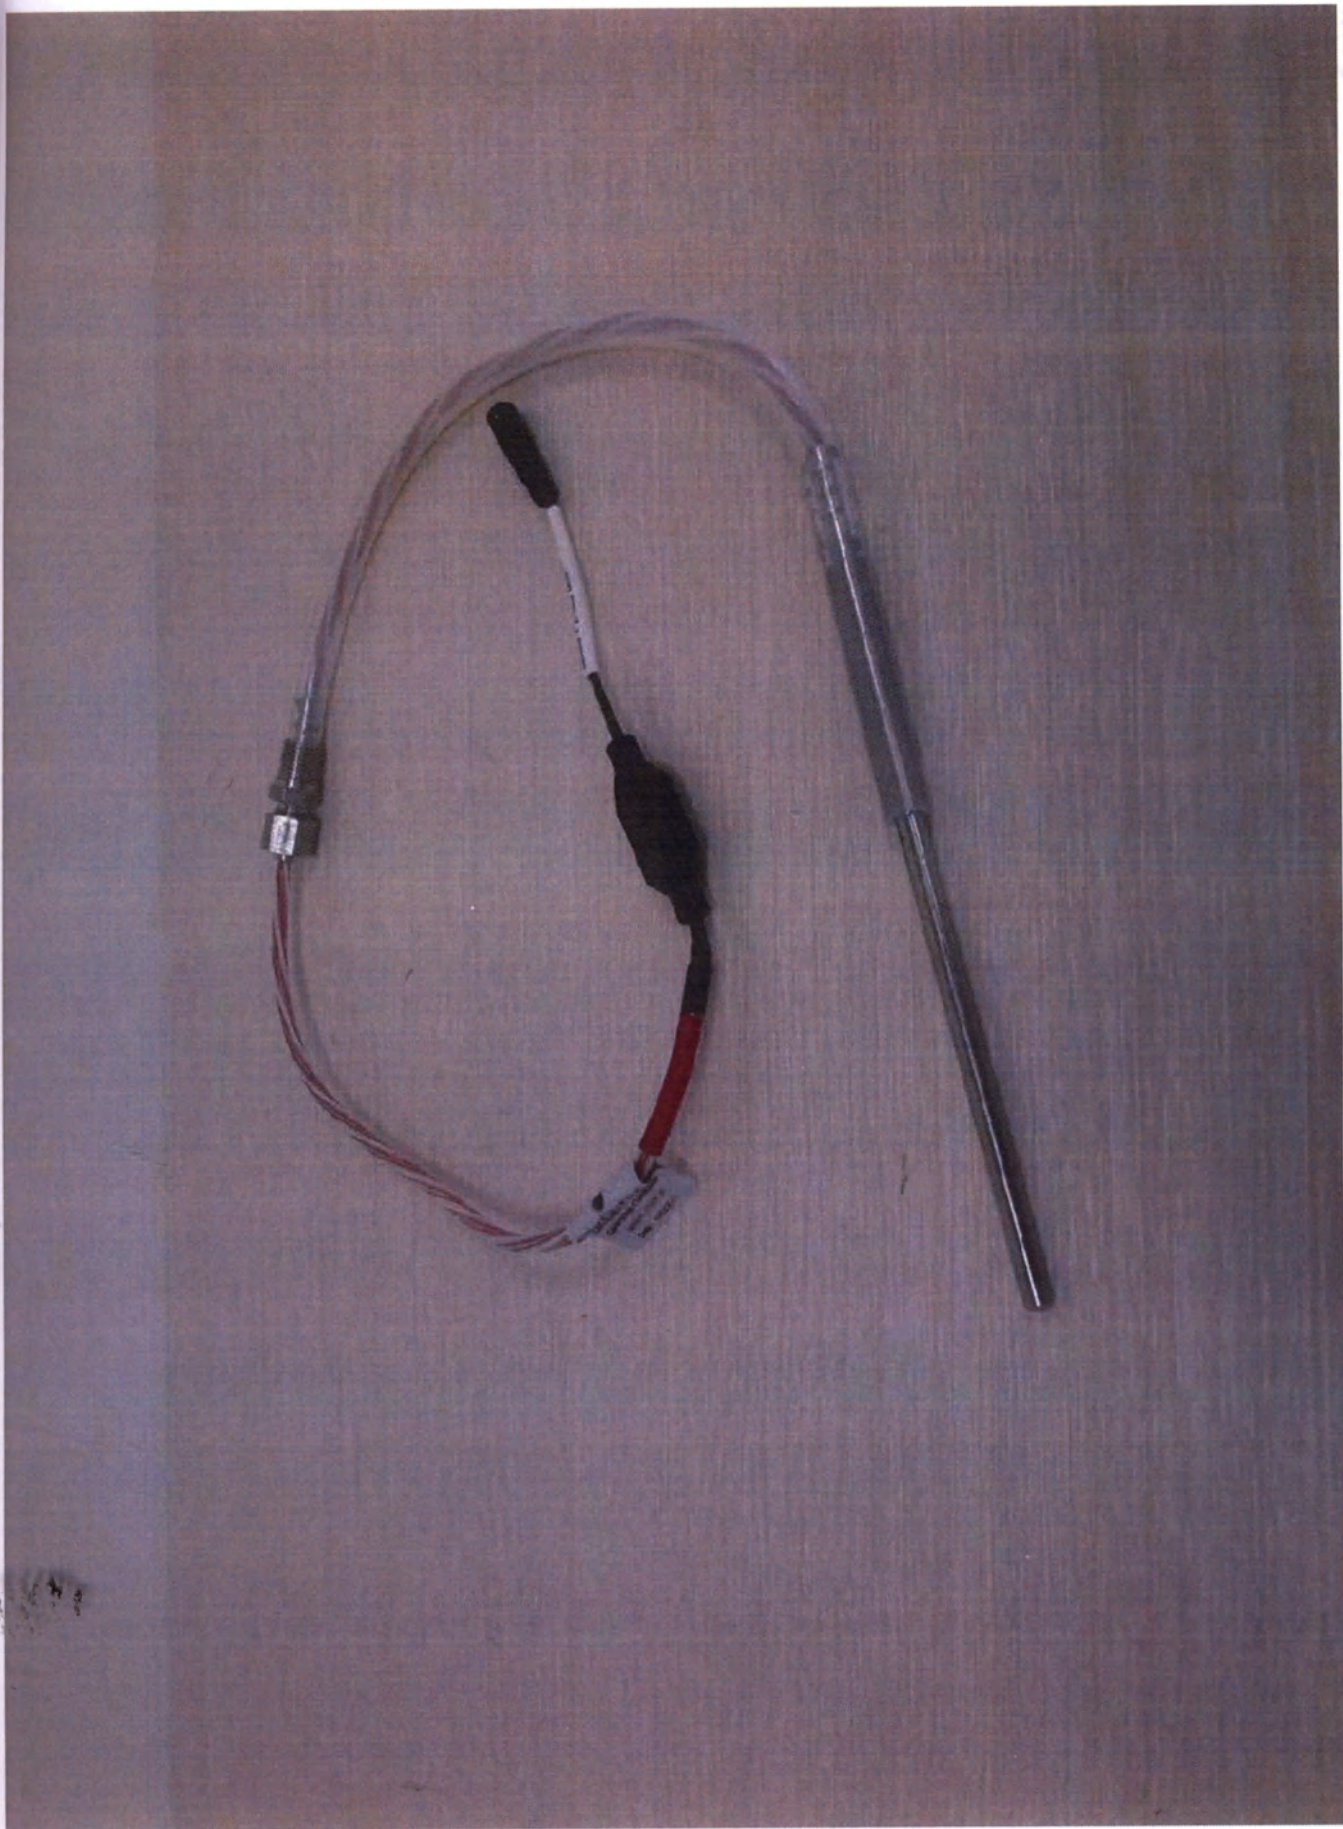




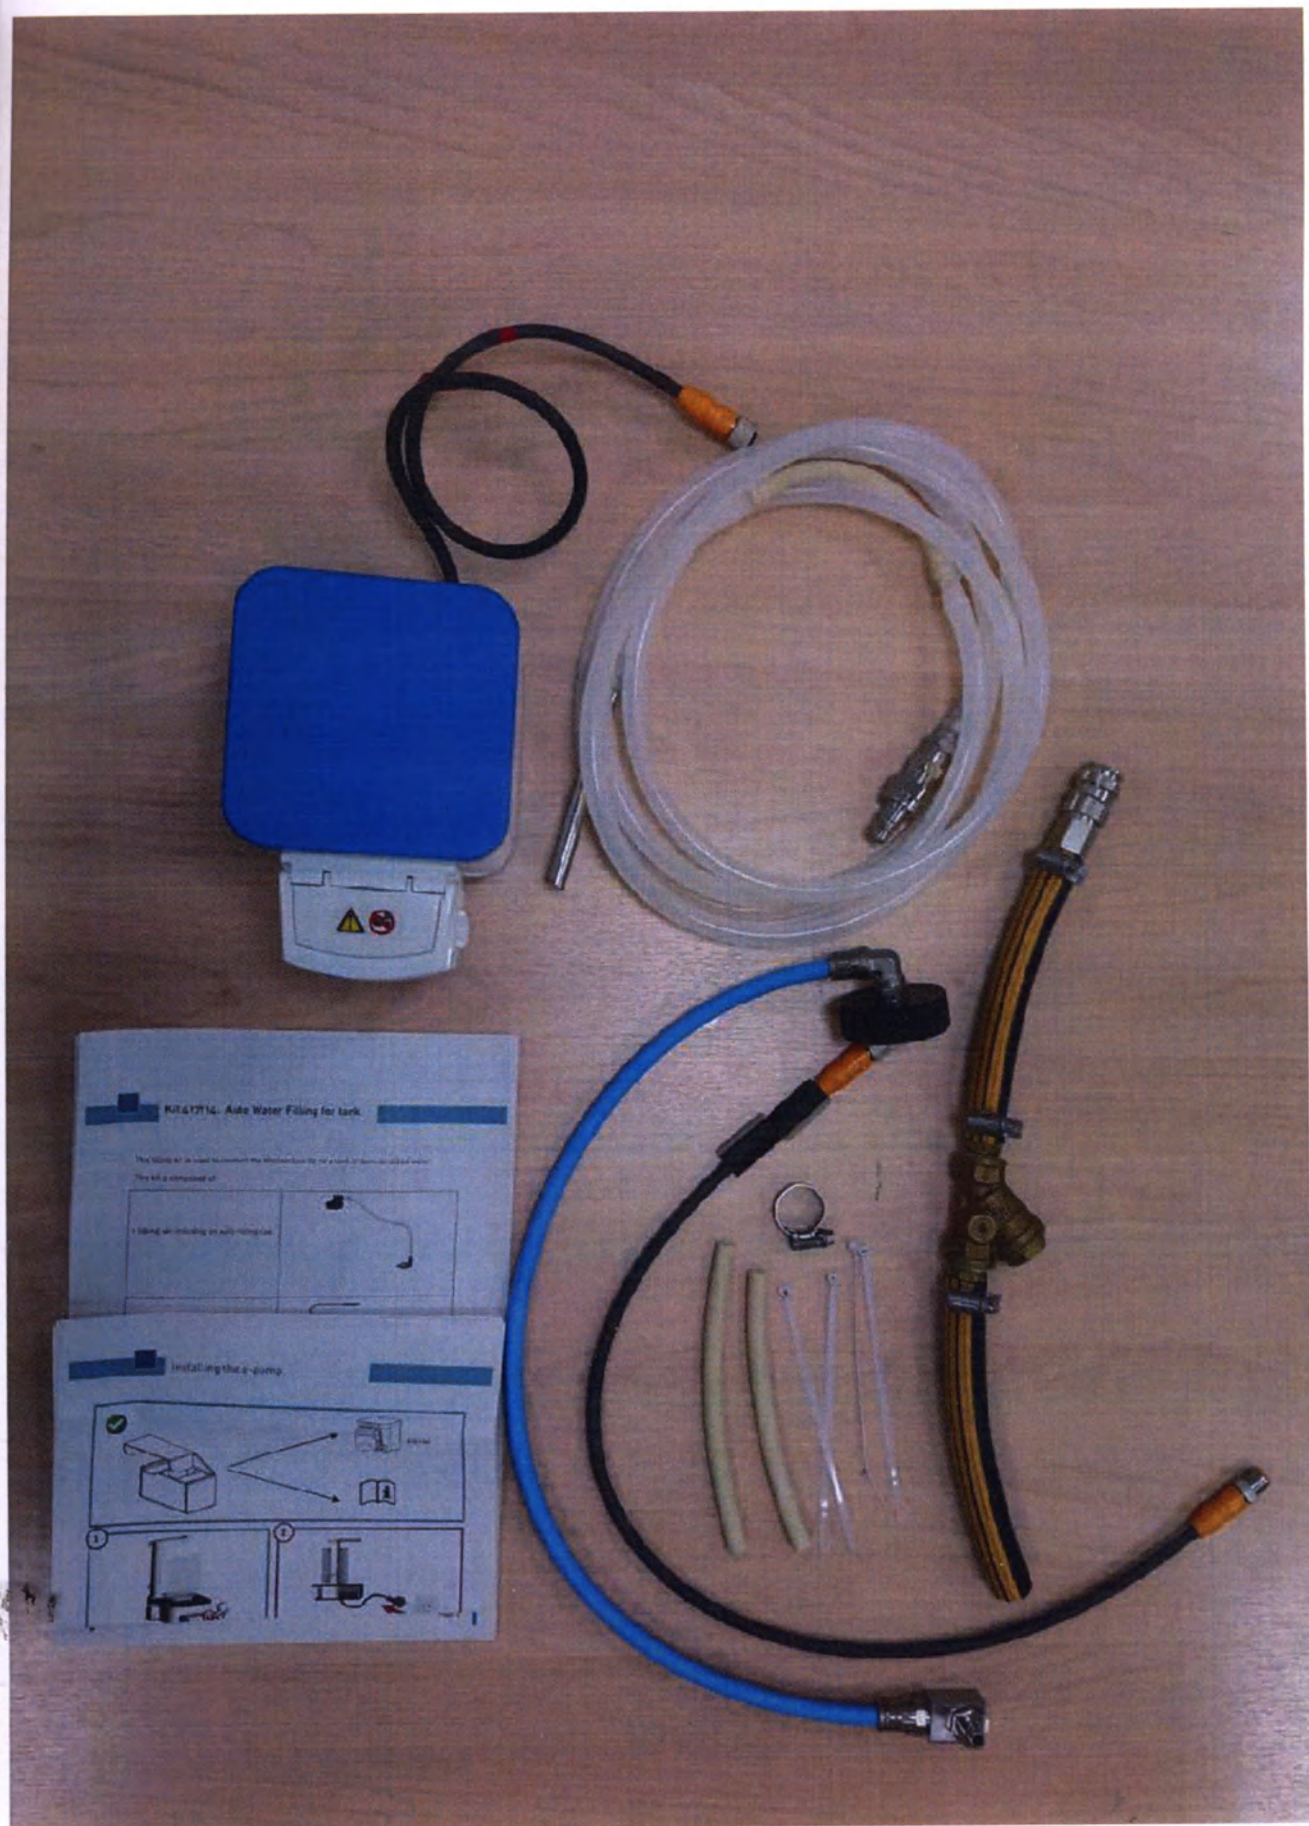







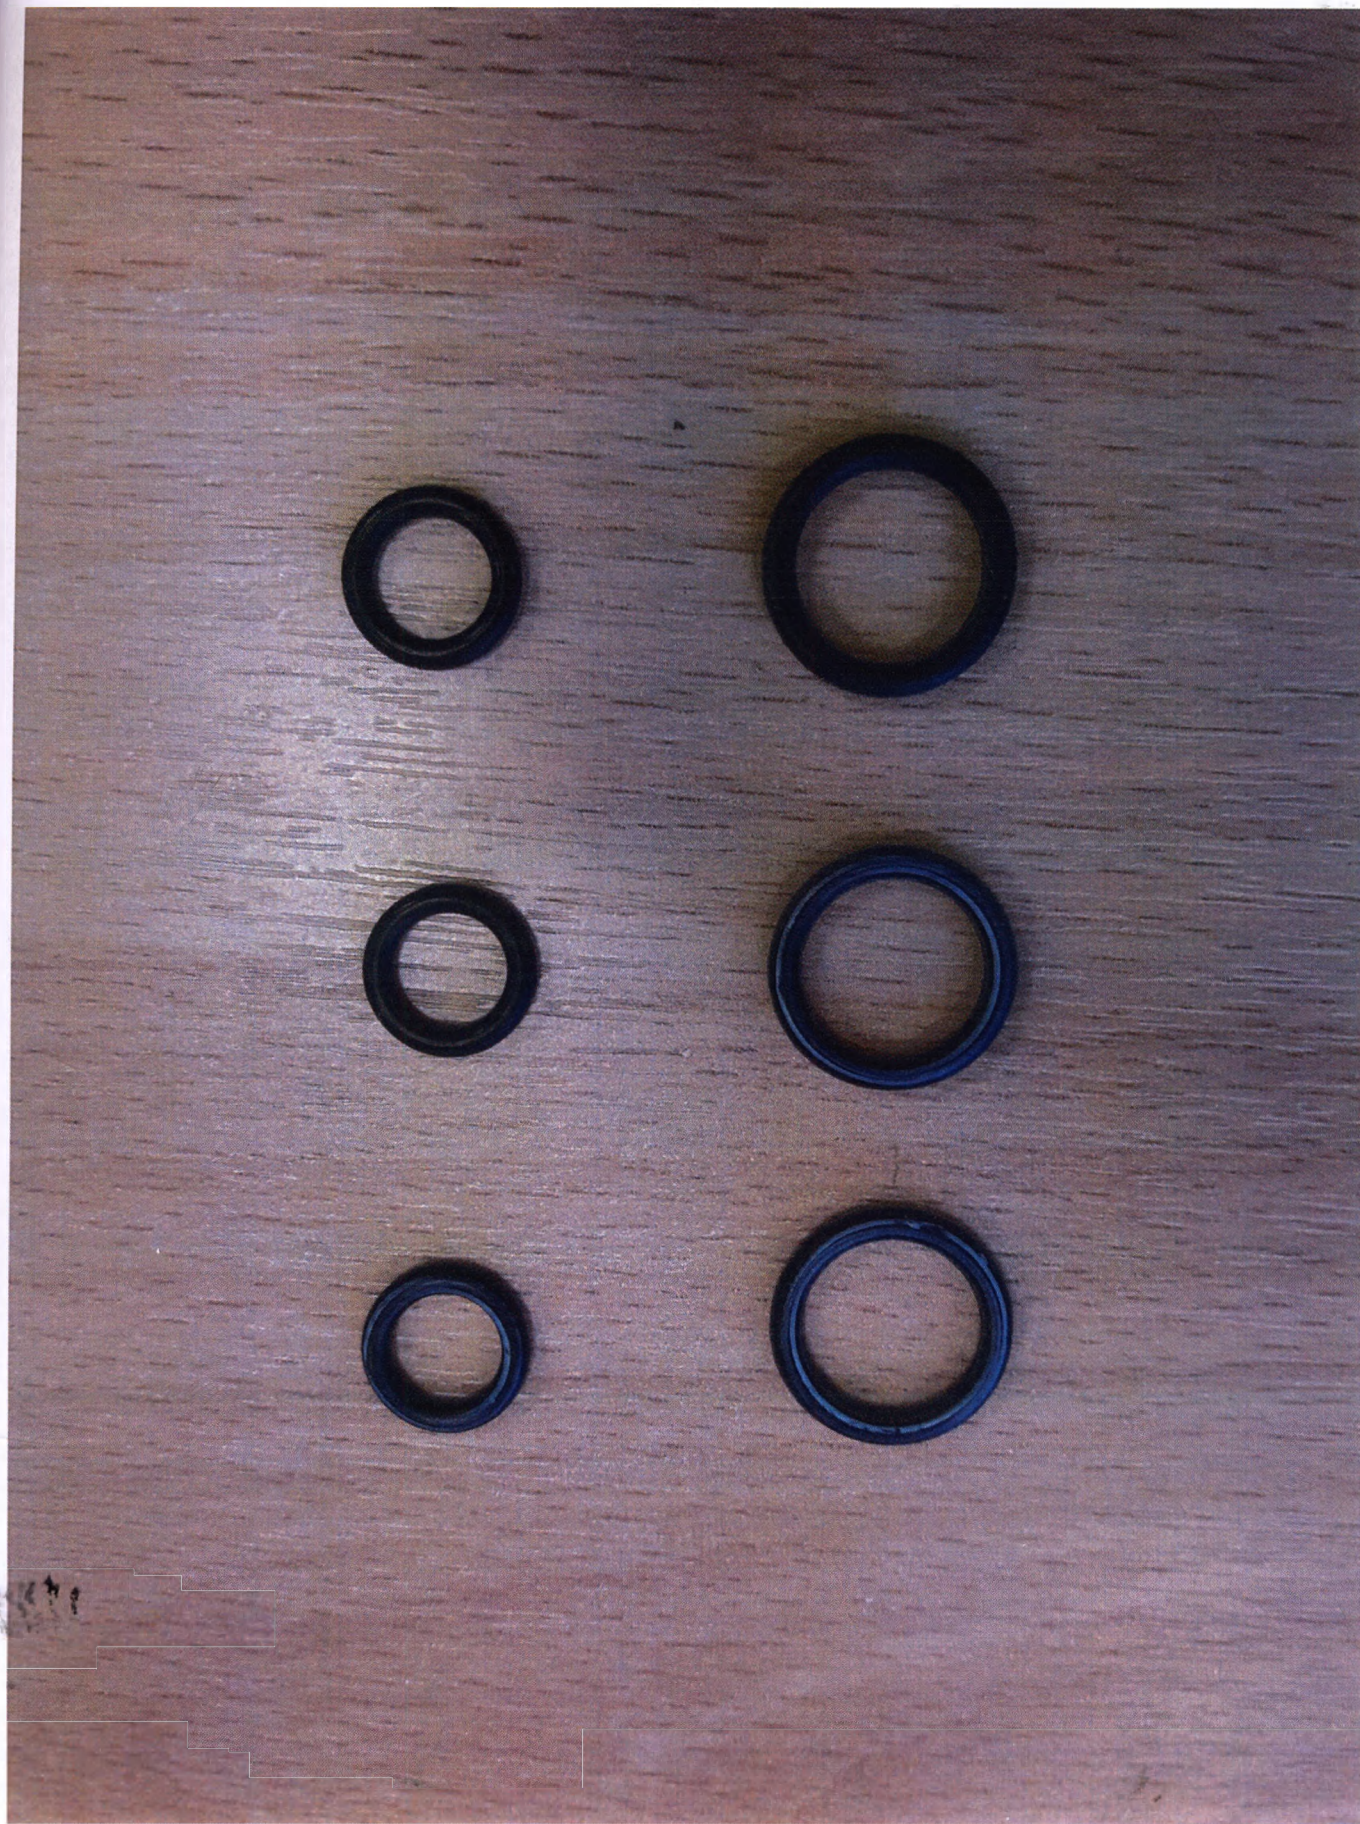
















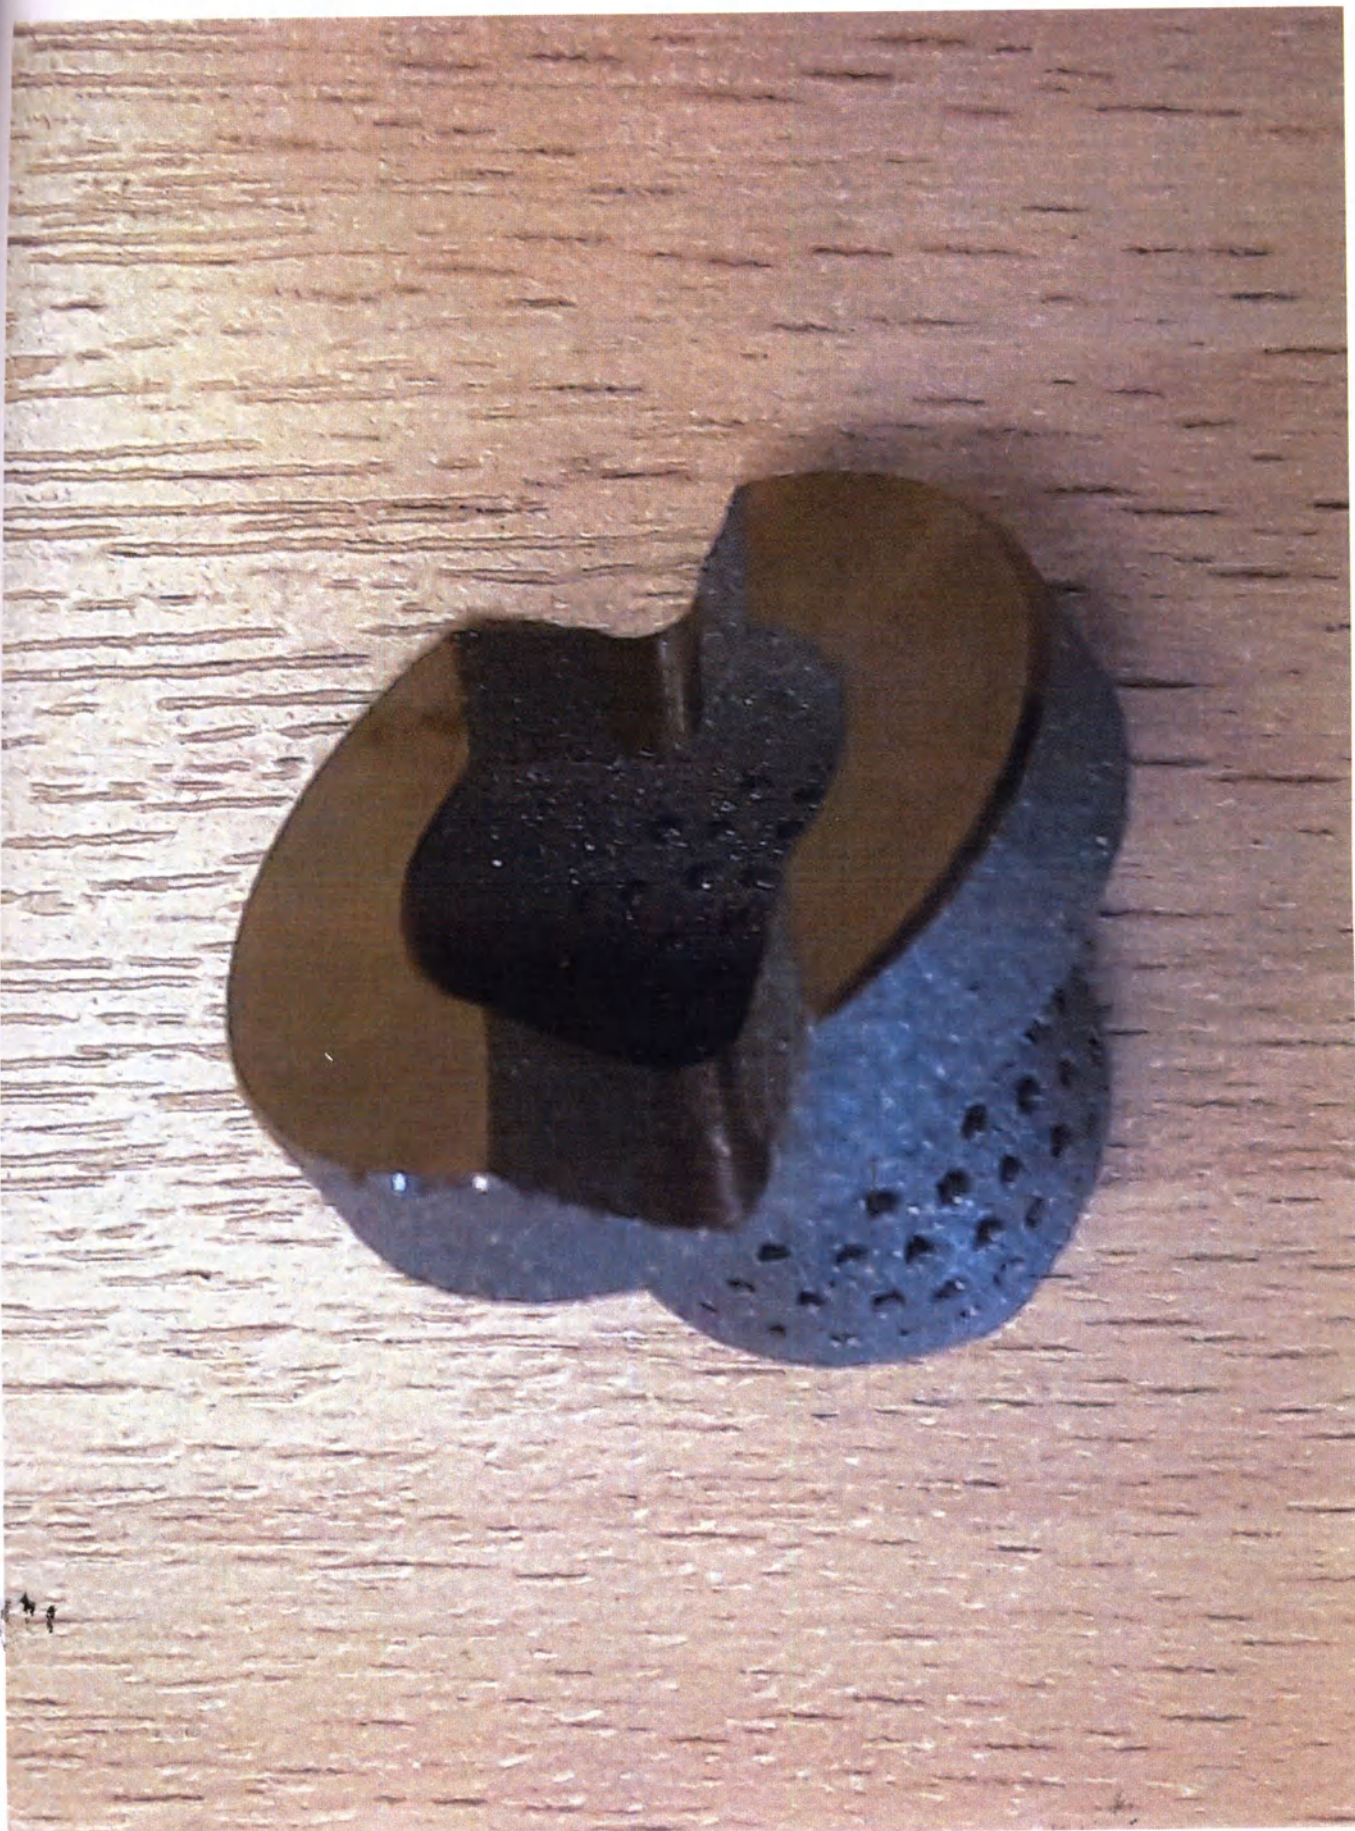





Masterclave

AN108113:04-12-13:8

3. Poser le septum au centre de l'embase septum et visser fermement l'écrou de maintien de septum




4. Revisser le bouchon d'ajout sur l'embase sans le serrer (juste en contact)



!
Le bouchon d'ajout ne doit en aucun cas être fortement serré sur l'embase sous peine de desserrer l'ensemble complet lors du retrait



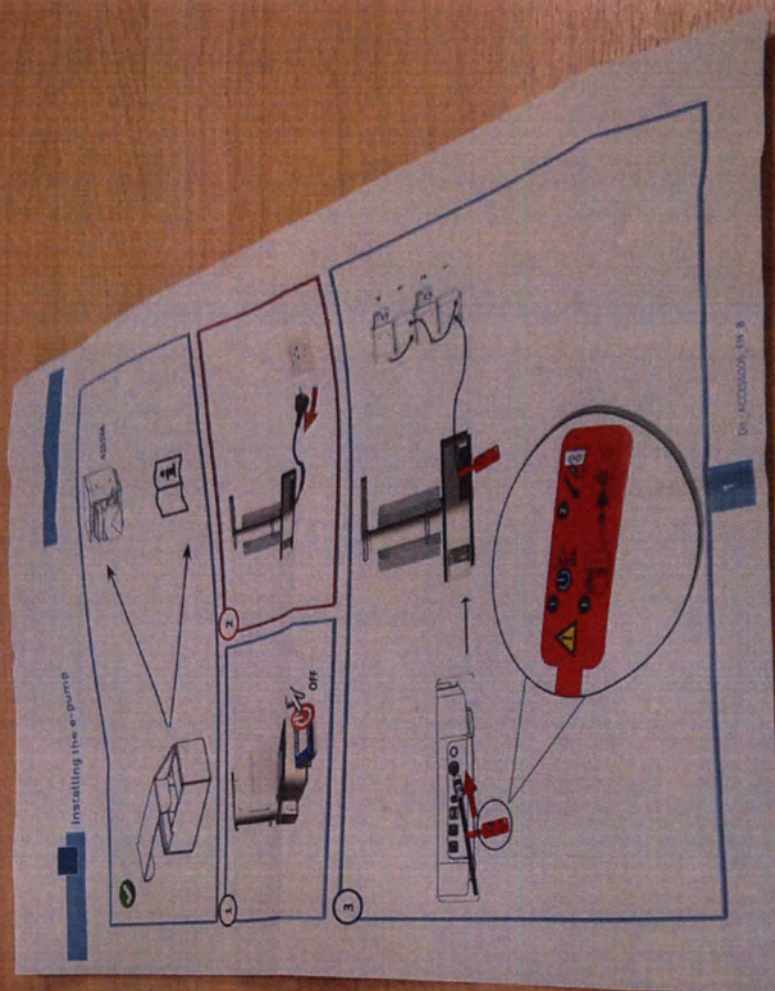





Насос перистальтический РМi (с сопроводительной документацией на бумажном носителе и электронных носителях))


















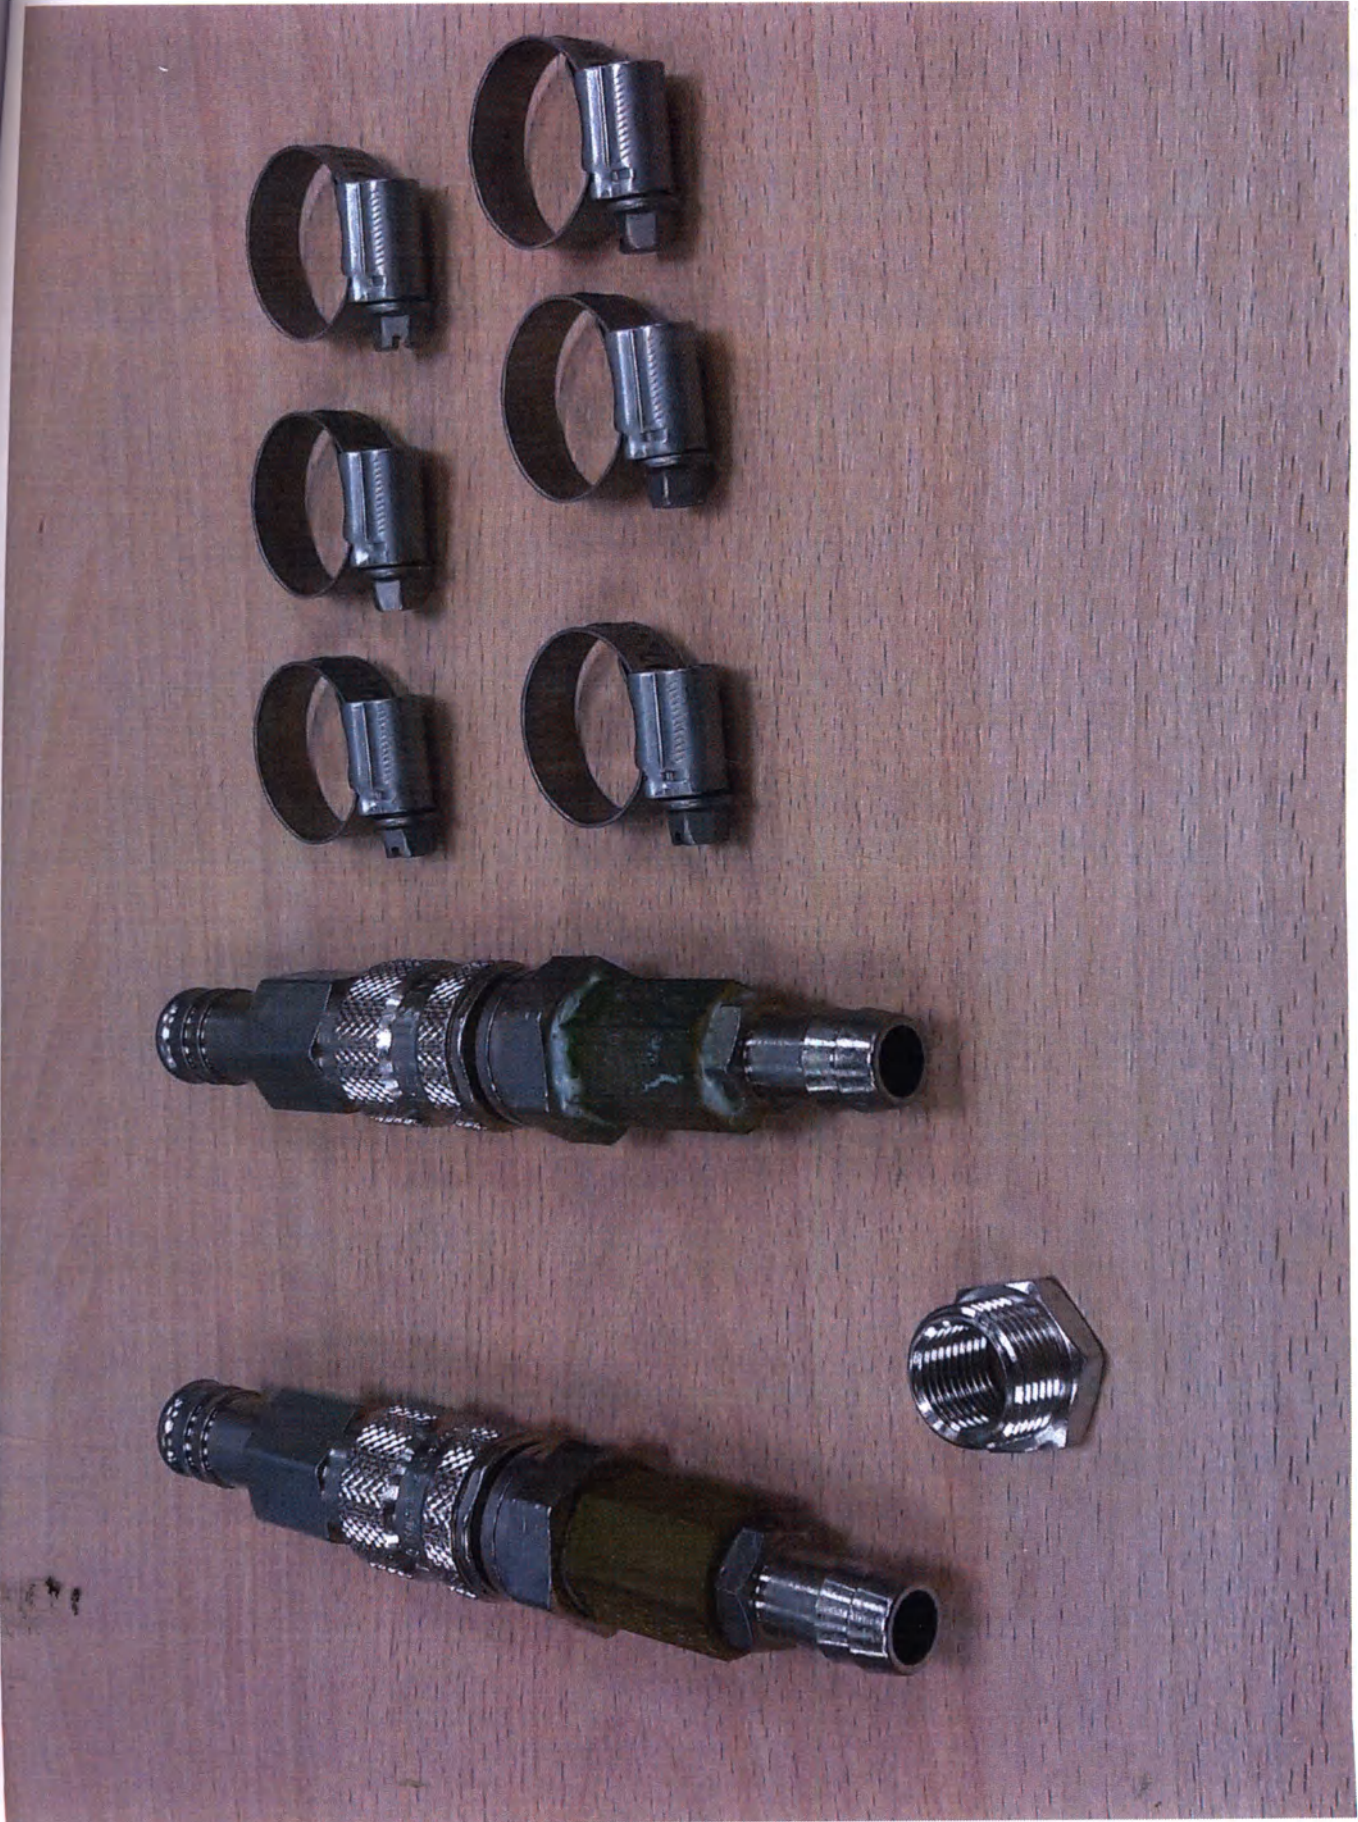



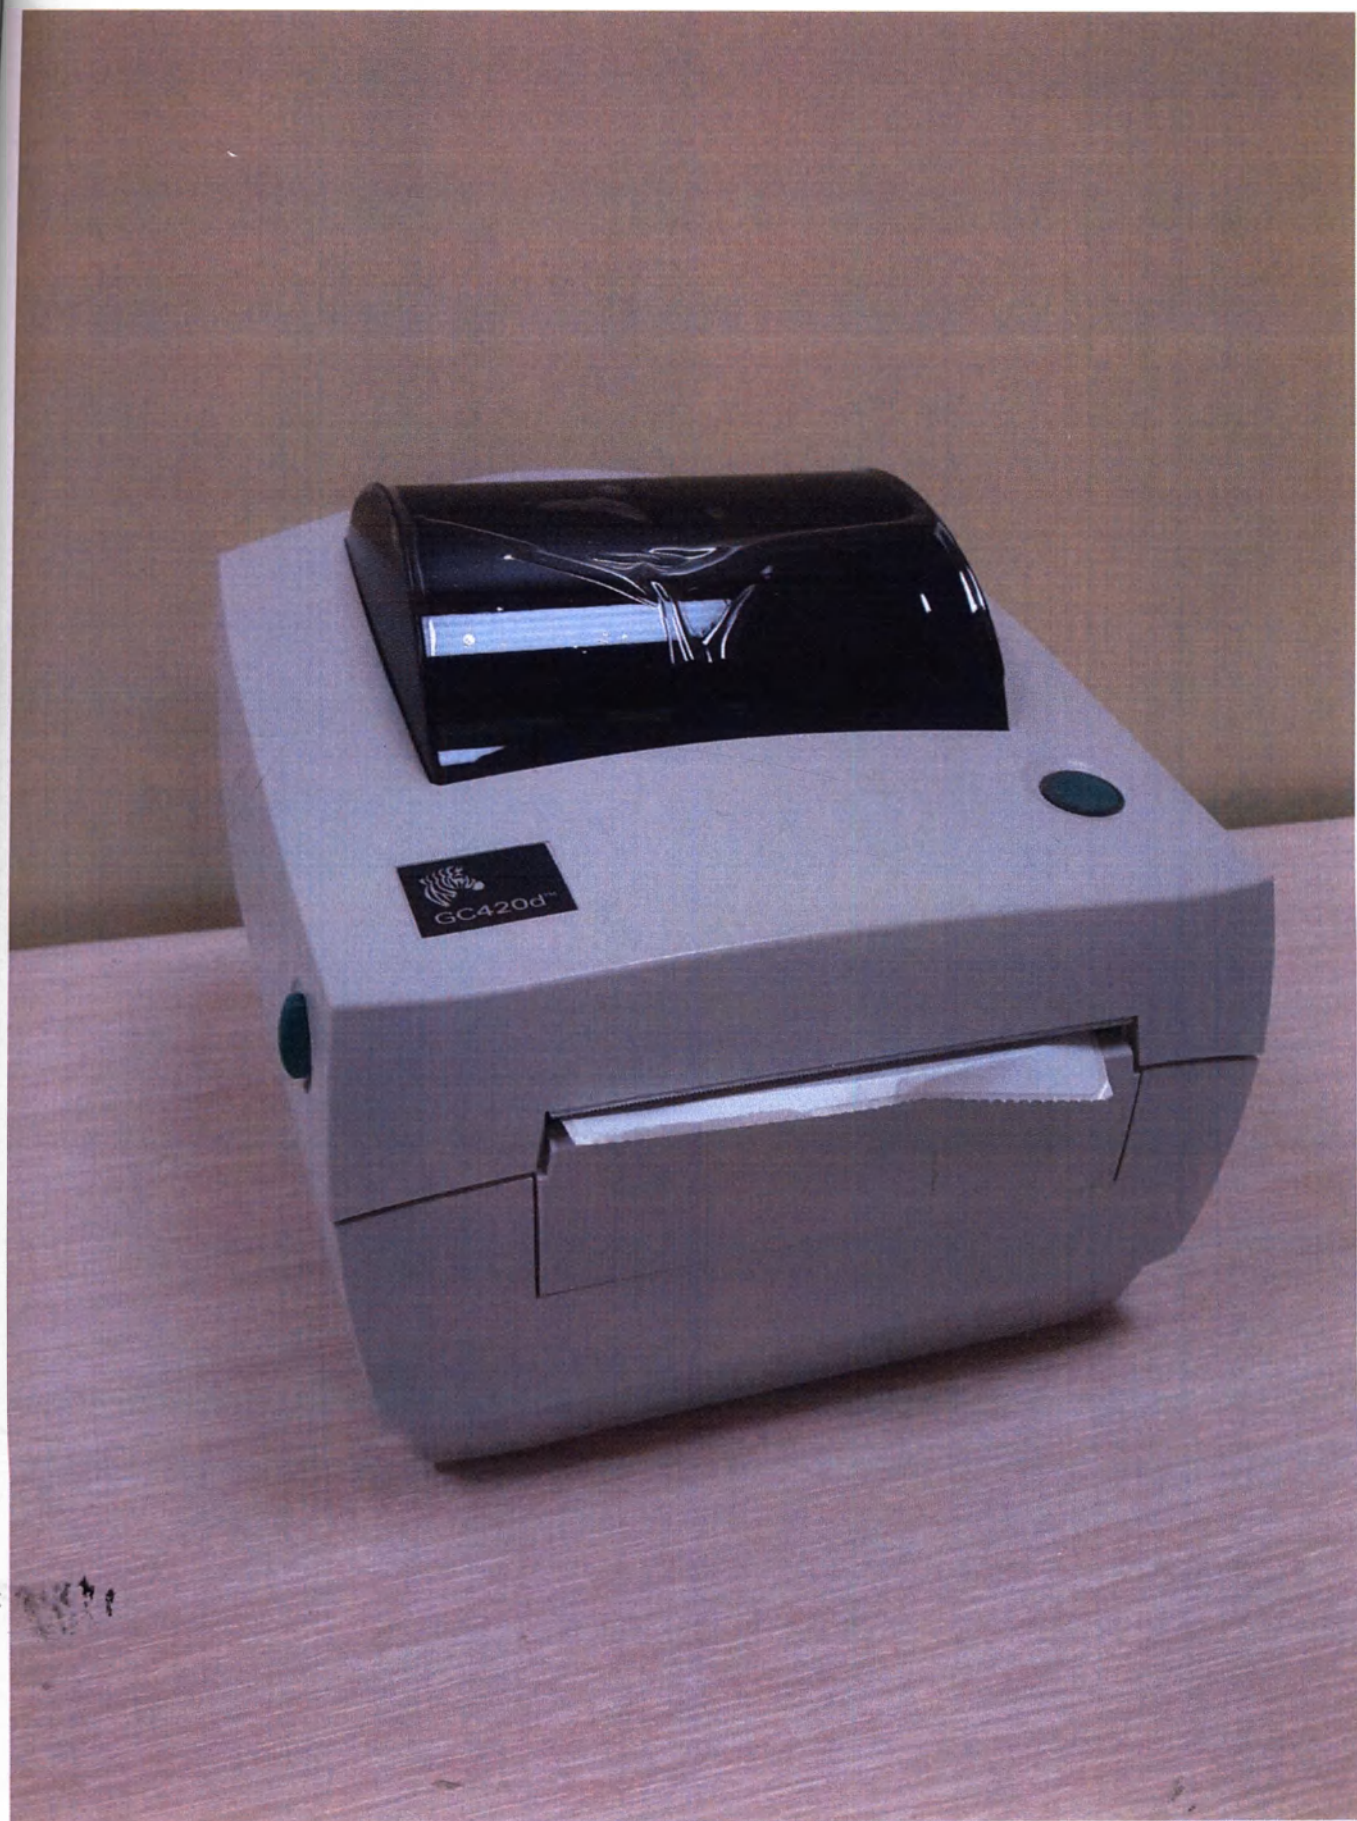

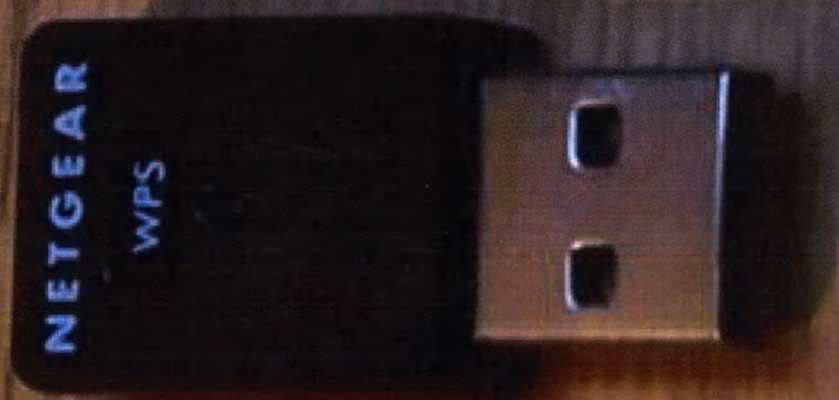













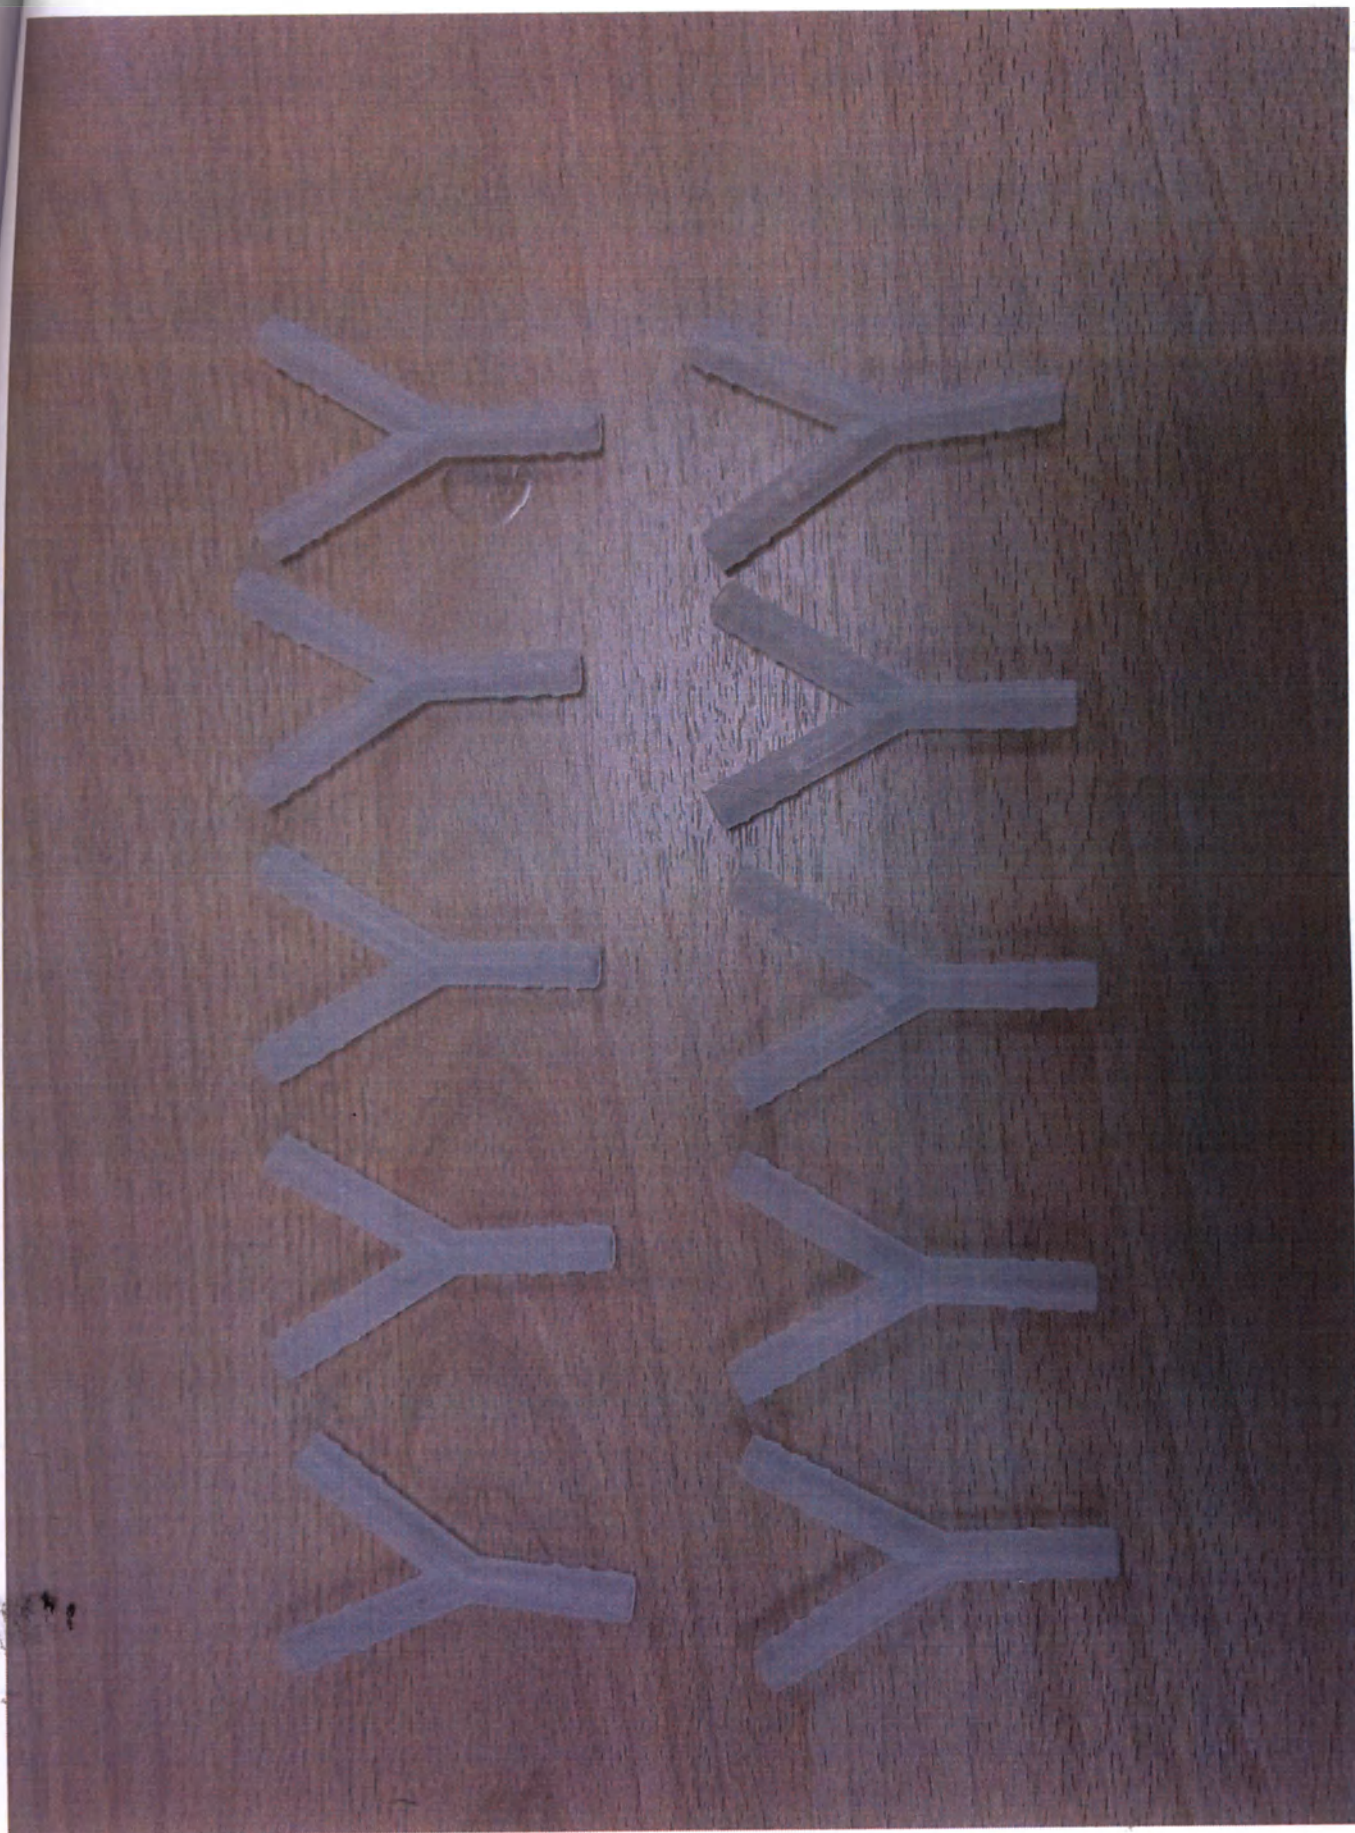



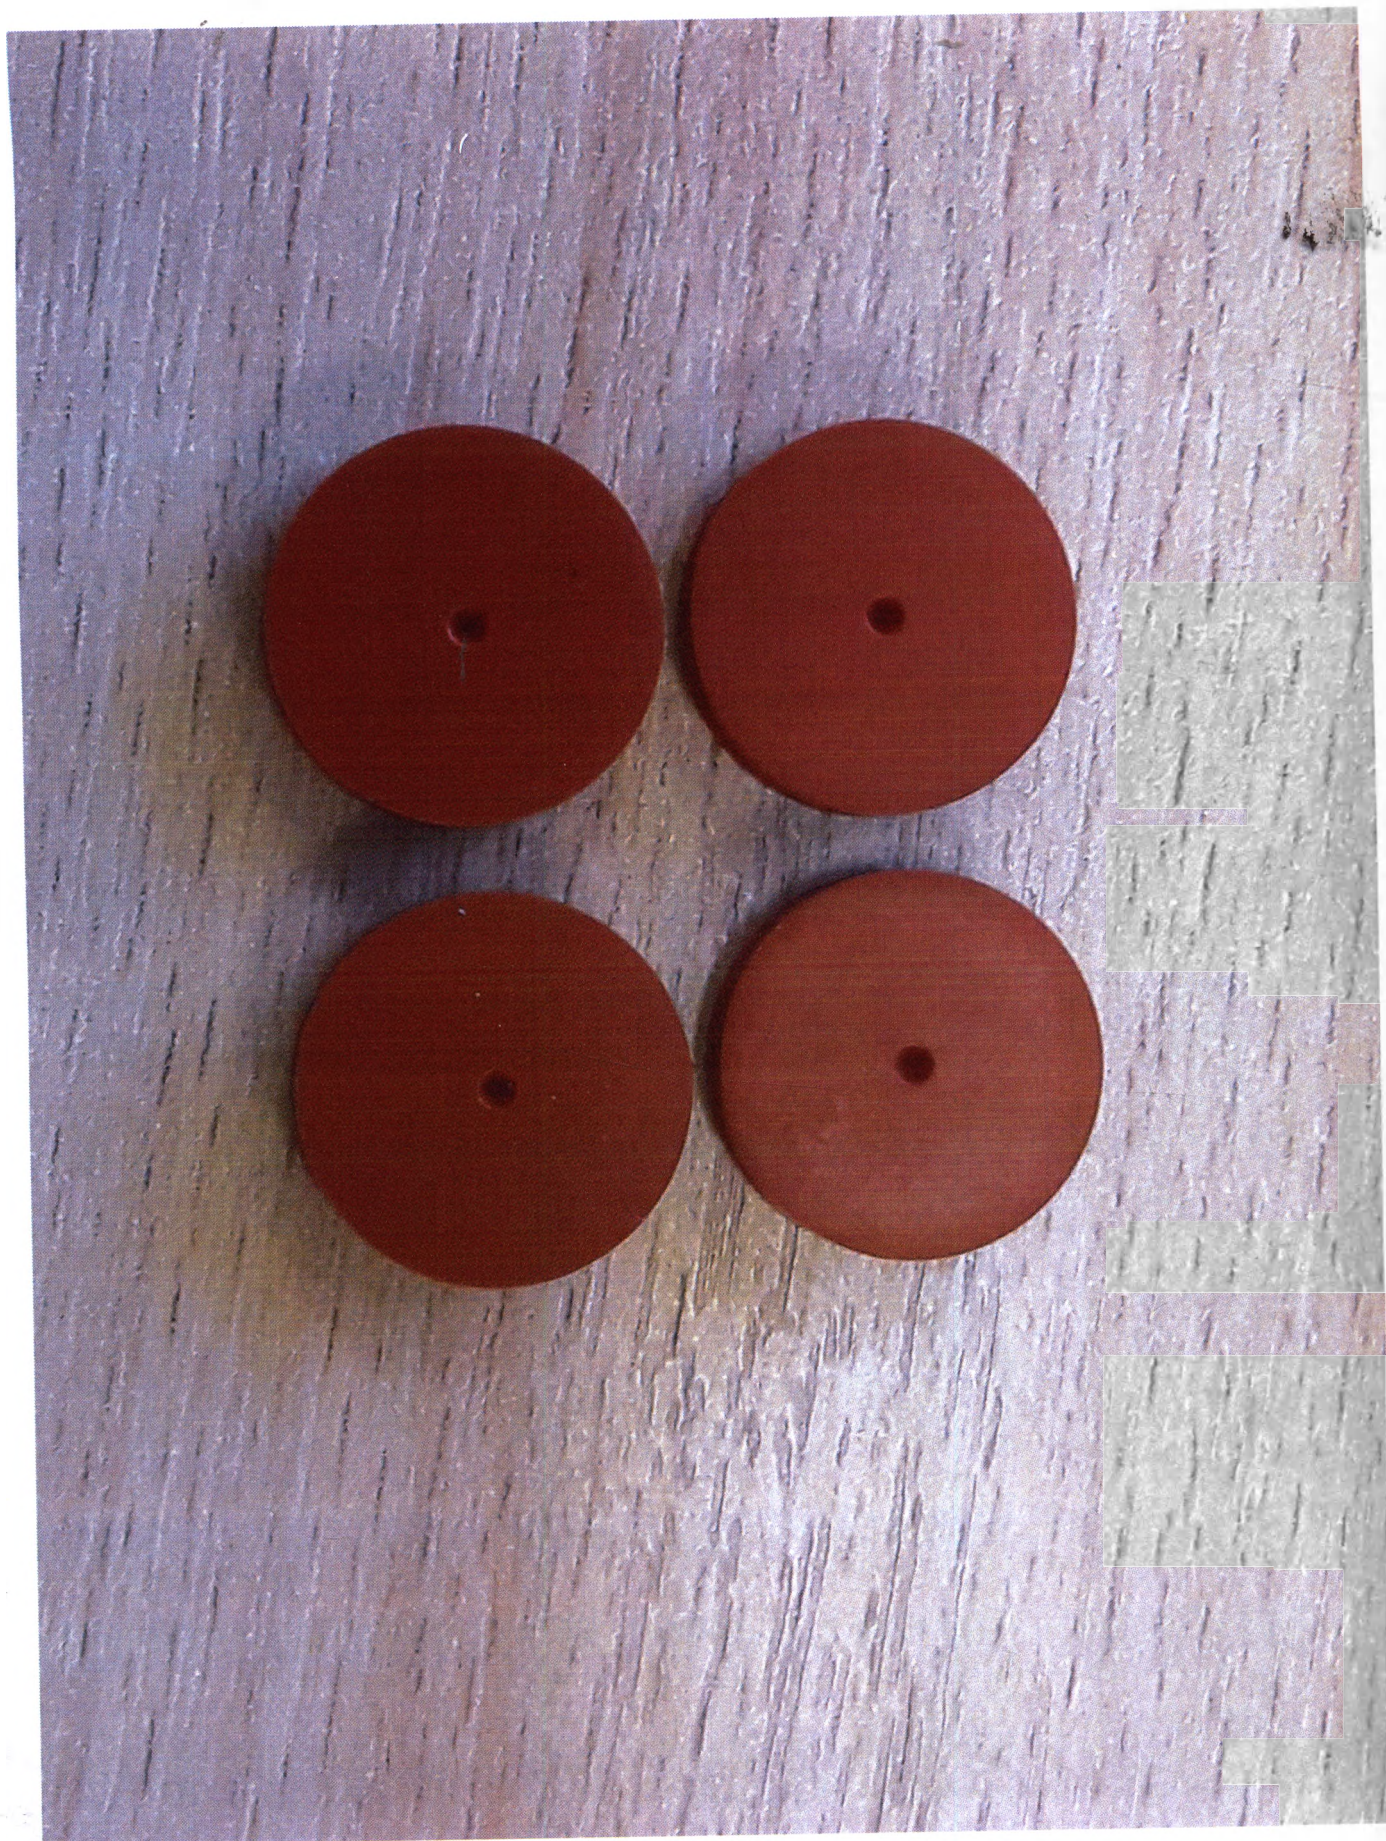












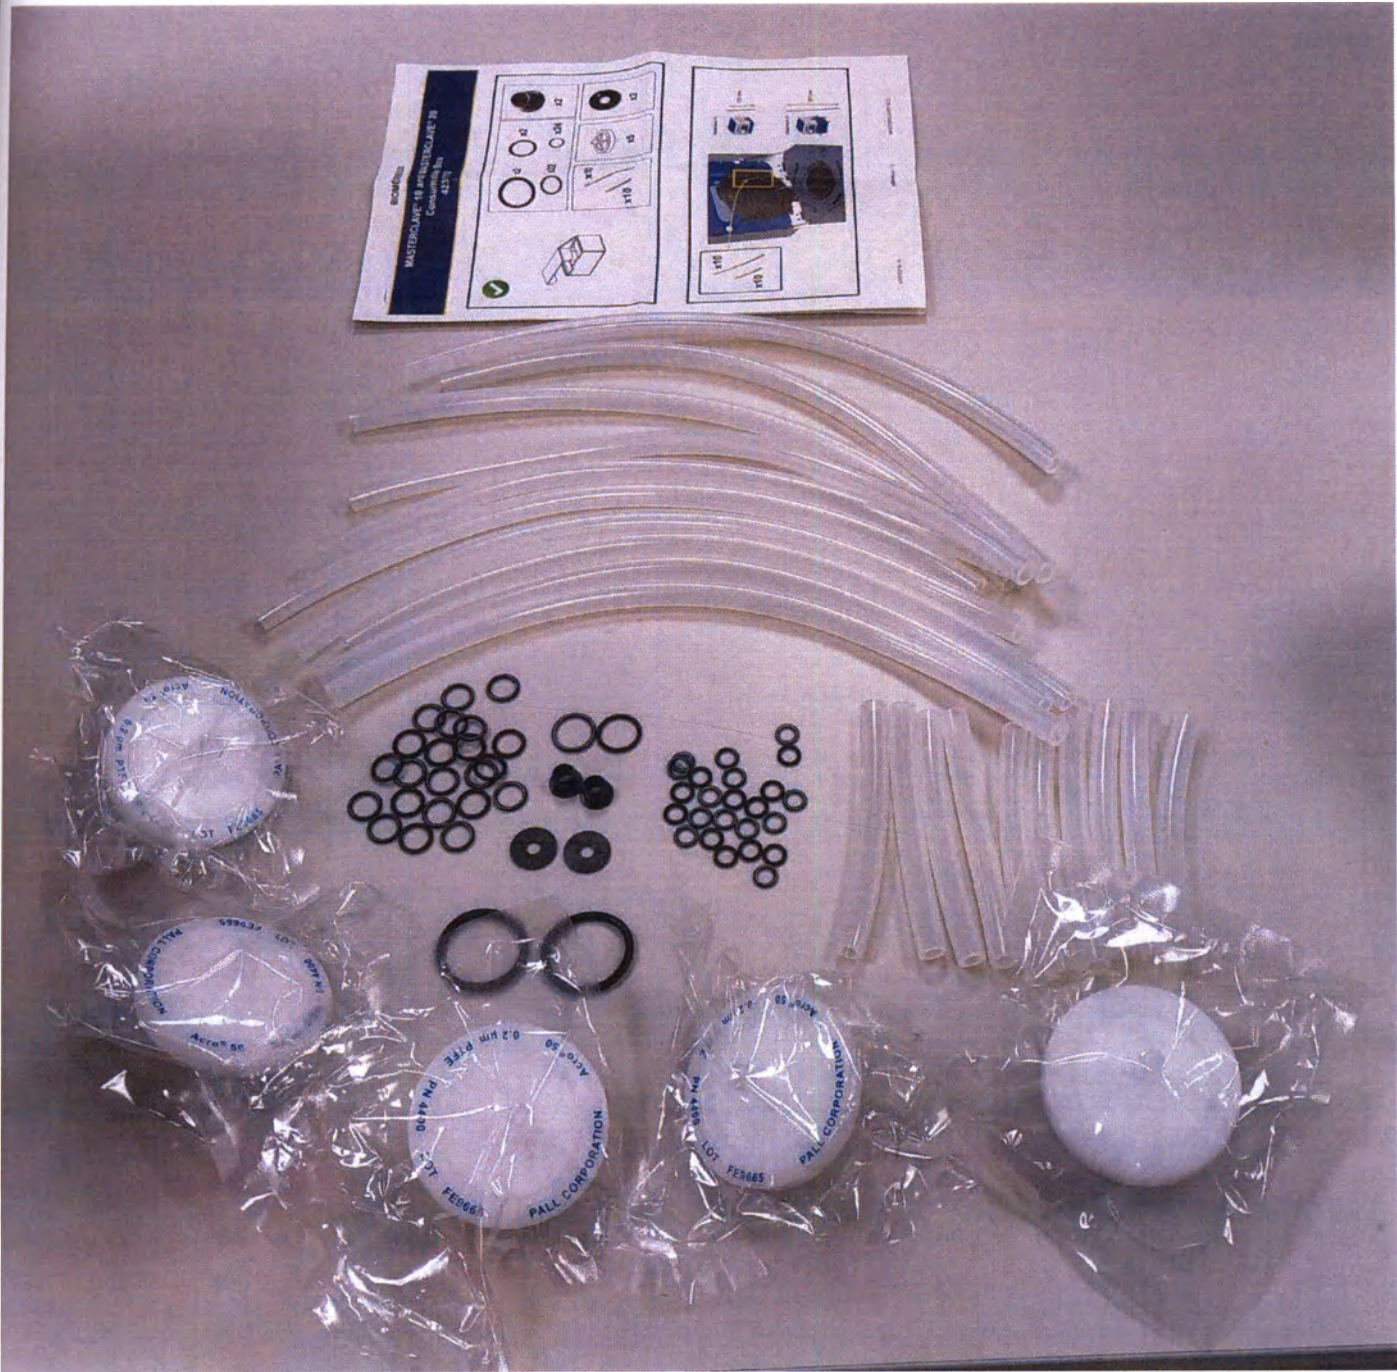

- уплотнитель большой для наконечника заправочного - 22 шт.




- уплотнитель малый для наконечника заправочного - 24 шт.



- переходник заправочный гибкий для МС10 - 10 шт.




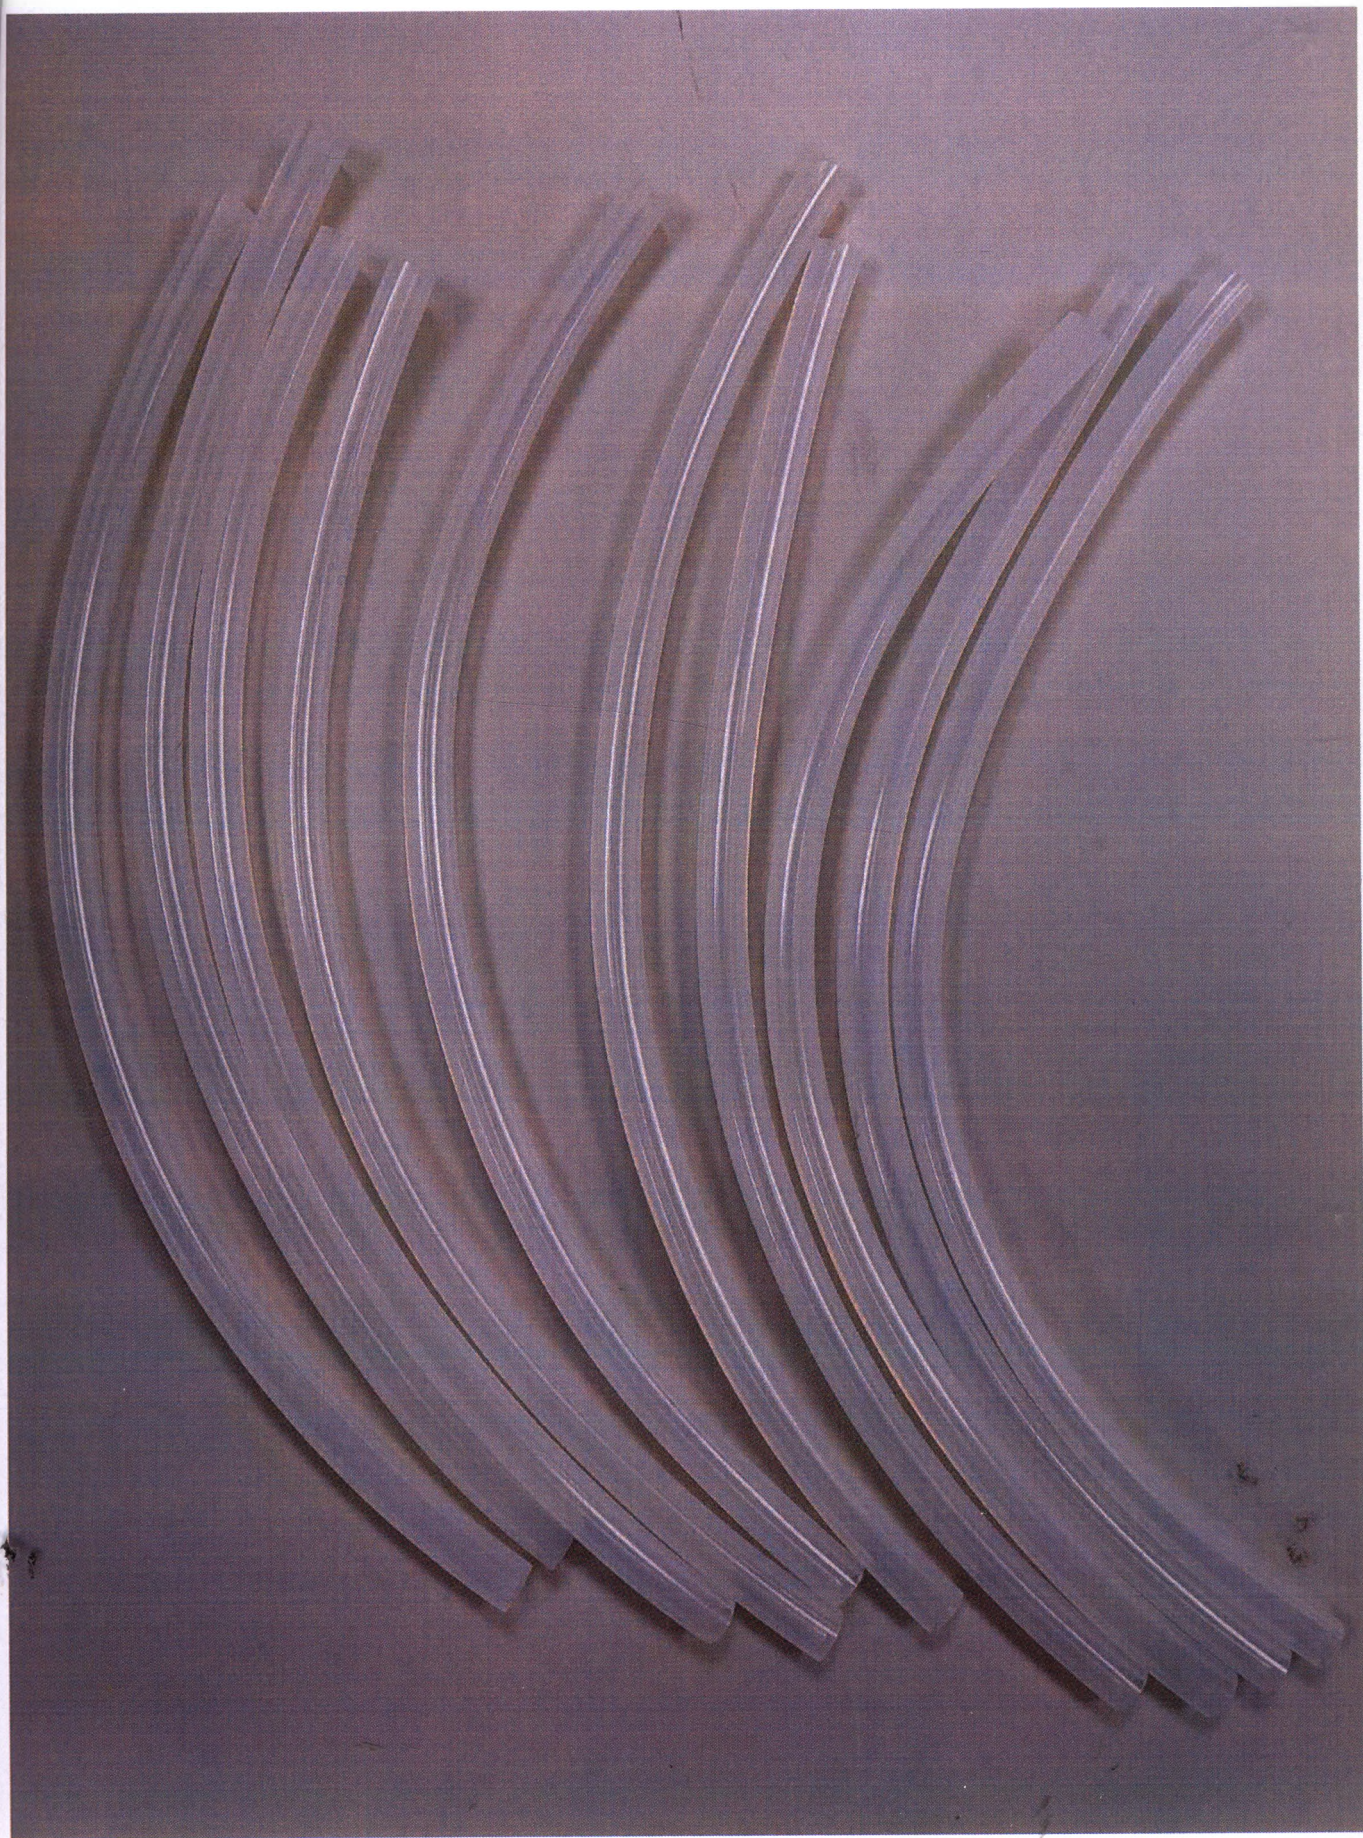


- фильтр декомпрессионный - 5 шт.





- уплотнитель кольцевой внутренней крышки отверстия внесения добавок - 2 шт.

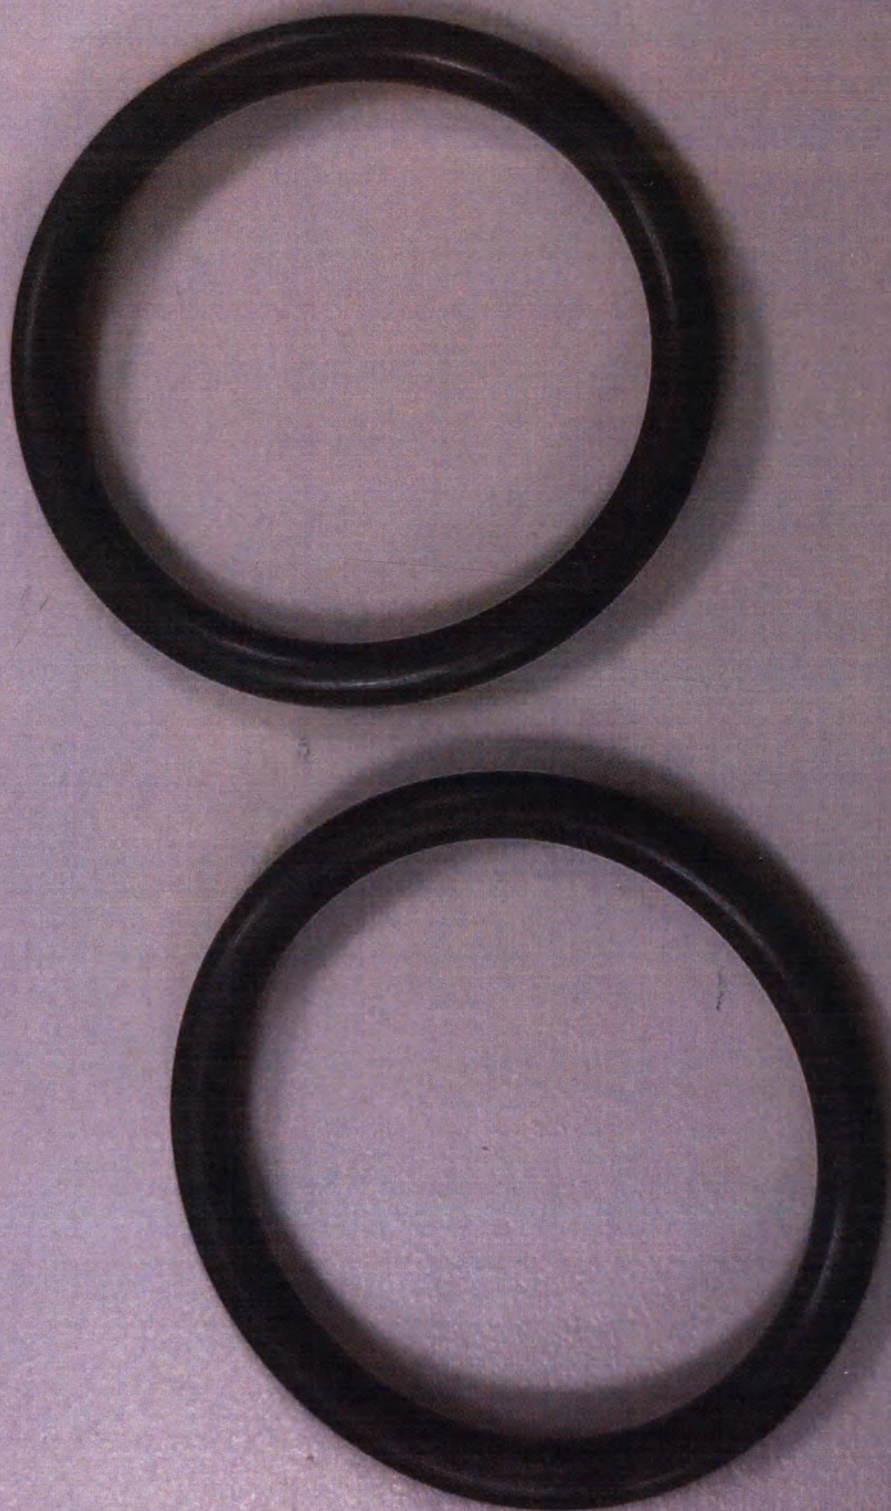


- уплотнитель кольцевой крышки для присоединения магистрали 16 x 2мм - 2 шт.

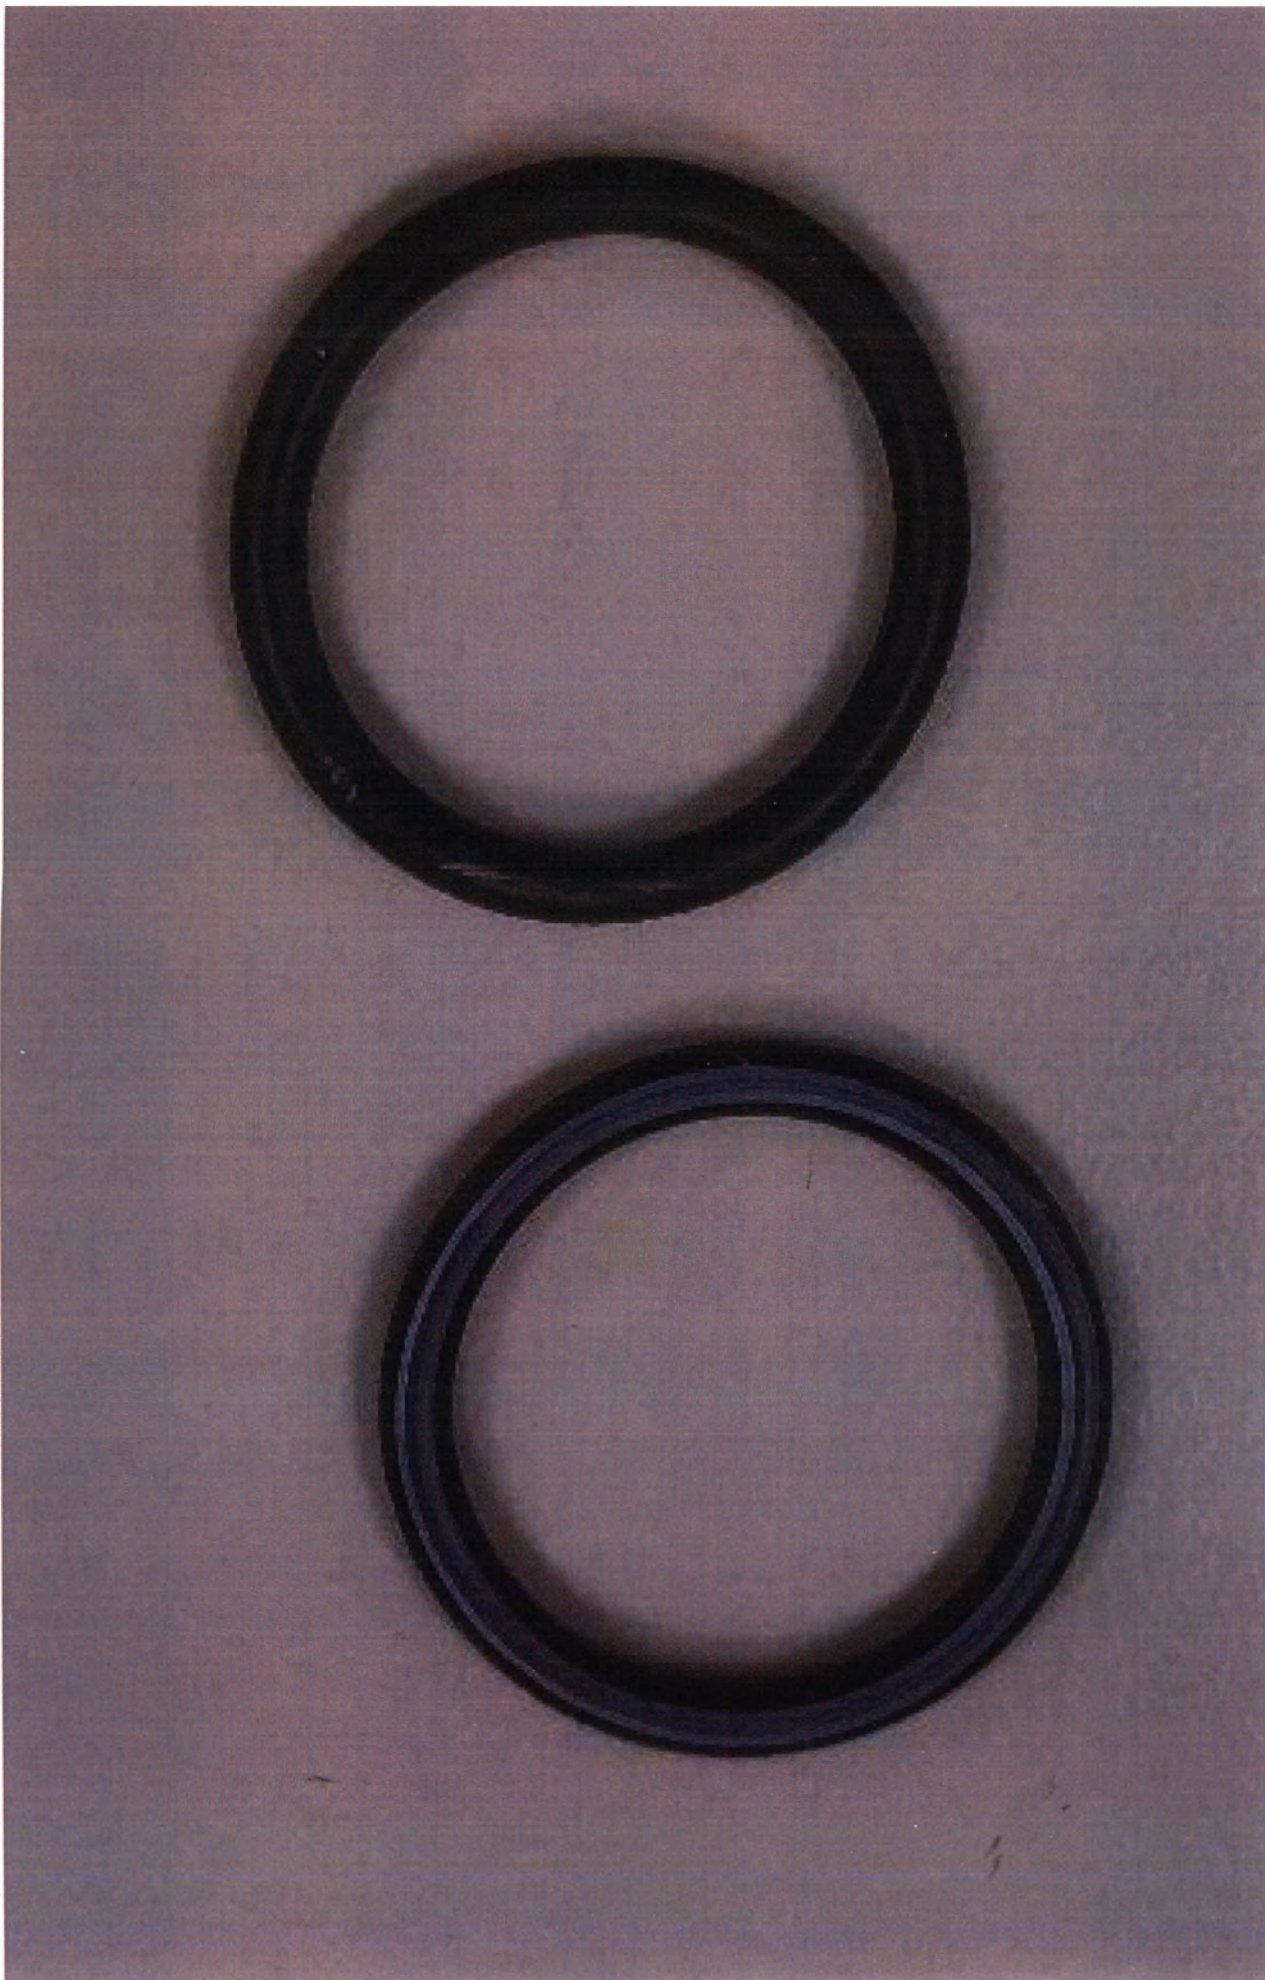


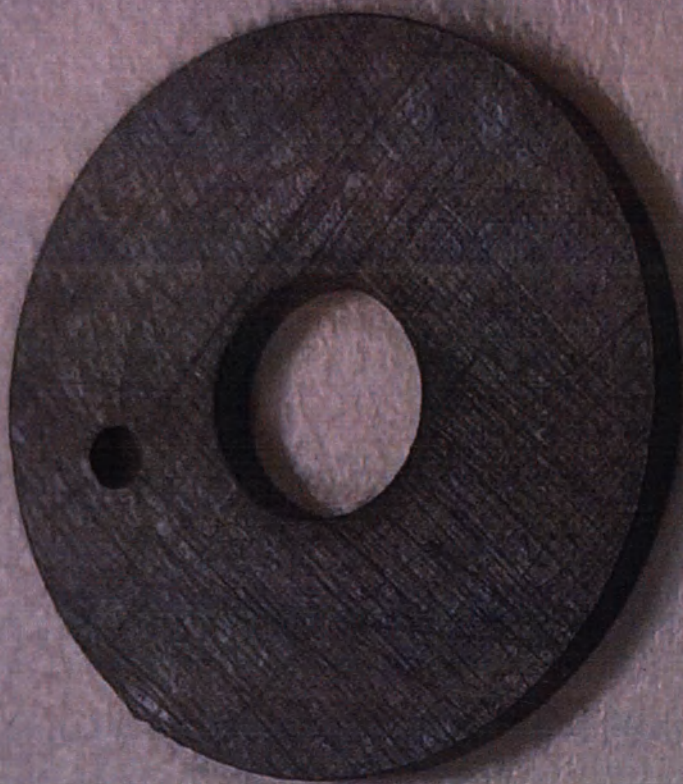

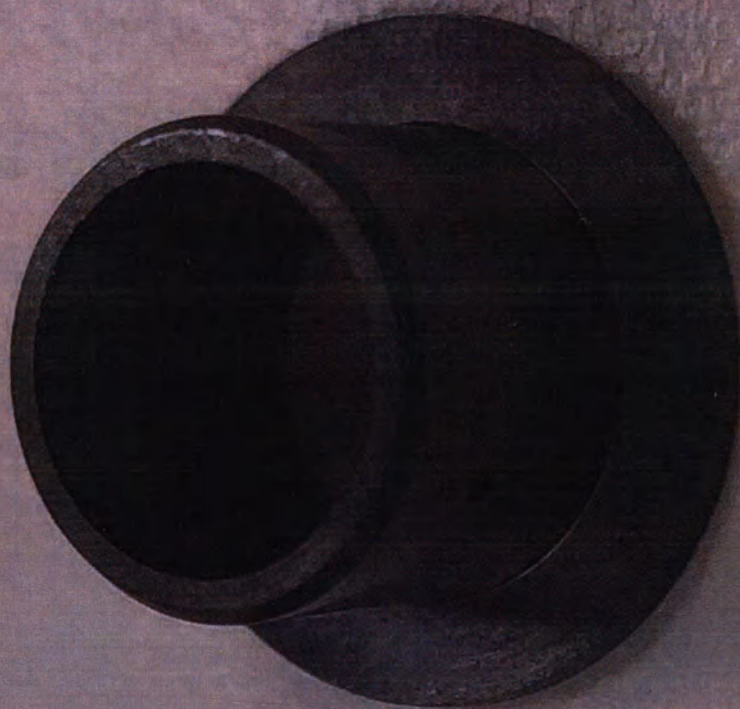



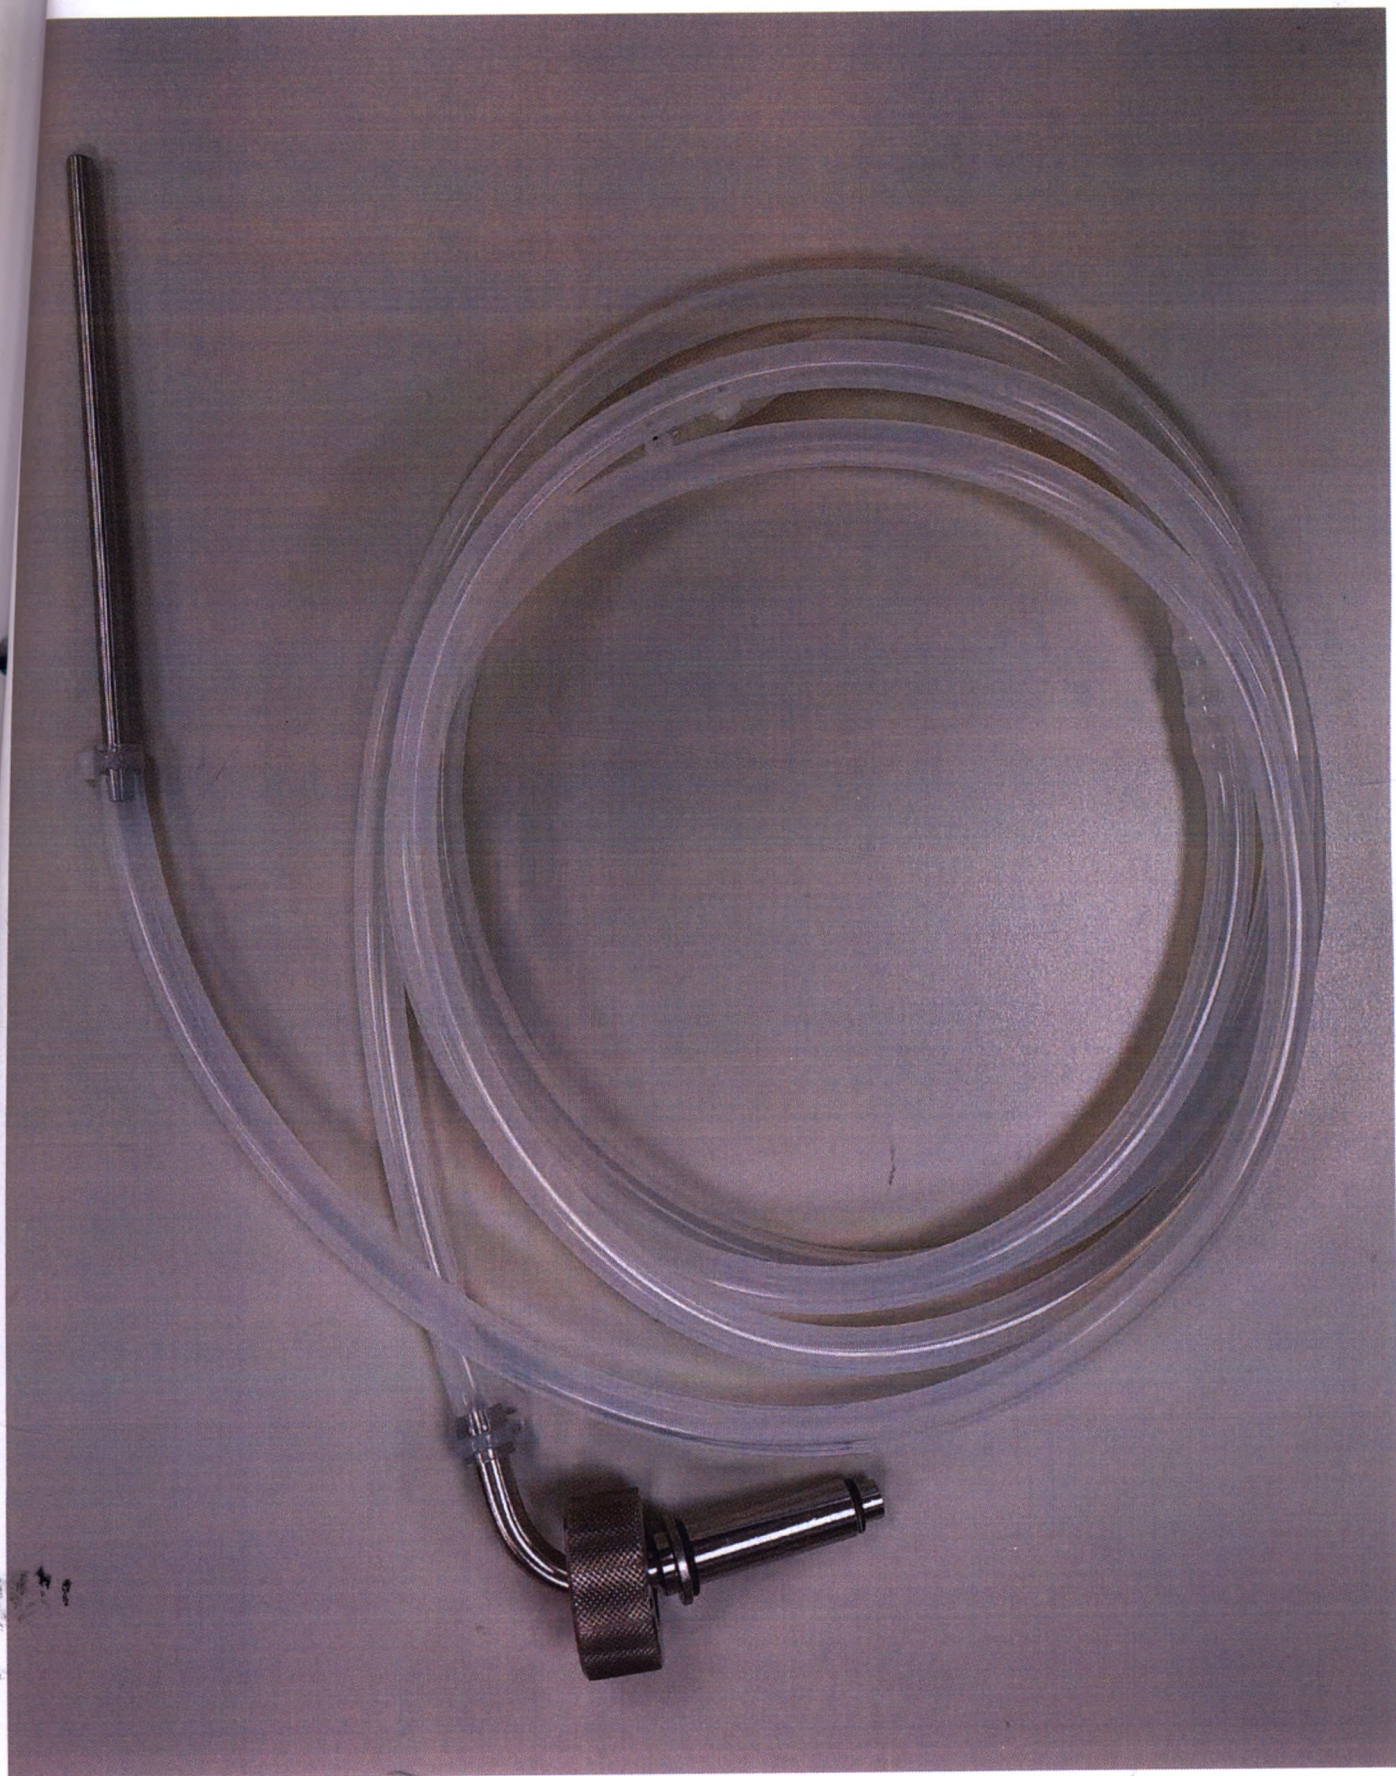

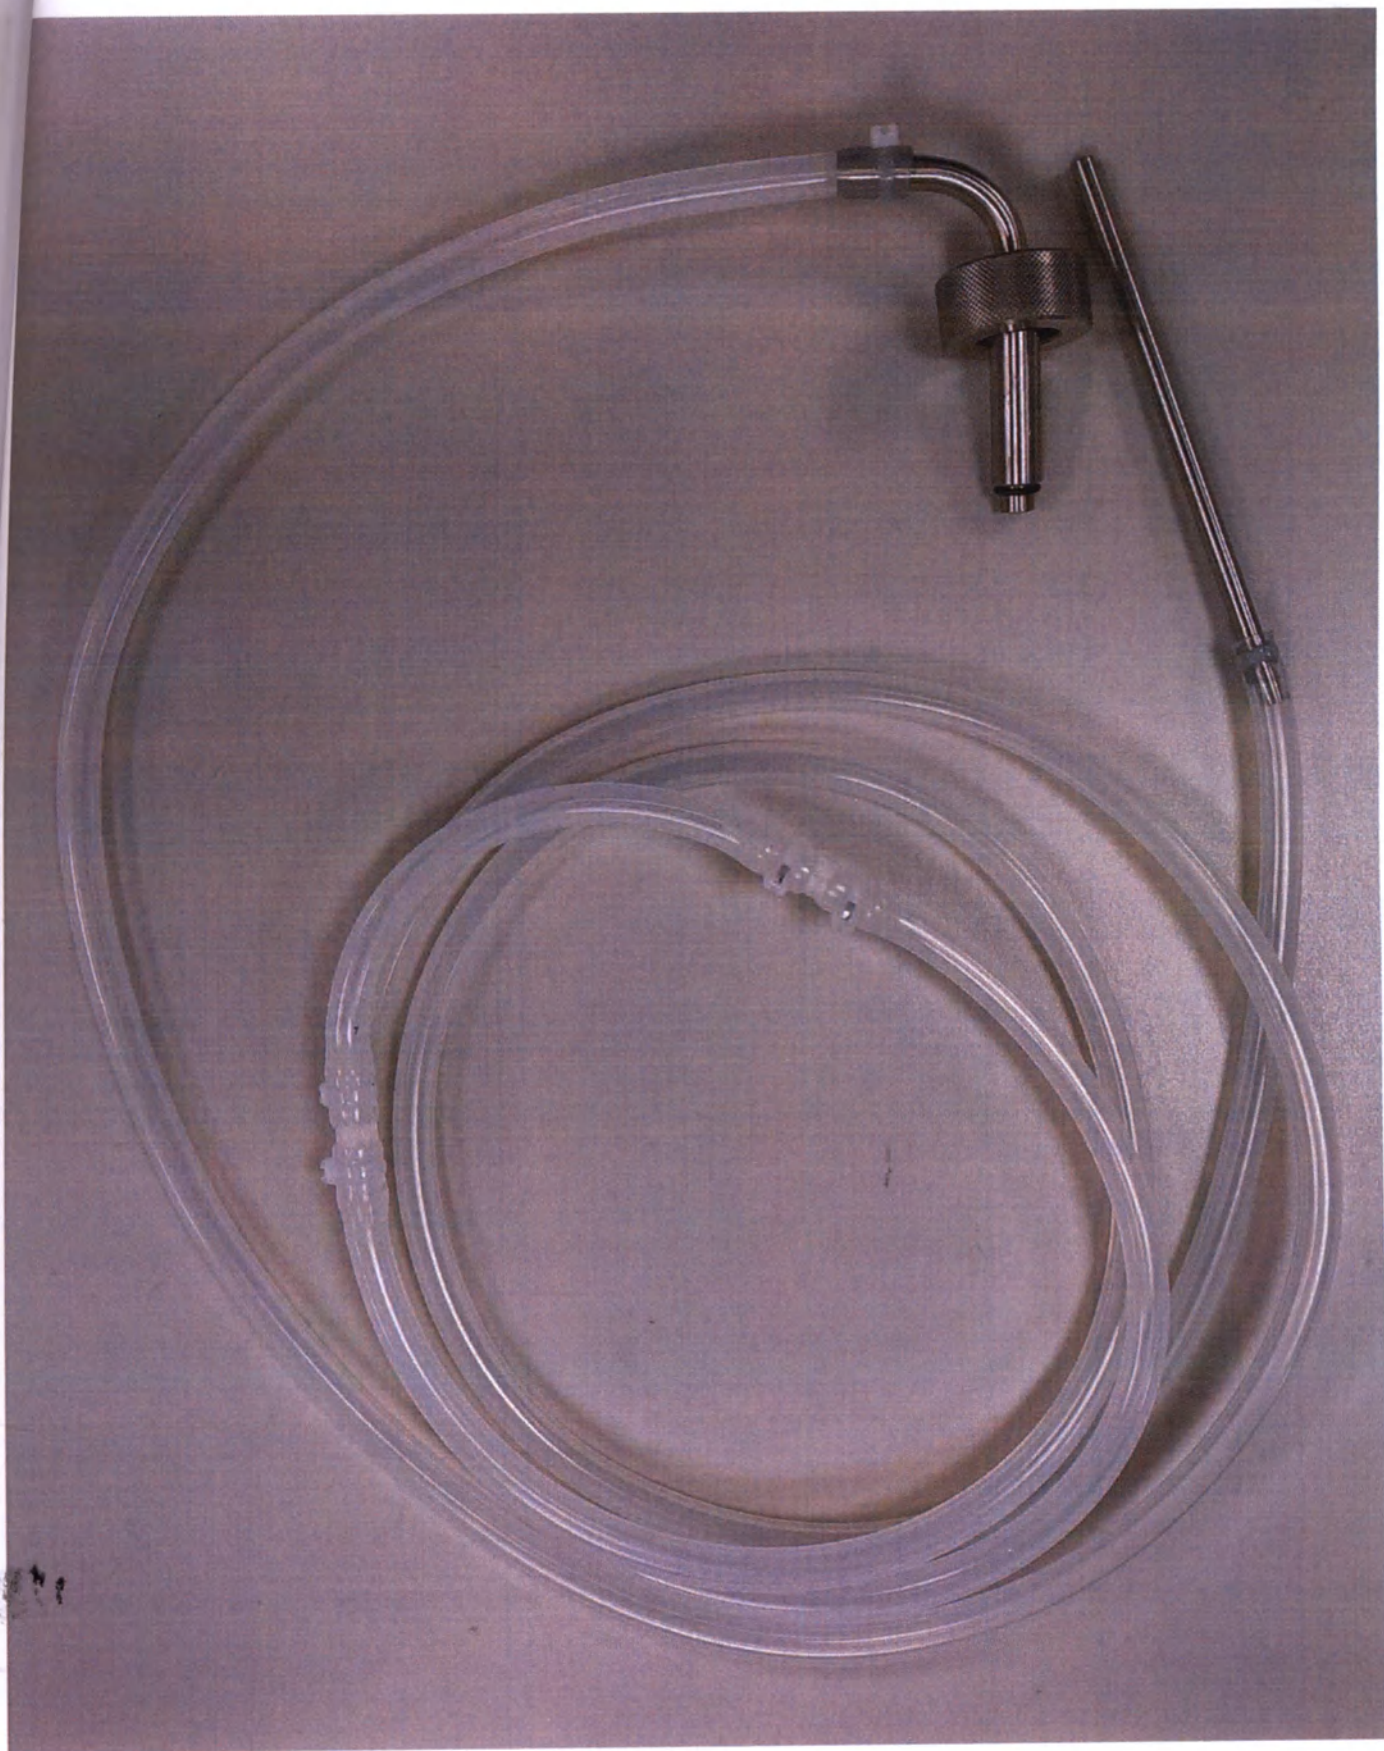

ATTENTION

BioMerieux préconise un changement de tuyau pompe toutes les 100 heures d'utilisation.

Au-delà, les caractéristiques de l'appareil ne sont plus garanties par BioMerieux. Cela évite un endommagement du rotor par éclatement du tuyau.

CAUTION

BioMerieux advocates to change pump tube after 100 hours of use.


Beyond this, characteristics of the equipment are not guaranteed by BioMerieux. This prevents rotor damage by tube burst.

AN104116: 31-12-13: B




Магистраль для розлива объемов от 1 до 5 мл с трубкой диаметром 1,6 мм и прямым наконечником заправочным (в комплекте со стяжками от 0 до 4 шт.)


Магистраль для розлива объемов от 4 до 50 мл с трубкой диаметром 3,2 мм и прямым наконечником заправочным (в комплекте со стяжками от 0 до 4 шт.)

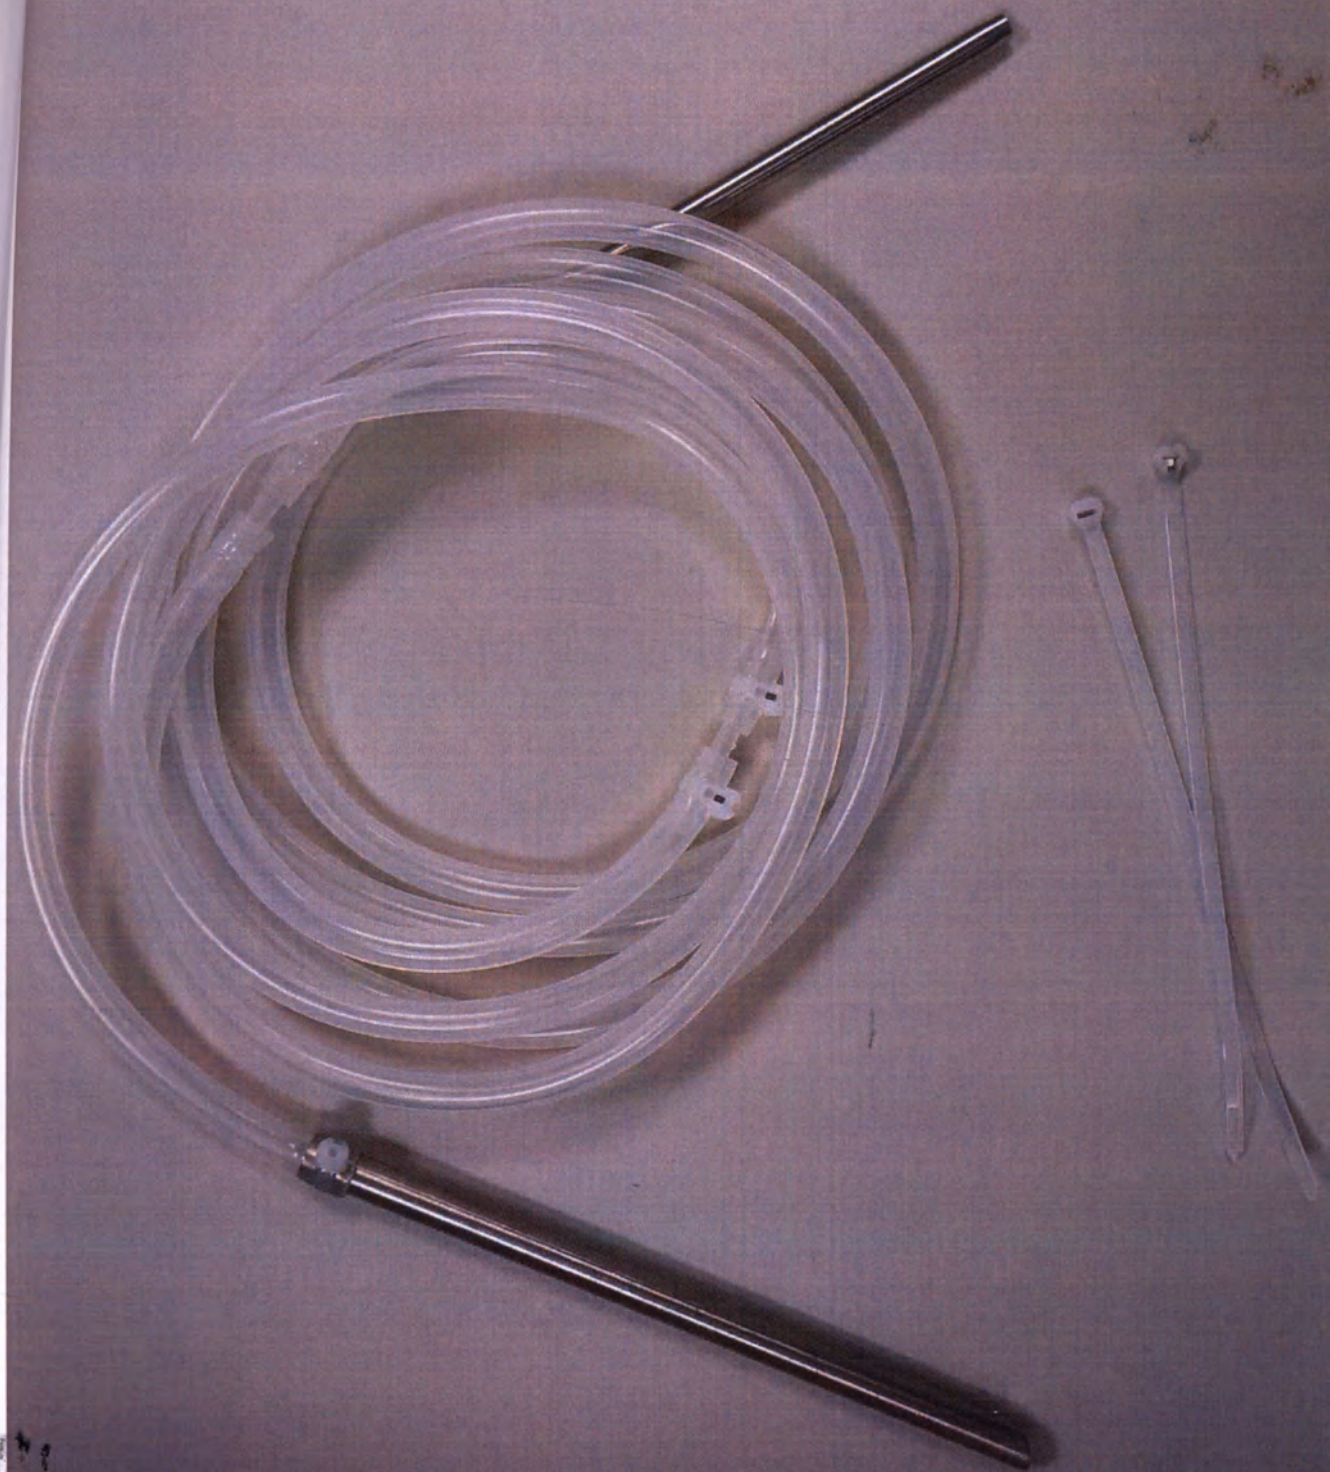

Магистраль для розлива объемов от 20 до 100 мл с трубкой диаметром 4,8 мм и прямым наконечником заправочным (в комплекте со стяжками от 0 до 4 шт.)

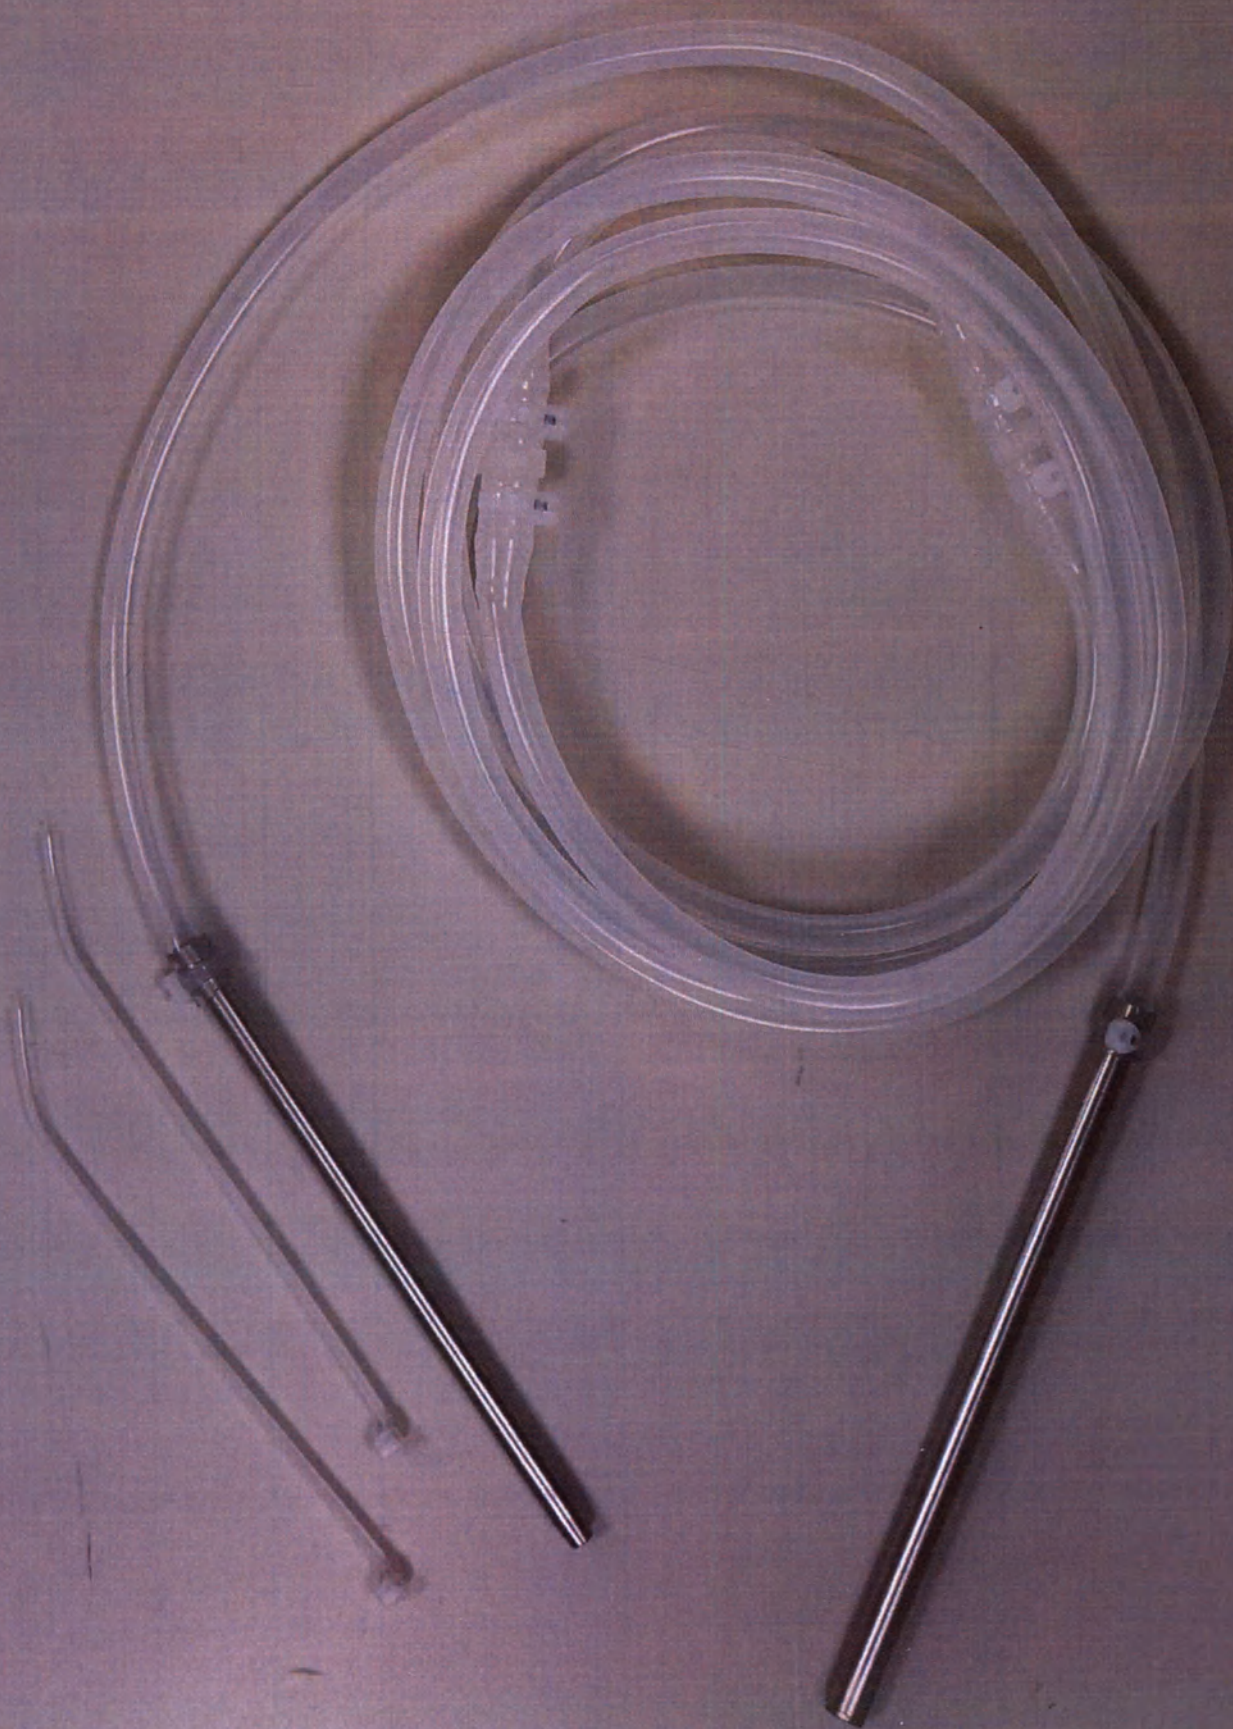


Магистраль для розлива объемов более 100 мл с трубкой диаметром 6,4 мм и прямым наконечником заправочным (в комплекте со стяжками от 0 до 4 шт.)

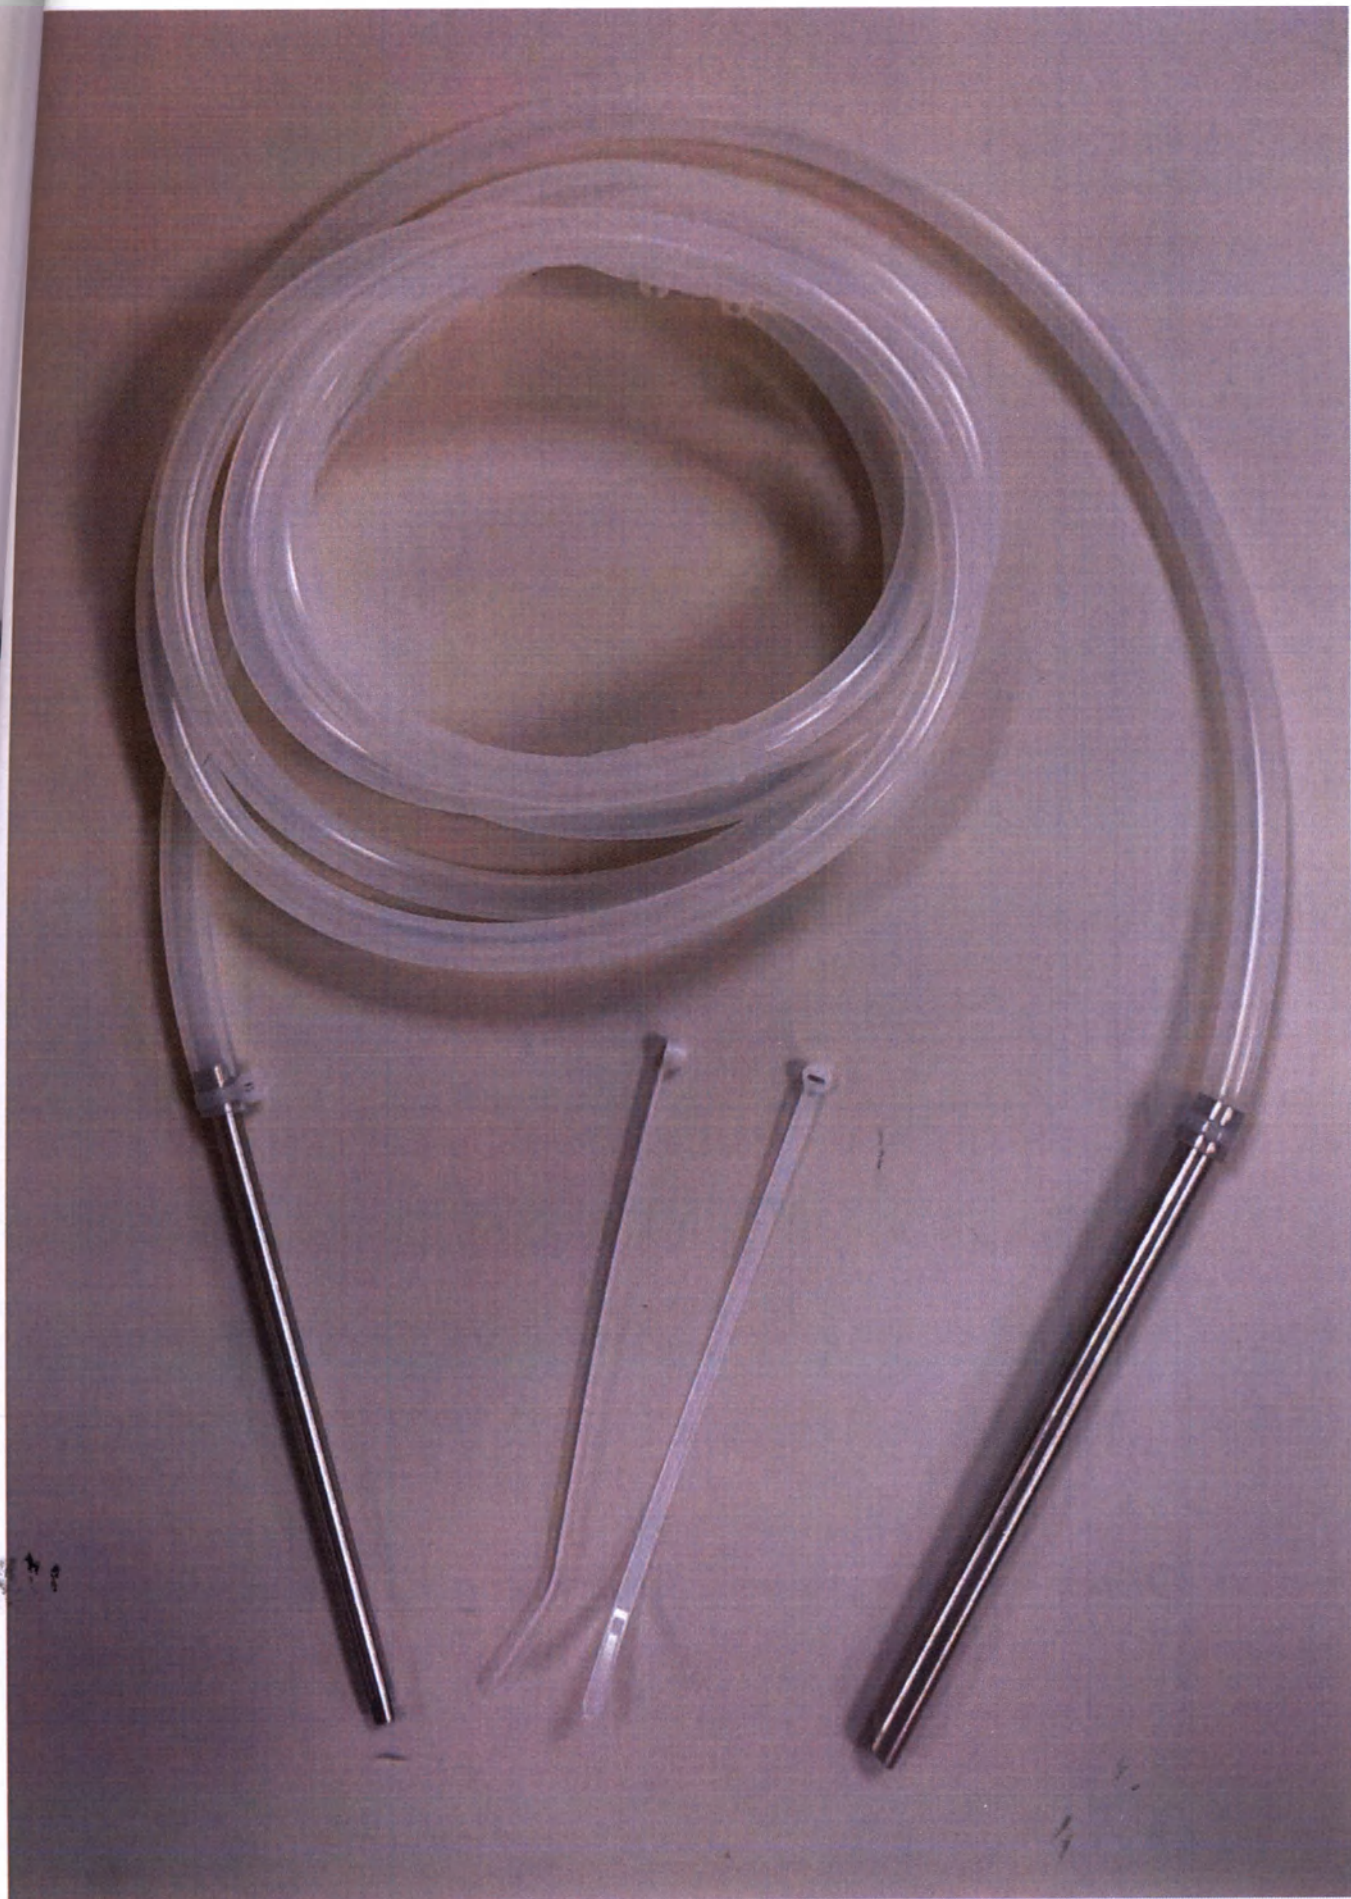



Трубка запасная для магистрали, диаметром 3,2мм (в комплекте со стяжками от 0 до 10 шт.), 5 шт./уп.





Трубка запасная для магистрали, диаметром 6,4 мм (в комплекте со стяжками от 0 до 12 шт.),
5шт./уп.

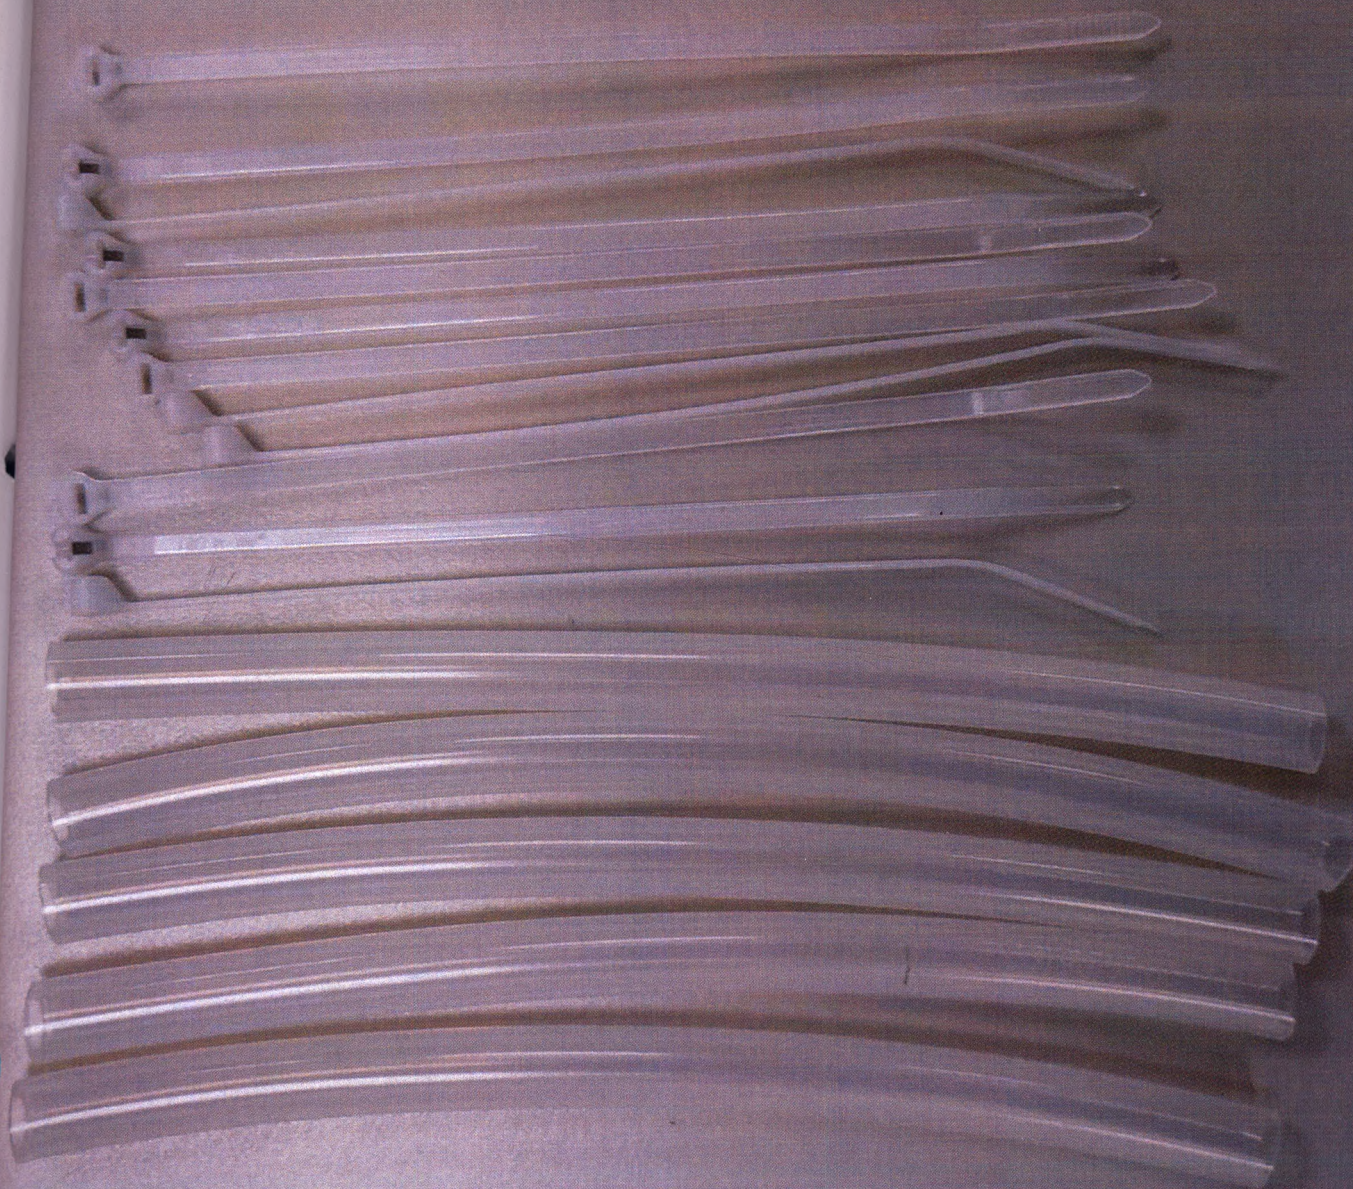


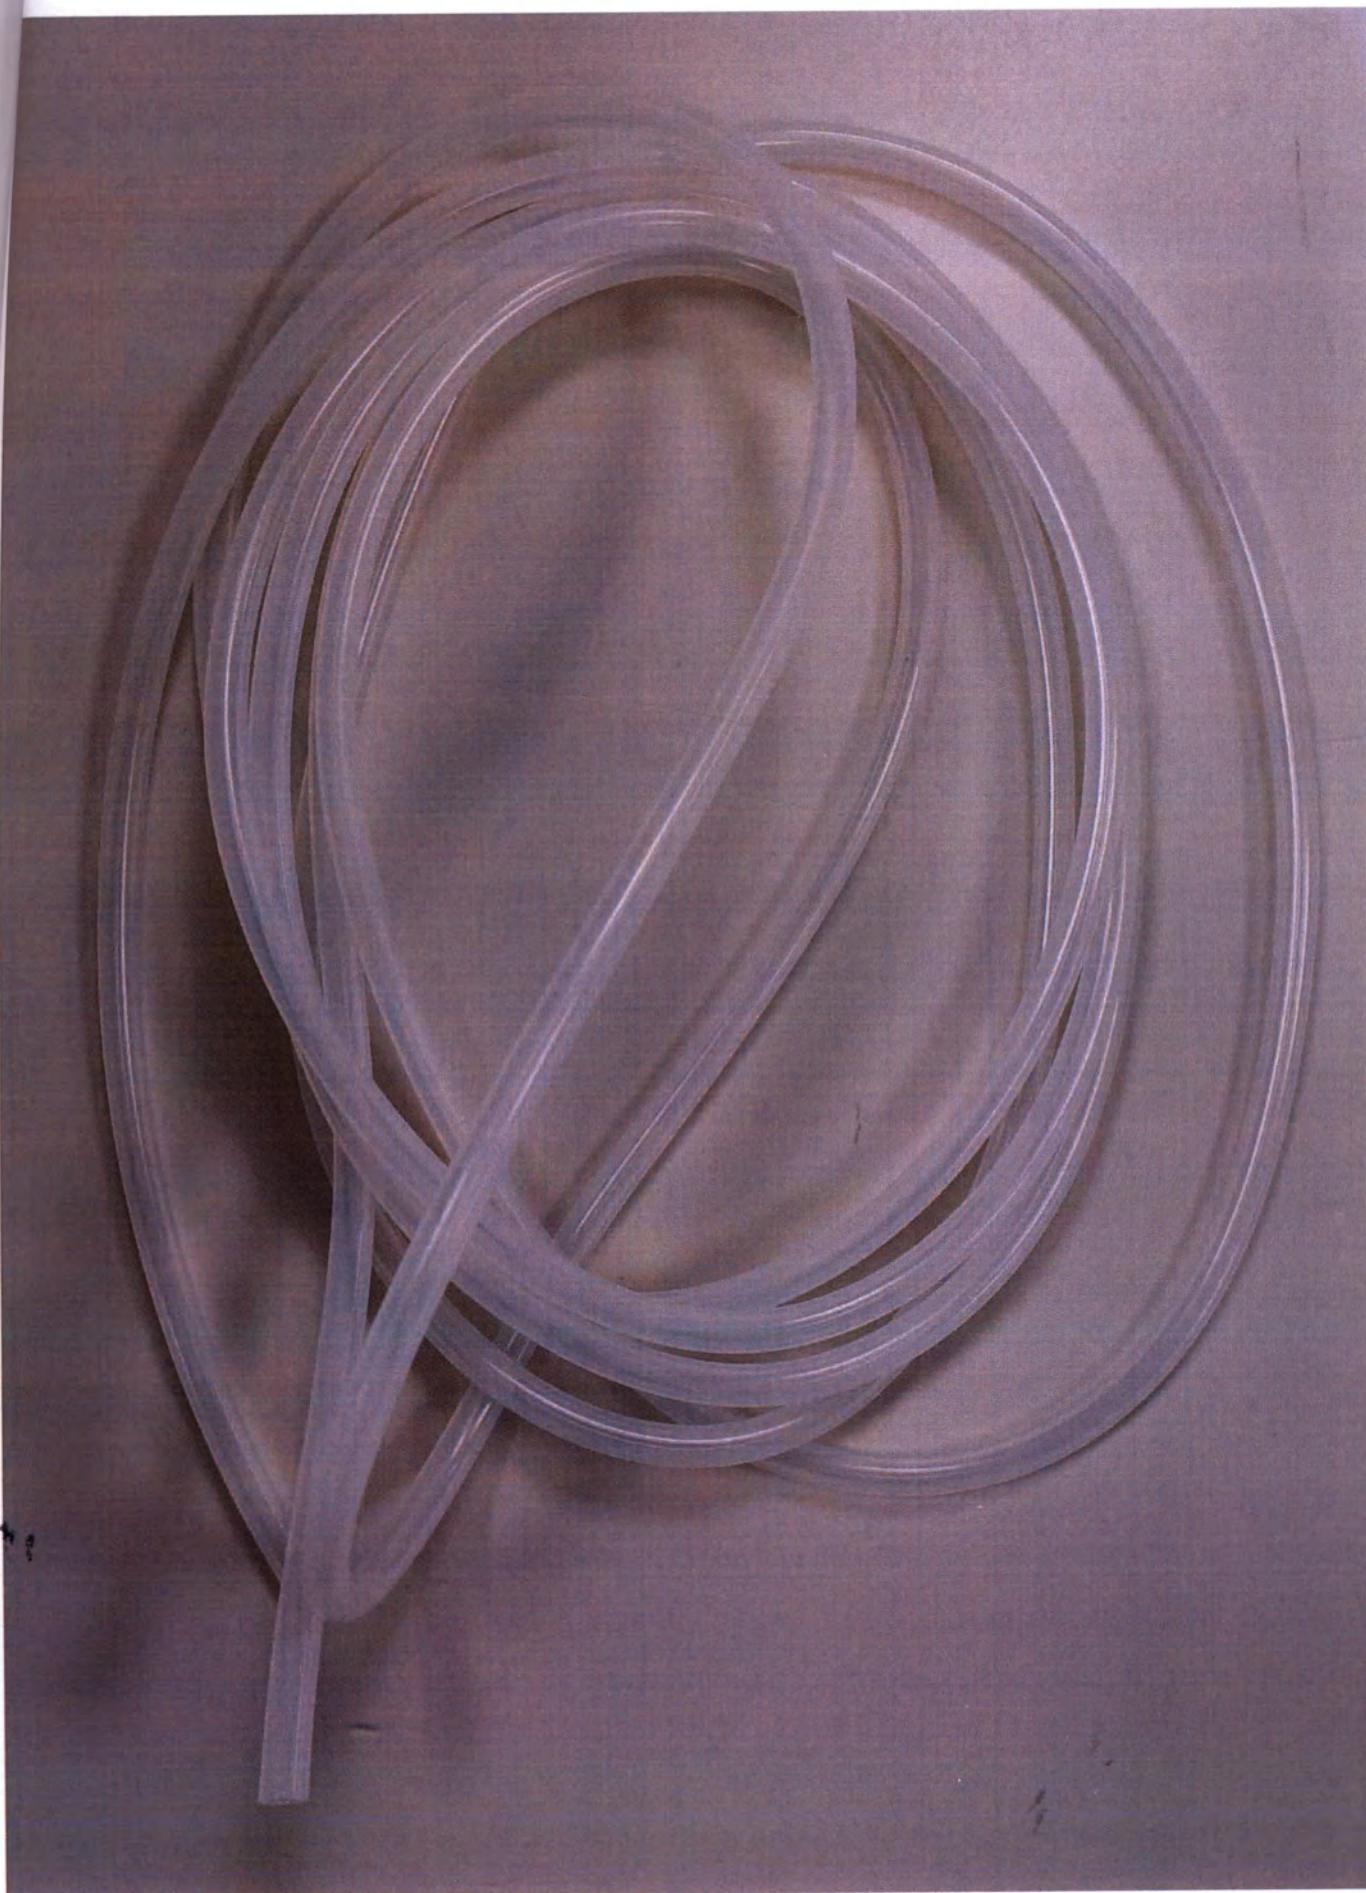

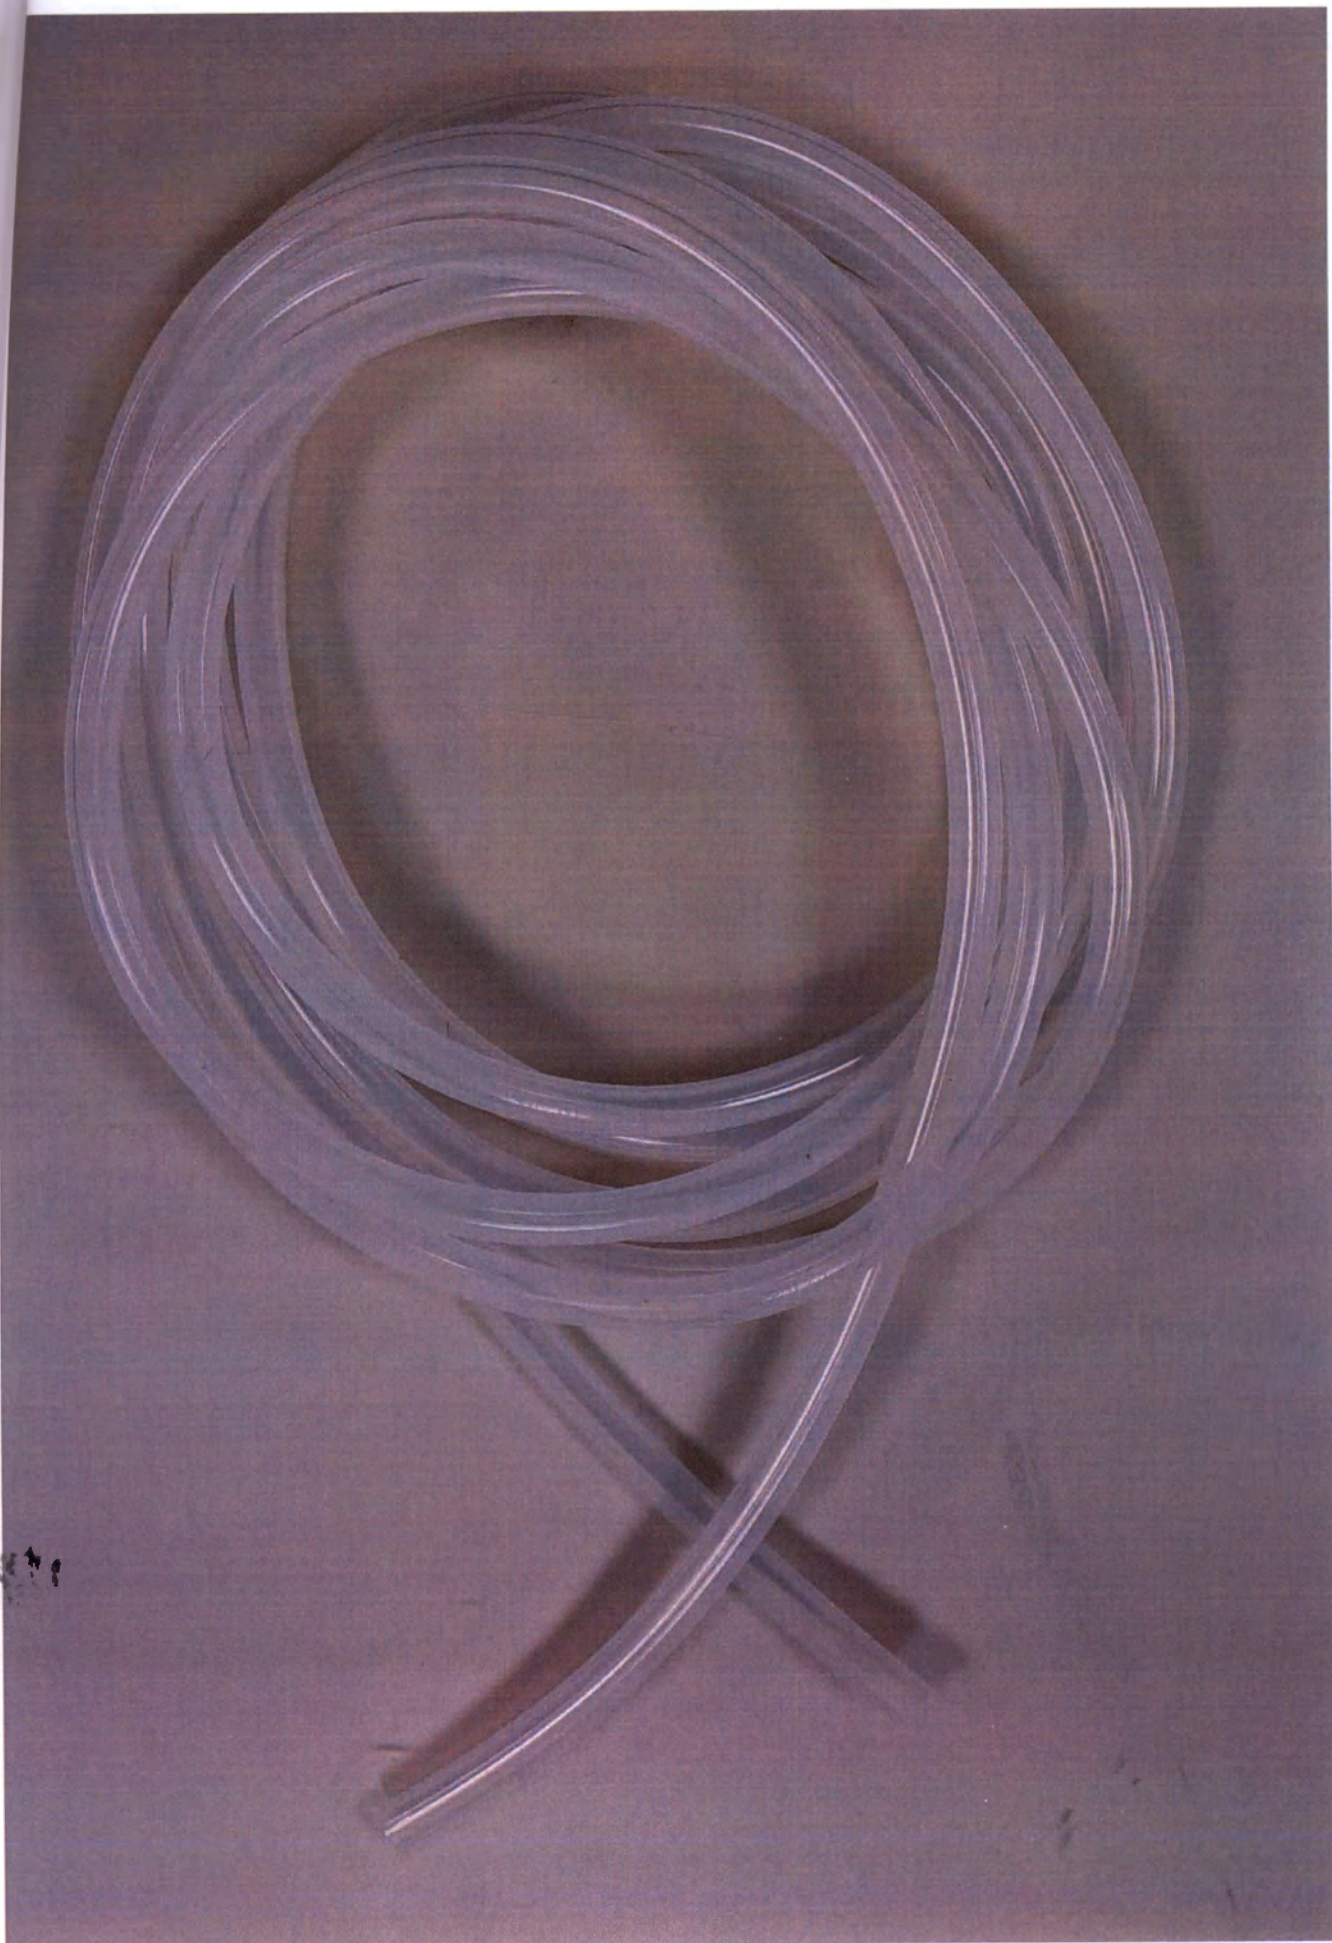


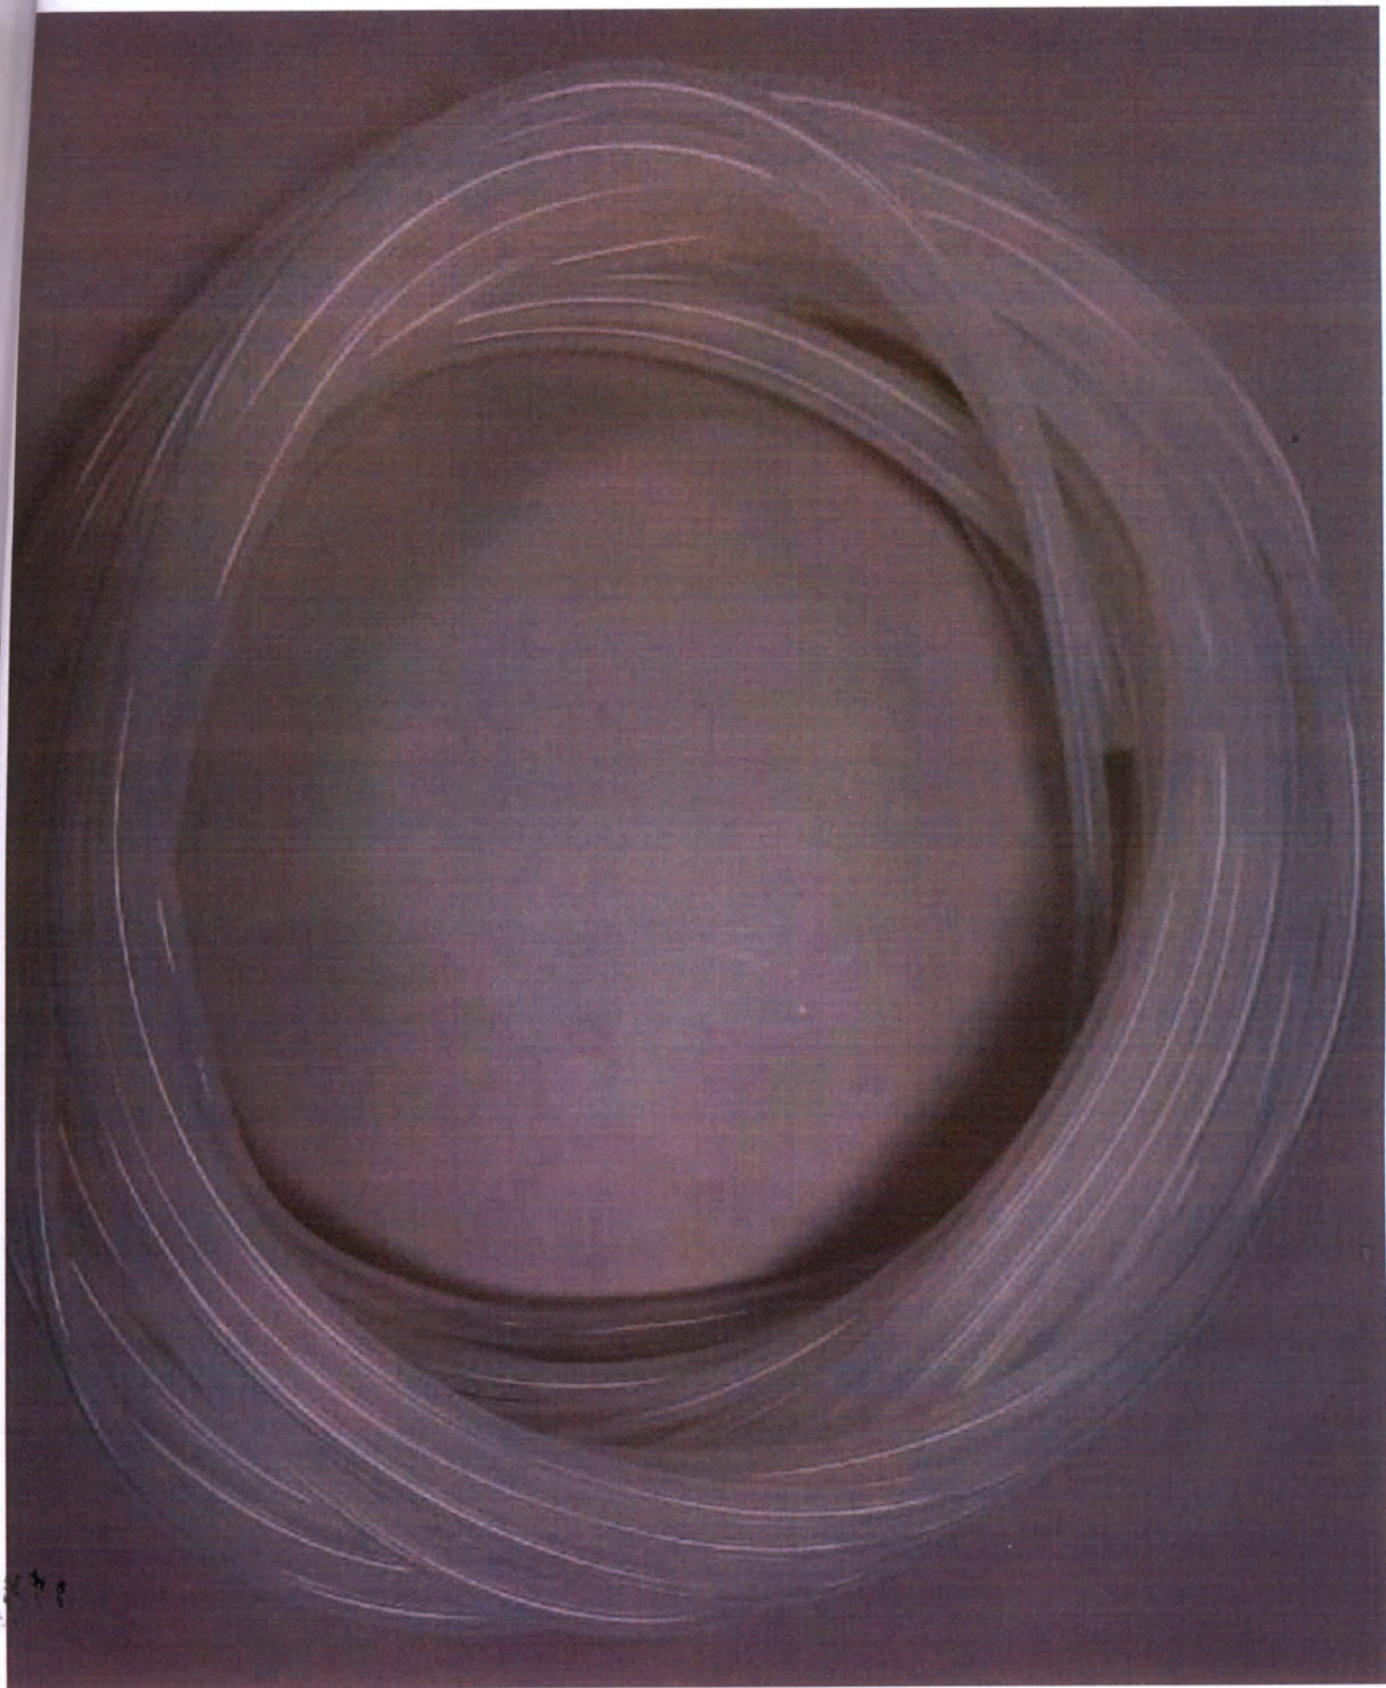


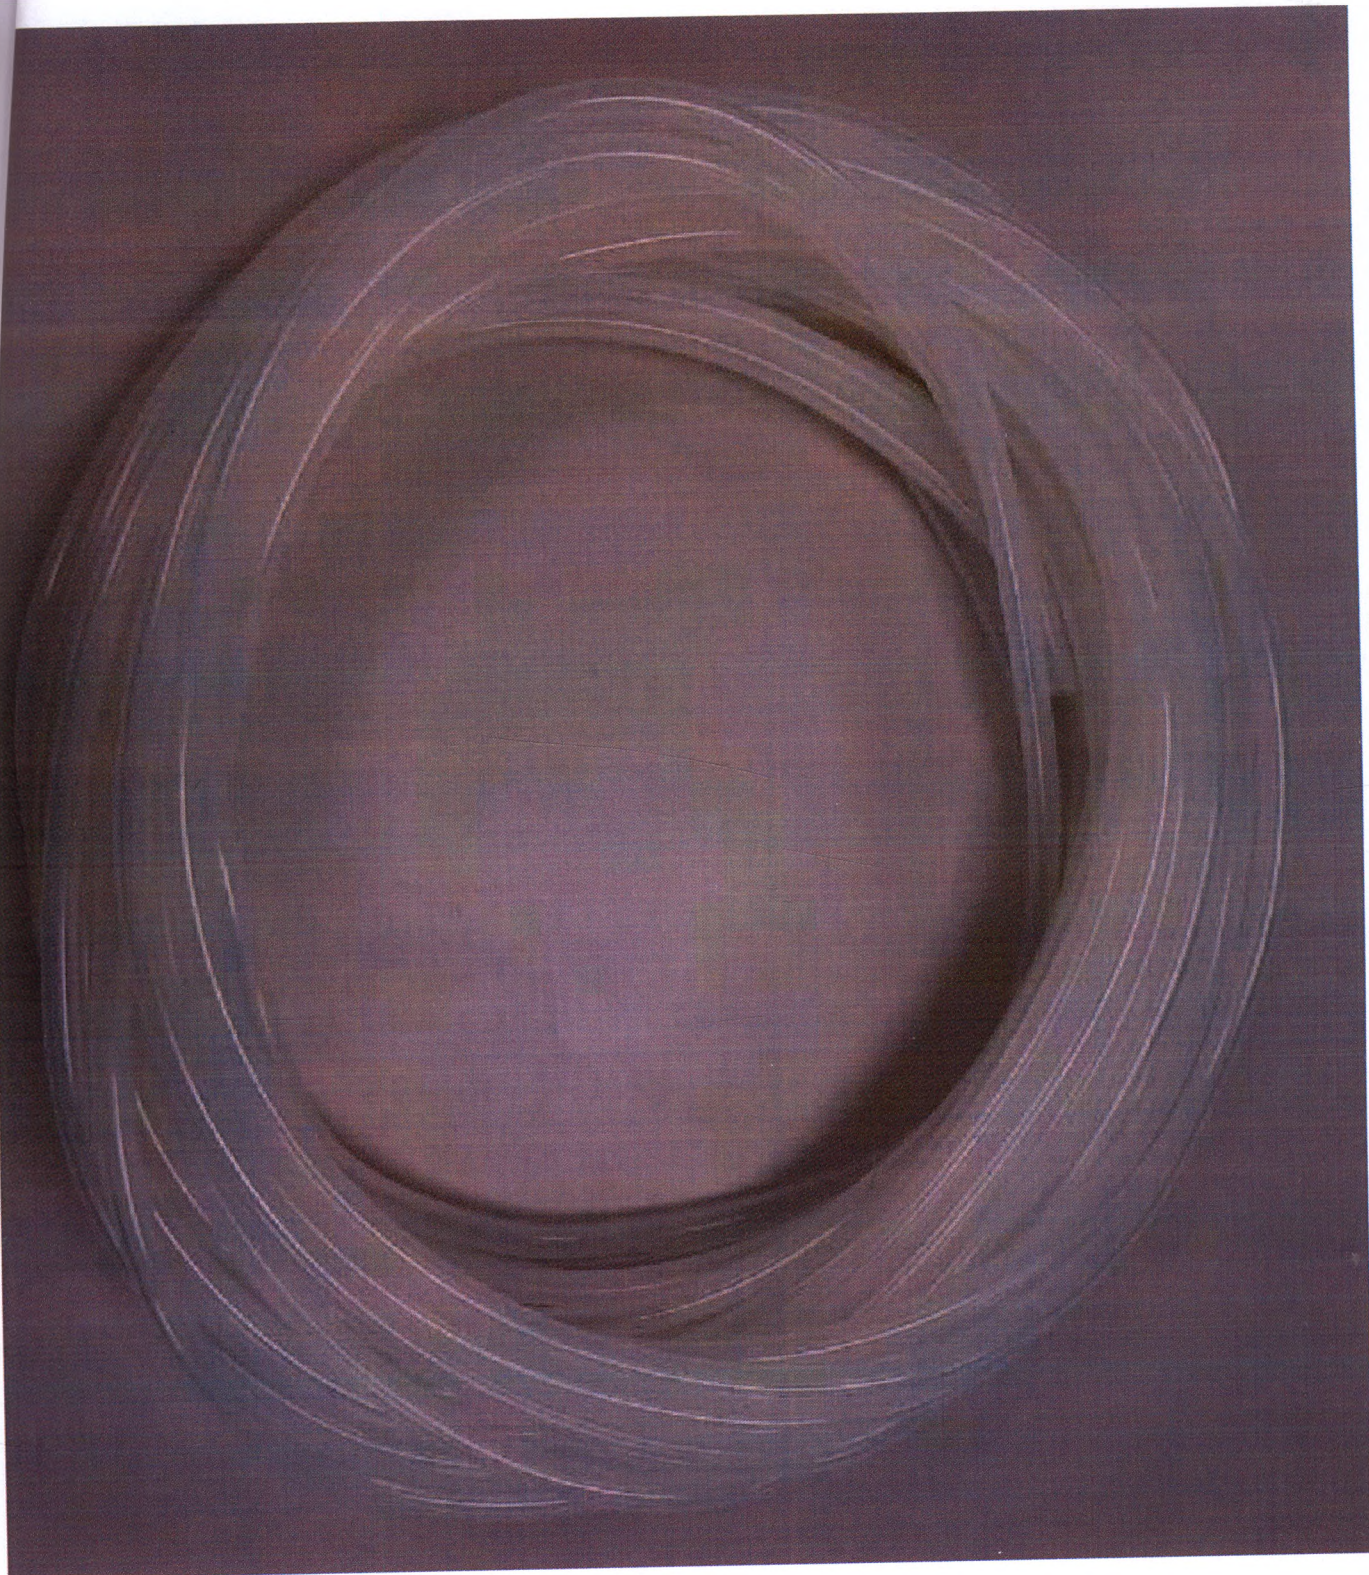


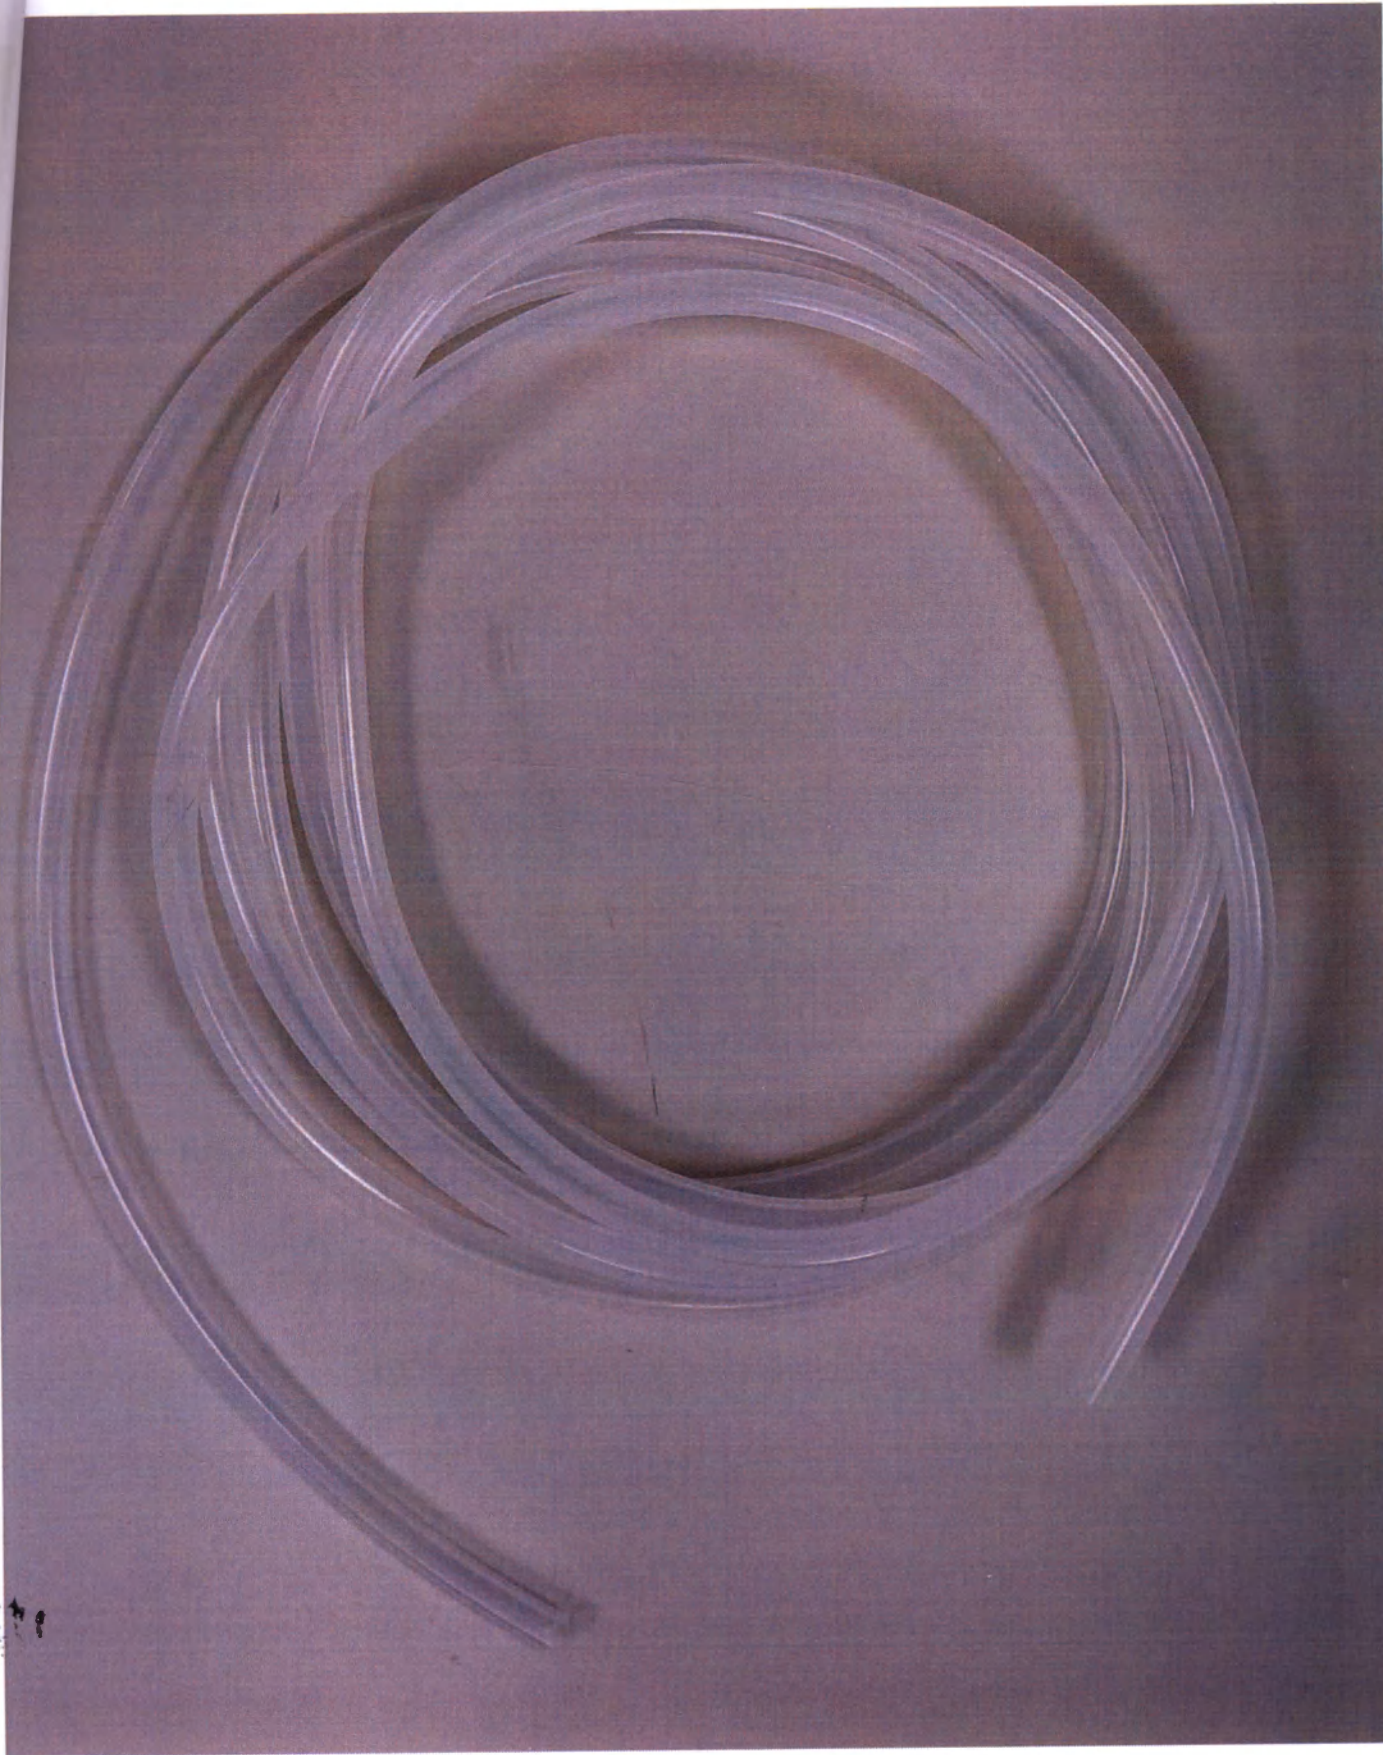


Комплект запасных трубок для магистрали для розлива диаметром 3,2 мм (не более 2 шт.) в составе:


- трубка силиконовая 5х8 мм – 2 шт.
- трубка силиконовая для помпы диаметром 3,2 мм – 10 шт.
- стяжки – от 0 до 20 шт.

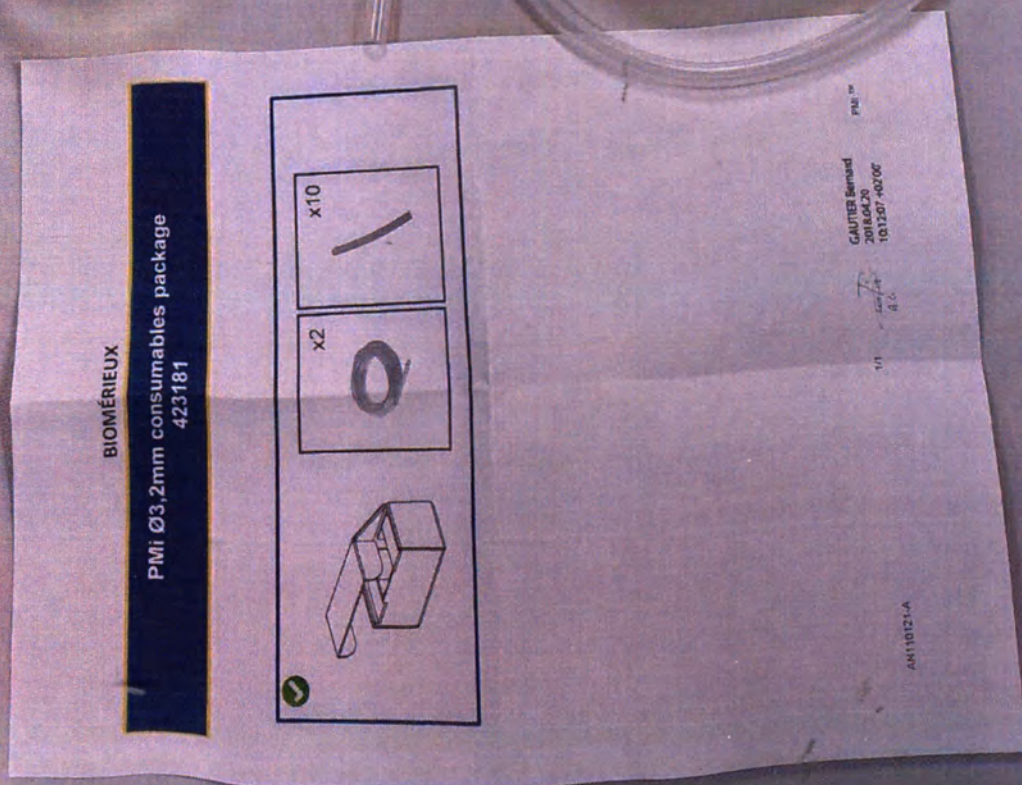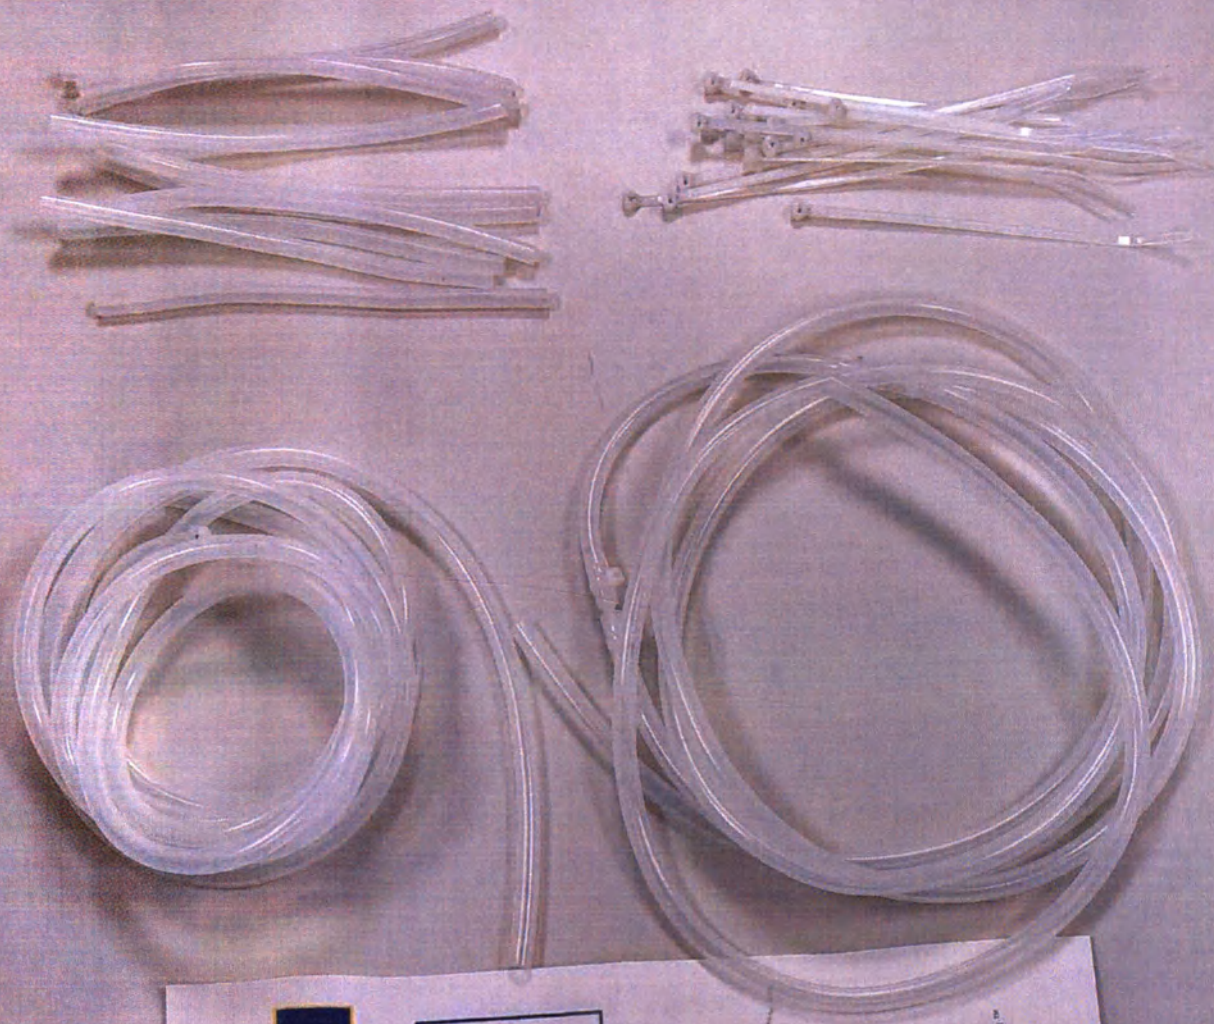


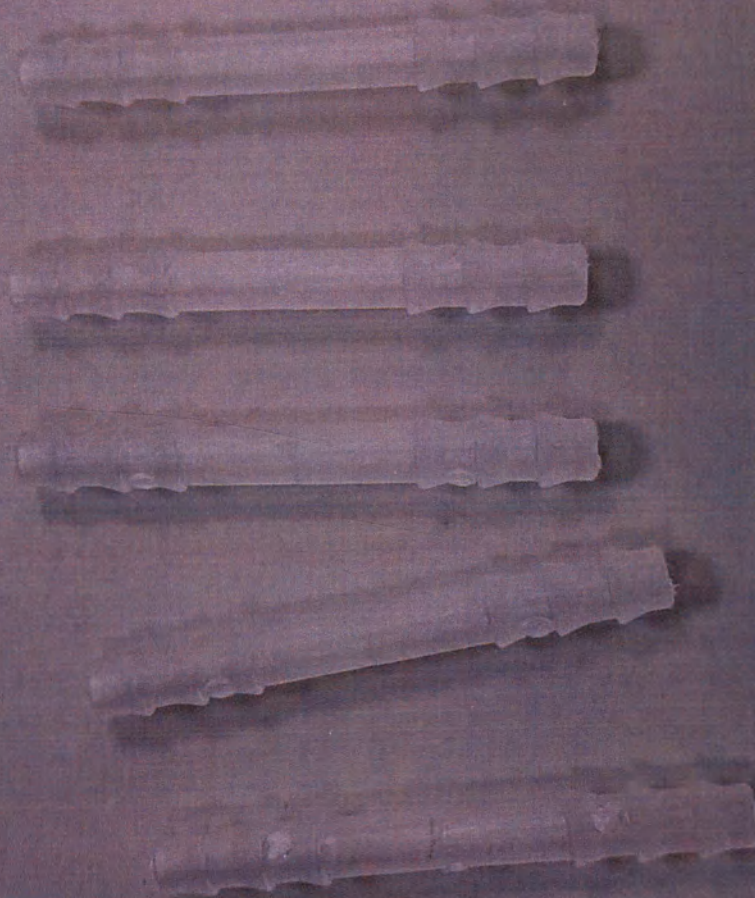



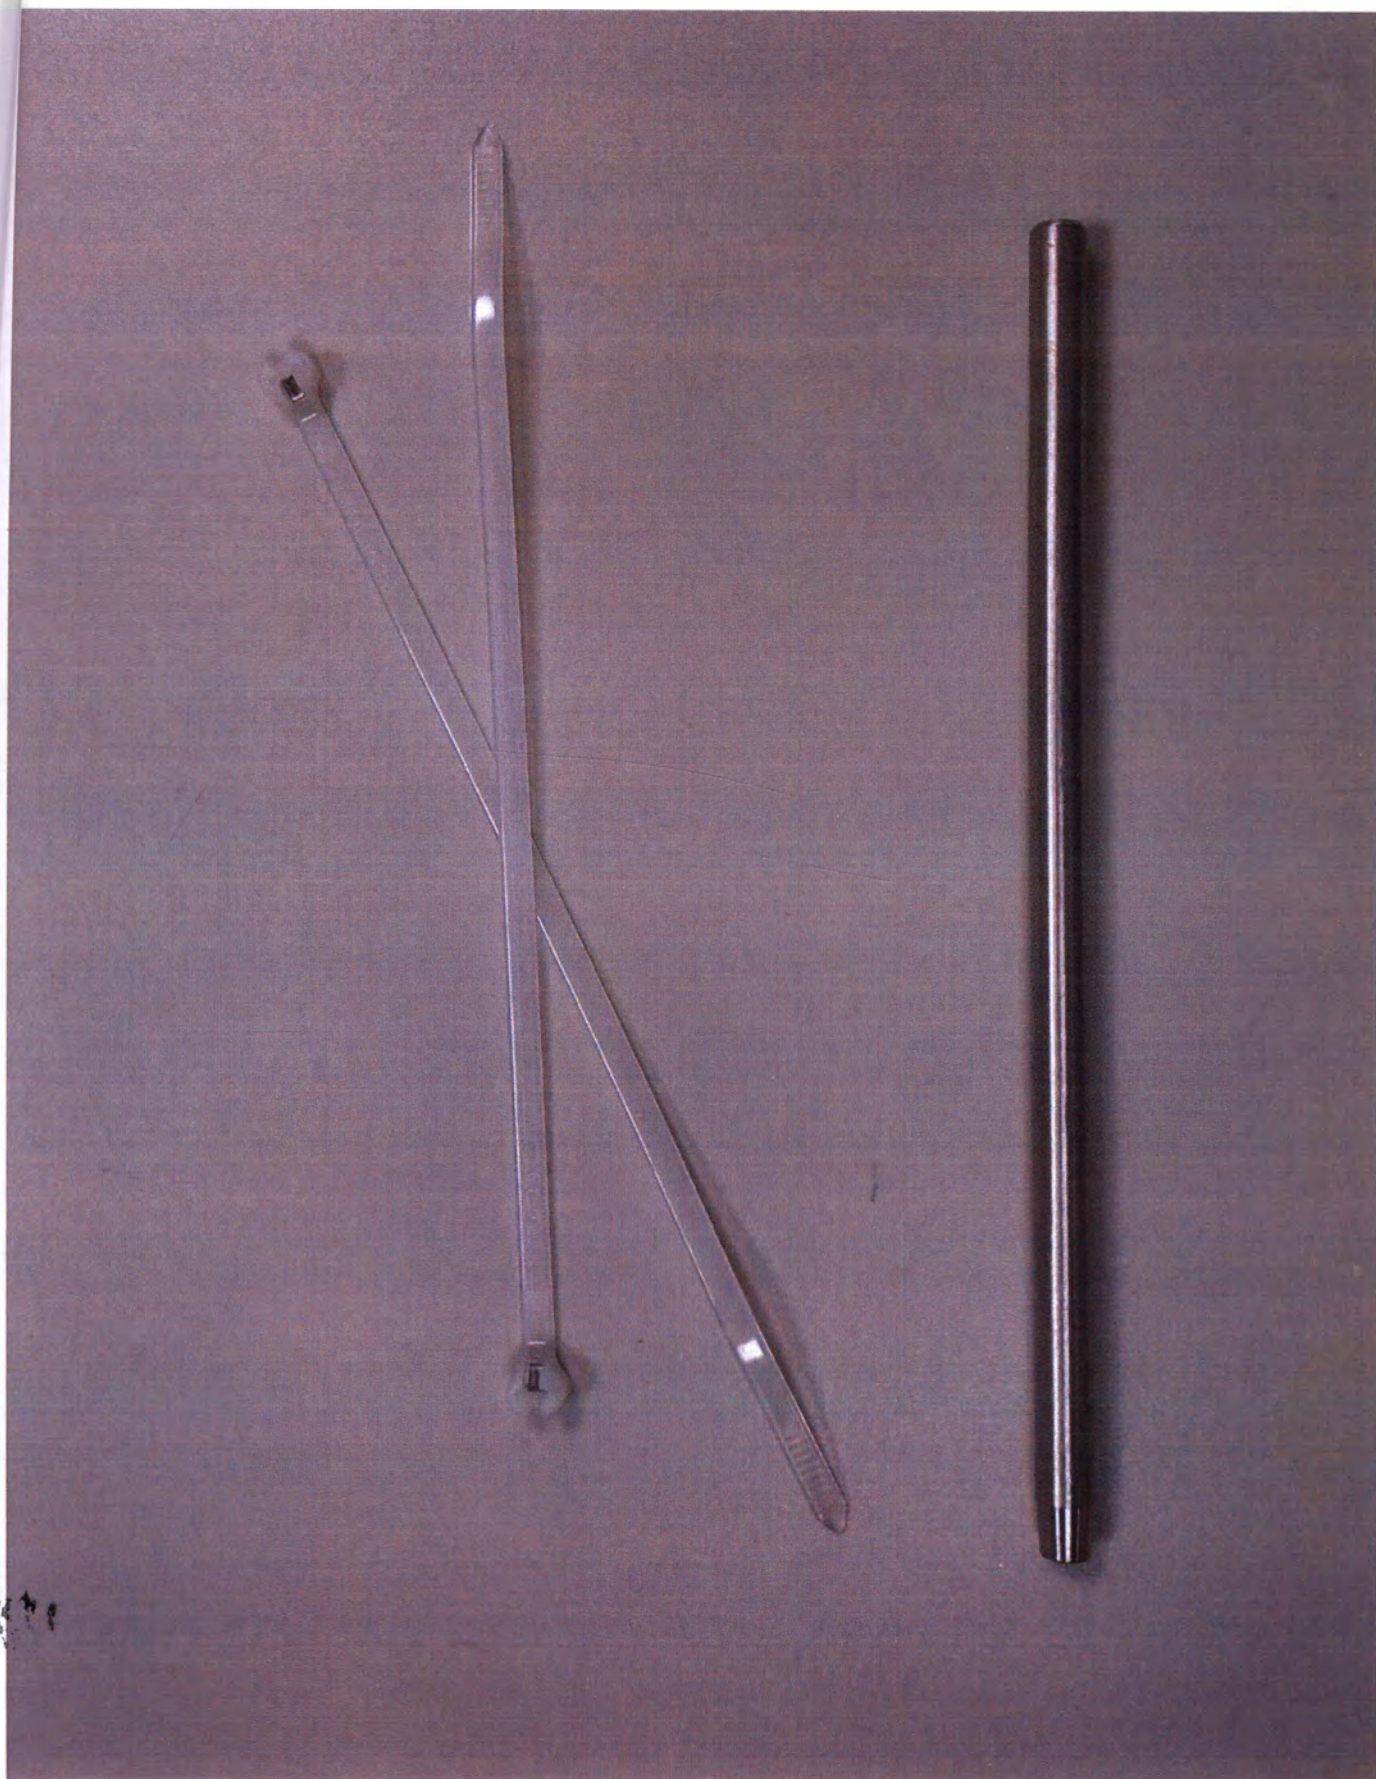

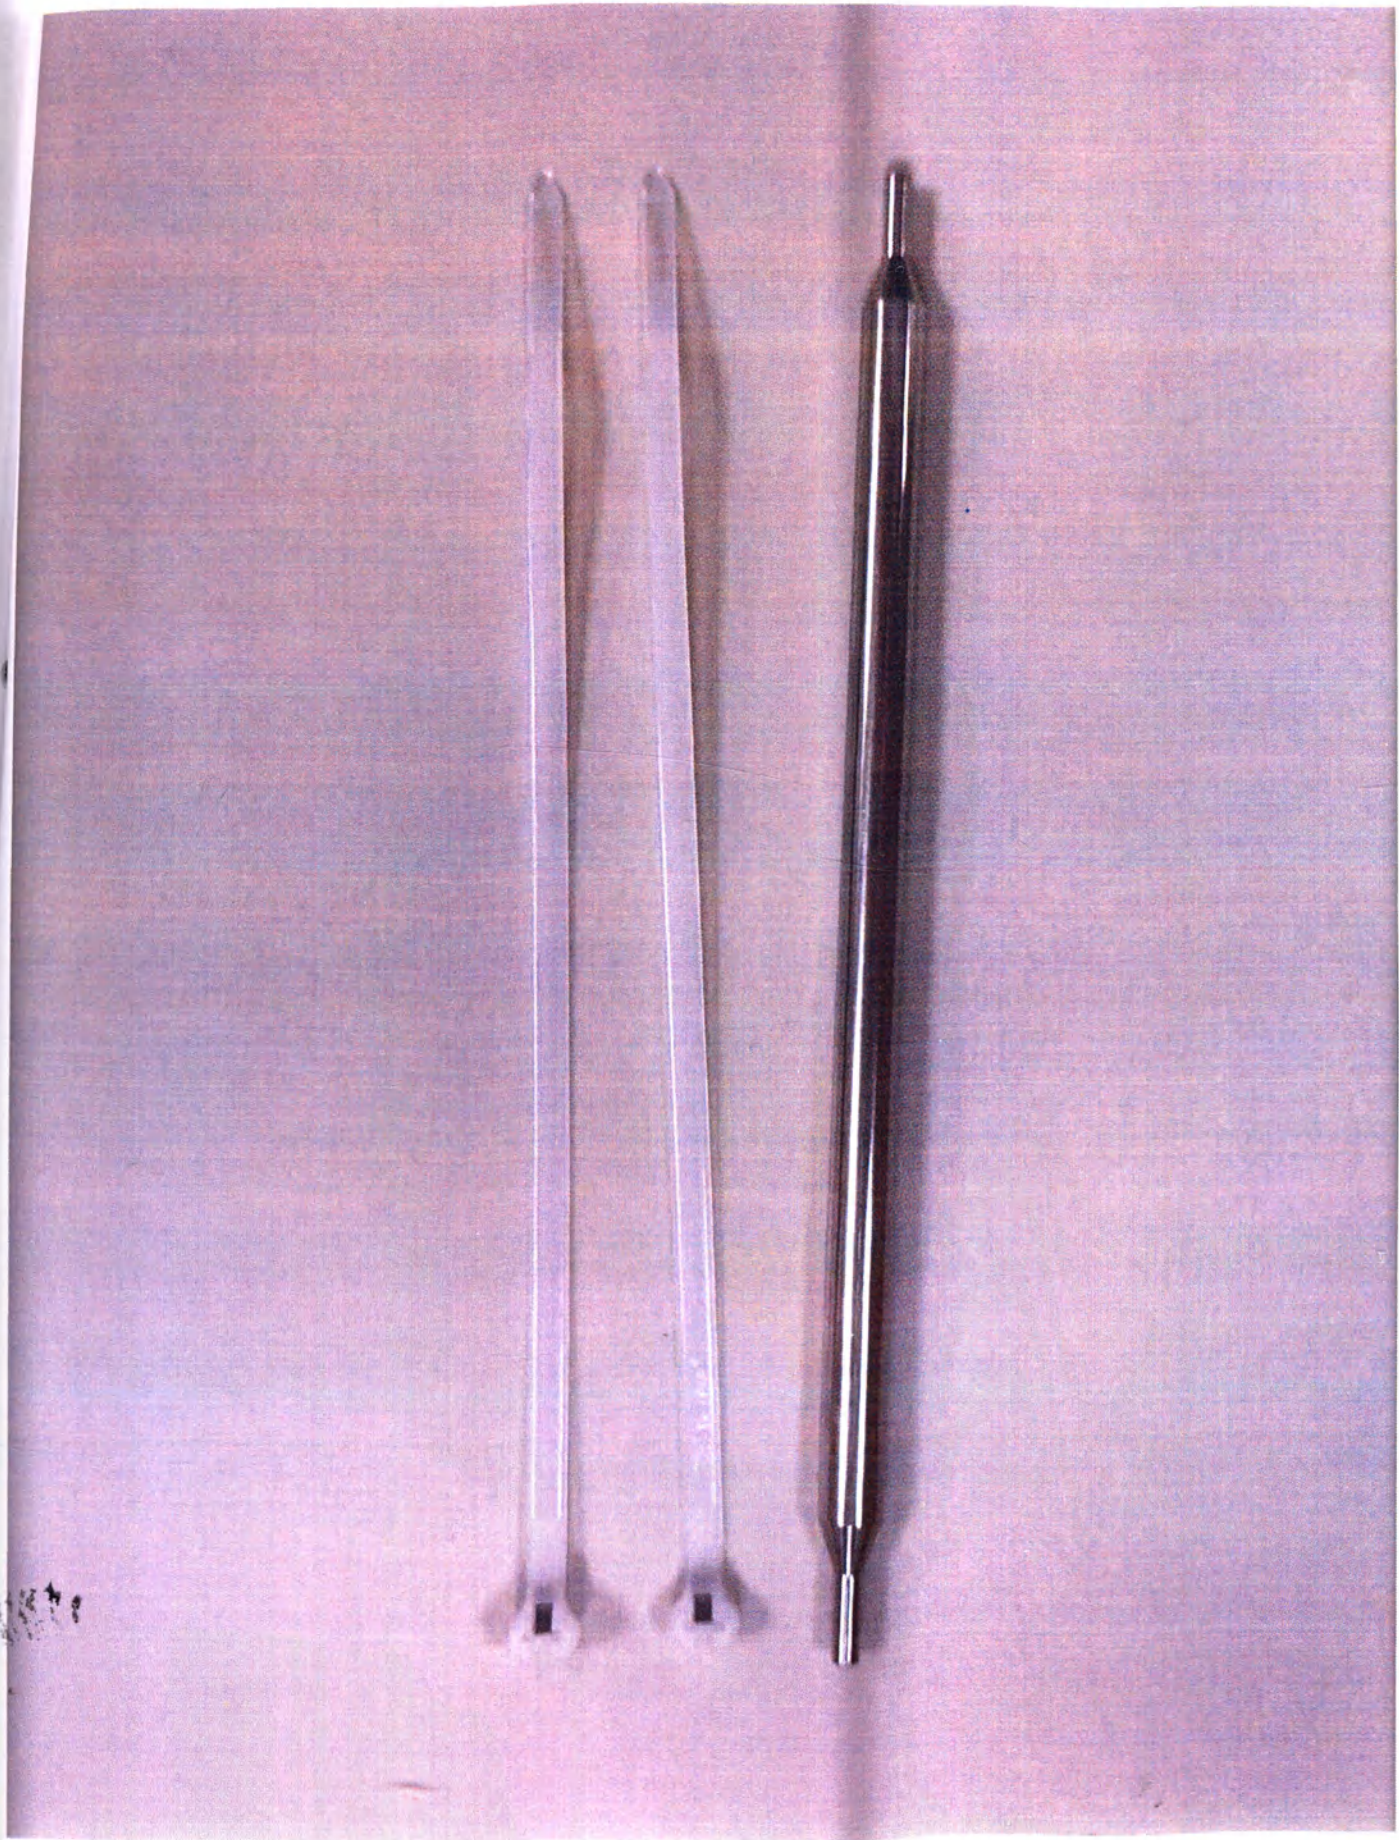


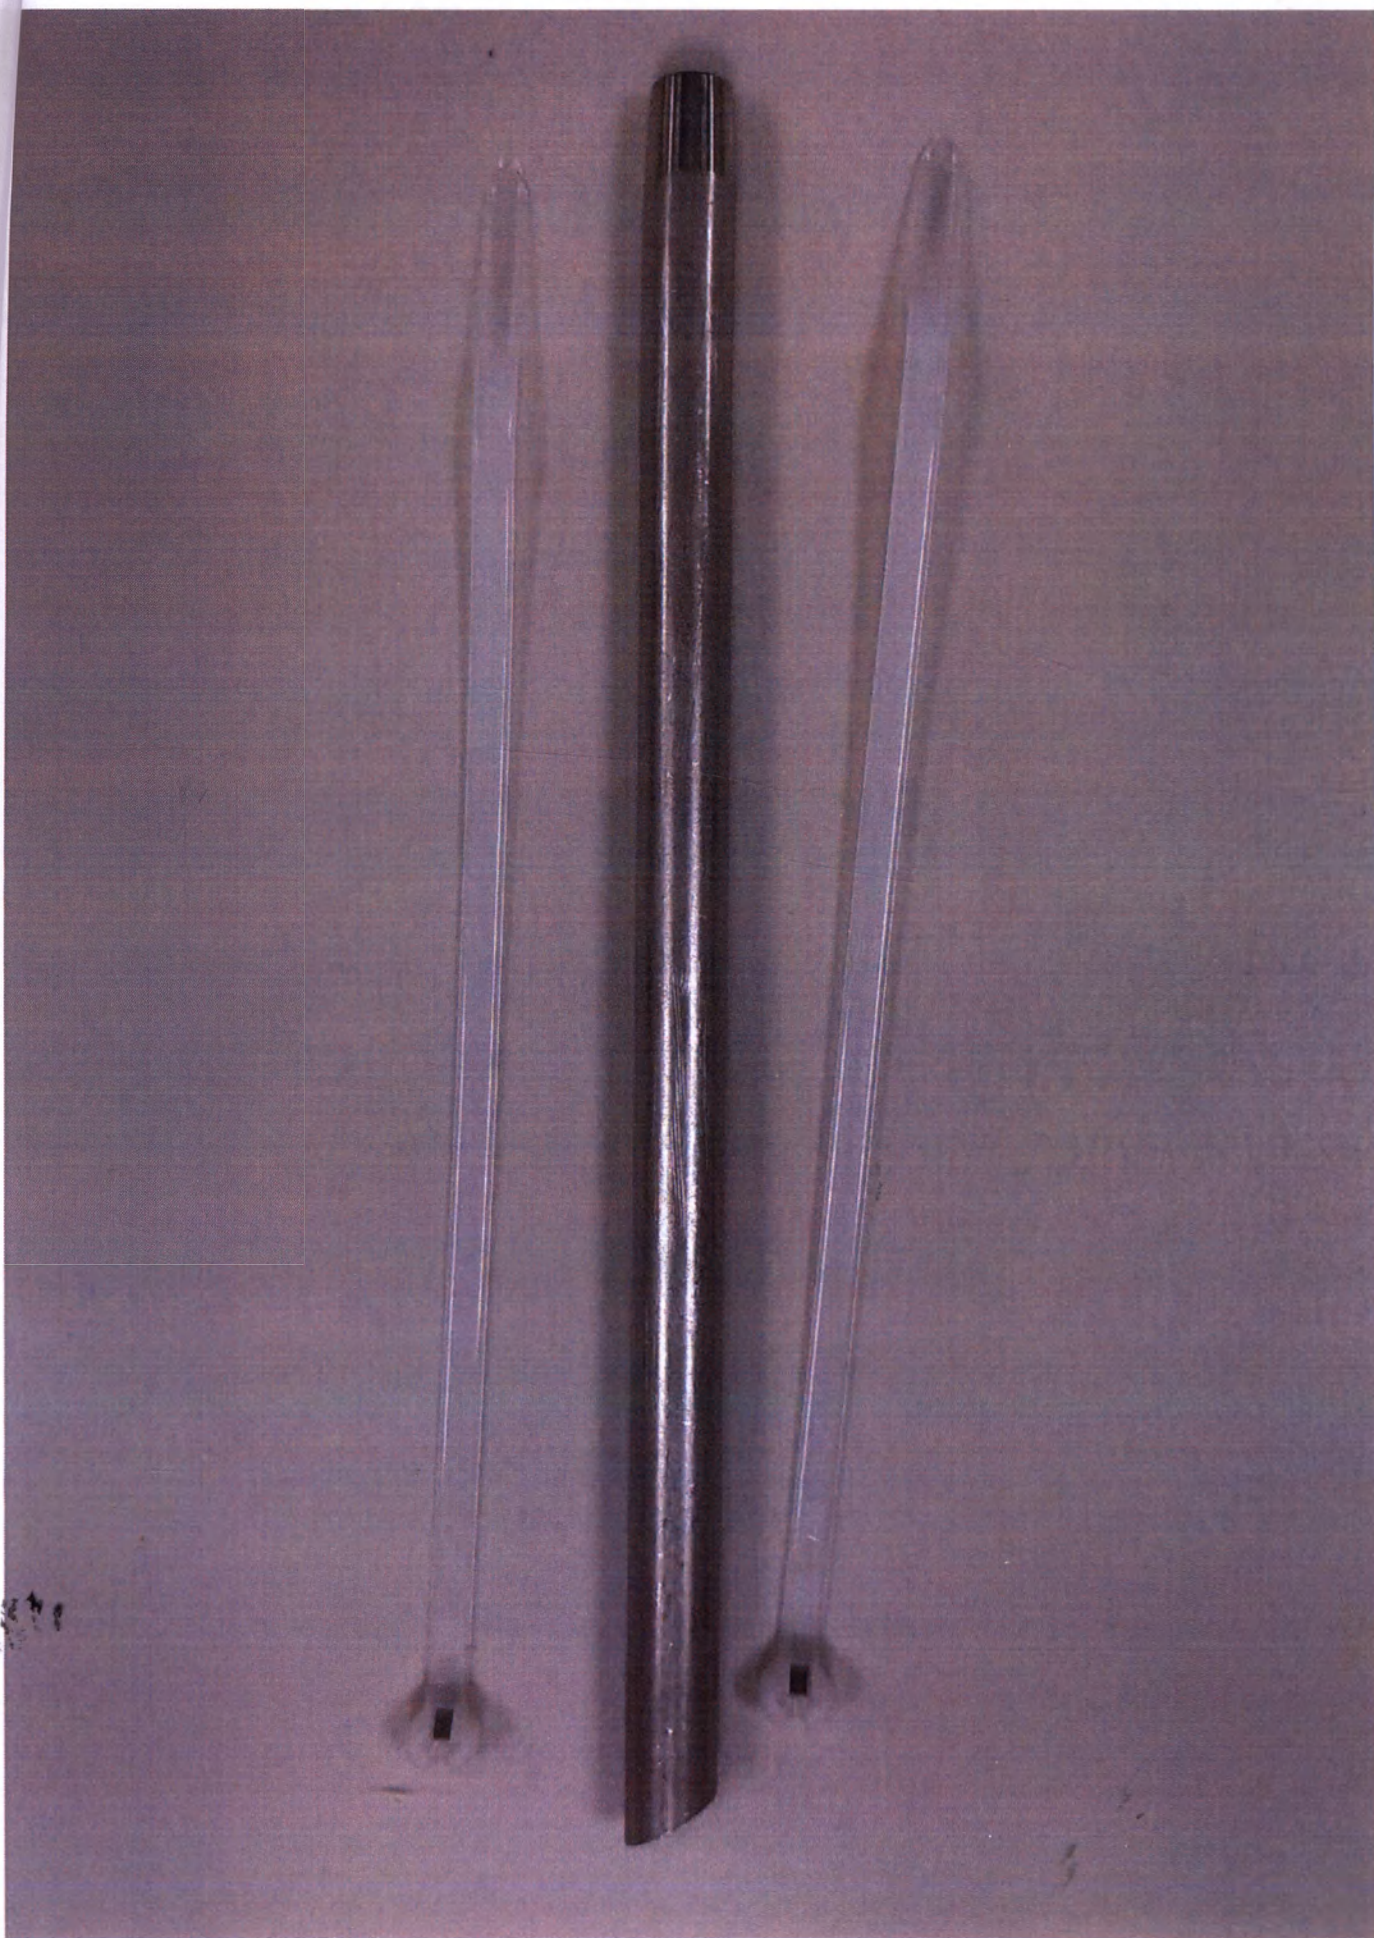




Уплотнитель кольцевой под порт для обратного клапана и под порт для установки наконечника заправочного 26 x 3мм, 5 шт./уп.



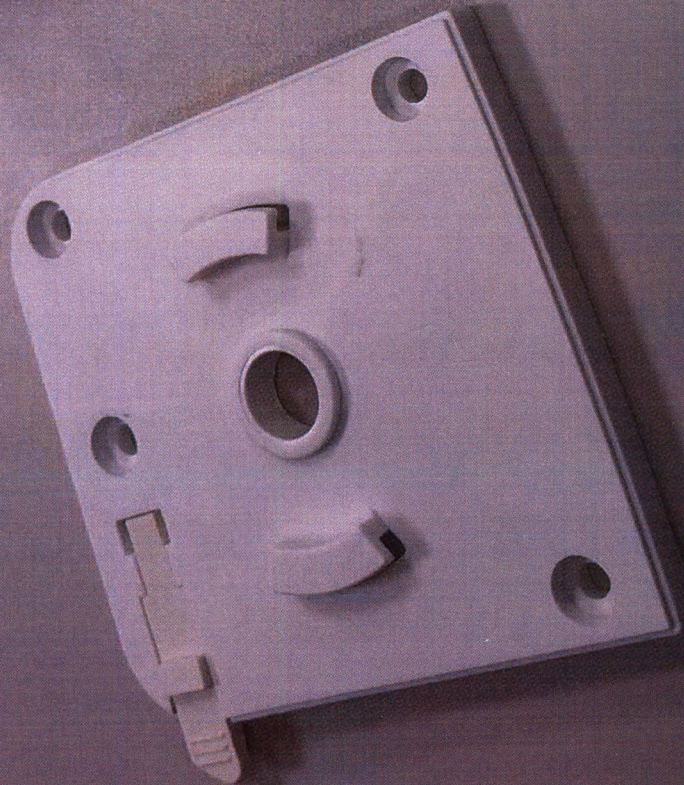

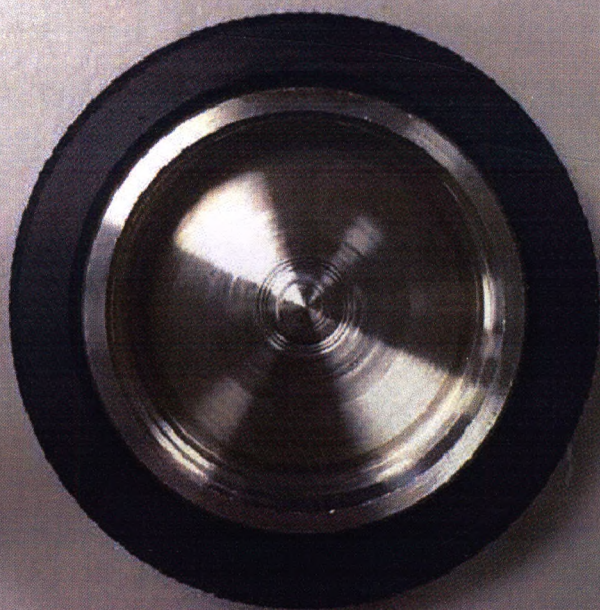

90 ЛИСТОВ

« 20 » августа 2021 года

Генеральный директор

Бердникова Н.В.

