

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной ответственностью

«ЮБИ ЛАБ»

Генеральный директор

Кузнецова О. Е.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «МАТЕРИАЛ С ГИАЛУРОНАТОМ НАТРИЯ ДЛЯ
ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЯХ CYTOCARE S LINE, CYTOCARE 715 C LINE, HAIRCARE»**



Рис. 1. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки CYTOCARE S Line.



Рис. 2. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки CYTOCARE S Line.

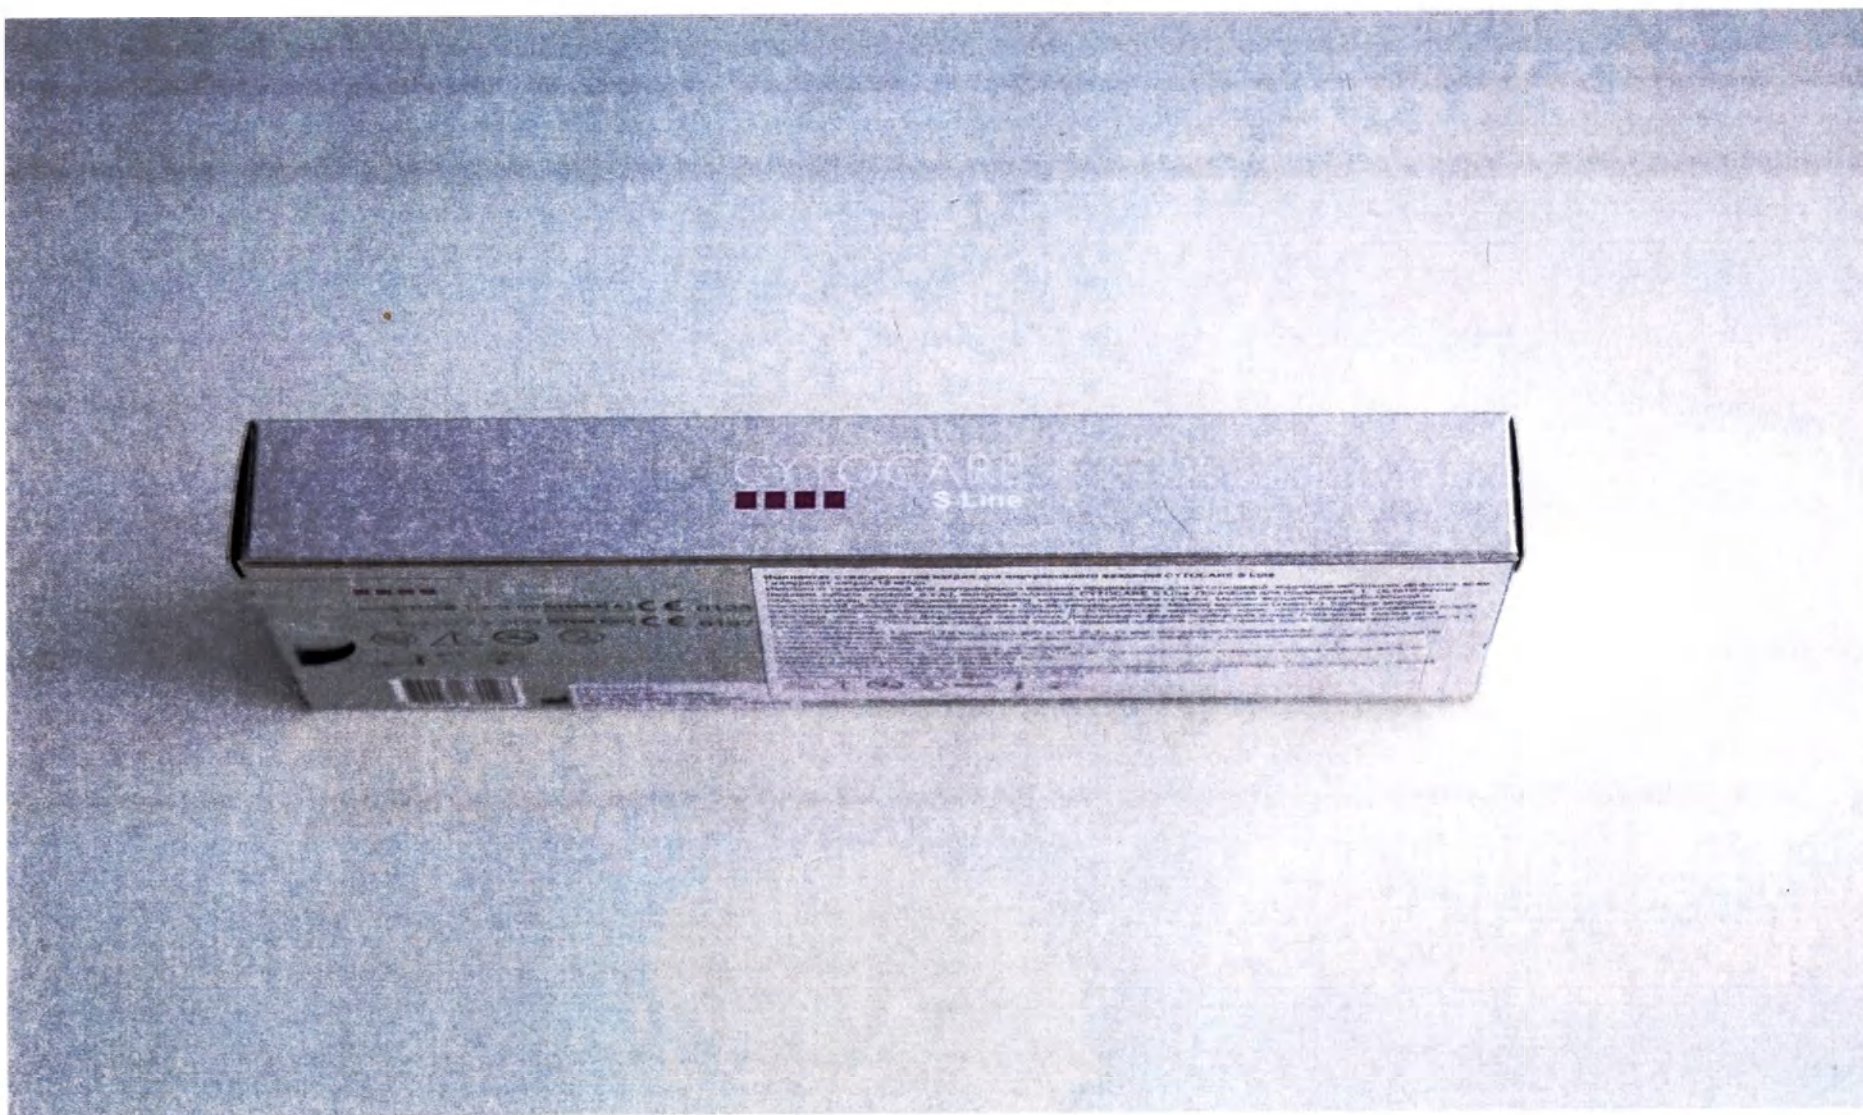


Рис. 3. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки CYTOCARE S Line.

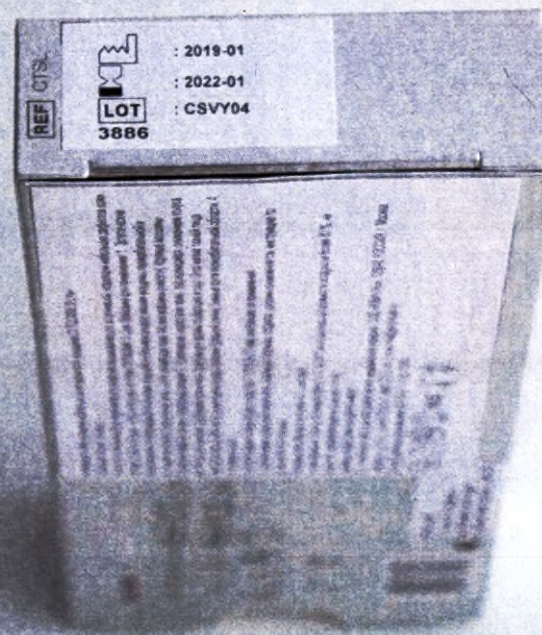


Рис. 4. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки CYTOCARE S Line.

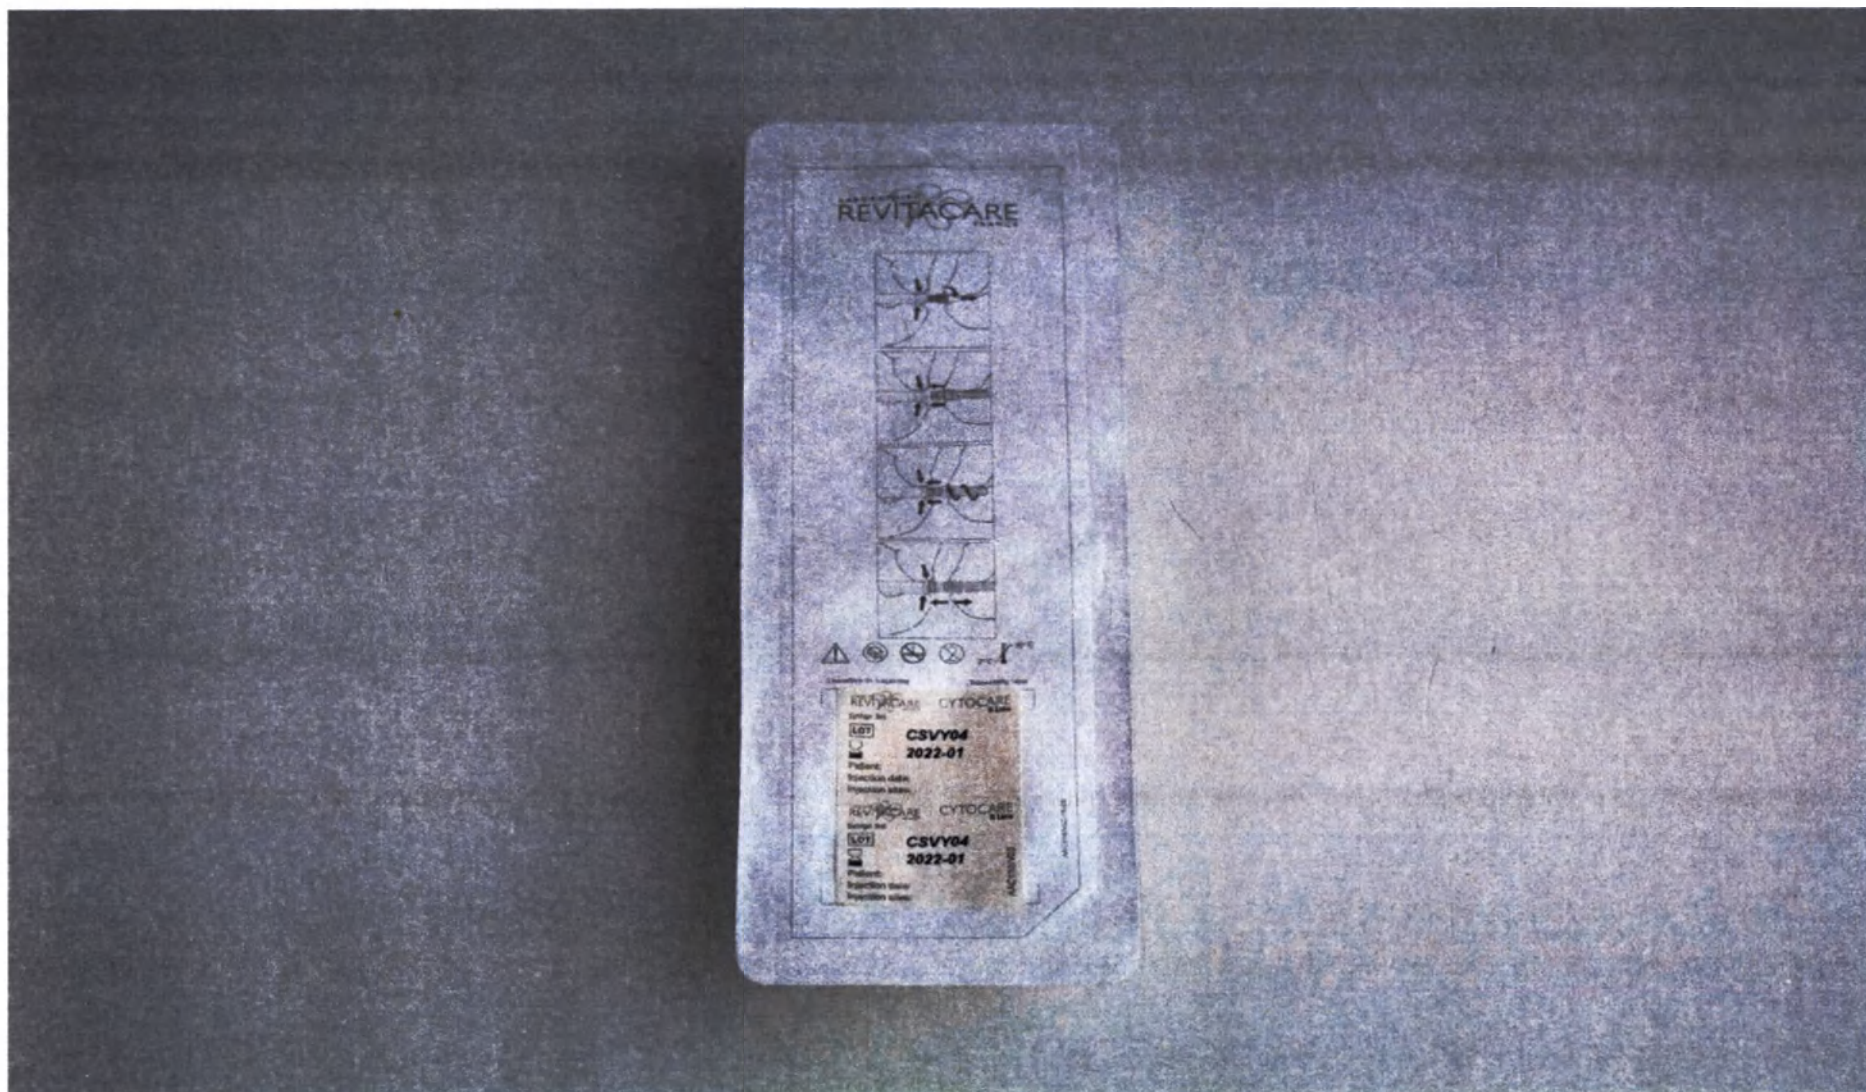


Рис. 5. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера CYTOCARE S Line.

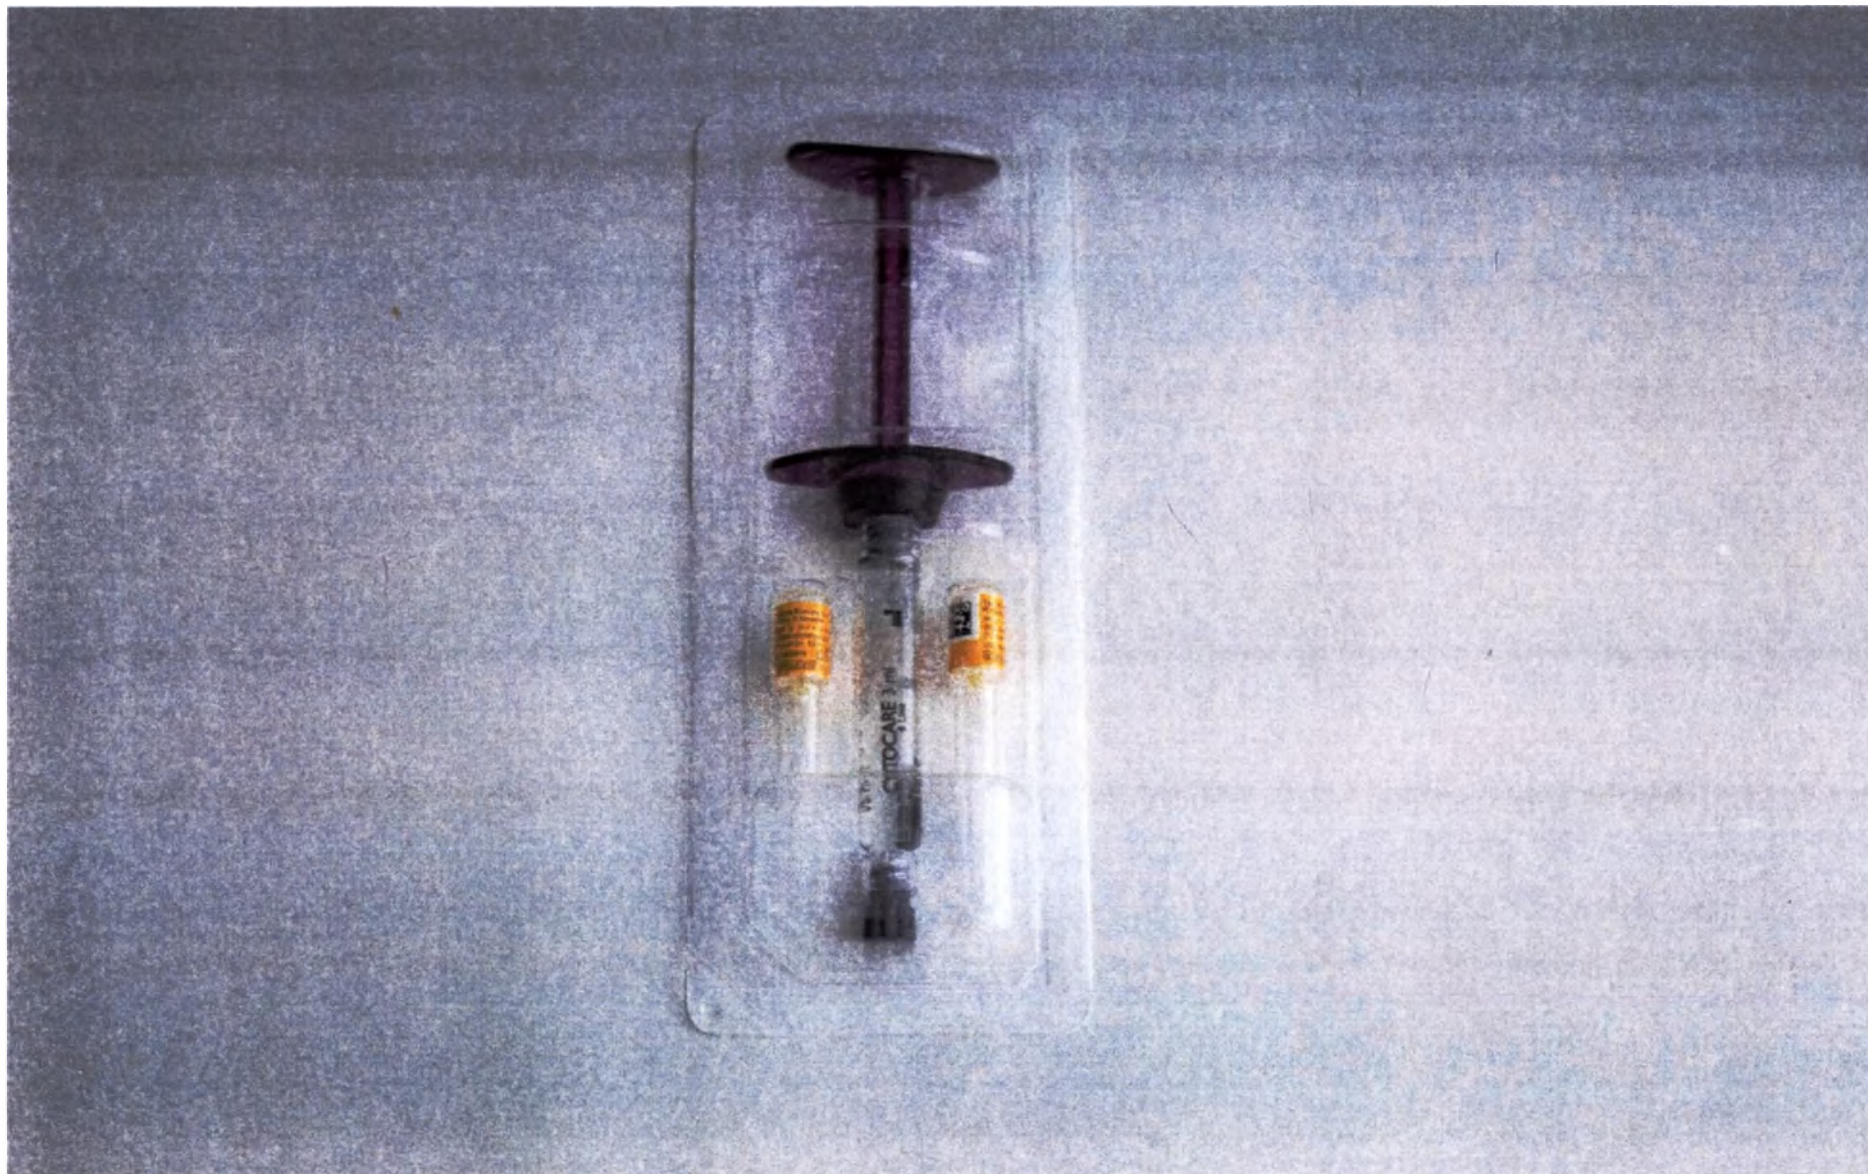


Рис. 6. На фотографии приведен общий вид обратной стороны блистера CYTOCARE S Line.

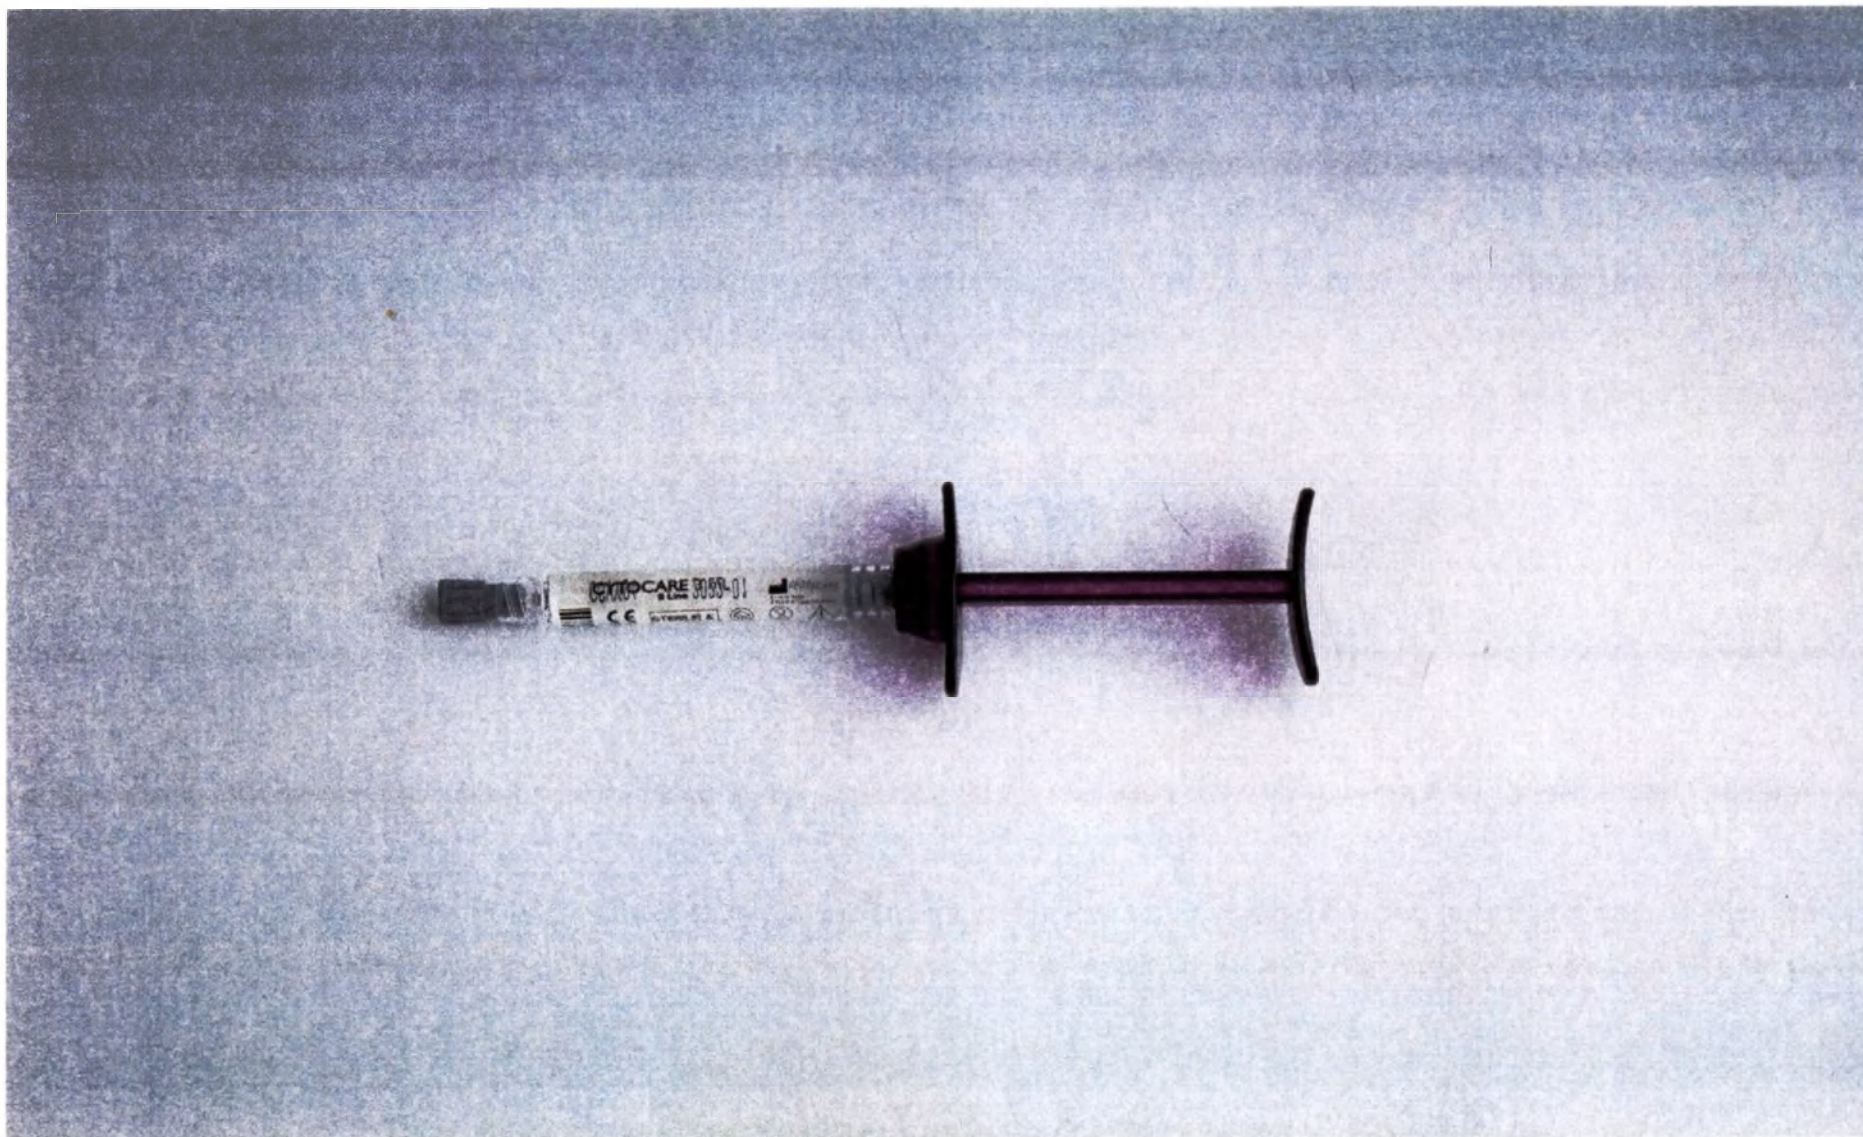


Рис. 7. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны наполненного шприца CYTOCARE S Line.

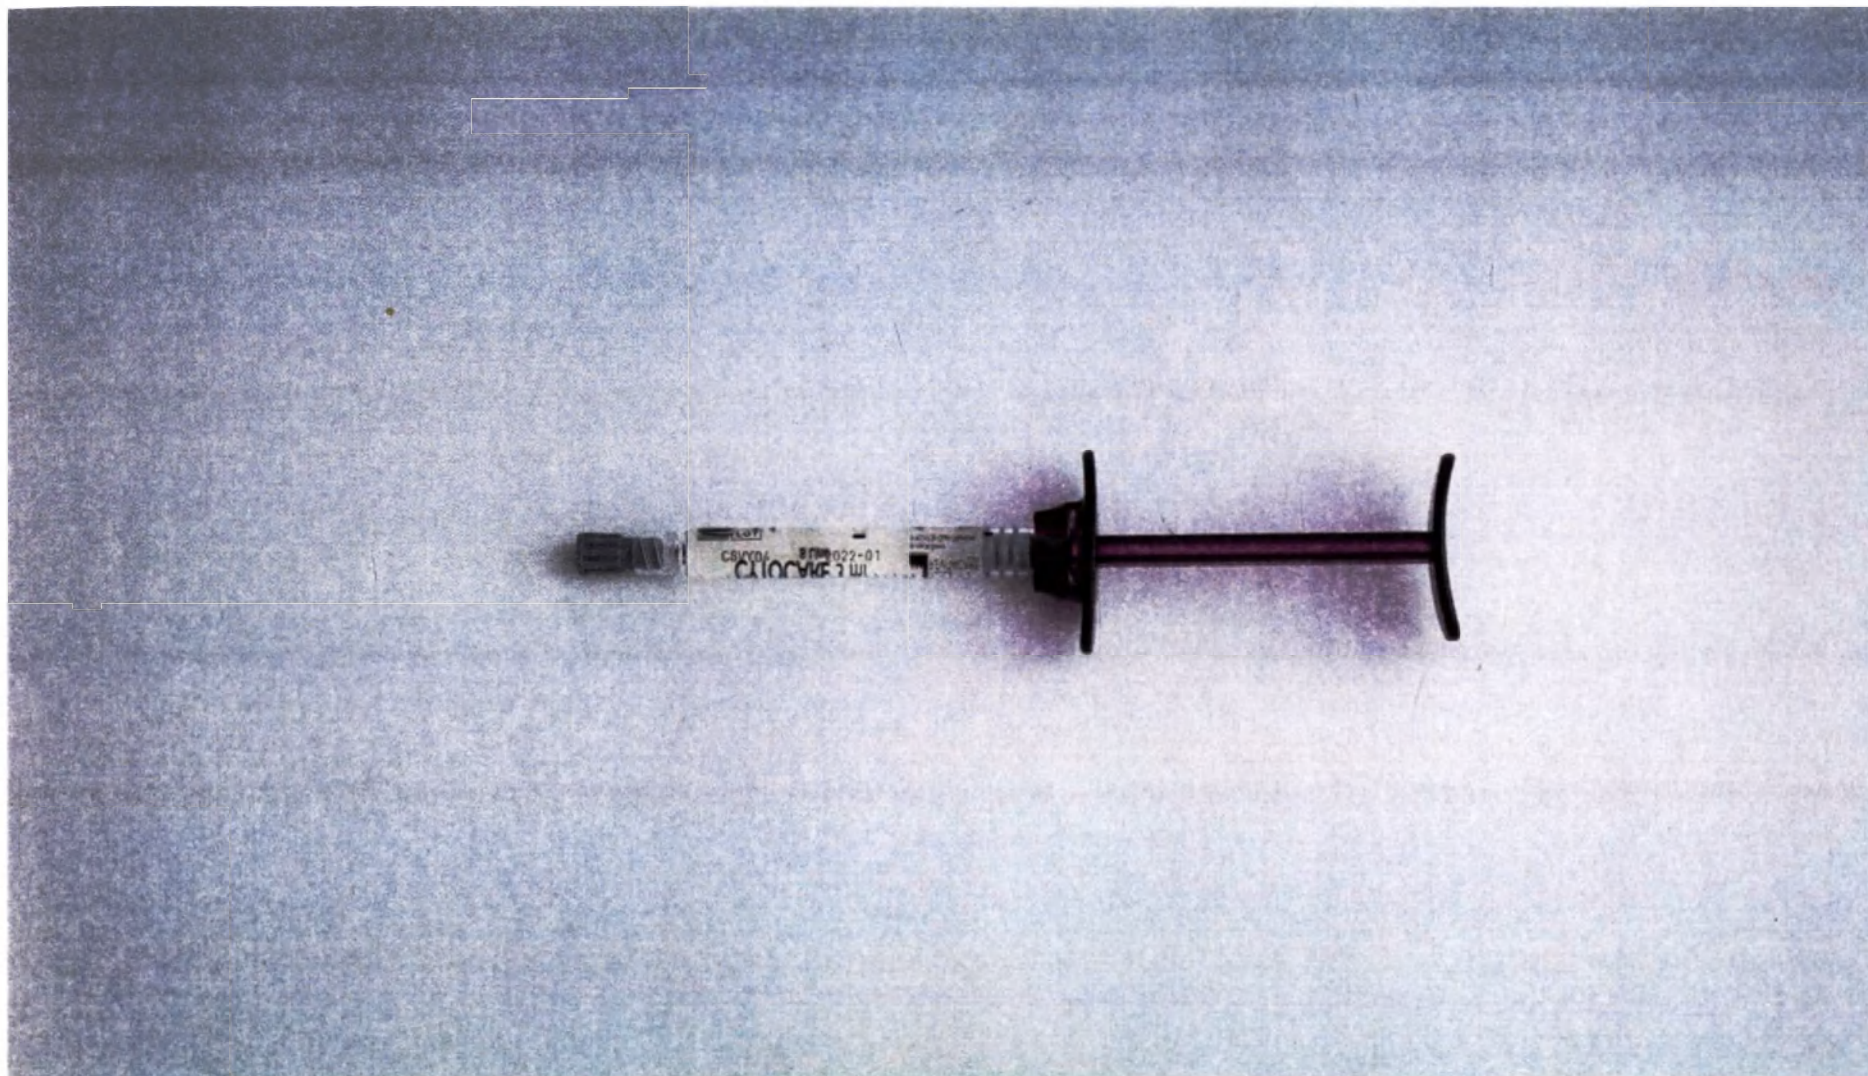


Рис. 8. На фотографии приведен общий вид обратной стороны шприца CYTOCARE S Line.

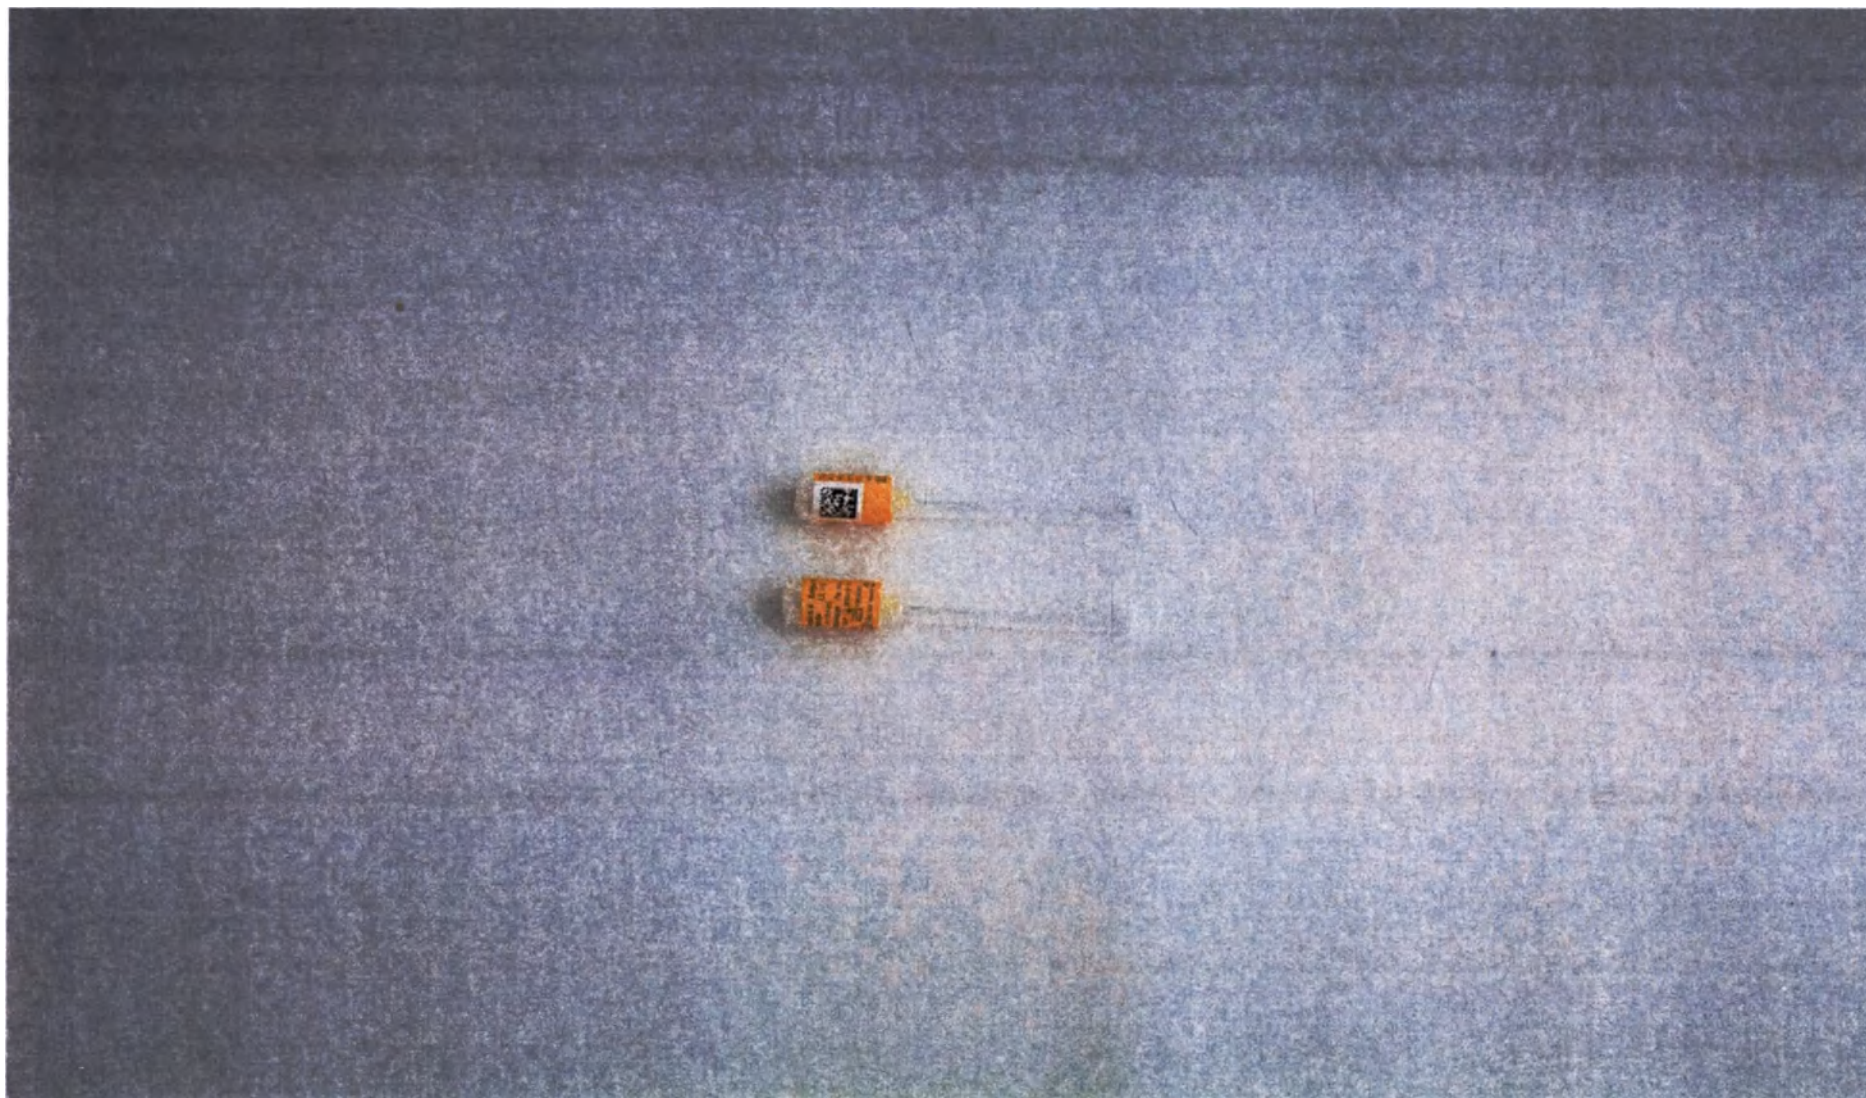


Рис. 9. На фотографии приведен общий вид колпачка с иглой CYTOCARE S Line.



Рис. 10. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки CYTOCARE 715 C Line.

10

go to atg.com/learnaboutus
for software support.



3 7602 71870 1

一

Рис. 11. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки CYTOCARE 715 C Line.

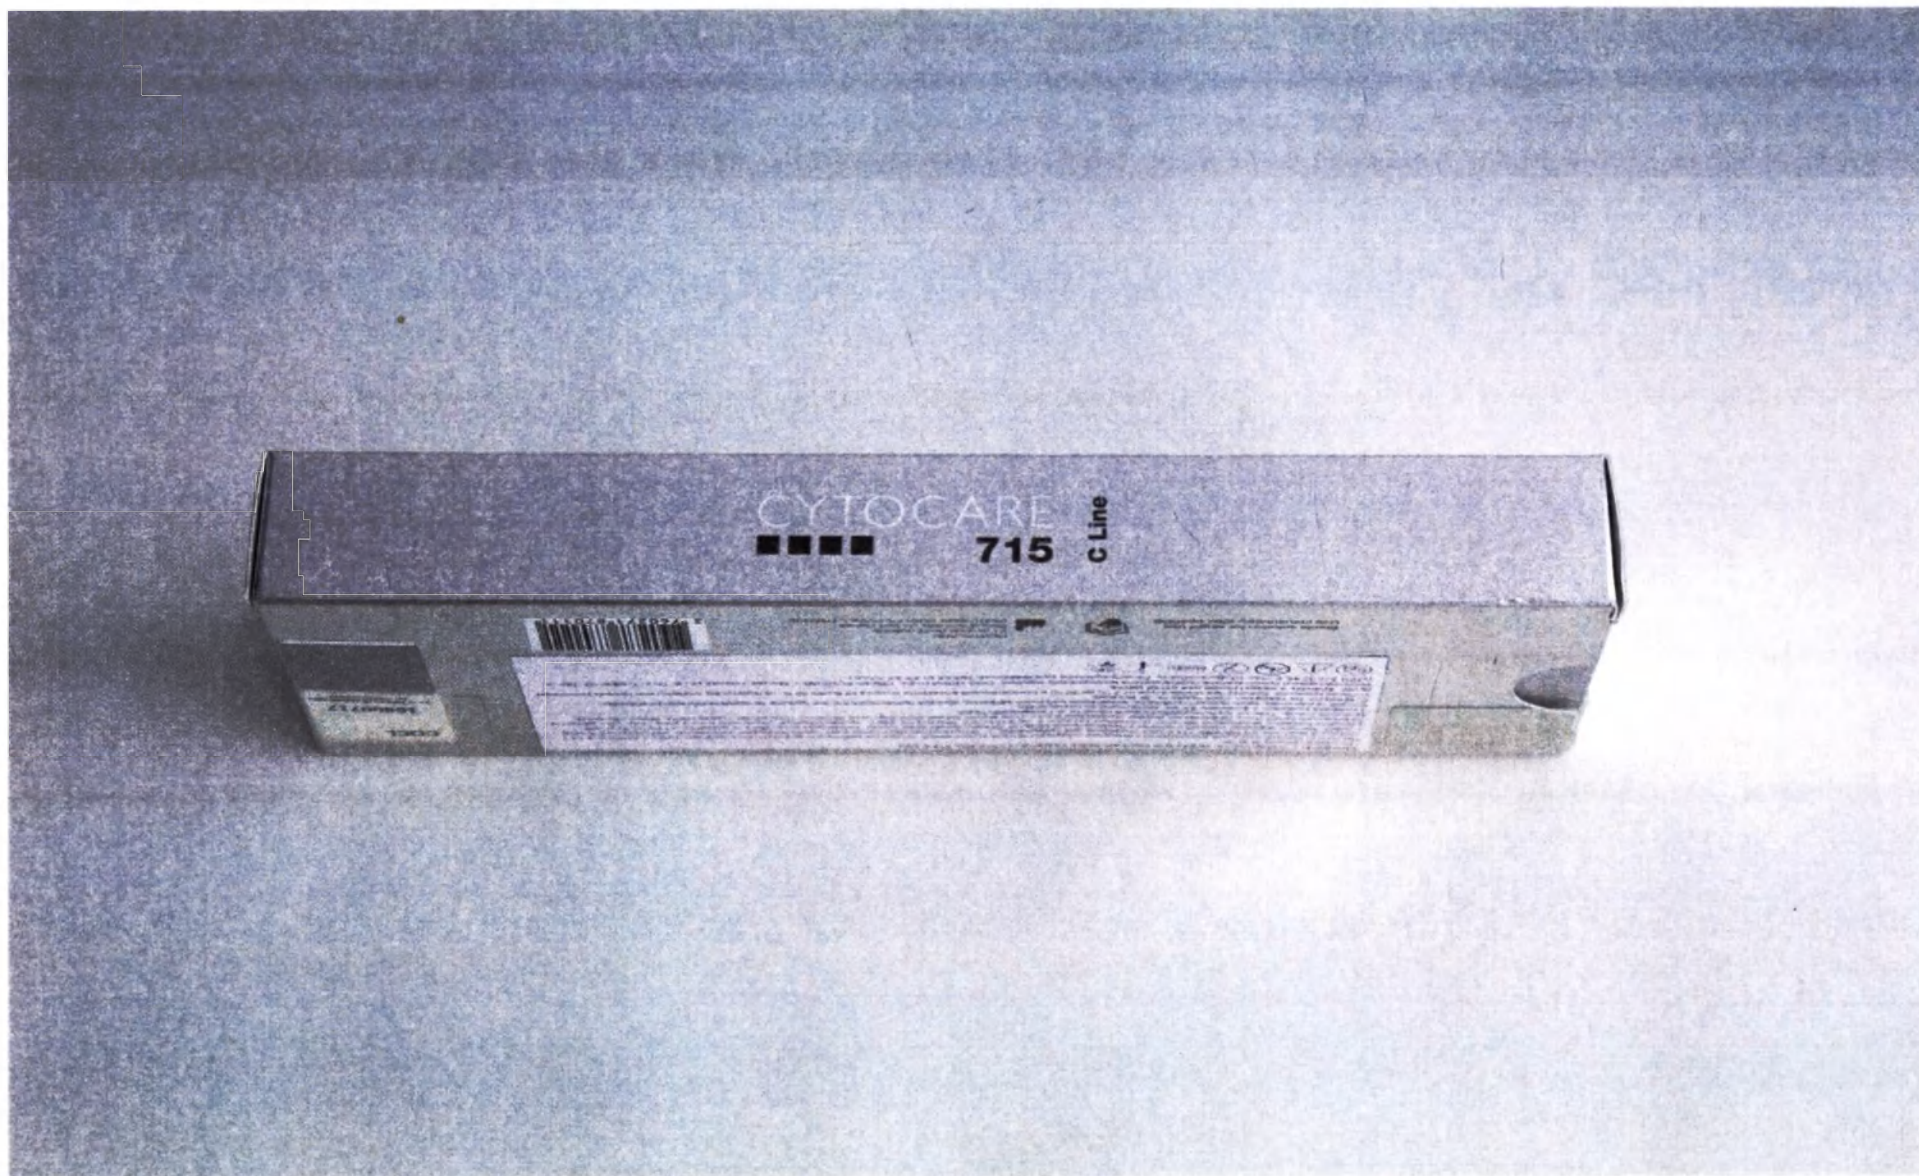


Рис. 12. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки CYTOCARE 715 C Line.

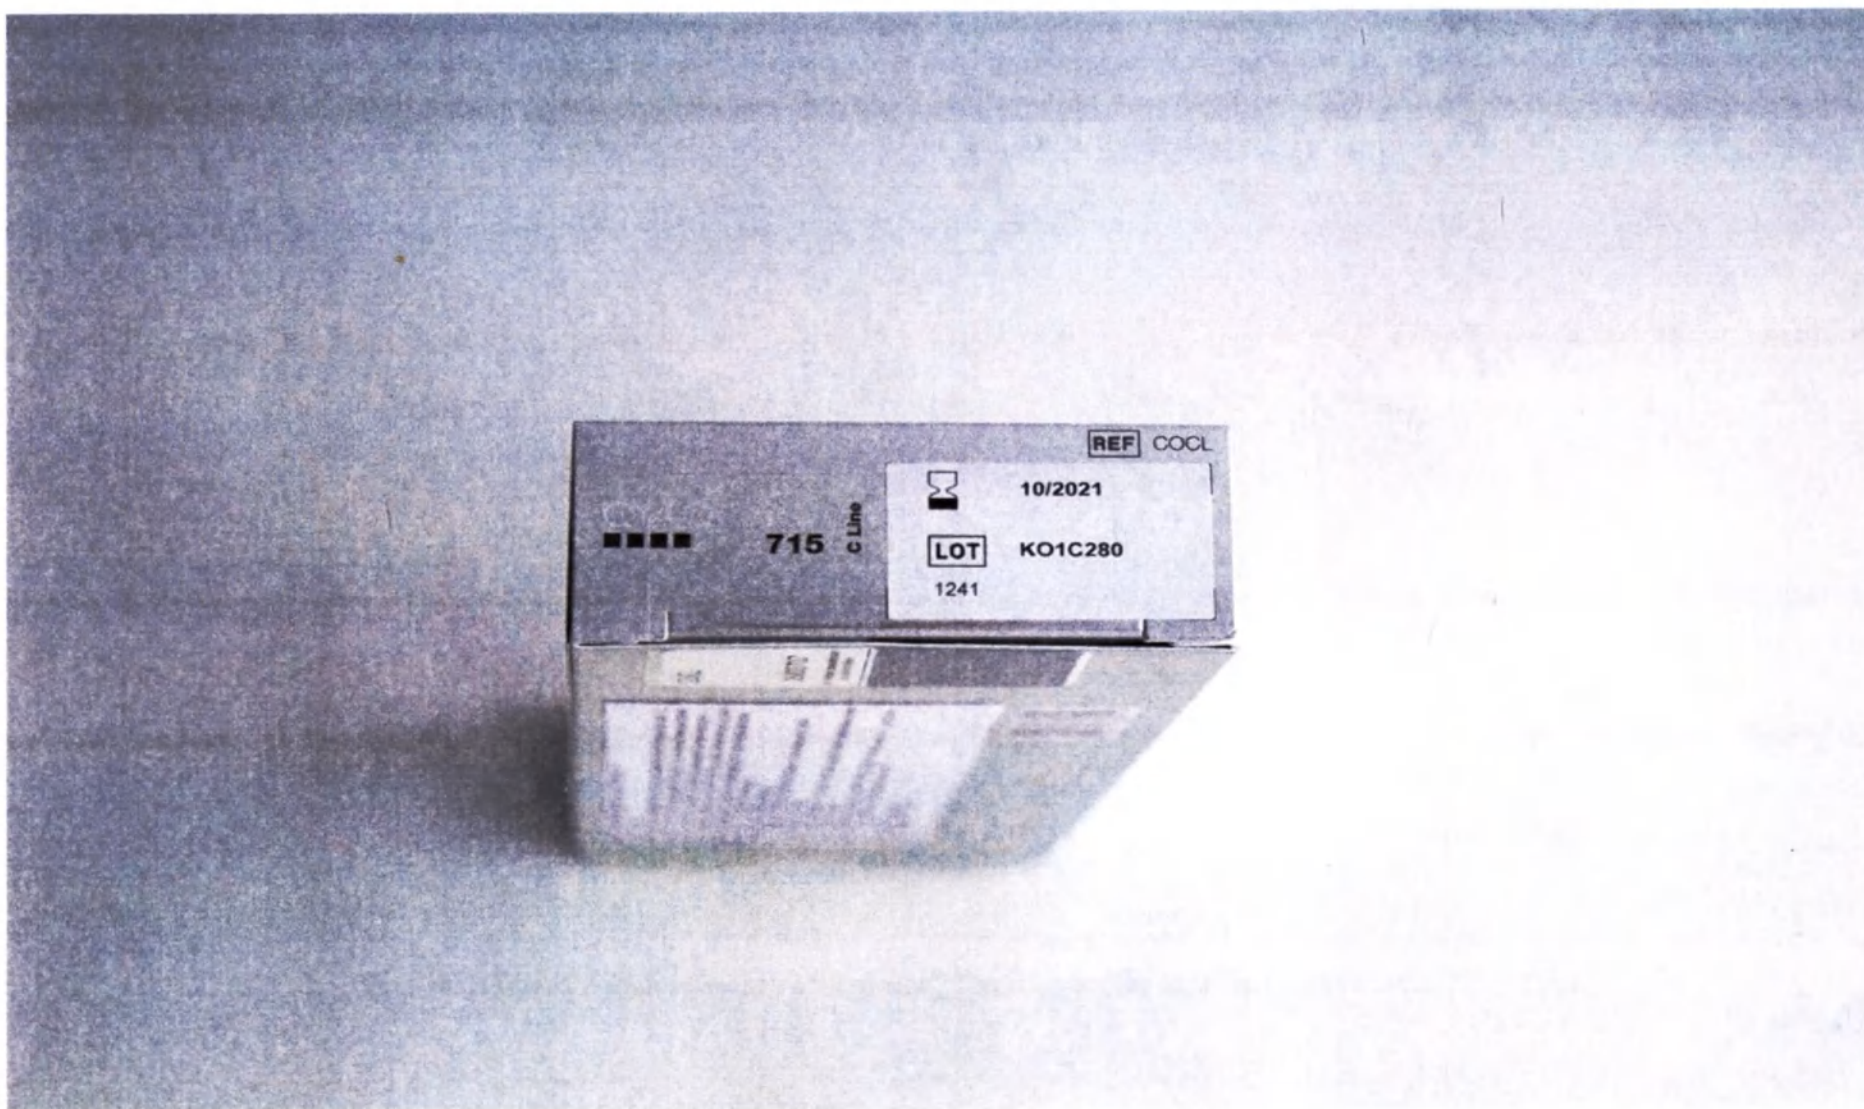


Рис. 13. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки CYTOCARE 715 C Line.



Рис. 14. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера CYTOCARE 715 C Line.

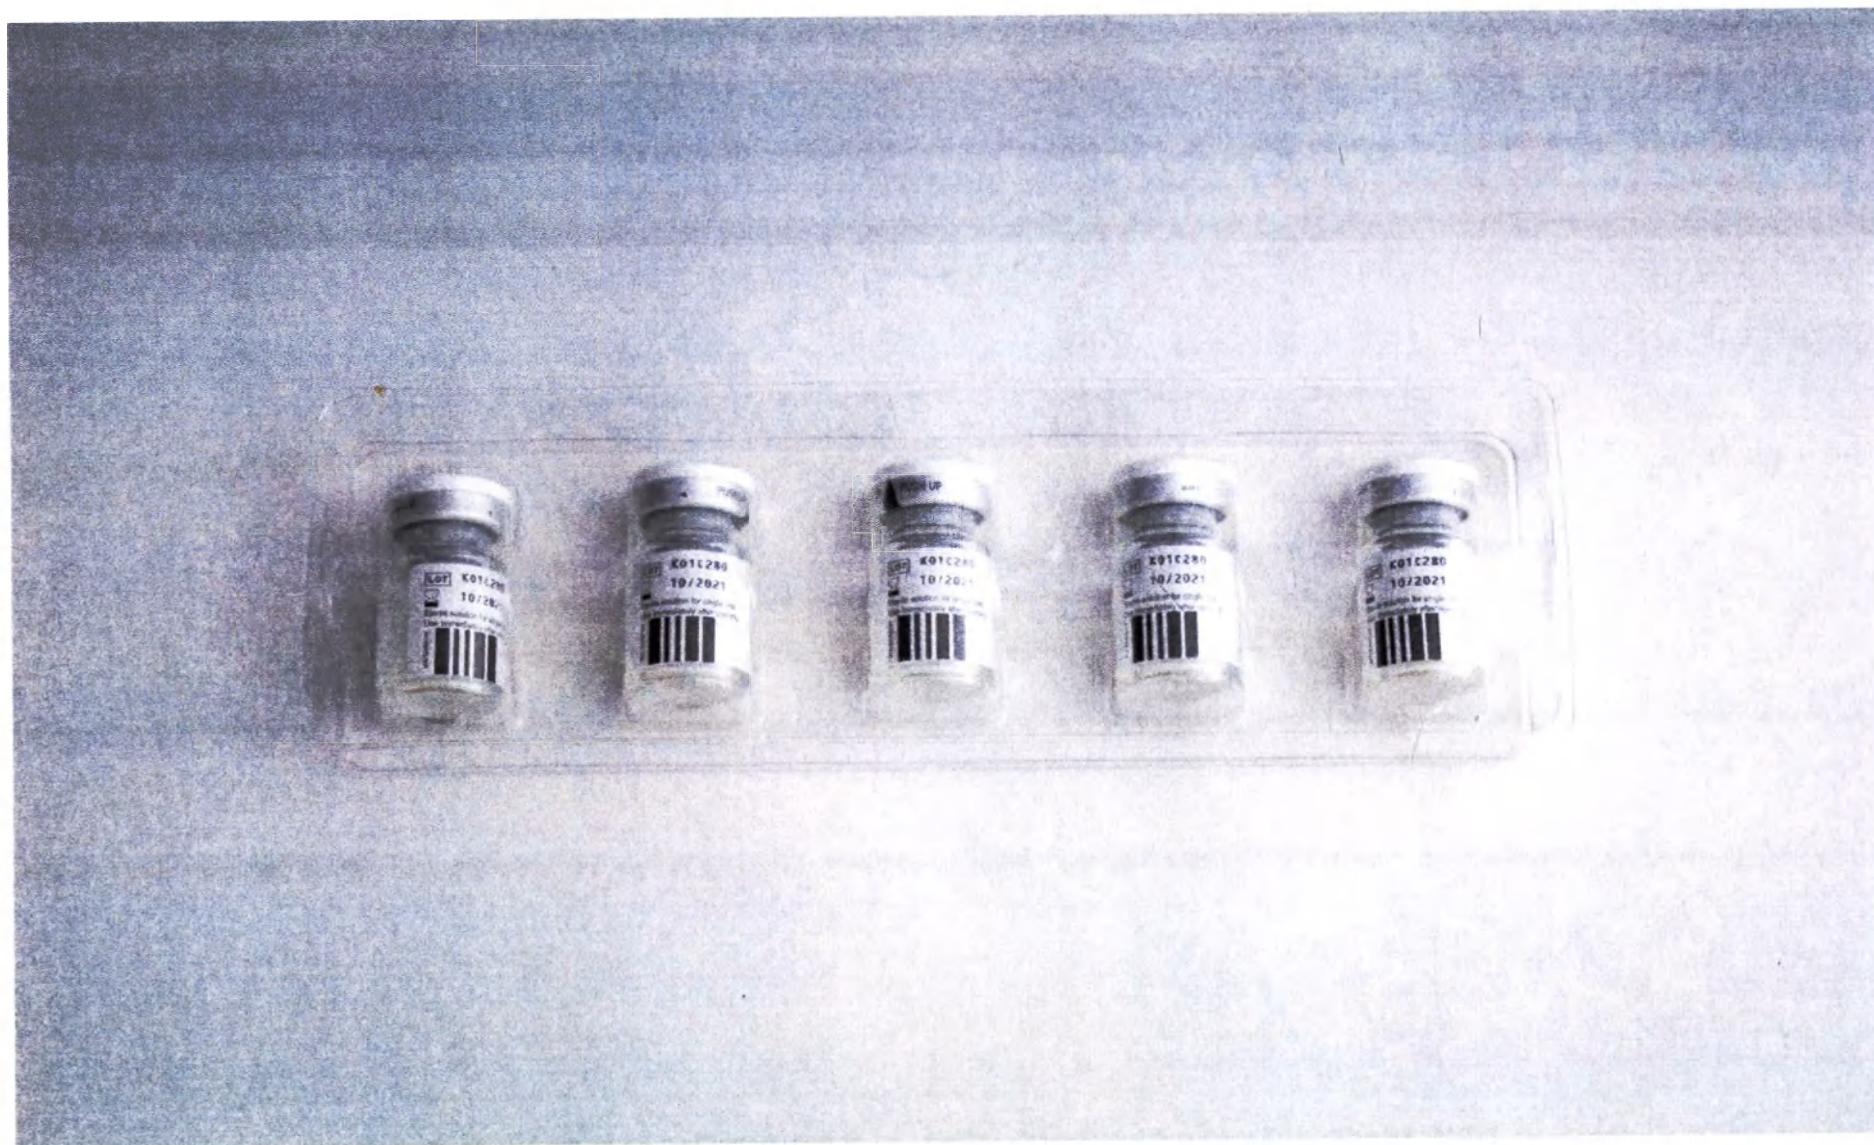


Рис. 15. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны блистера CYTOCARE 715 C Line.

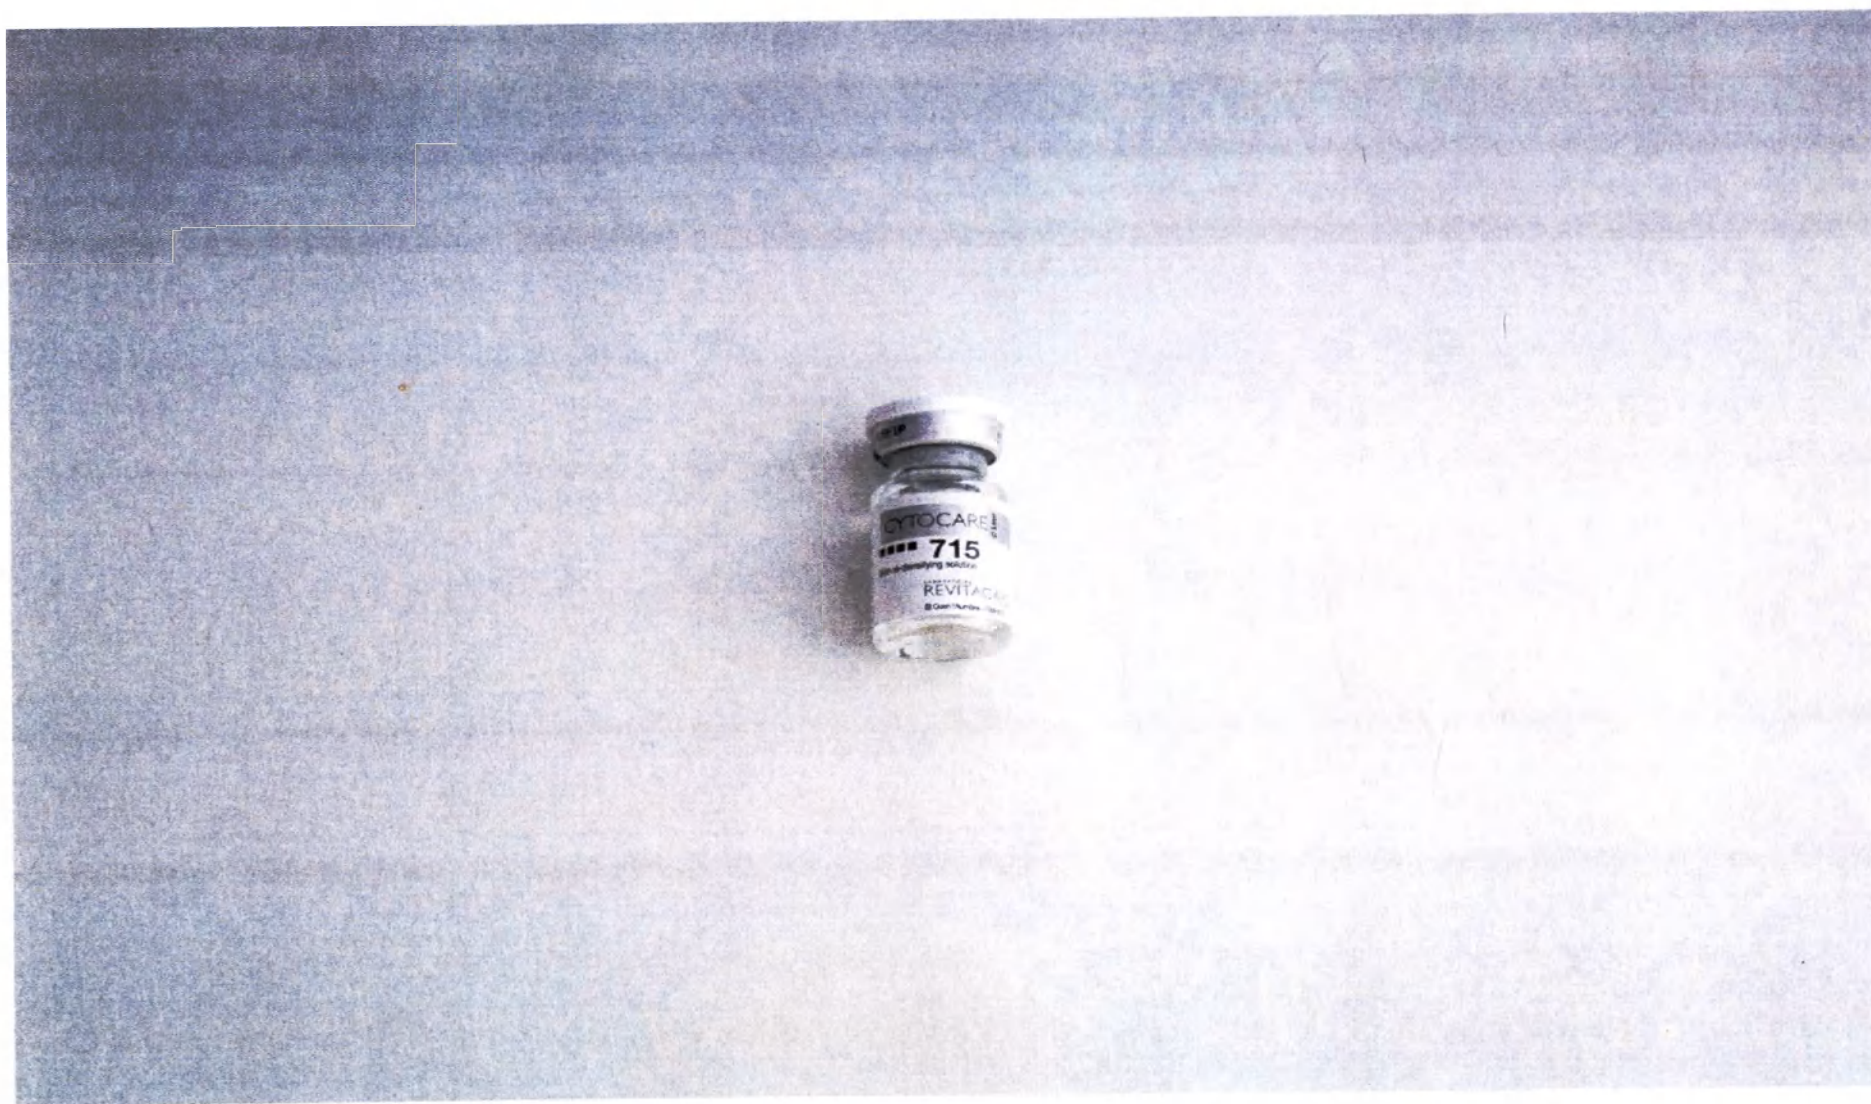


Рис. 16. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны флакона CYTOCARE 715 C Line.

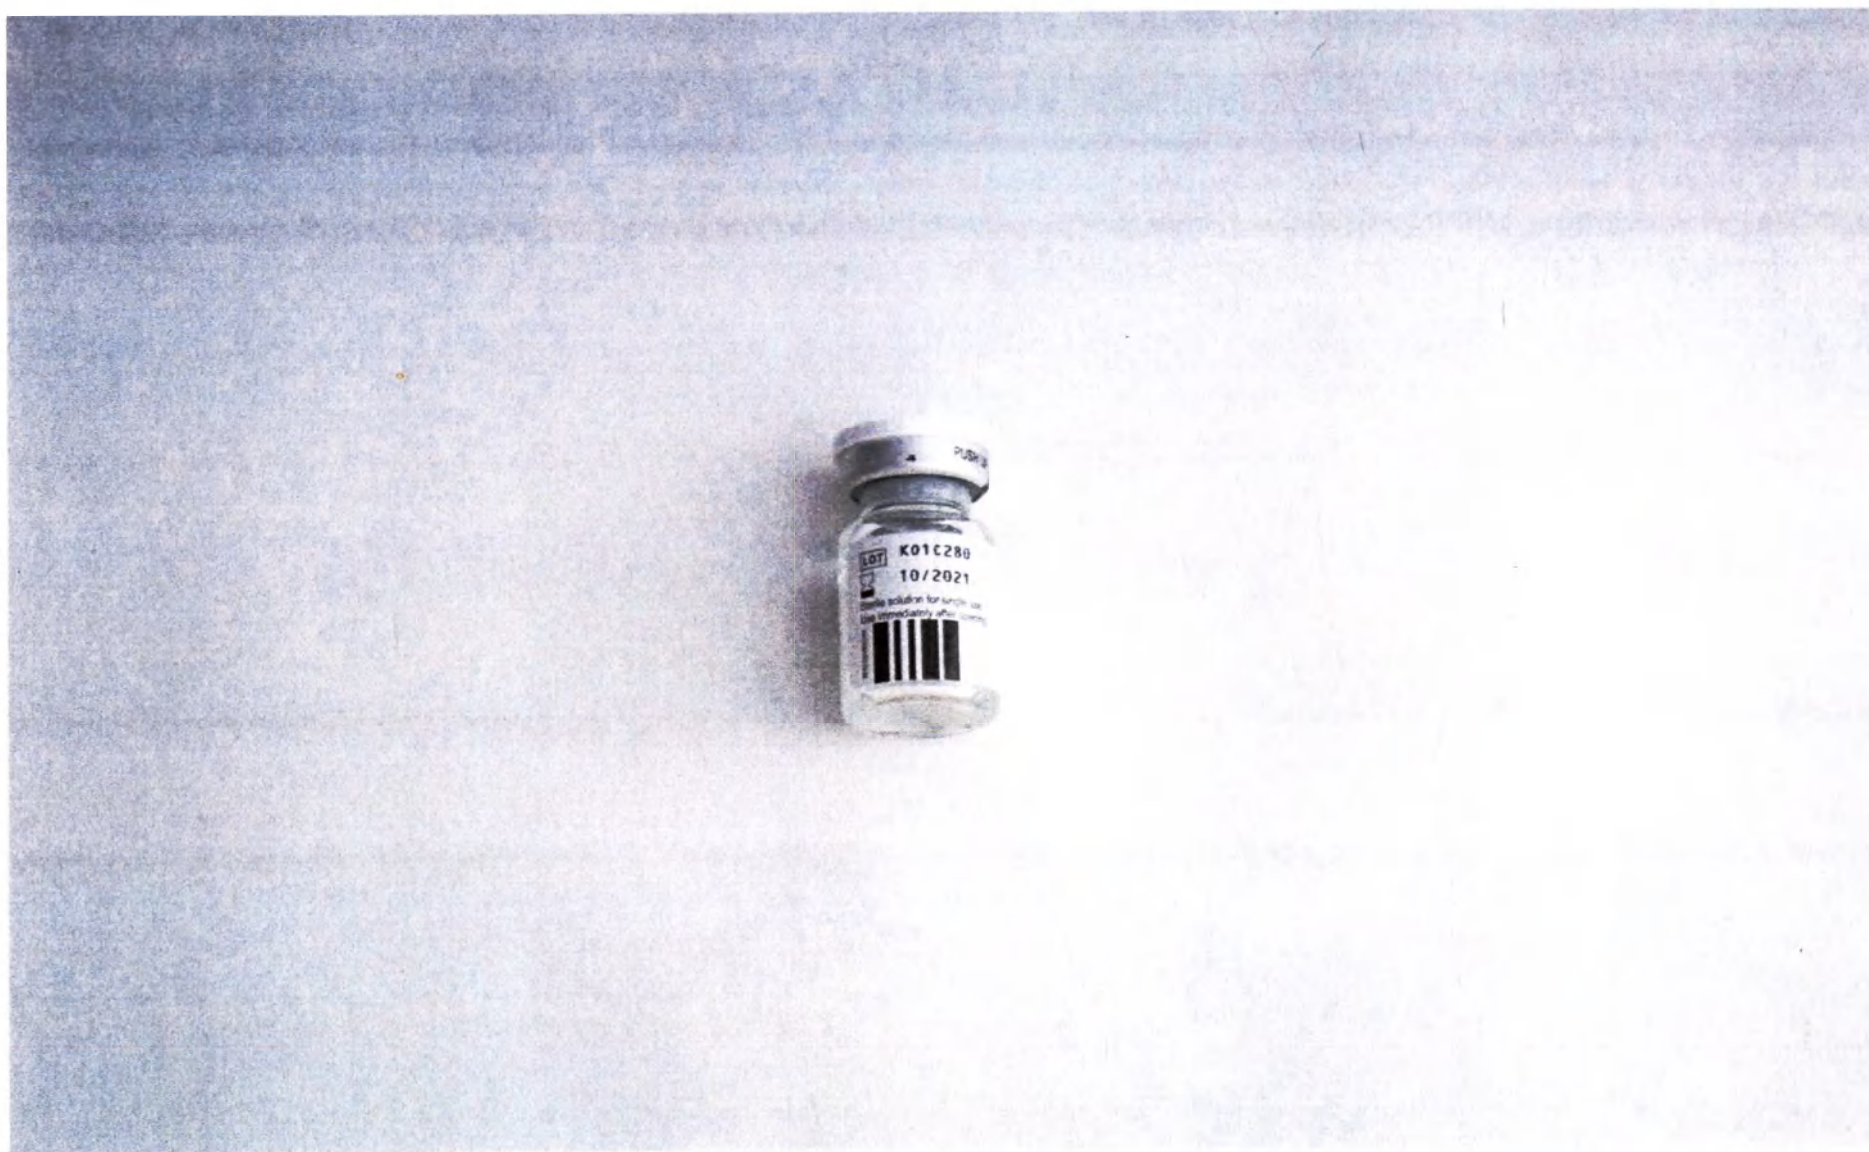


Рис. 17. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны флакона CYTOCARE 715 C Line.



Рис. 18. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки HAIRCARE.

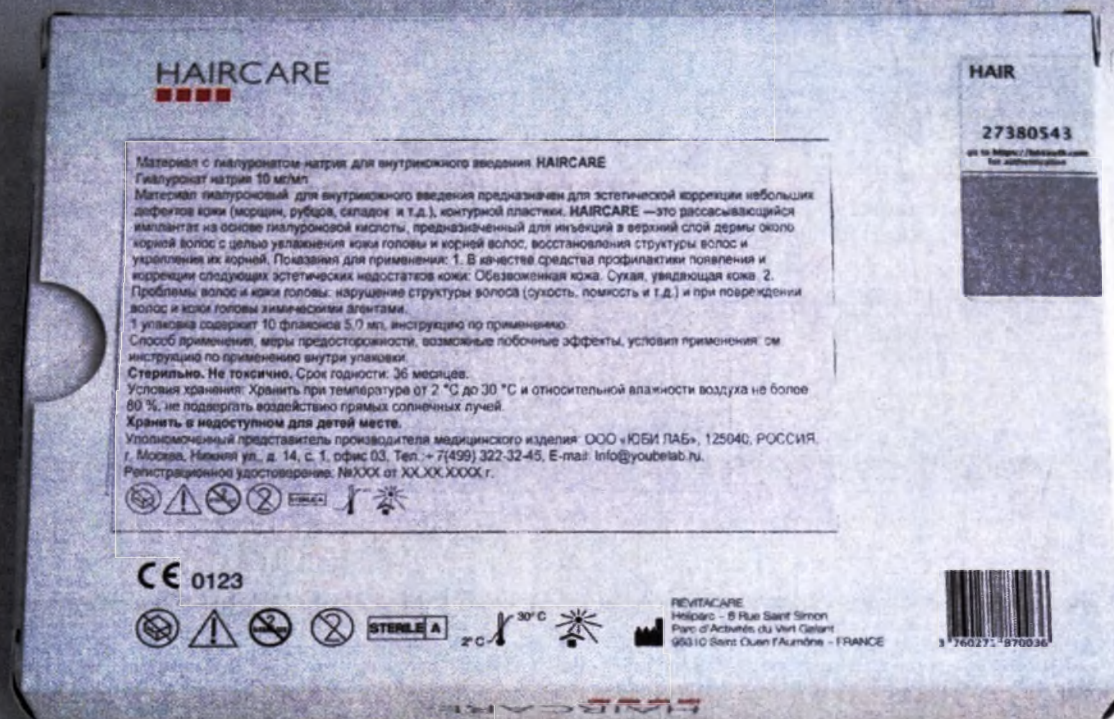


Рис. 19. На фотографии приведен общий вид обратной стороны картонной коробки HAIRCARE.

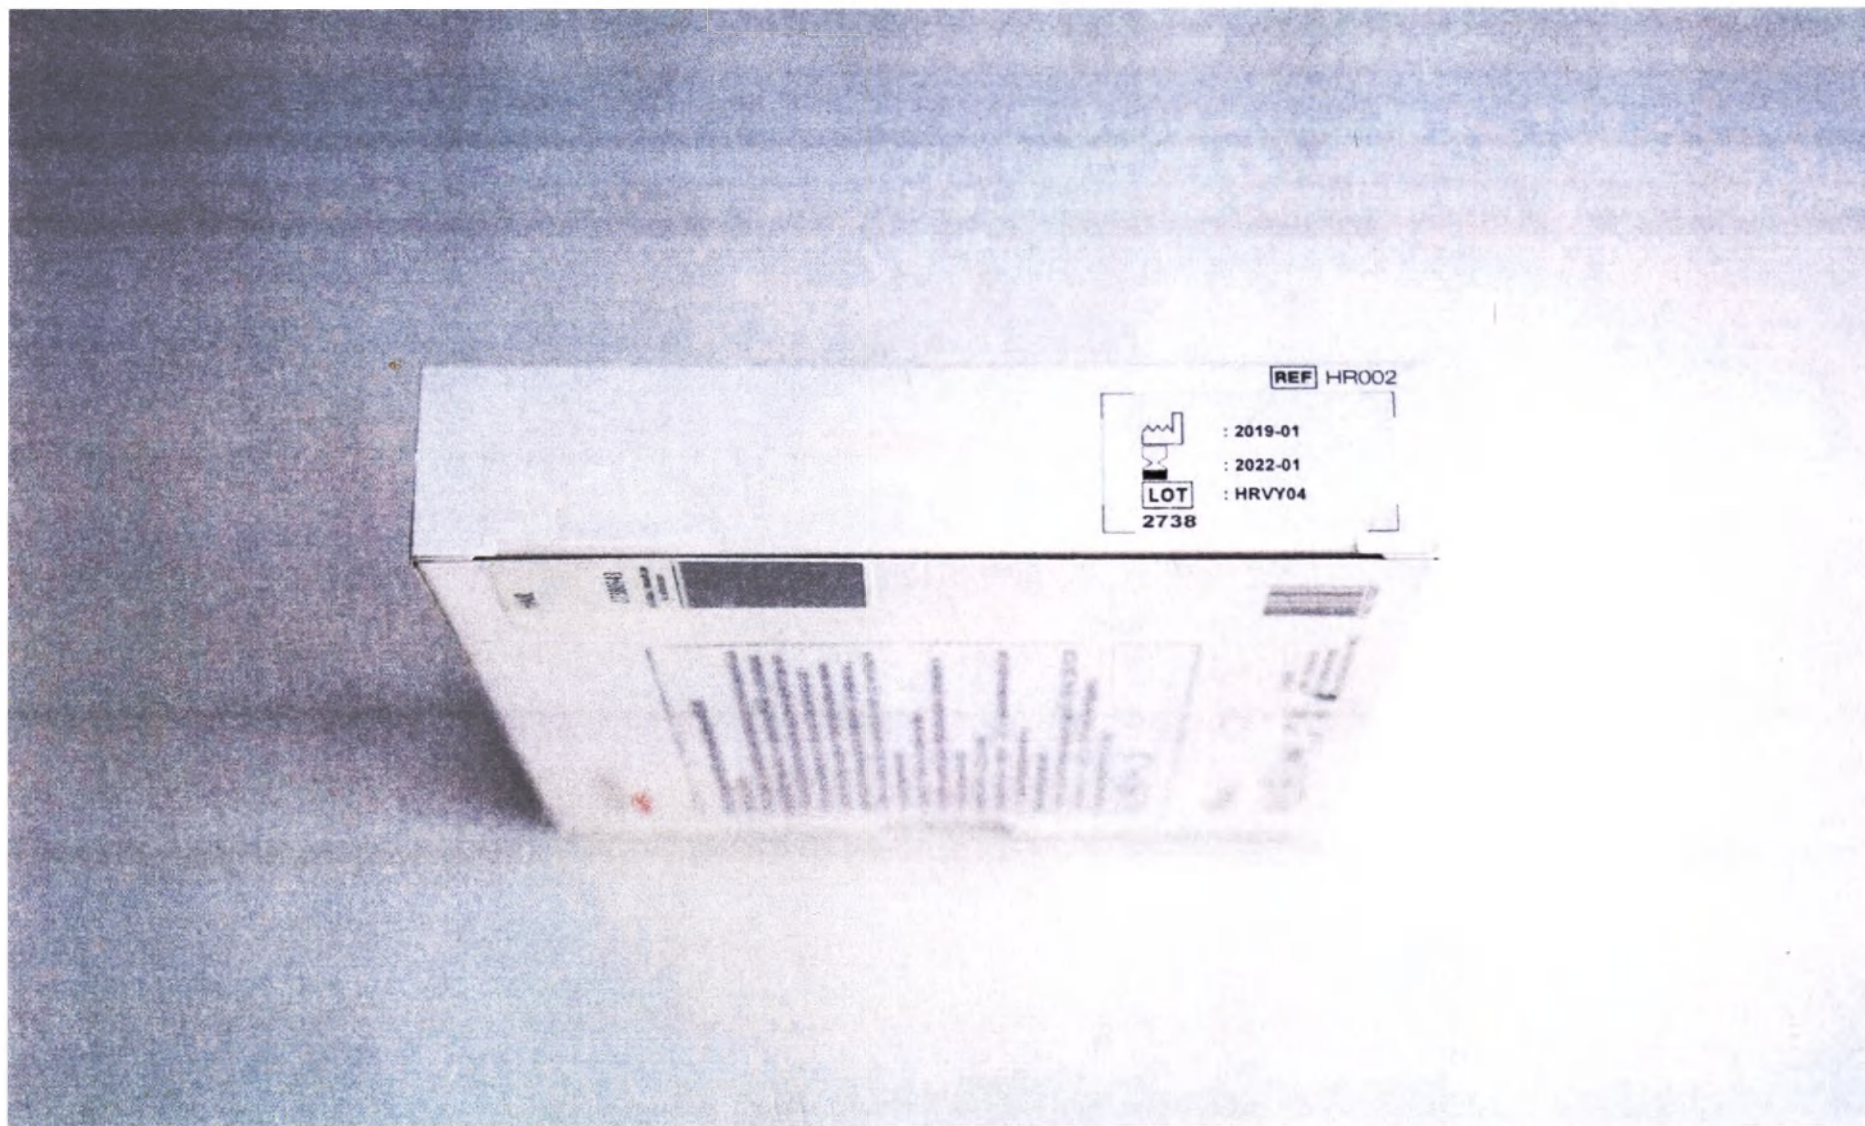


Рис. 20. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки HAIRCARE.

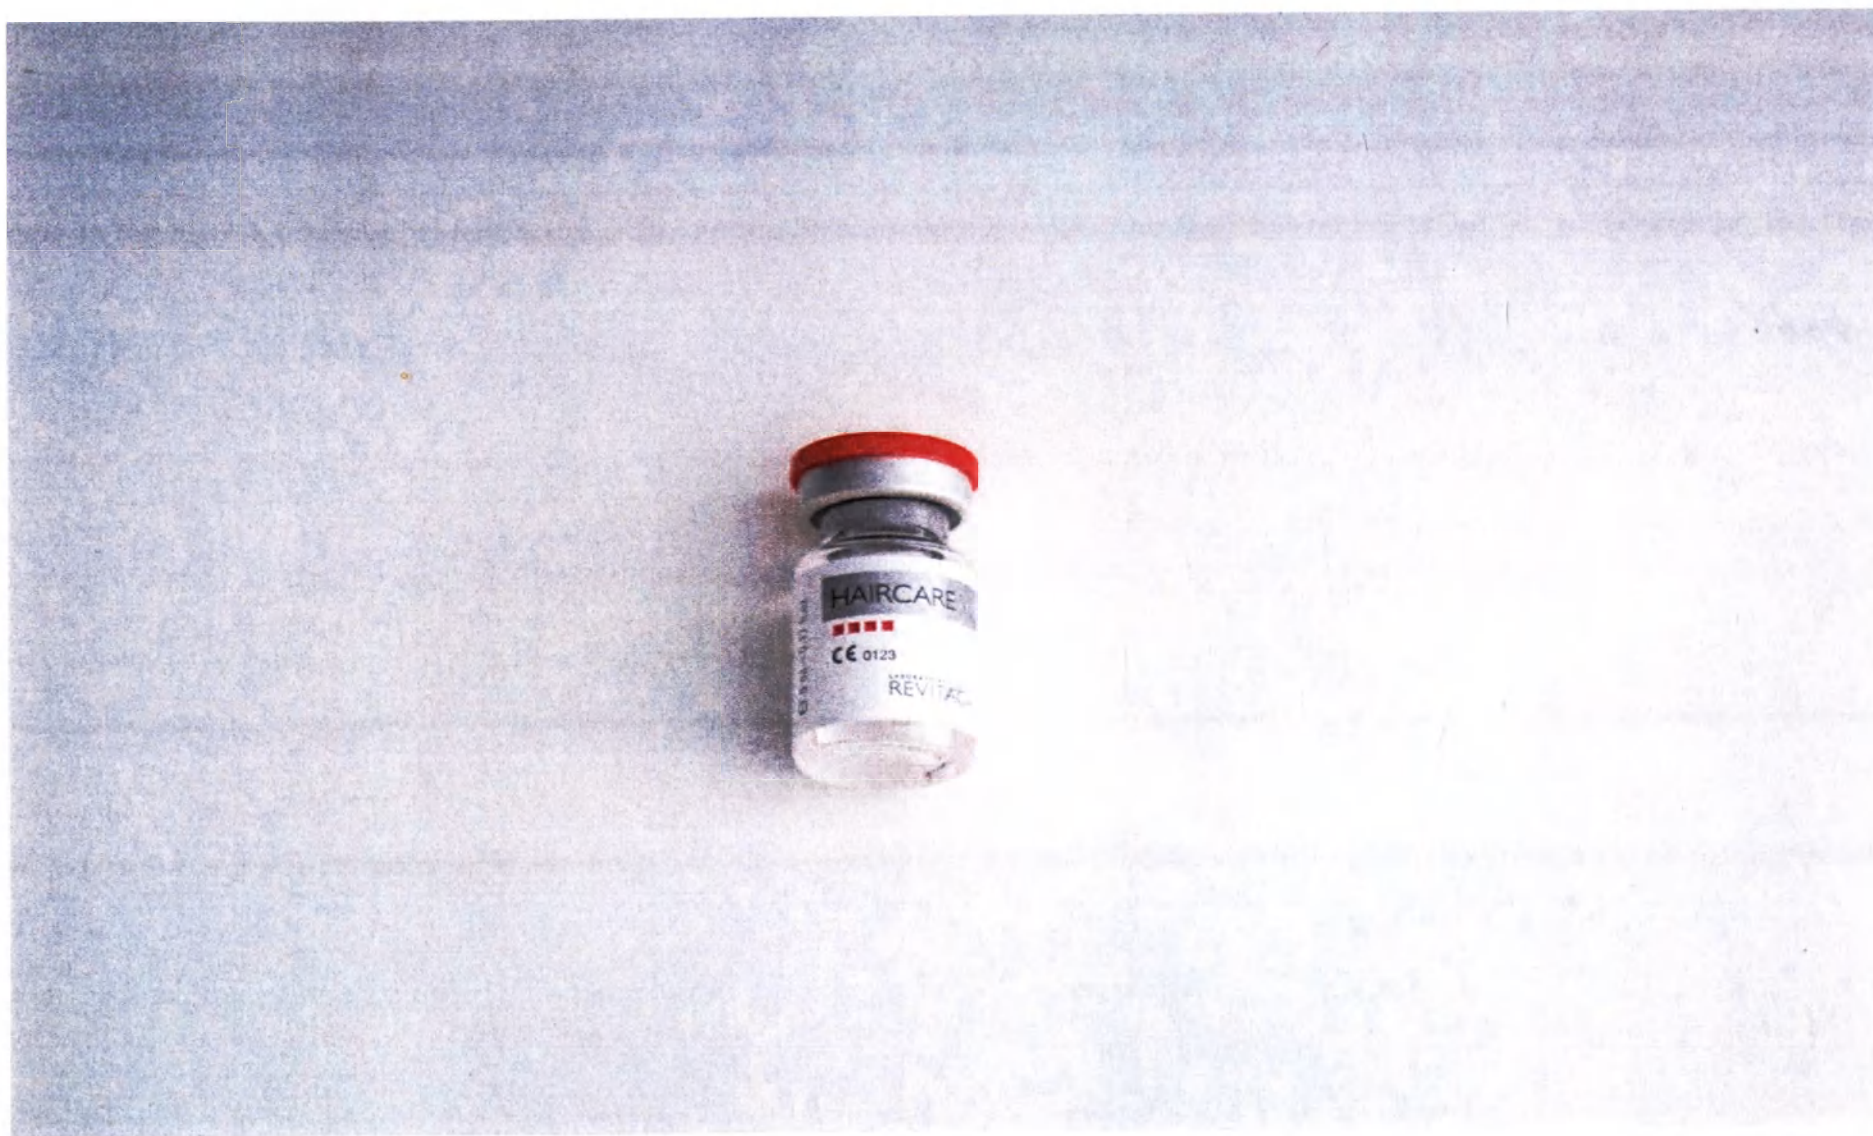


Рис. 21. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны HAIRCARE.

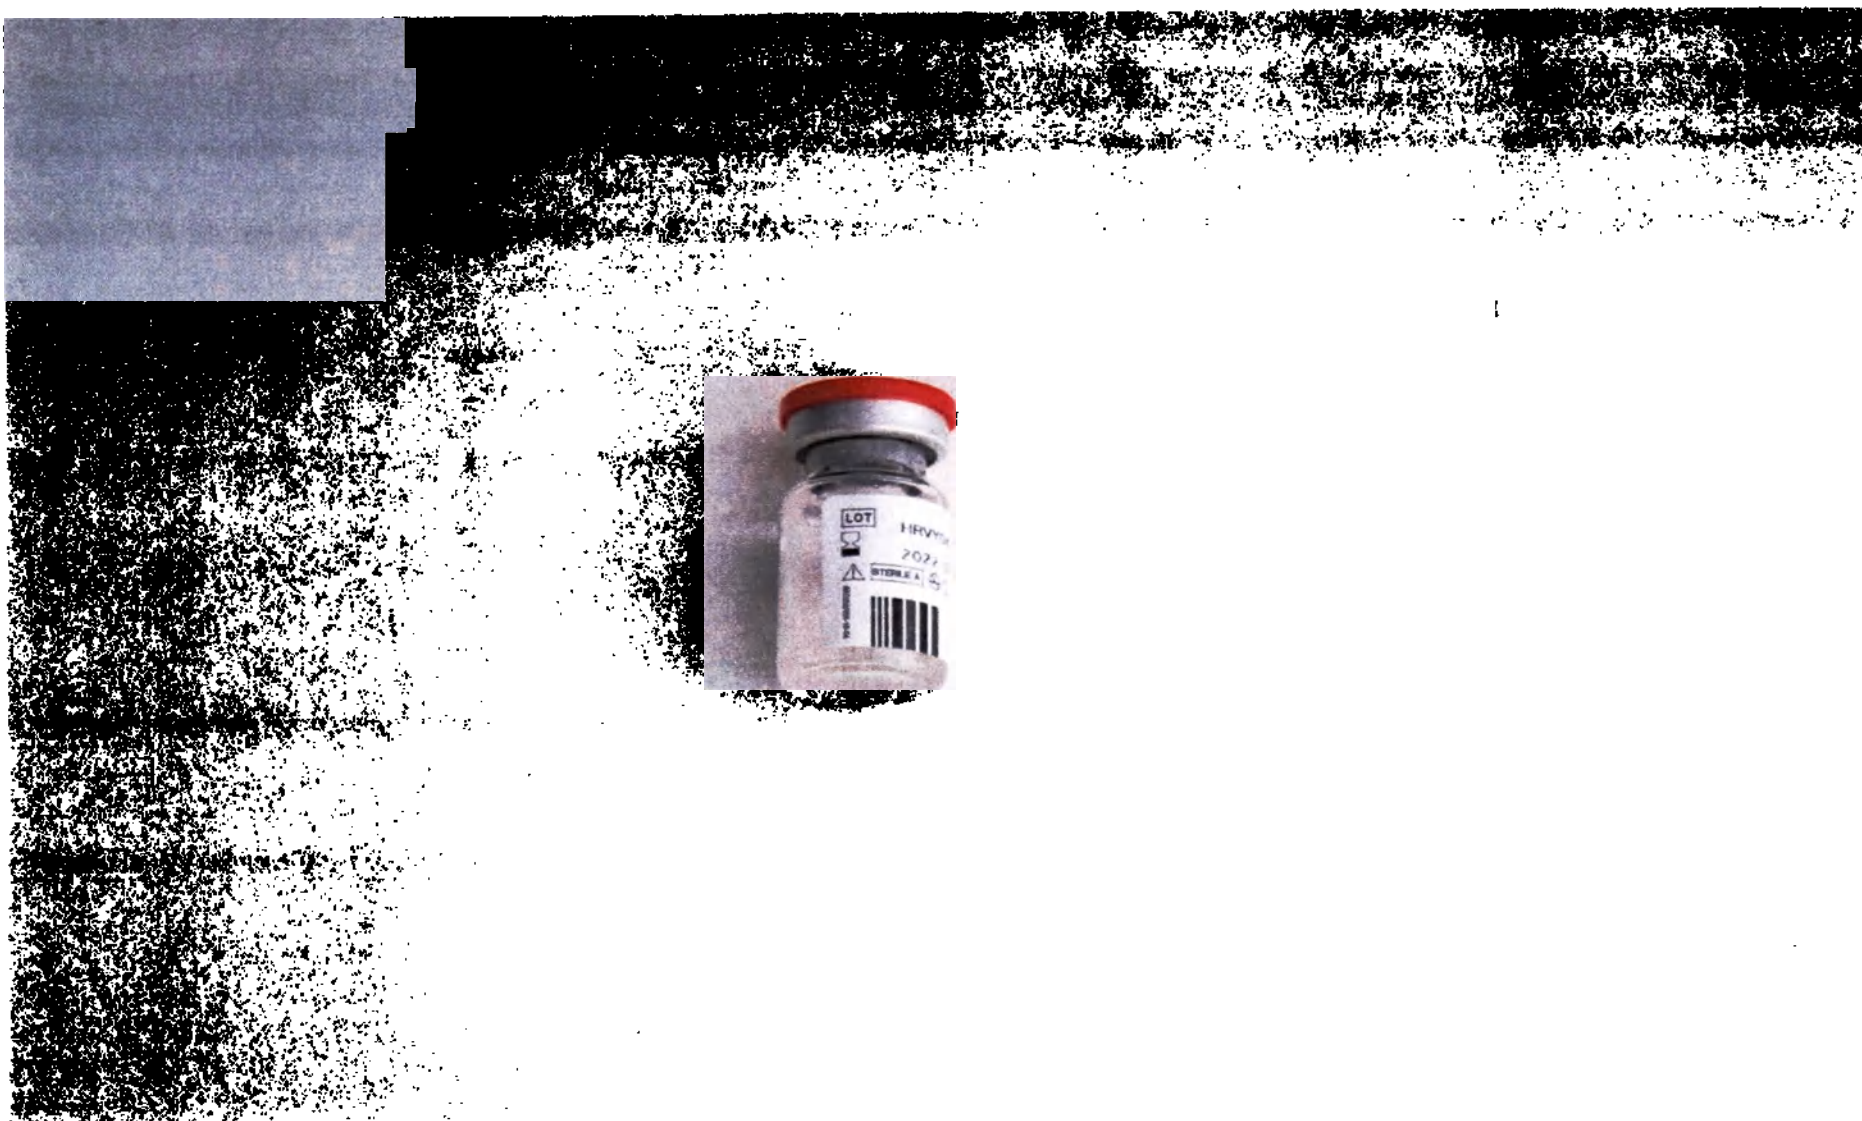


Рис. 22. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны HAIRCARE.



Рис. 23. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера HAIRCARE.



Рис. 24. На фотографии приведен оборотной стороны блистера HAIRCARE.

Прошито и пронумеровано
скреплено печатью 25 л

Генеральный директор
ООО «ЮБИ ЛАБ»

О.Е. Кузне

МП

« 21 »

2022 г.

