

**Фотографии общего вида медицинского изделия**  
**Тест-полоска мочевая Littest для in vitro исследования мочи на анализаторах URIT, UriLit:**


Для применения на анализаторе

# Тест-полоски мочевые **LITTEST 11F**

## Urine Reagent Strips

100 тест-полосок

- Аскорбиновая кислота
- Лейкоциты
- Кетоны
- Нитрит
- Уробилиноген
- Билирубин
- Протеин
- Глюкоза
- Удельная плотность
- Кровь
- pH



IVD



Guangxi Medical Electronic Co., Ltd.  
No. D-07 Information Industry District  
High-Tech Zone, Guilin  
Guangxi 541004, PR China

полномочный представитель и импортер

# Тест-полоски мочевые **LITTEST 11F**

## Urine Reagent Strips

Для применения на анализаторе

**100 тест-полосок**

- Аскорбиновая кислота
- Лейкоциты
- Кетоны
- Нитрит
- Уробилиноген
- Билирубин
- Протеин
- Глюкоза
- Удельная плотность
- Кровь
- pH


2°C — 30°C




Urit Medical Electronic Co., Ltd.  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Guilin  
Guangxi 541004, PR China

РУ №...

Уполномоченный представитель и импортер:

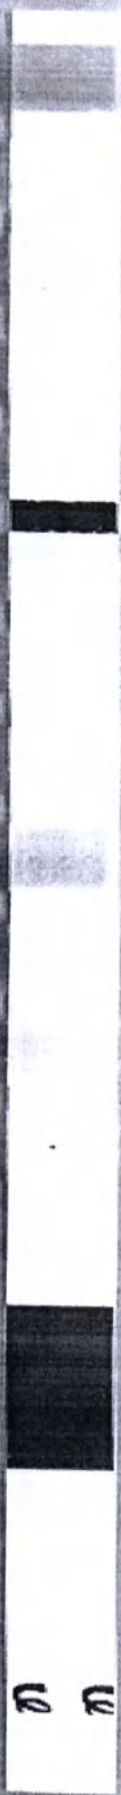

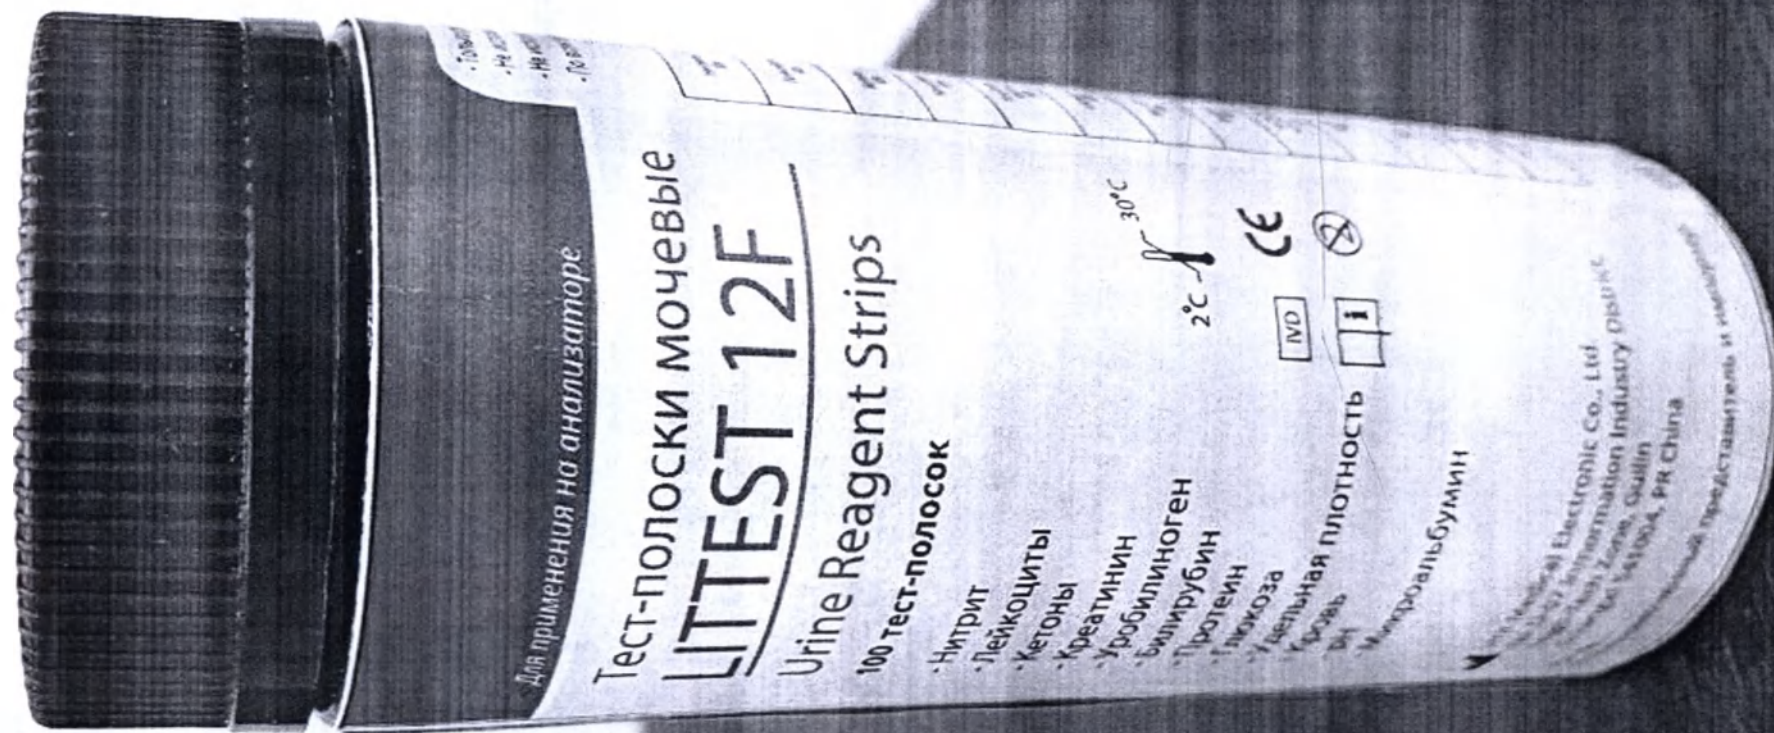

# Тест-полоски мочевые **LITTEST 12F**

## Urine Reagent Strips

Для применения на анализаторе

**100 тест-полосок**

- Нитрит
- Лейкоциты
- Кетоны
- Креатинин
- Уробилиноген
- Билирубин
- Протеин
- Глюкоза
- Удельная плотность
- Кровь
- pH
- Микроальбумин

2°C — 30°C



Unit Medical Electronic Co., Ltd.  
No. D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Guilin  
Guangxi 541004, P.R. China

РУ №...

Уполномоченный представитель и импортер:

9 :

Тест-полоски мочевые LITTEST 14F

Для применения на анализаторе

# Тест-полоски мочевые LITTEST 14F

## Urine Reagent Strips

100 тест-полосок

- Аскорбиновая кислота
- Нитрит
- Микроальбумин
- Лейкоциты
- Креатинин
- Кетоны
- Уробилиноген
- Билирубин
- Глюкоза
- Протеин
- Удельная плотность
- pH
- Кровь
- Кальций

2°C - 30°C



Urn Medical Electronic Co., Ltd.  
No. D-07 Information Industry District  
High-Tech Zone, Guilin  
Guangxi 541004, P.R. China


# Тест-полоски мочевые **LITTEST 14F**

## Urine Reagent Strips

Для применения на анализаторе

**100 тест-полосок**

- Аскорбиновая кислота
- Нитрит
- Микроальбумин
- Лейкоциты
- Креатинин
- Кетоны
- Уробилиноген
- Билирубин
- Глюкоза
- Протеин
- Удельная плотность
- pH
- Кровь
- Кальций




Urit Medical Electronic Co., Ltd.  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Gulin  
Guangxi 541004, PR China

РУ №...

Уполномоченный представитель в России



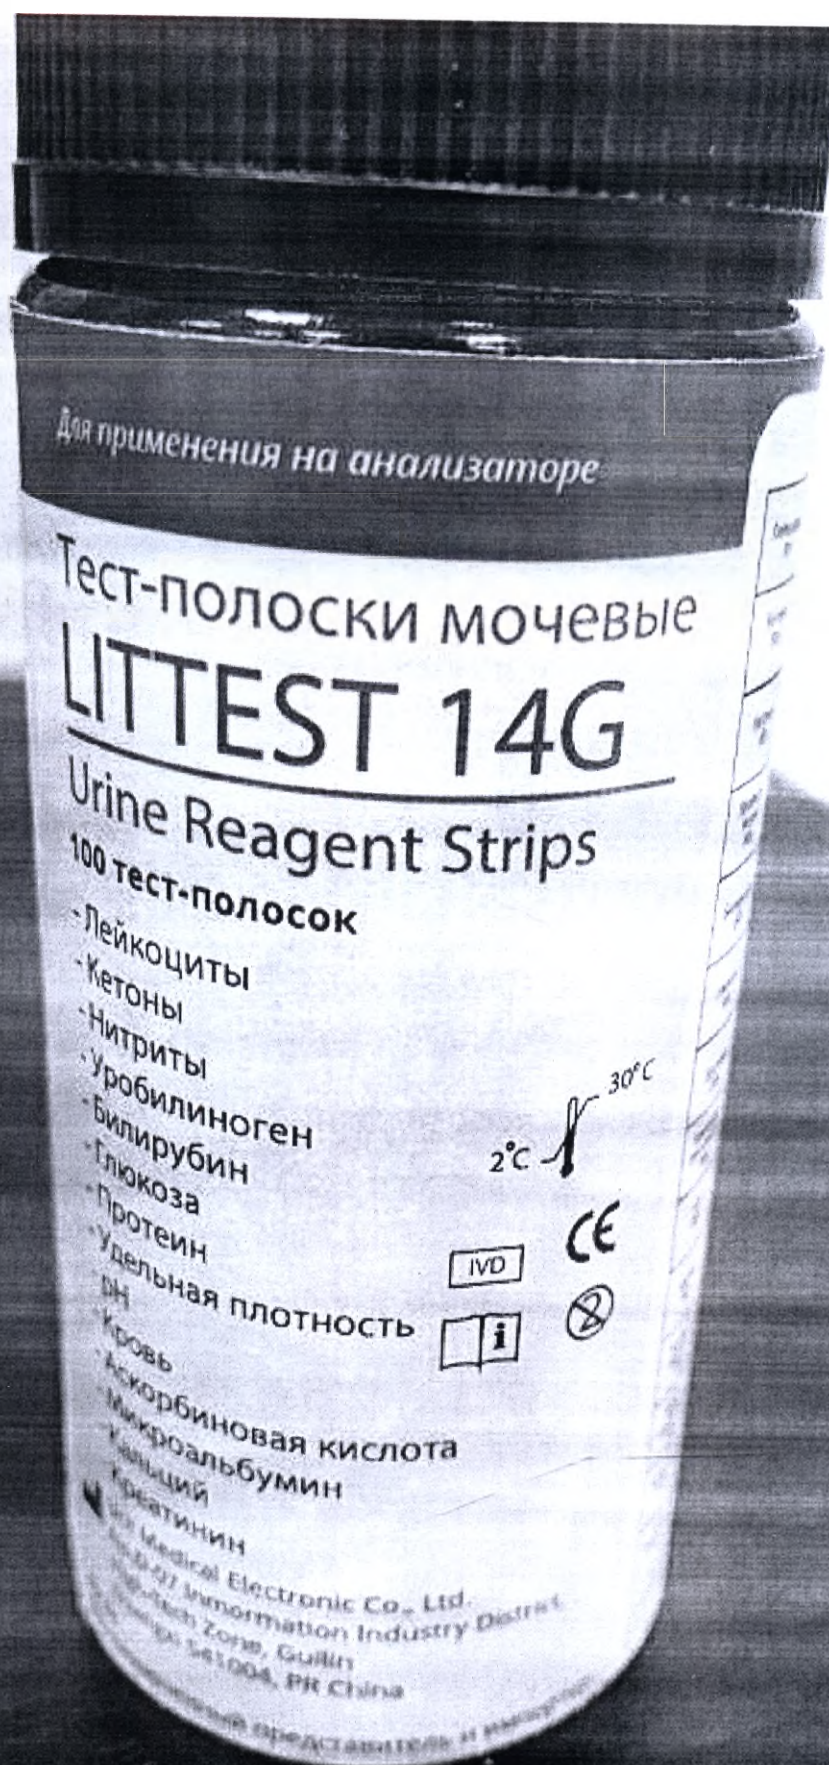

Для применения на анализаторе

# Тест-полоски мочевые

## LITTEST 14G

### Urine Reagent Strips

100 тест-полосок

- Лейкоциты
- Кетоны
- Нитриты
- Уробилиноген
- Билирубин
- Глюкоза
- Протеин
- Удельная плотность
- pH
- Кровь
- Аскорбиновая кислота
- Микроальбумин
- Кальций
- Креатинин

2°C — 30°C

IVD

CE



# Тест-полоски мочевые LITTEST 14G

## Urine Reagent Strips

Для применения на анализаторе

**100 тест-полосок**

- Лейкоциты
- Кетоны
- Нитриты
- Уробилиноген
- Билирубин
- Глюкоза
- Протеин
- Удельная плотность
- pH
- Кровь
- Аскорбиновая кислота
- Микроальбумин
- Кальций
- Креатинин

2°C  30°C

IVD


CE



Unit Medical Electronic Co., Ltd  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Guimin  
Guangxi 541004, PR China

РТУ №...

Эксплуатационный журнал №... 2004

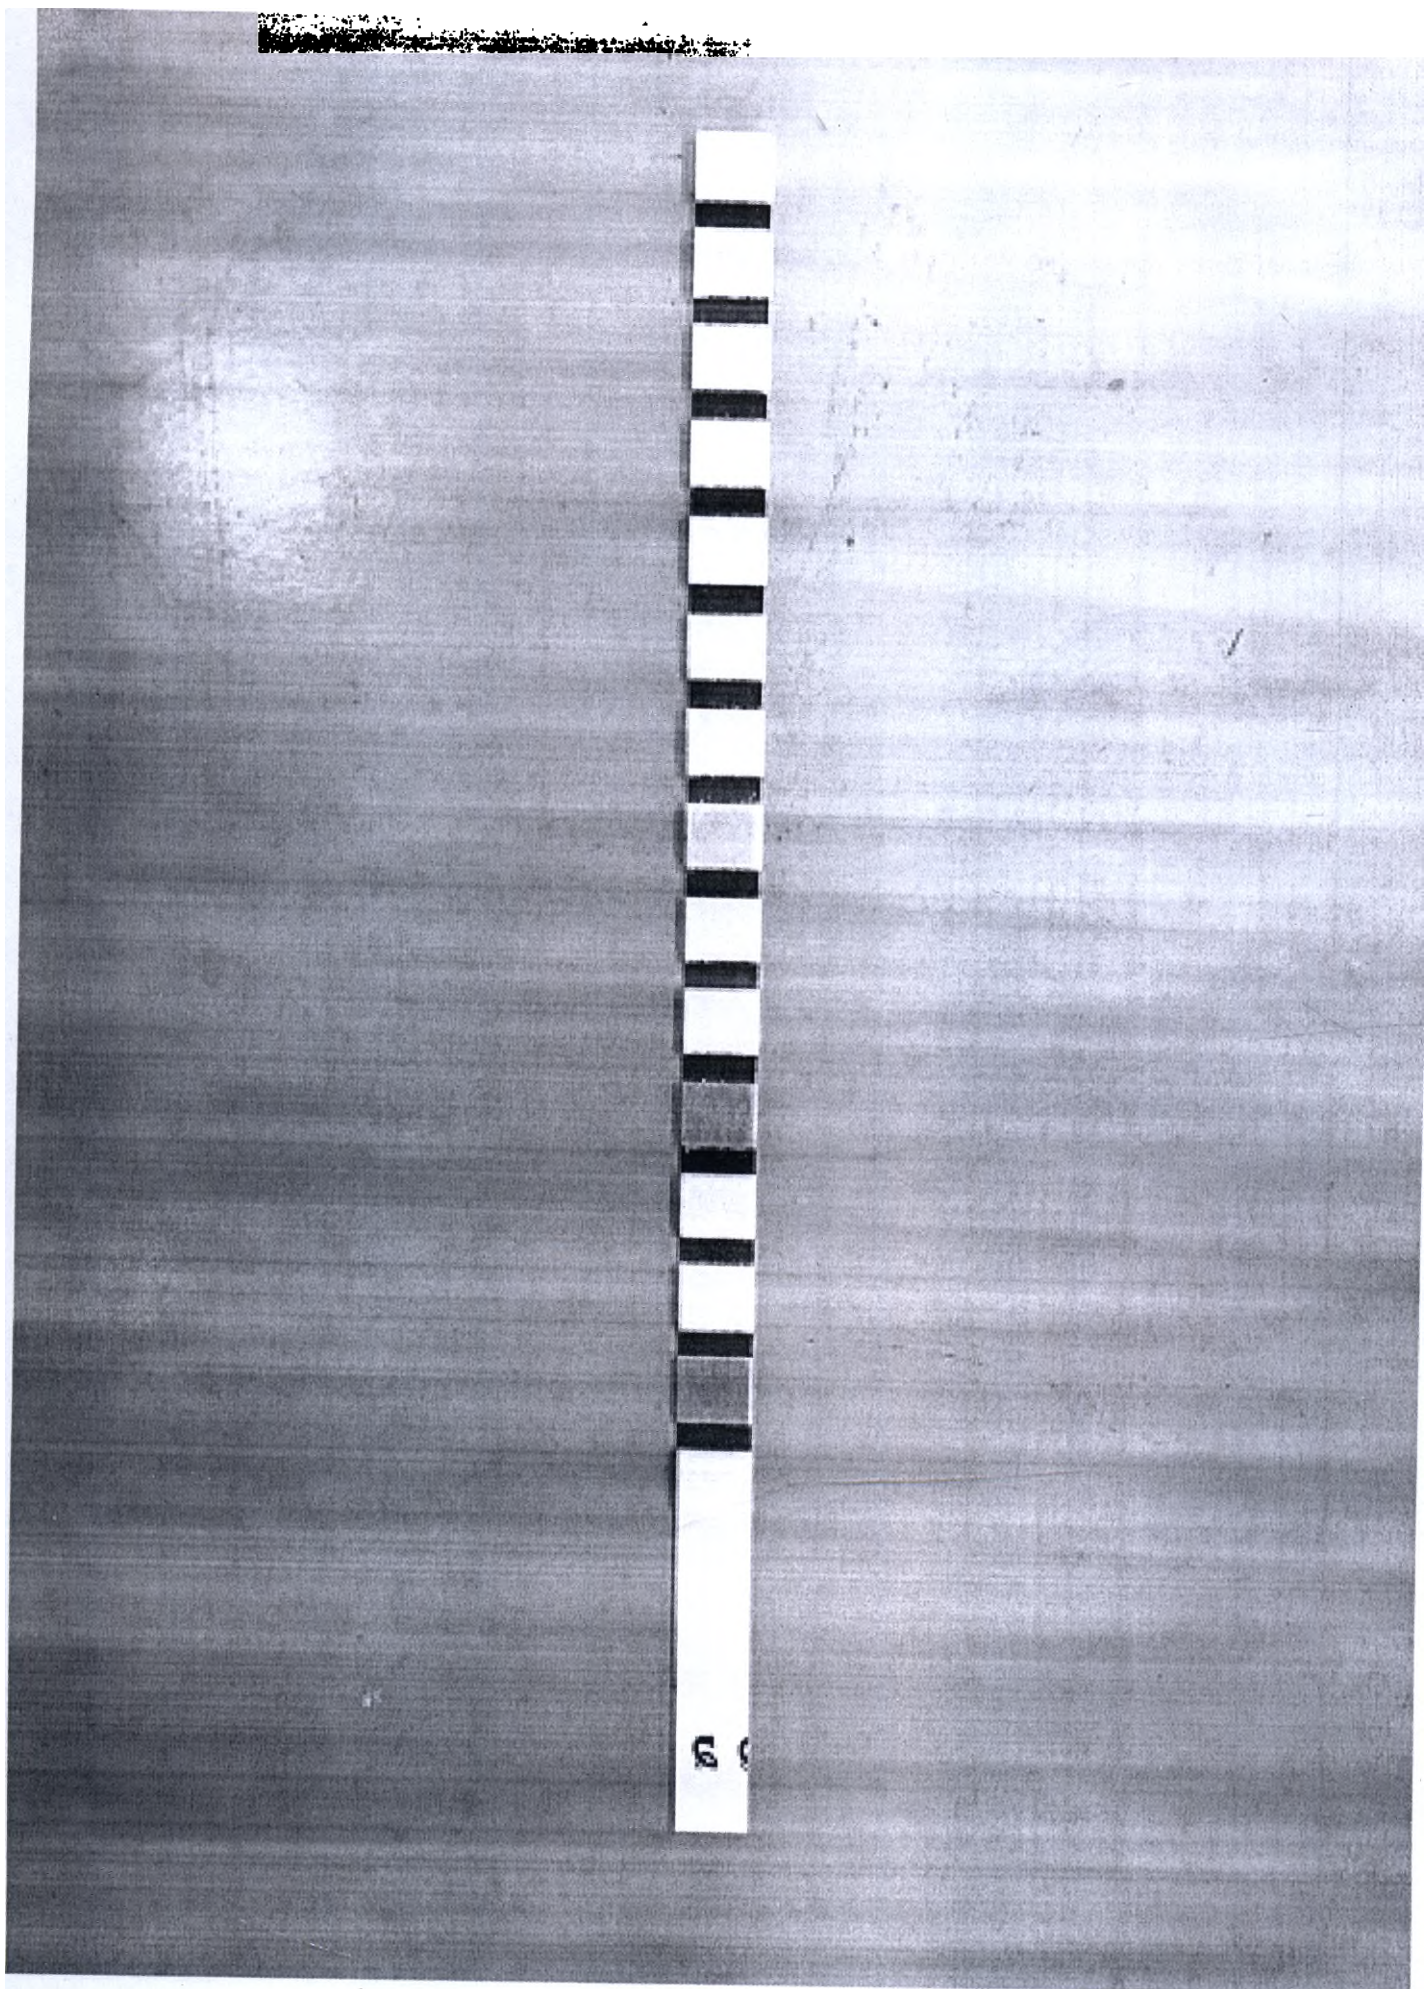

Прошито и скреплено печатью

13 листа ( Тринадцать )


Генеральный директор ООО «КОРВЭЙ»

Линд В.А.



**Фотографии общего вида медицинского изделия**

**Тест-полоска мочева Litest для анализаторов мочи URIT-50, 180, 50B, 500C, 330, 31, 330, 560, 1500, 1600, 1610,  
UriLit- 150, 500C, 1500, 1600 для диагностики ин витро:**

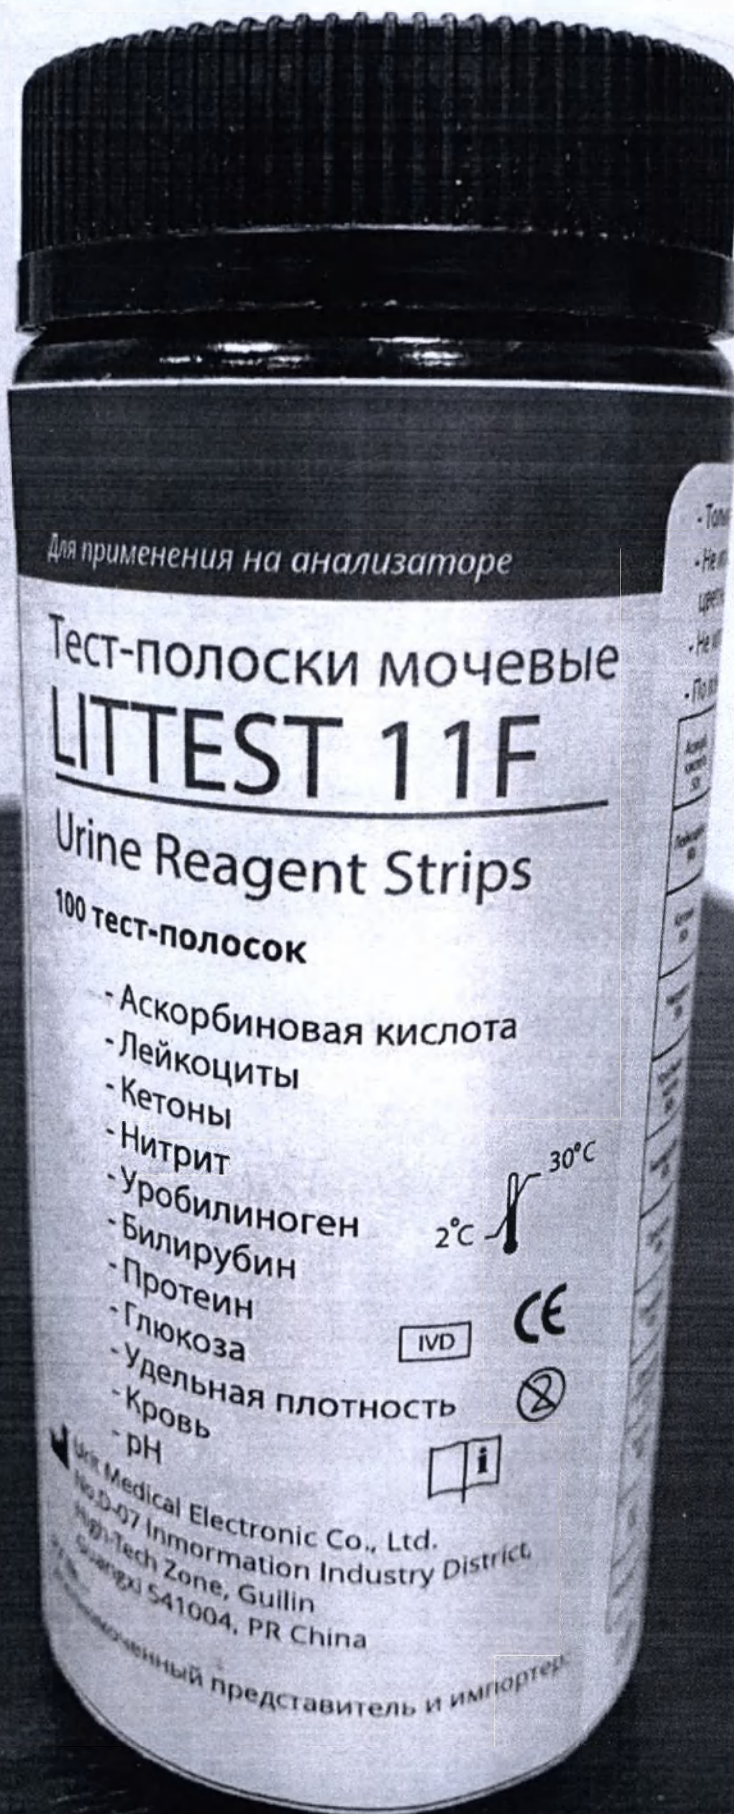

# Тест-полоски мочевые **LITTEST 11F**

## Urine Reagent Strips

Для применения на анализаторе

**100 тест-полосок**

- Аскорбиновая кислота
- Лейкоциты
- Кетоны
- Нитрит
- Уробилиноген
- Билирубин
- Протеин
- Глюкоза
- Удельная плотность
- Кровь
- pH

2°C — 30°C

ND


CE



 Urk Medical Electronic Co., Ltd.  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Gullin  
Guangxi 541004, PR China

РУ №...  
Уполномоченный представитель и импортер:



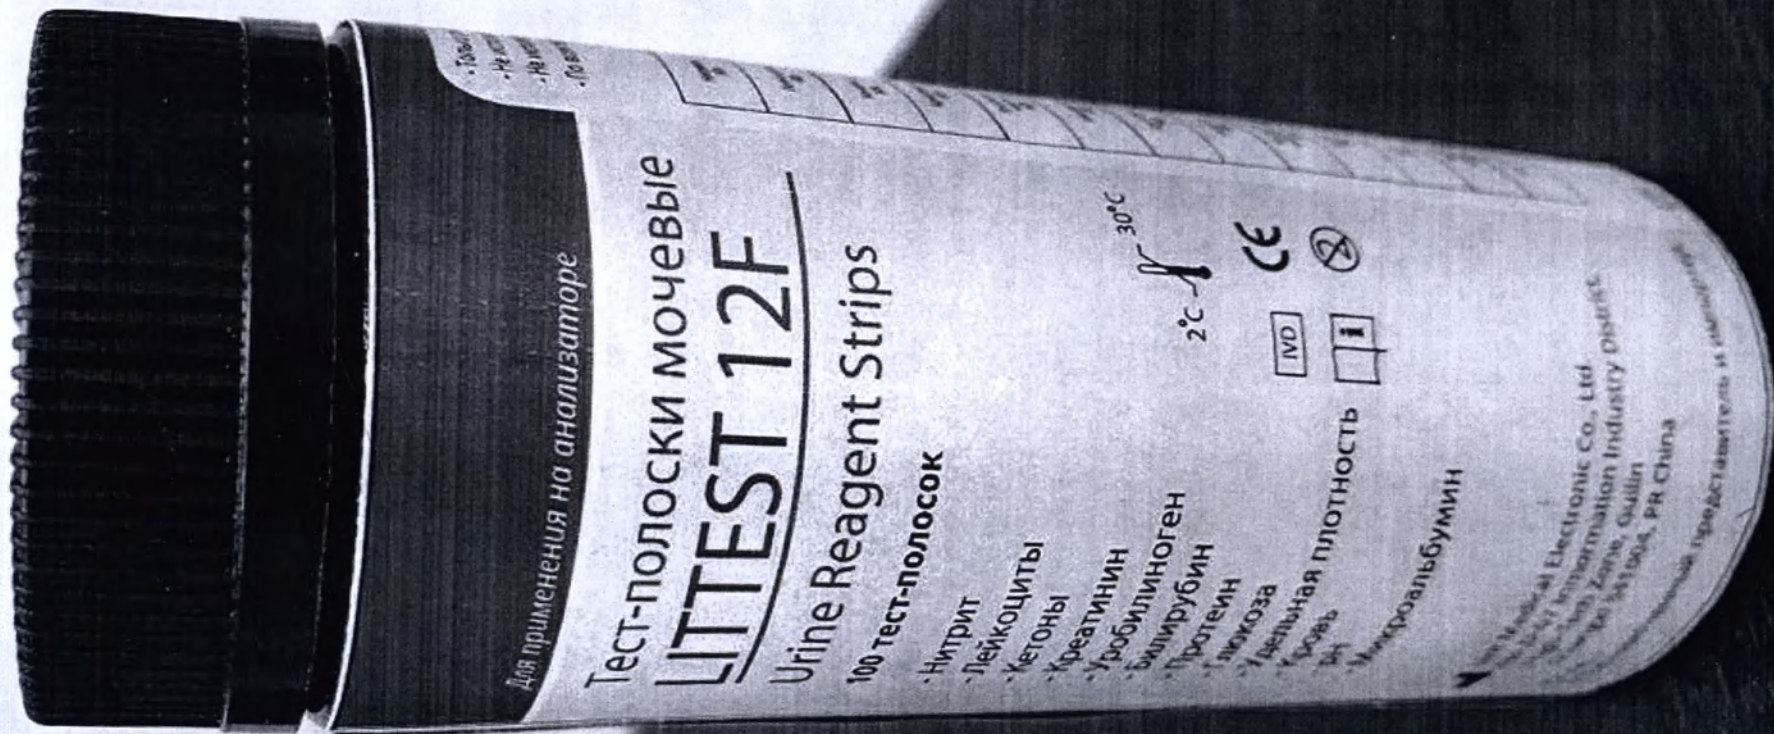

# Тест-полоски мочевые **LITTEST 12F**

## Urine Reagent Strips

Для применения на анализаторе

**100 тест-полосок**

- Нитрит
- Лейкоциты
- Кетоны
- Креатинин
- Уробилиноген
- Билирубин
- Протеин
- Глюкоза
- Удельная плотность
- Кровь
- pH
- Микроальбумин

2°C 30°C



Urit Medical Electronic Co., Ltd.  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Guilin  
Guangxi 541004, PR China

РУ №...

Уполномоченный представитель и импортер:





# Тест-полоски мочевые **LITTEST 14F**

## Urine Reagent Strips

Для применения на анализаторе

**100 тест-полосок**

- Аскорбиновая кислота
- Нитрит
- Микроальбумин
- Лейкоциты
- Креатинин
- Кетоны
- Уробилиноген
- Билирубин
- Глюкоза
- Протеин
- Удельная плотность
- pH
- Кровь
- Кальций

2°C  30°C




Urit Medical Electronic Co., Ltd.  
No.D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Gullin  
Guangxi 541004, PR China

РУ №...

Уполномоченный представитель и импортер



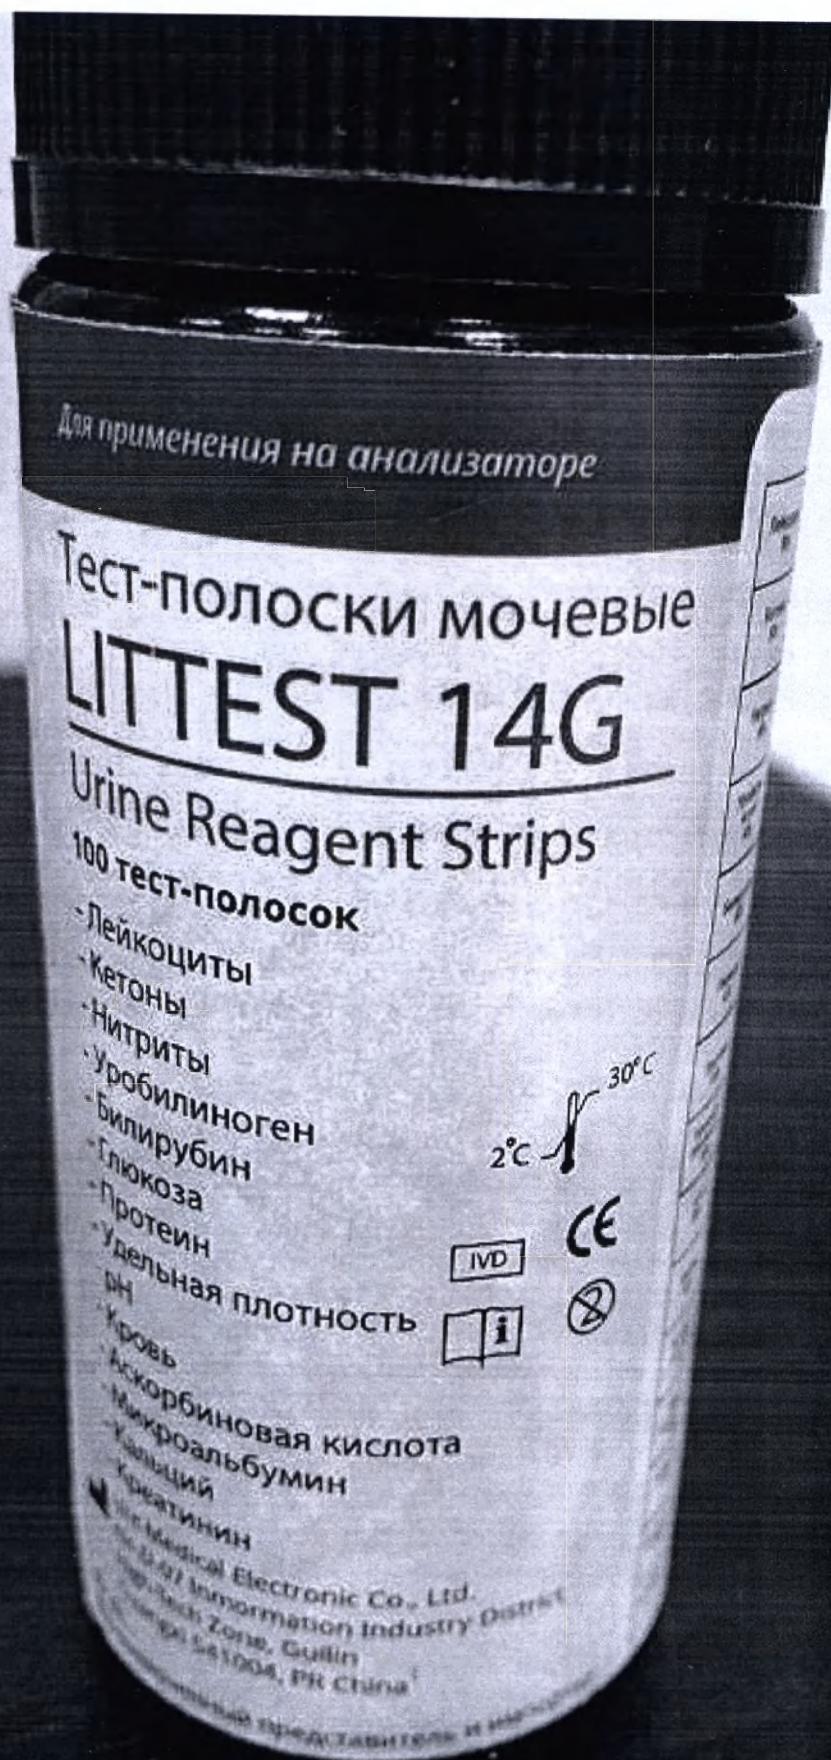

# Тест-полоски мочевые LITTEST 14G

## Urine Reagent Strips

Для применения на анализаторе

100 тест-полосок

- Лейкоциты
- Кетоны
- Нитриты
- Уробилиноген
- Билирубин
- Глюкоза
- Протеин
- Удельная плотность
- pH
- Кровь
- Аскорбиновая кислота
- Микроальбумин
- Кальций
- Креатинин

2°C  30°C



 Urk Medical Electronic Co., Ltd.  
No. D-07 Information Industry District,  
High-Tech Zone, Guilin  
Guangxi 541004, P.R. China

РУ №...

уполномоченный представитель в России



Прошито и скреплено печатью  
13 листов тринадцать )

Генеральный директор ООО «КОРВЭЙ»

Линд В.А.

