


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор контрольных материалов для подтверждения воспроизводимости и правильности определения показателей клинической химии (холинэстераза, креатинин, дибуканновое число, гидроксибутиратдегидрогеназа, железо, литий, панкреатическая амилаза) в биологических материалах человека на биохимических анализаторах Alinity с «Контрольные материалы для клинической химии 2 (Alinity с Clinical Chemistry Control 2 Kit)»


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Фотографическое изображение открытой упаковки «Контрольные материалы для клинической химии 2 (Alinity с Clinical Chemistry Control 2 Kit)»

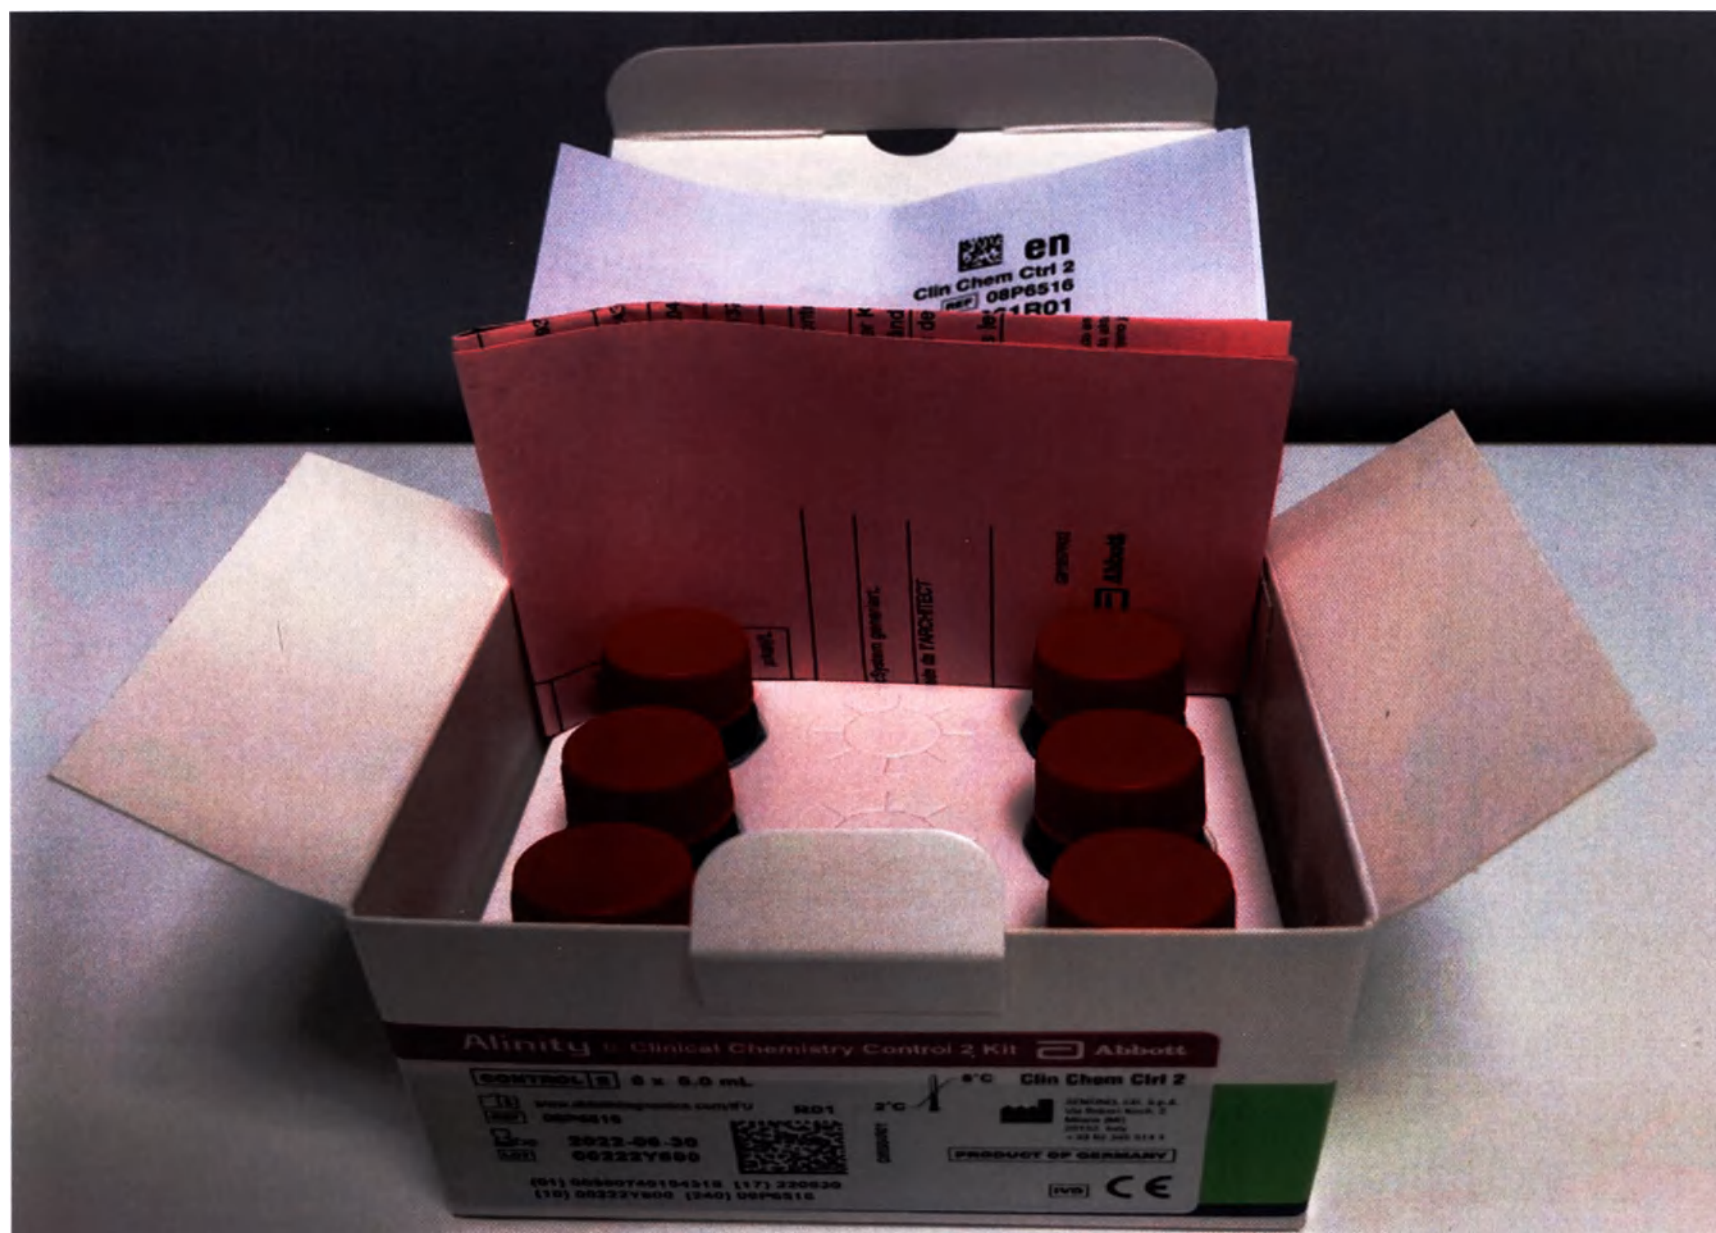

Фотографическое изображение упаковки и флаконов «Контрольные материалы для клинической химии 2 (Alinity с Clinical Chemistry Control 2 Kit)»

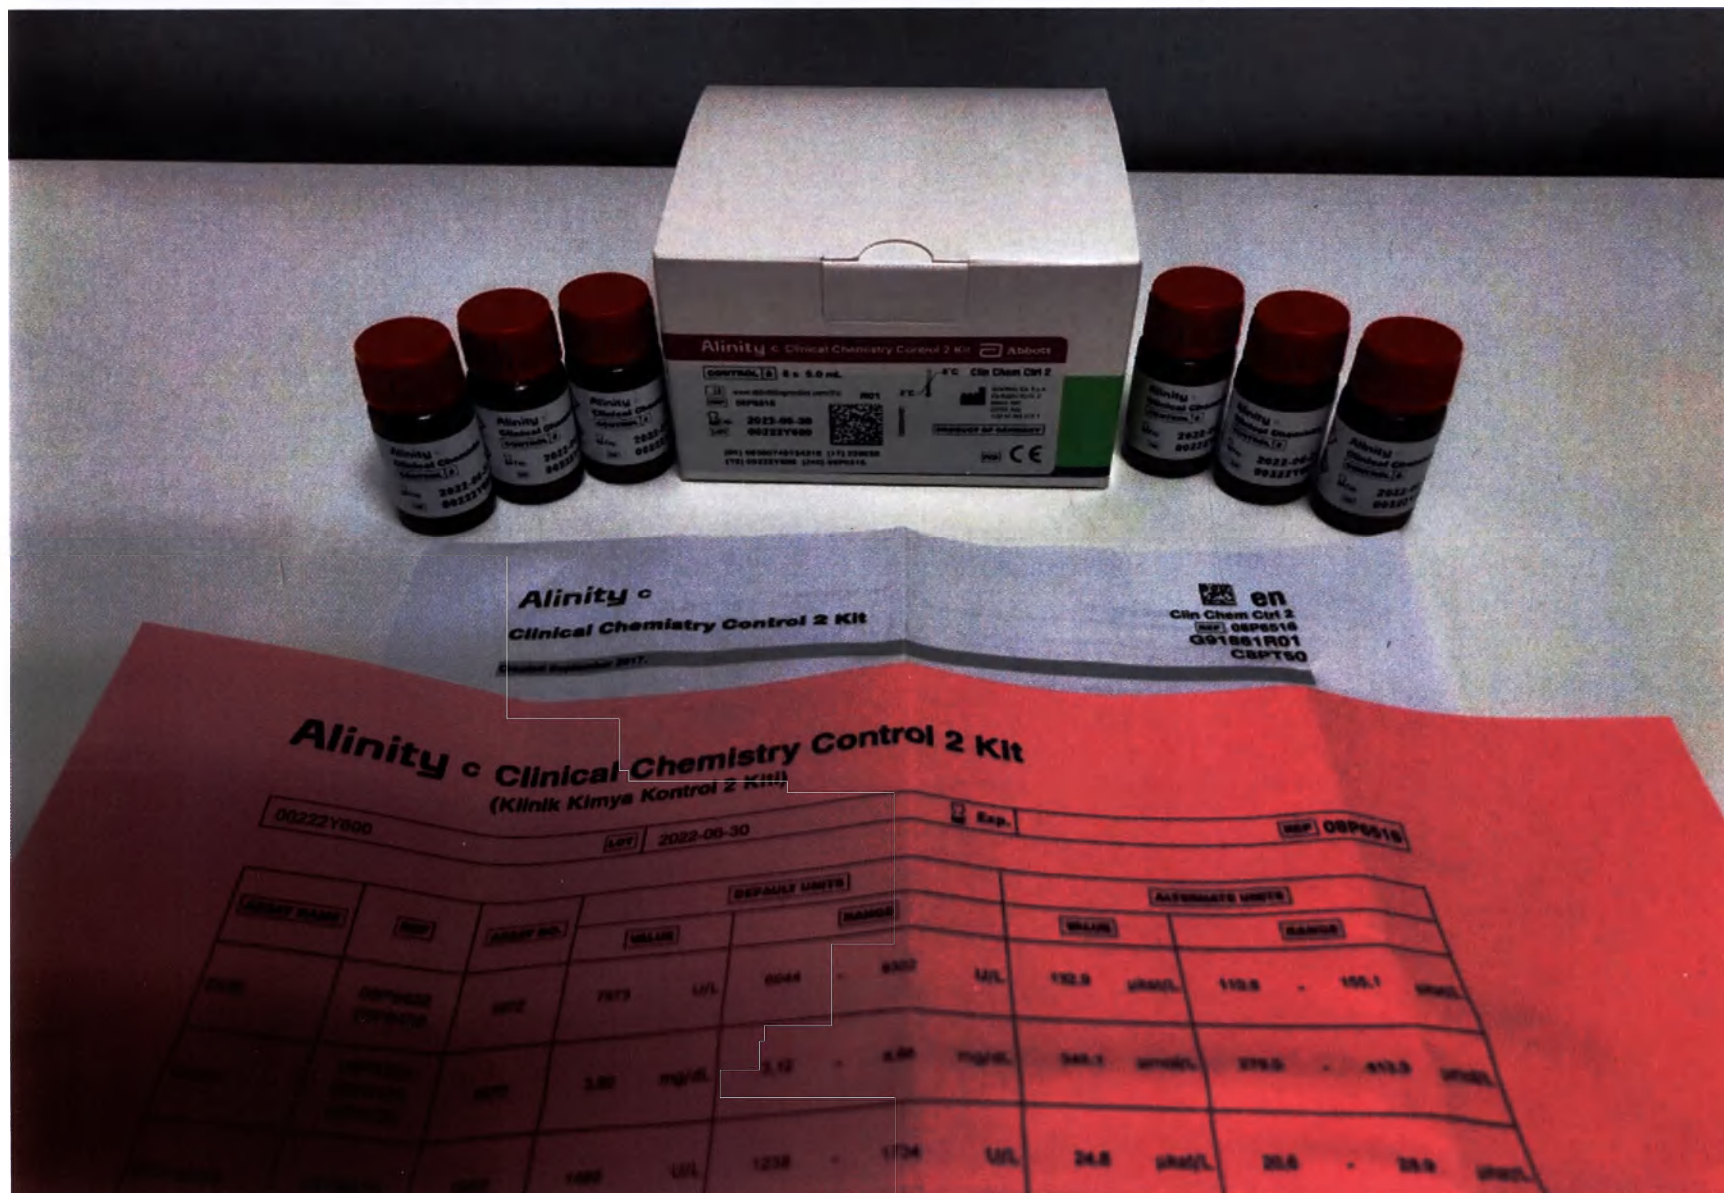

Фотографическое изображение флакона «Контрольные материалы для клинической химии 2 (Alinity с Clinical Chemistry Control 2 Kit)»



...и скреплено печатью
...листов



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор контрольных материалов для подтверждения воспроизводимости и правильности определения показателей клинической химии (холинэстераза, креатинин, дибуканновое число, гидроксибутиратдегидрогеназа, железо, литий, панкреатическая амилаза) в биологических материалах человека на биохимических анализаторах Alinity с «Контрольные материалы для клинической химии 2 (Alinity с Clinical Chemistry Control 2 Kit)»Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории РФ


**REF****08P65-16****IVD**

Набор контрольных материалов для подтверждения воспроизводимости и правильности определения показателей клинической химии (холинэстераза, креатинин, дибукаиновое число, гидроксибутиратдегидрогеназа, железо, литий, панкреатическая амилаза) в биологических материалах человека на биохимических анализаторах Alinity с «Контрольные материалы для клинической химии 2 (Alinity с Clinical Chemistry Control 2 Kit)» в составе: Контроль 2 (Alinity с Clin Chem Ctrl 2) – 6 флаконов x 5,0 мл; Таблица значений Контрольных материалов 2; Инструкция по применению/ Производитель: СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А., SENTINEL CH. S.p.A, Via Robert Koch, 2, Milano (MI) 20152, Italy (Италия)/ Страна происхождения: Германия / РУ № _____ / _____ от _____ / Инструкцию по применению на русском языке см.: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз»,
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Clin Chem Ctrl 2**Alinity с Clinical Chemistry Control 2 Kit** **CONTROL 2** 6 x 5.0 mL**CONTROL 2** 6 x 5.0 mL www.abbottdiagnostics.com/IFU**REF 08P6516** 2°C 8°C **Clin Chem Ctrl 2**
SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1**PRODUCT OF GERMANY**



SENTINEL



Alinity c
Clinical Chemistry

CONTROL 2



CN

08P65
5.0 mL

G72040R02



Подпись