


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


Набор контрольных материалов для подтверждения воспроизводимости и правильности определения показателей клинической химии (холинэстераза, креатинин, дибукаиновое число, гидроксибутиратдегидрогеназа, железо, литий, панкреатическая амилаза) в биологических материалах человека на биохимических анализаторах Alinity c «Контрольные материалы для клинической химии 1 (Alinity c Clinical Chemistry Control 1 Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Фотографическое изображение вида упаковки «Контрольные материалы для клинической химии 1 (Alinity c Clinical Chemistry Control 1 Kit)»

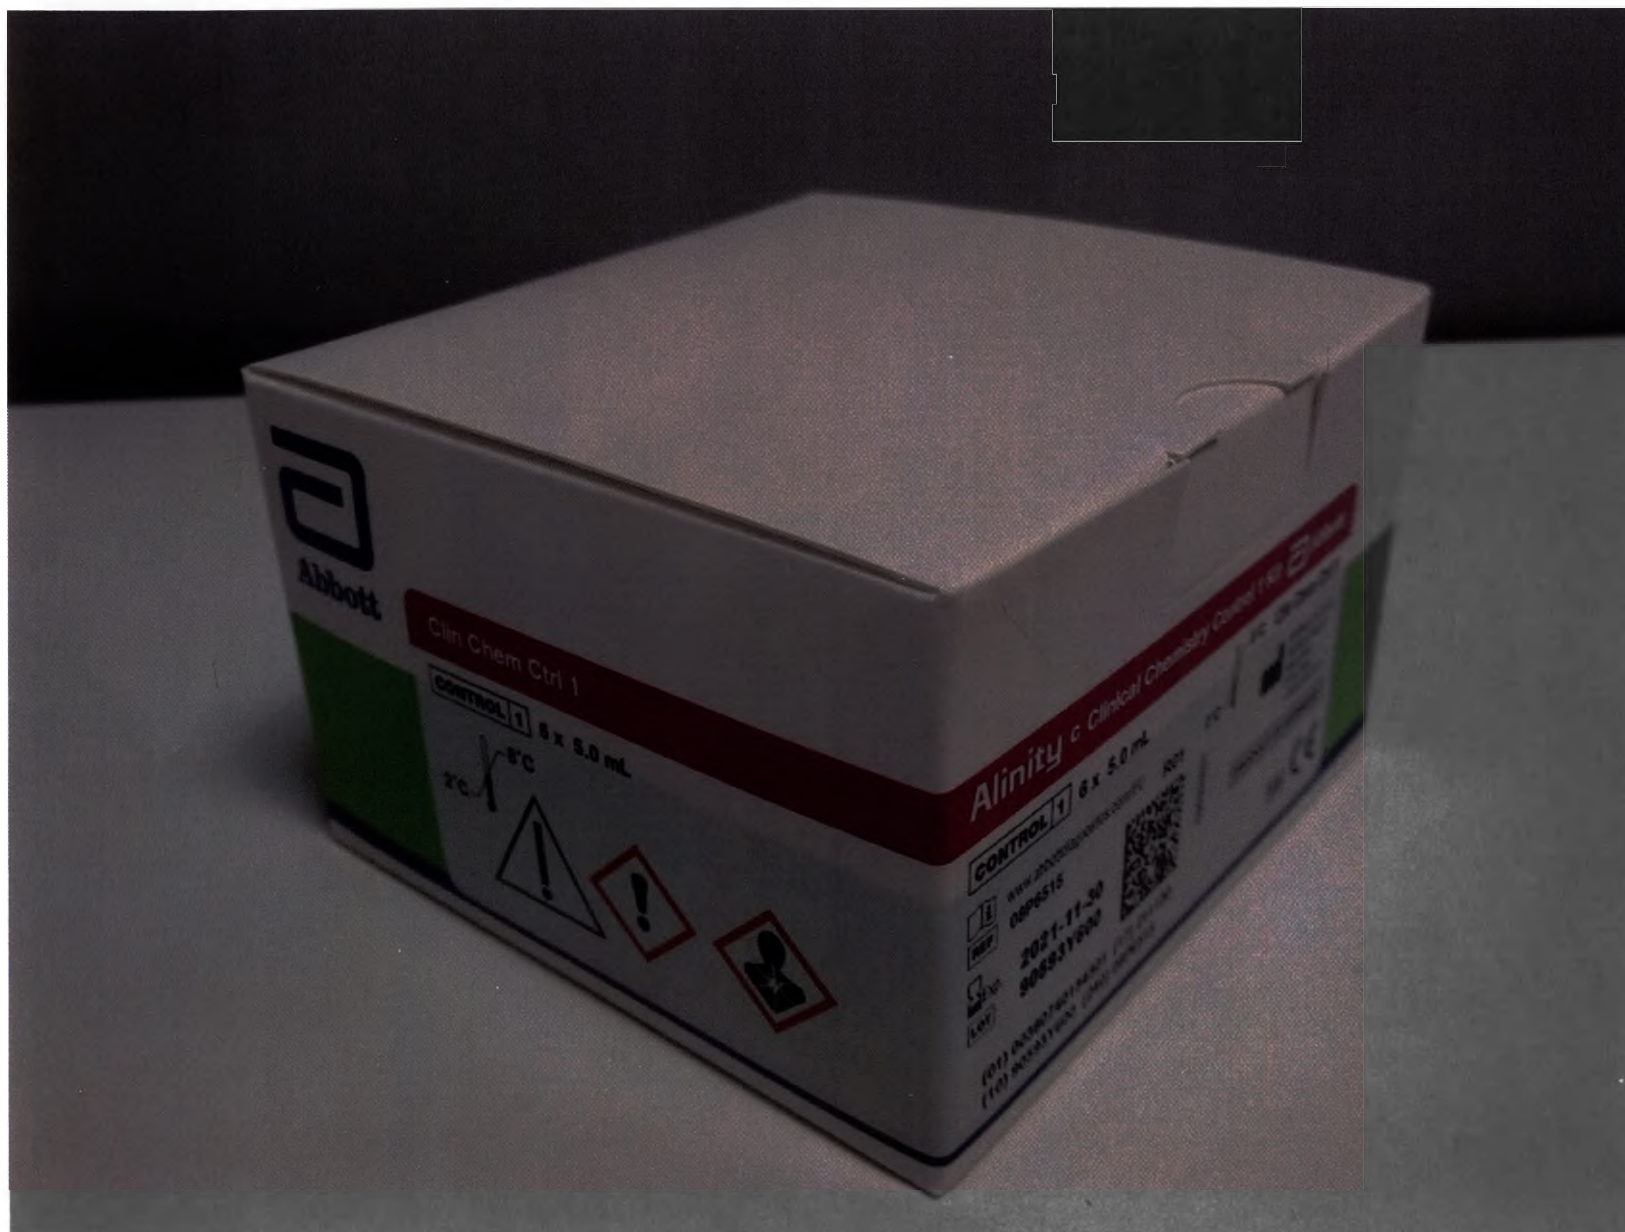

Фотографическое изображение открытой упаковки «Контрольные материалы для клинической химии 1 (Alinity с Clinical Chemistry Control 1 Kit)»

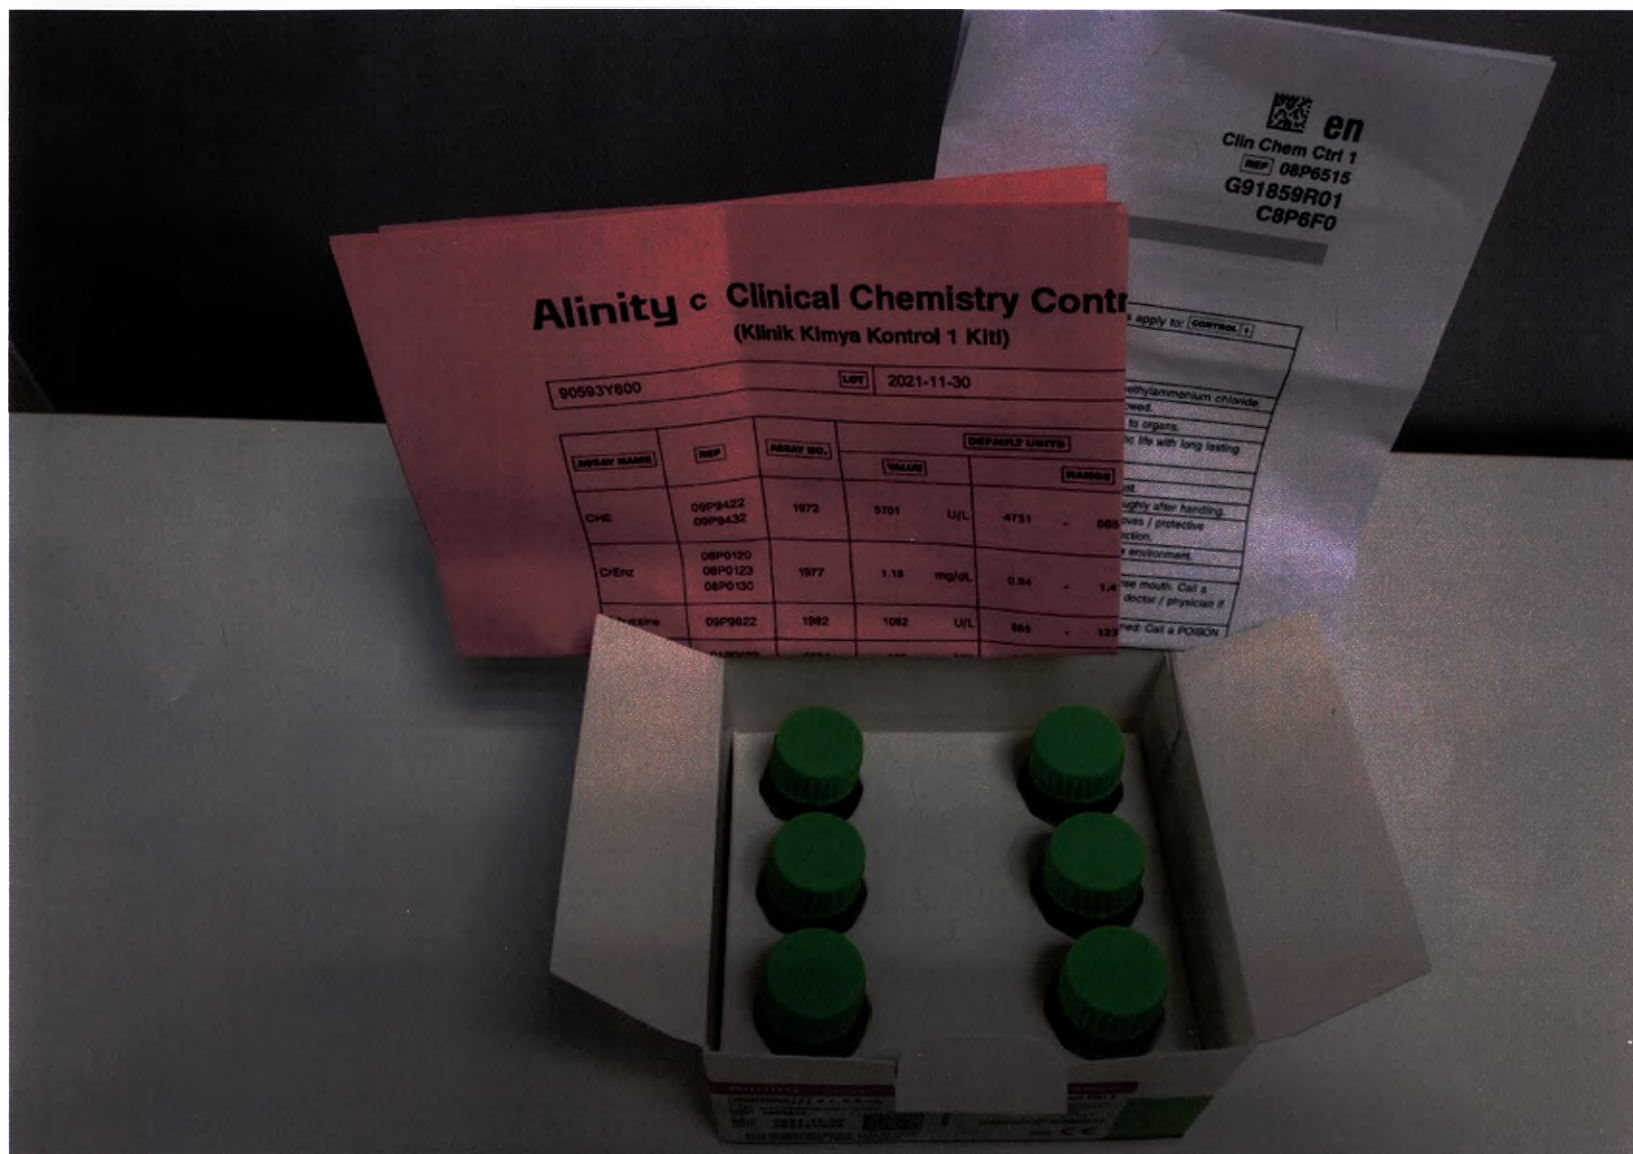


Фотографическое изображение упаковки и флаконов «Контрольные материалы для клинической химии 1 (Alinity c Clinical Chemistry Control 1 Kit)»

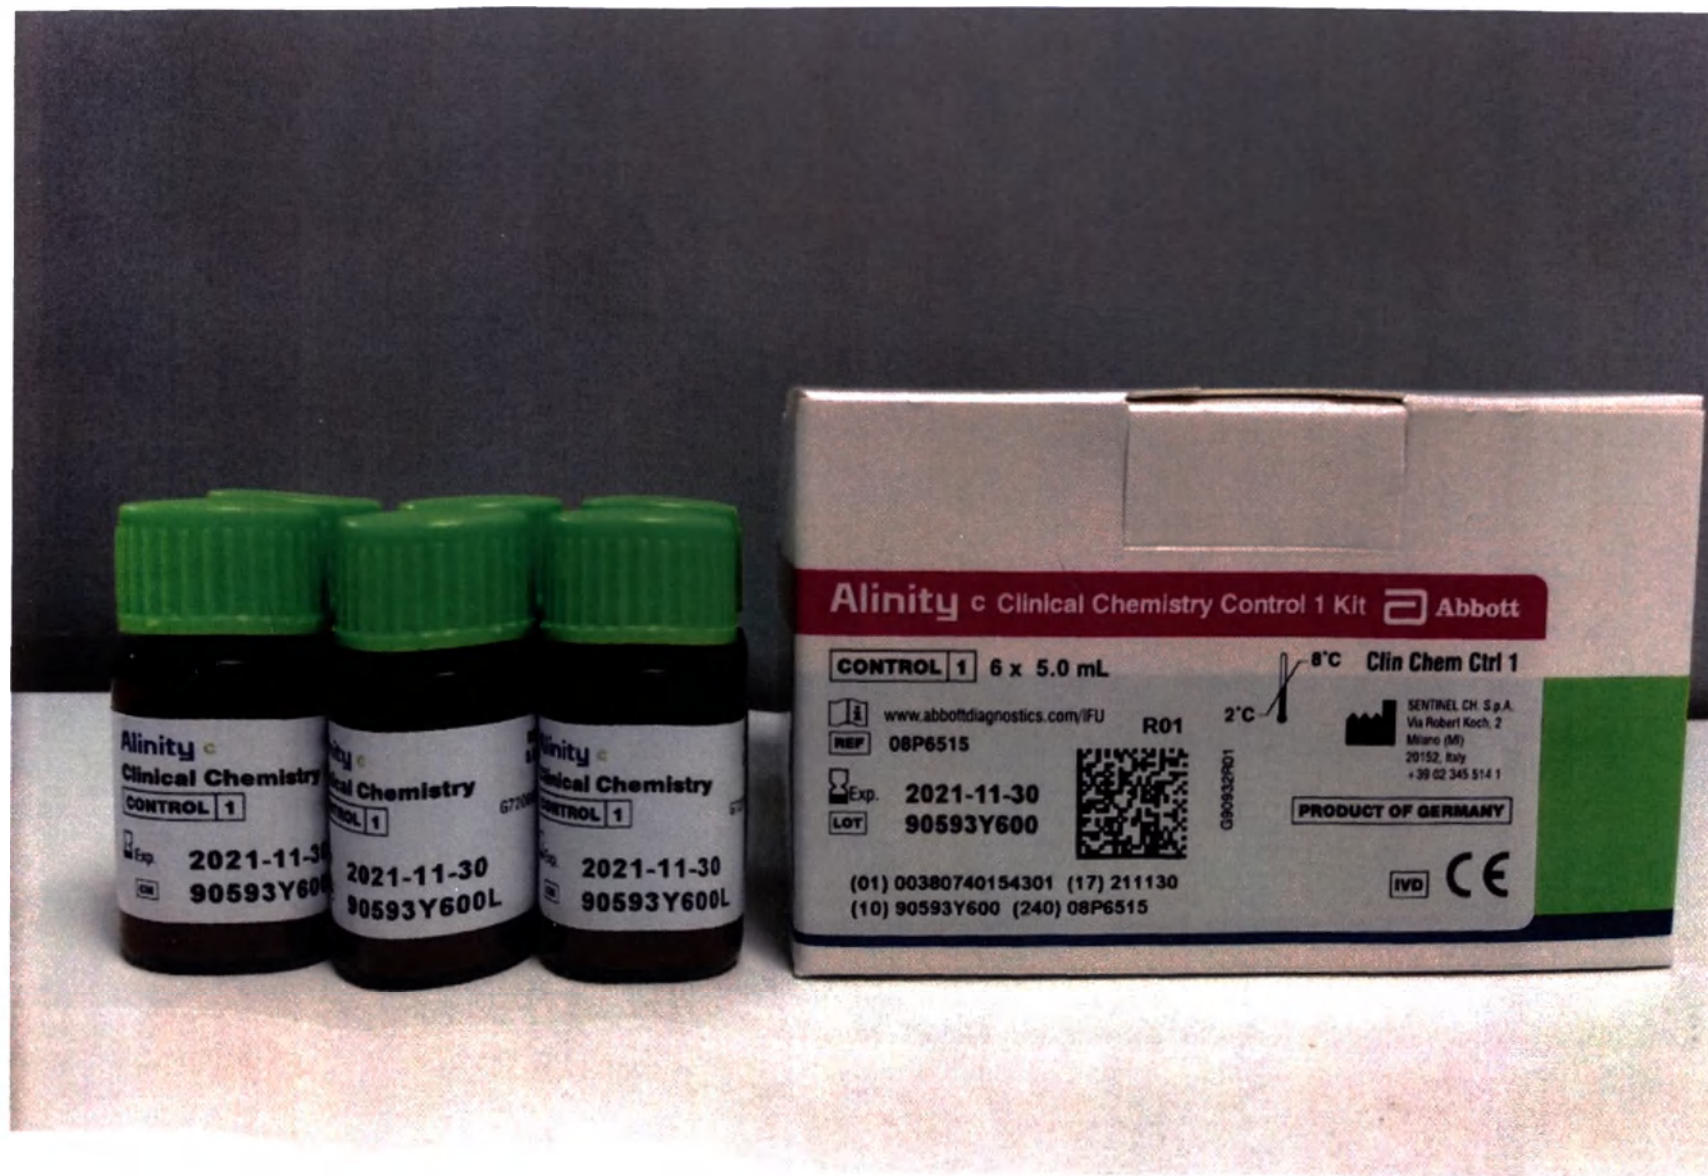

Фотографическое изображение флакона «Контрольные материалы для клинической химии 1 (Alinity с Clinical Chemistry Control 1 Kit)»



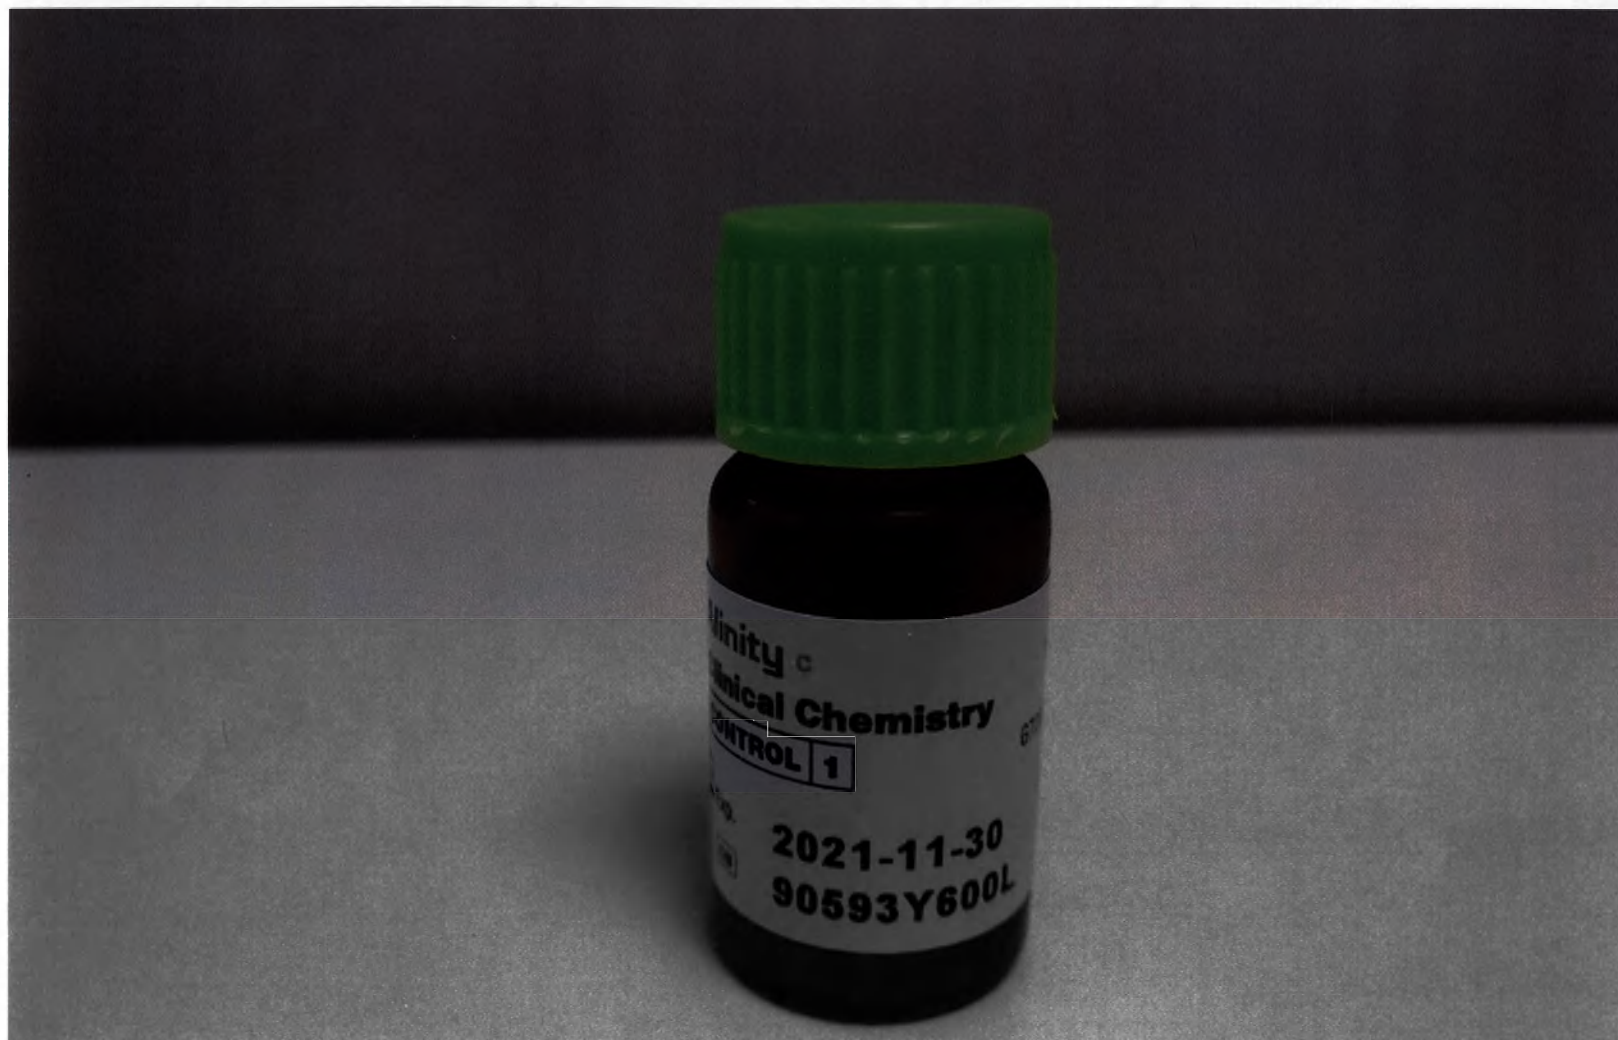

...прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
листов



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор контрольных материалов для подтверждения воспроизводимости и правильности определения показателей клинической химии (холинэстераза, креатинин, дибуканновое число, гидроксипутиратдегидрогеназа, железо, литий, панкреатическая амилаза) в биологических материалах человека на биохимических анализаторах Alinity с «Контрольные материалы для клинической химии 1 (Alinity с Clinical Chemistry Control 1 Kit)»



08P65-15



Набор контрольных материалов для подтверждения воспроизводимости и правильности определения показателей клинической химии (холинэстераза, креатинин, дибукаиновое число, гидроксibuтиратдегидрогеназа, железо, литий, панкреатическая амилаза) в биологических материалах человека на биохимических анализаторах Alinity с «Контрольные материалы для клинической химии 1 (Alinity с Clinical Chemistry Control 1 Kit)» в составе: Контроль 1 (Alinity с Clin Chem Ctrl 1) – 6 флаконов х 5,0 мл; Таблица значений Контрольных материалов 1; Инструкция по применению/ Производитель: СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А., SENTINEL CH. S.p.A, Via Robert Koch, 2, Milano (MI) 20152, Italy (Италия)/ Страна происхождения: Германия / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкцию по применению на русском языке см.: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз»,
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Clin Chem Ctrl 1

Alinity с Clinical Chemistry Control 1 Kit Abbott

CONTROL 1 6 x 5.0 mL



CONTROL 1 6 x 5.0 mL



2°C 8°C Clin Chem Ctrl 1



Макет маркировки флаконов медицинского изделия



IVD



Alinity ^c
Clinical Chemistry

CONTROL 1

 Exp.

CN

08P65
5.0 mL

G72066R02

и скреплено печатью
3 листов

