

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на
анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM
aTgII QC))»**

производства «Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd., «Сименс Хелскеа Диагностикс
Продактс Лтд.»

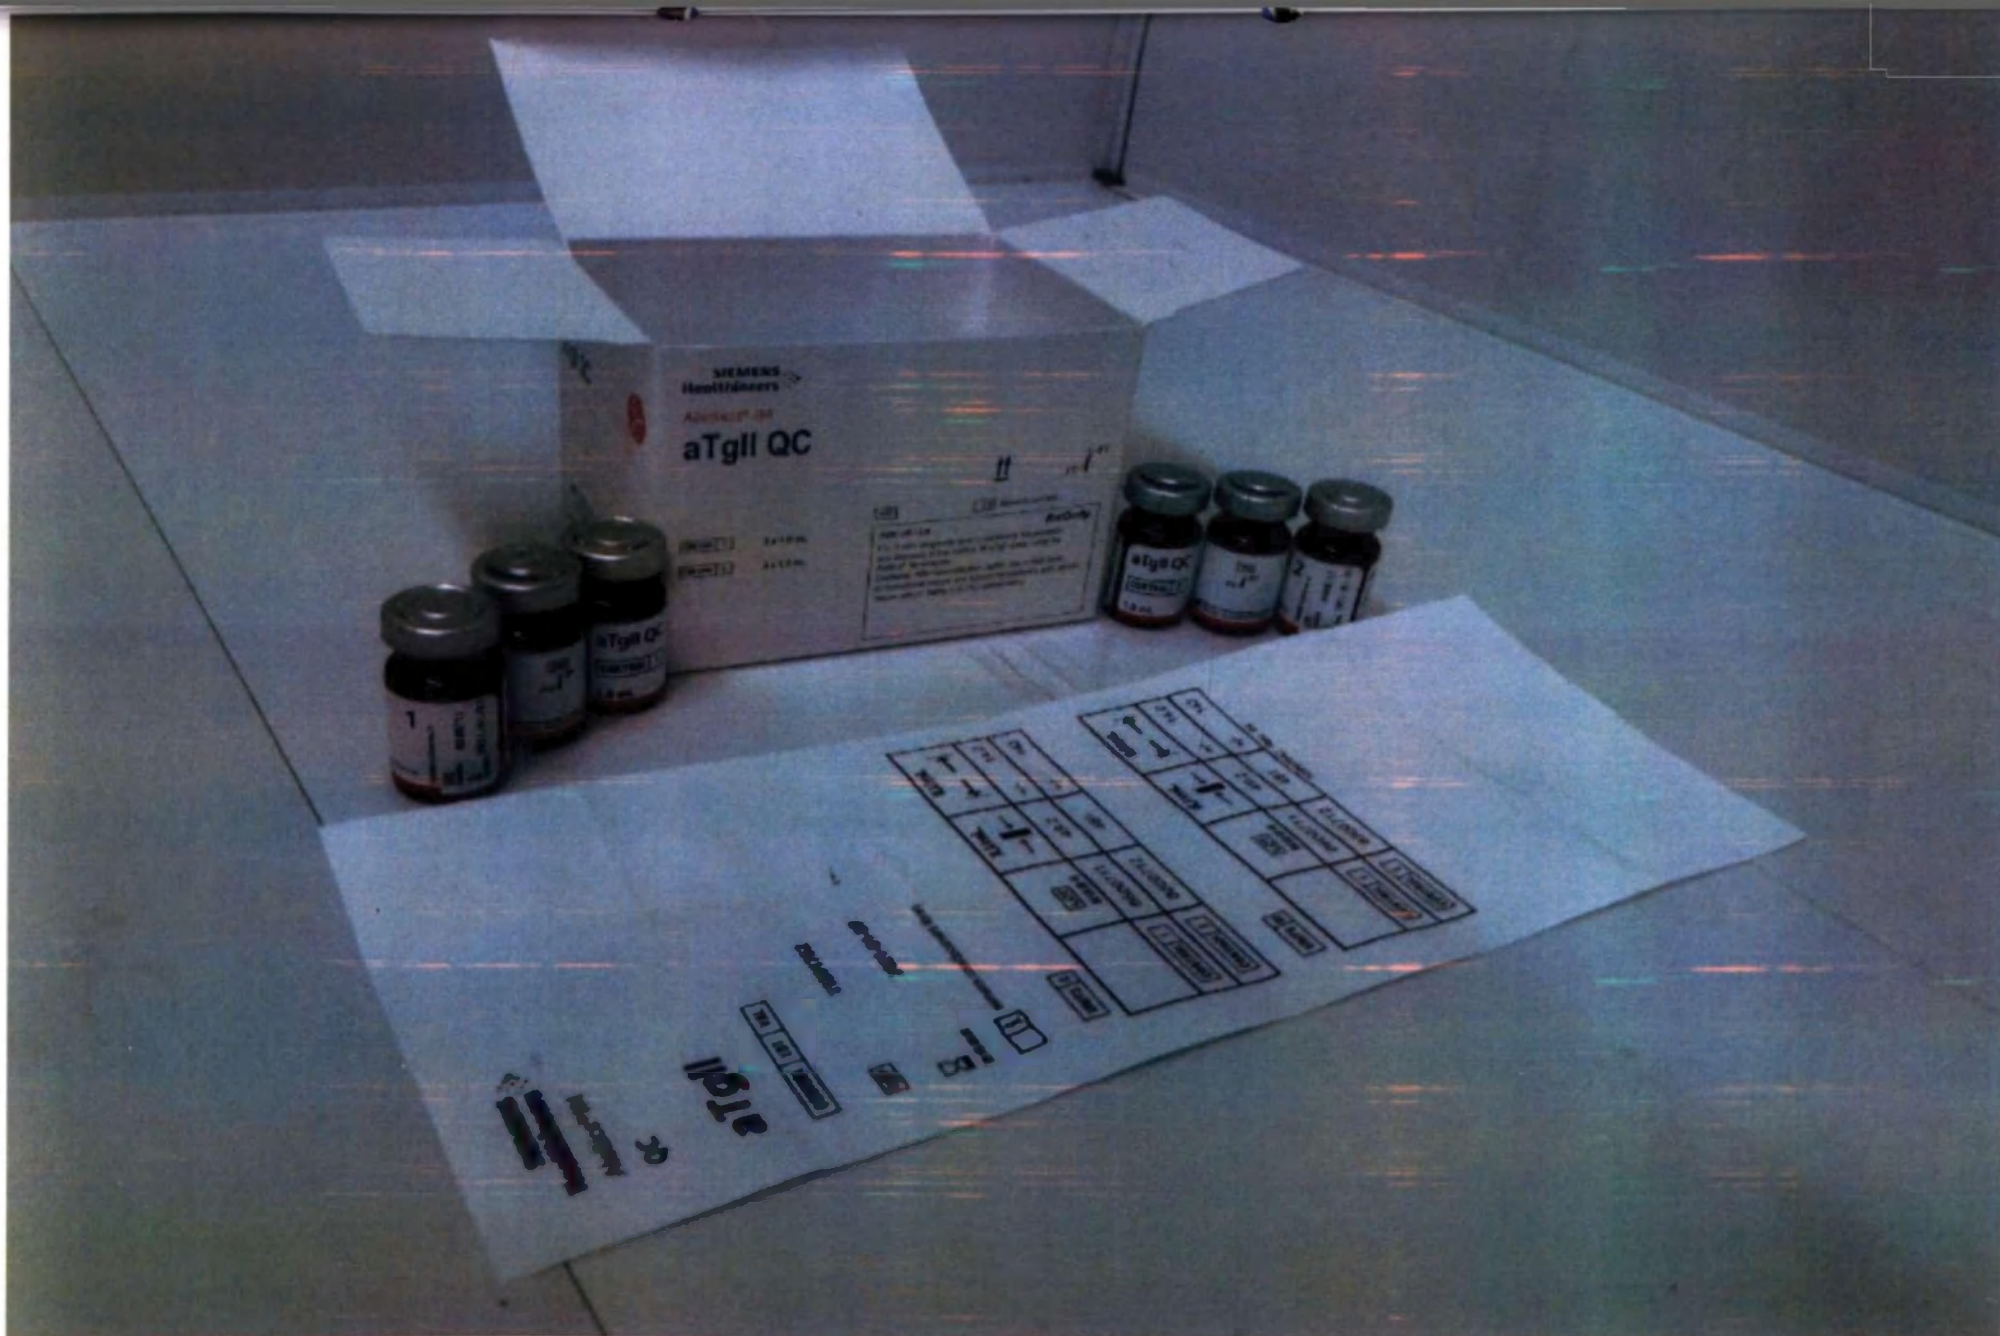


Рисунок 1. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM aTgII QC)). Общий вид



Рисунок 2. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM aTgII QC): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM aTgII QC CONTROL 1, 1,0 мл.

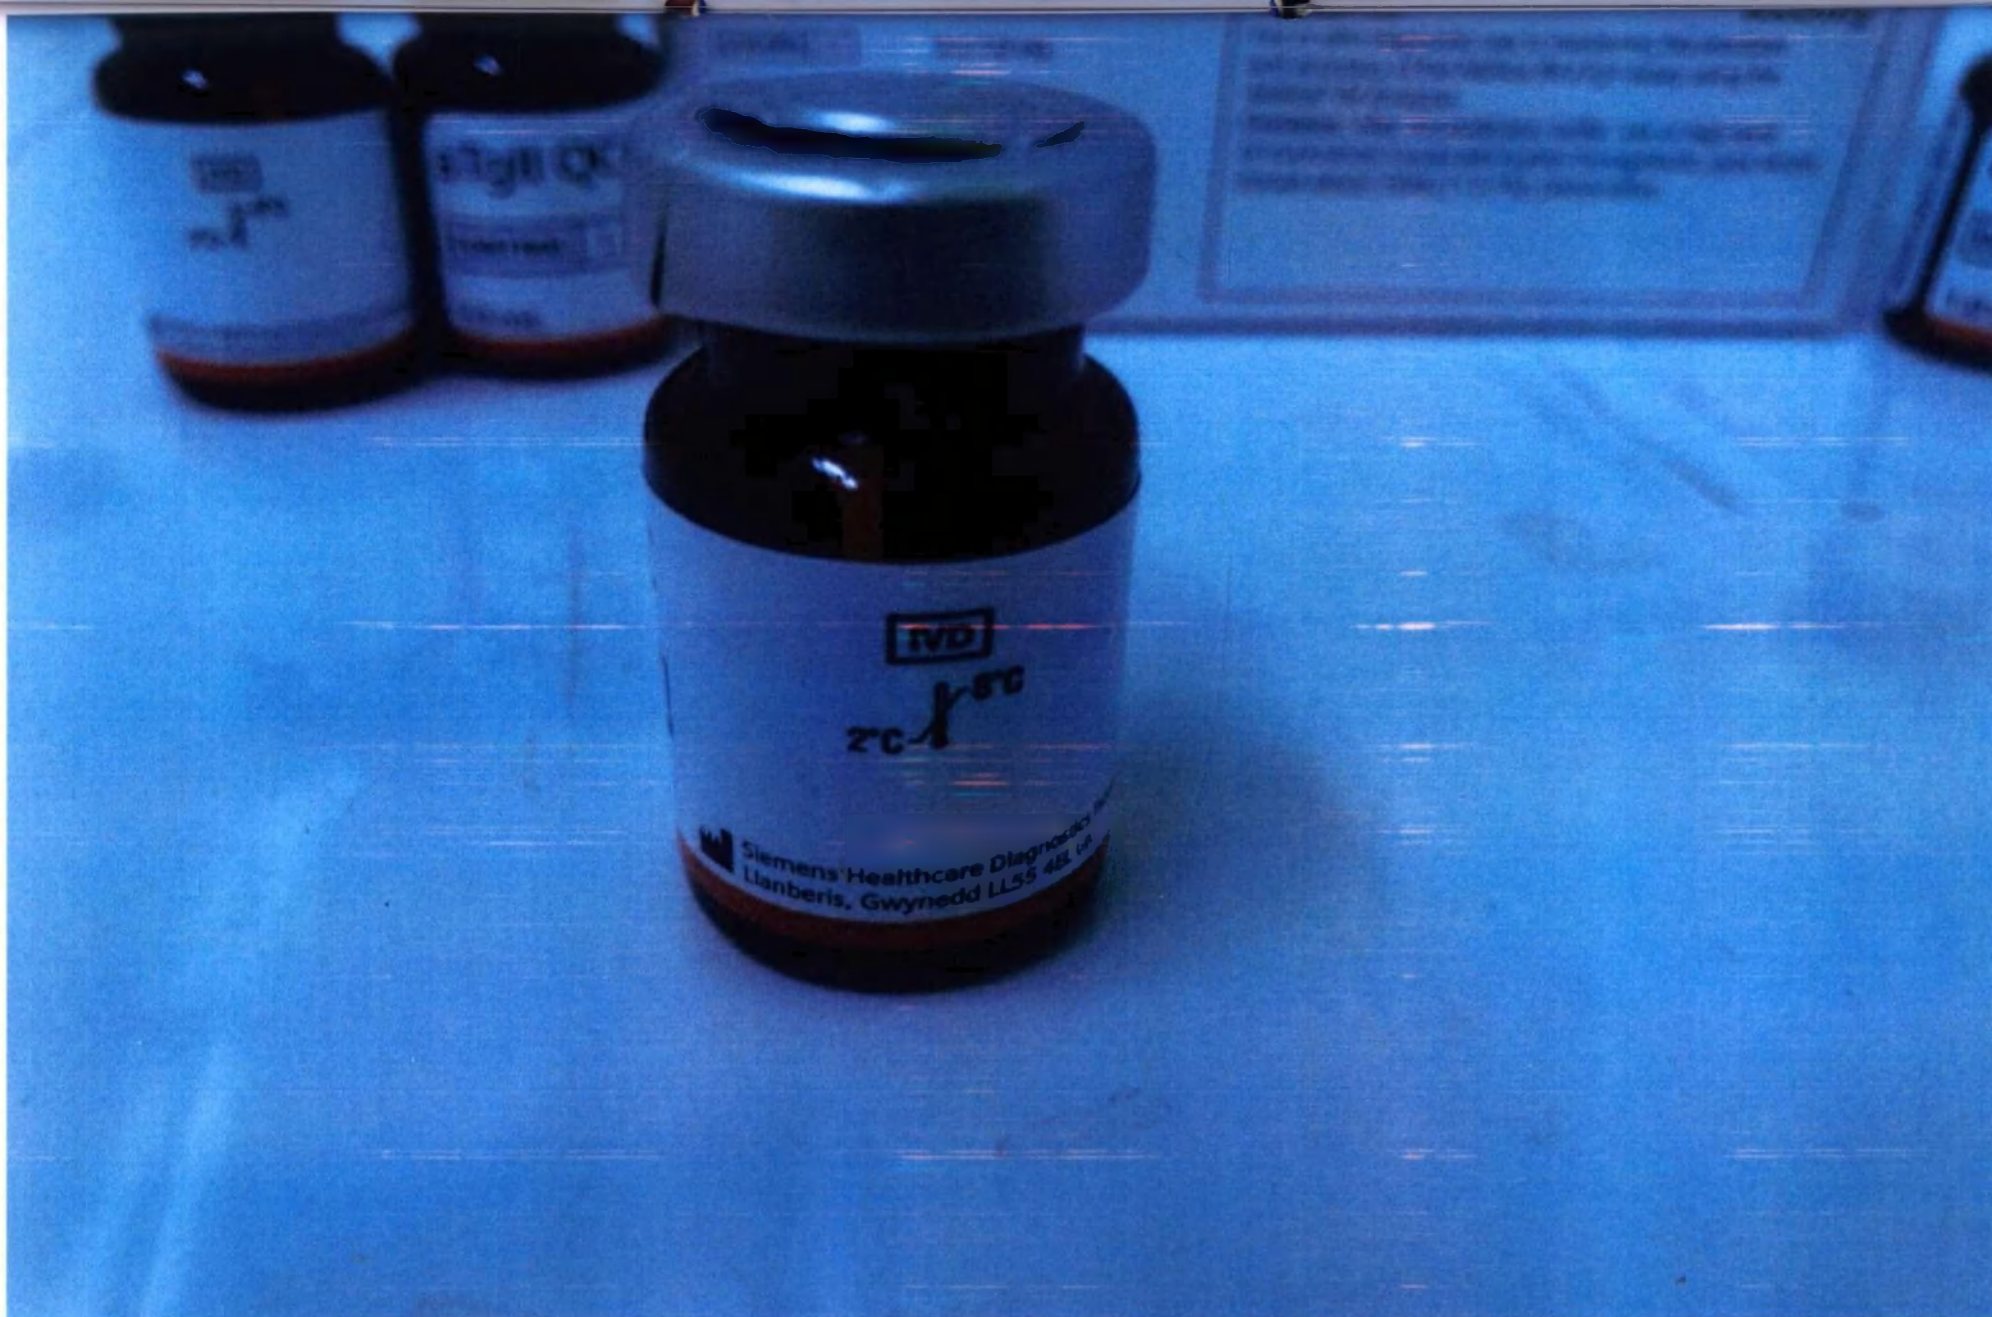


Рисунок 3. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM aTgII QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM aTgII QC CONTROL 1, 1,0

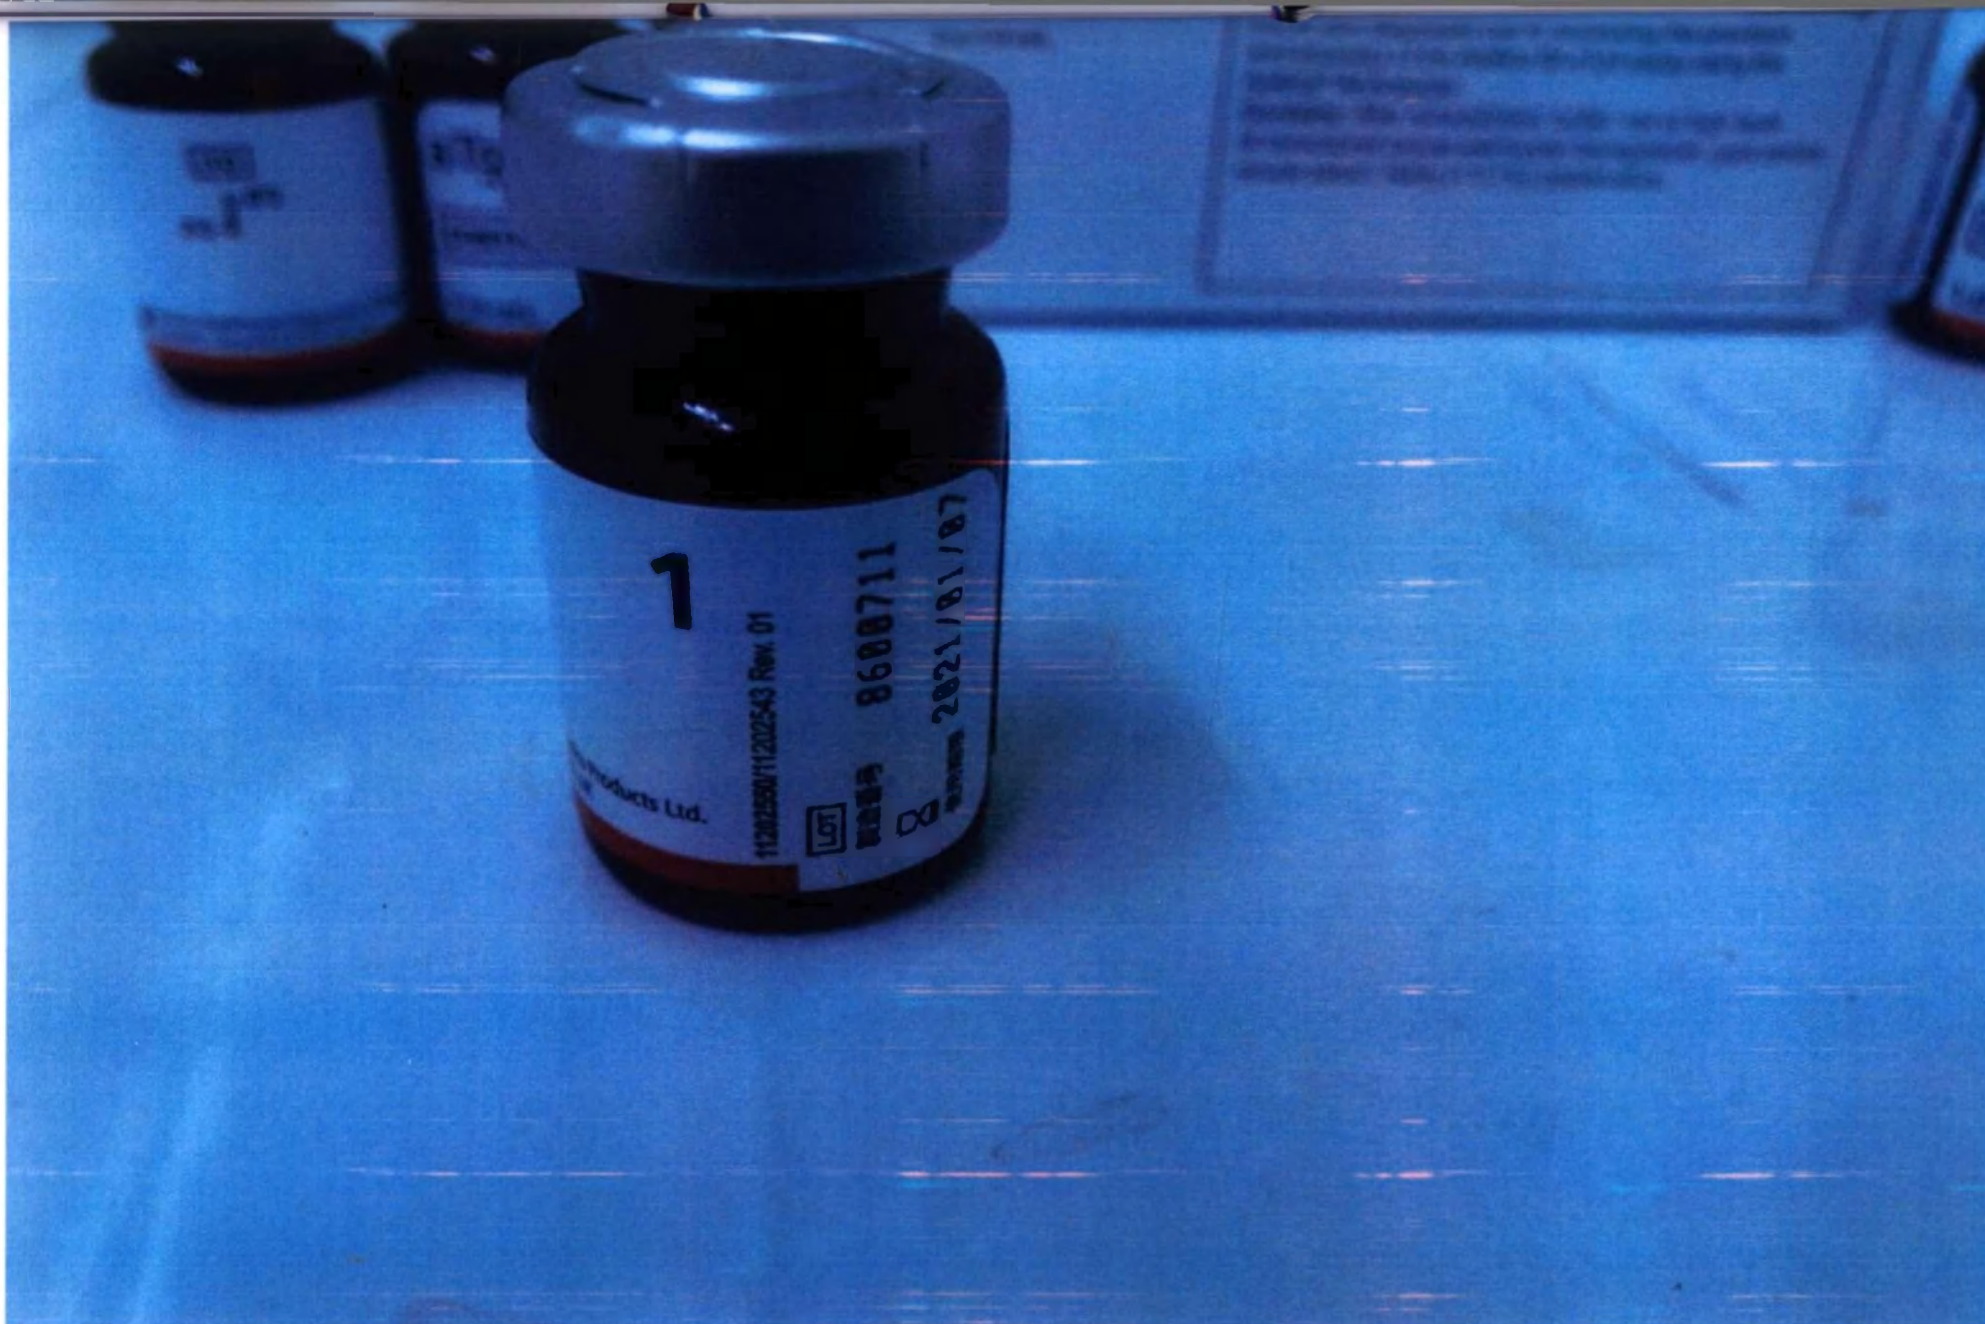


Рисунок 4. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM aTgII QC)): Контрольный материал 1-го уровня Atellica IM aTgII QC CONTROL 1, 1,0 мл.



Рисунок 5. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM aTgII QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM aTgII QC CONTROL 2, 1,0 мл

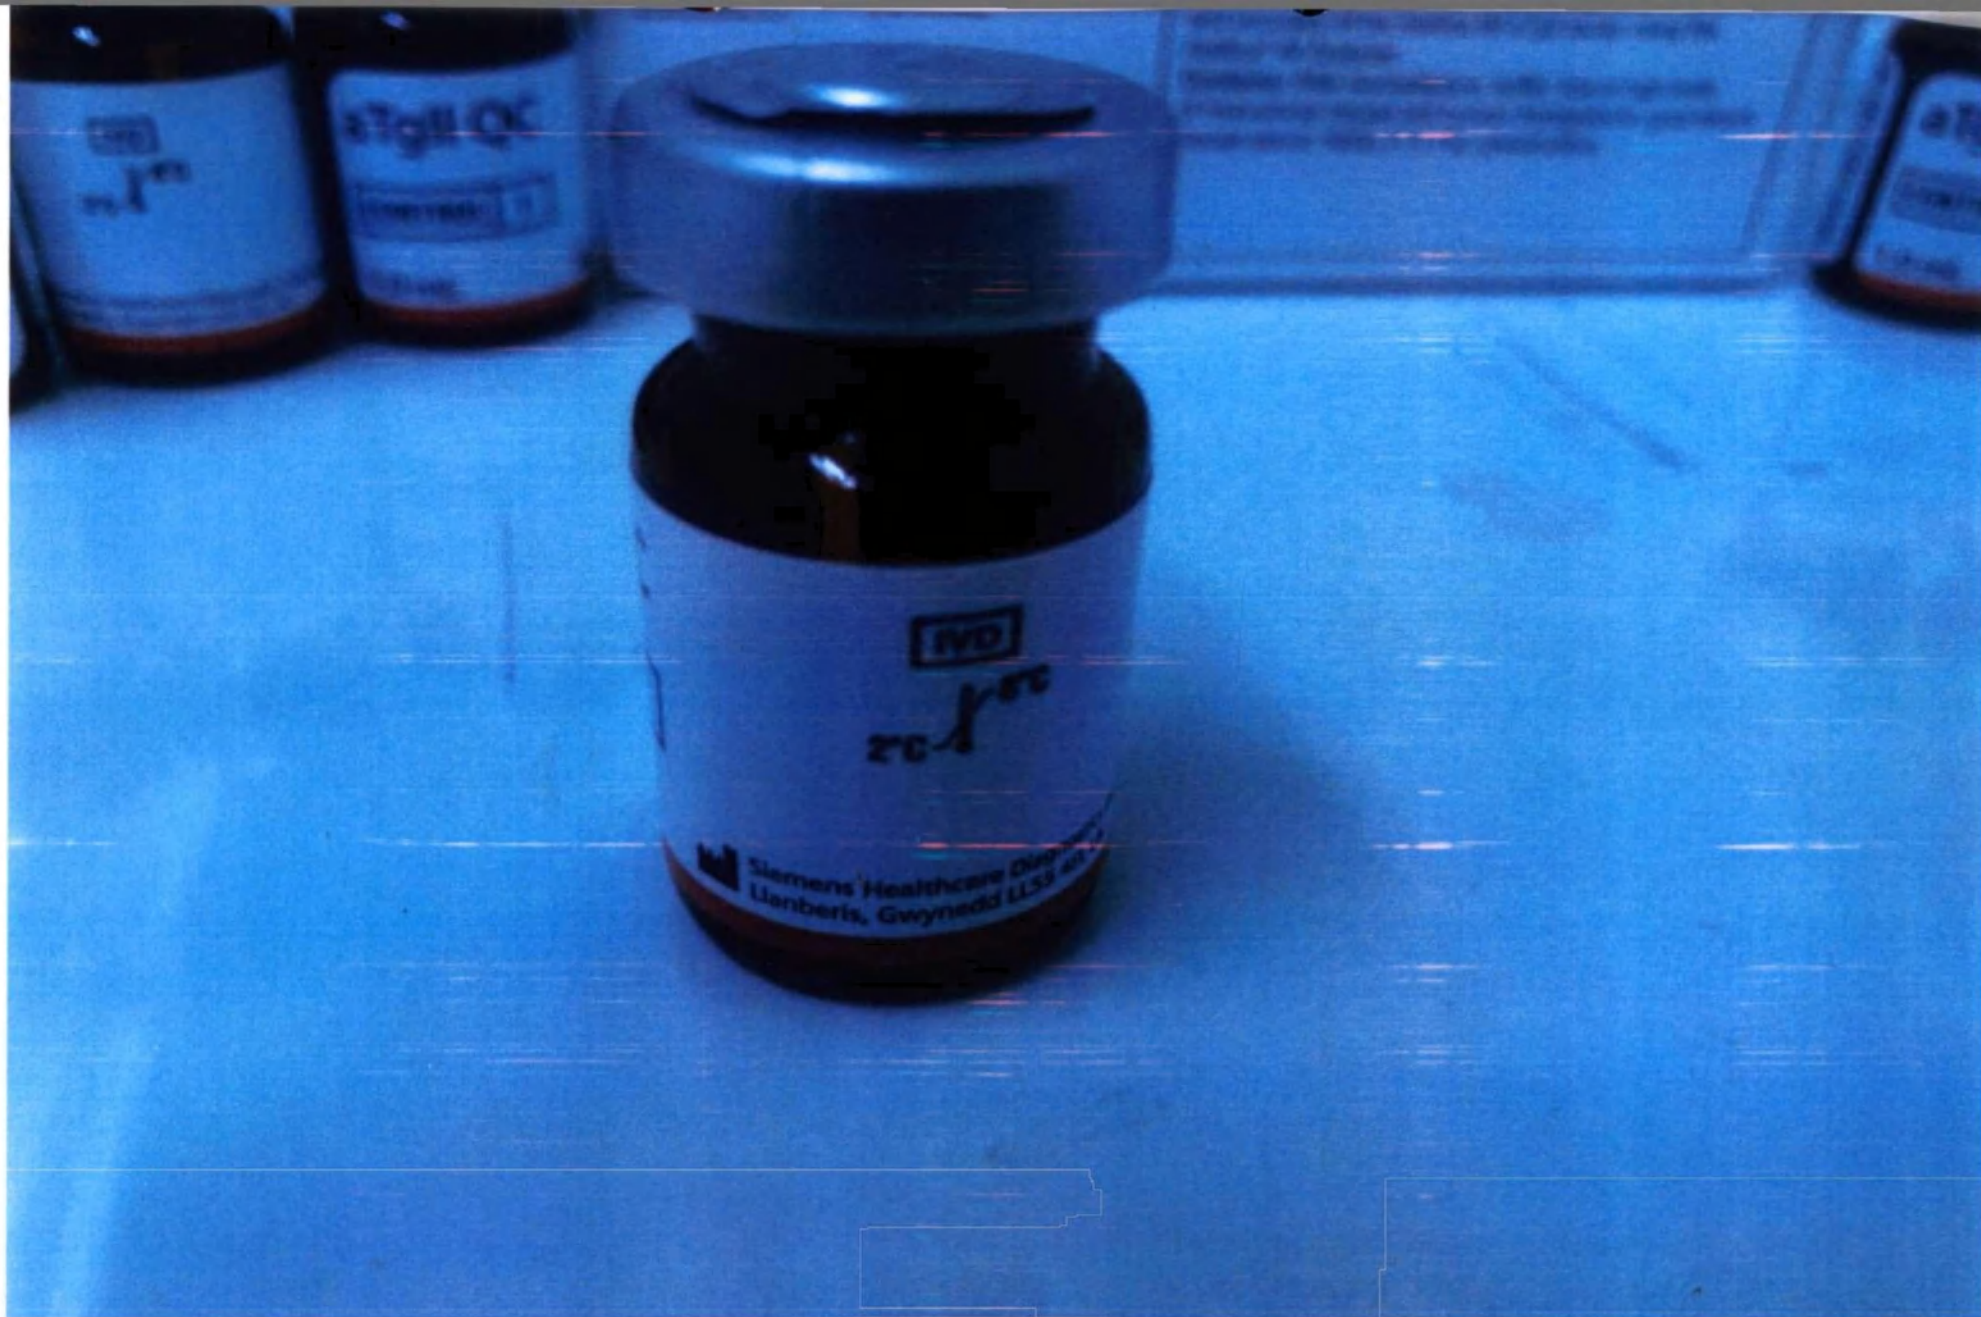


Рисунок 6. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM aTgII QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM aTgII QC CONTROL 2, 1,0 мл

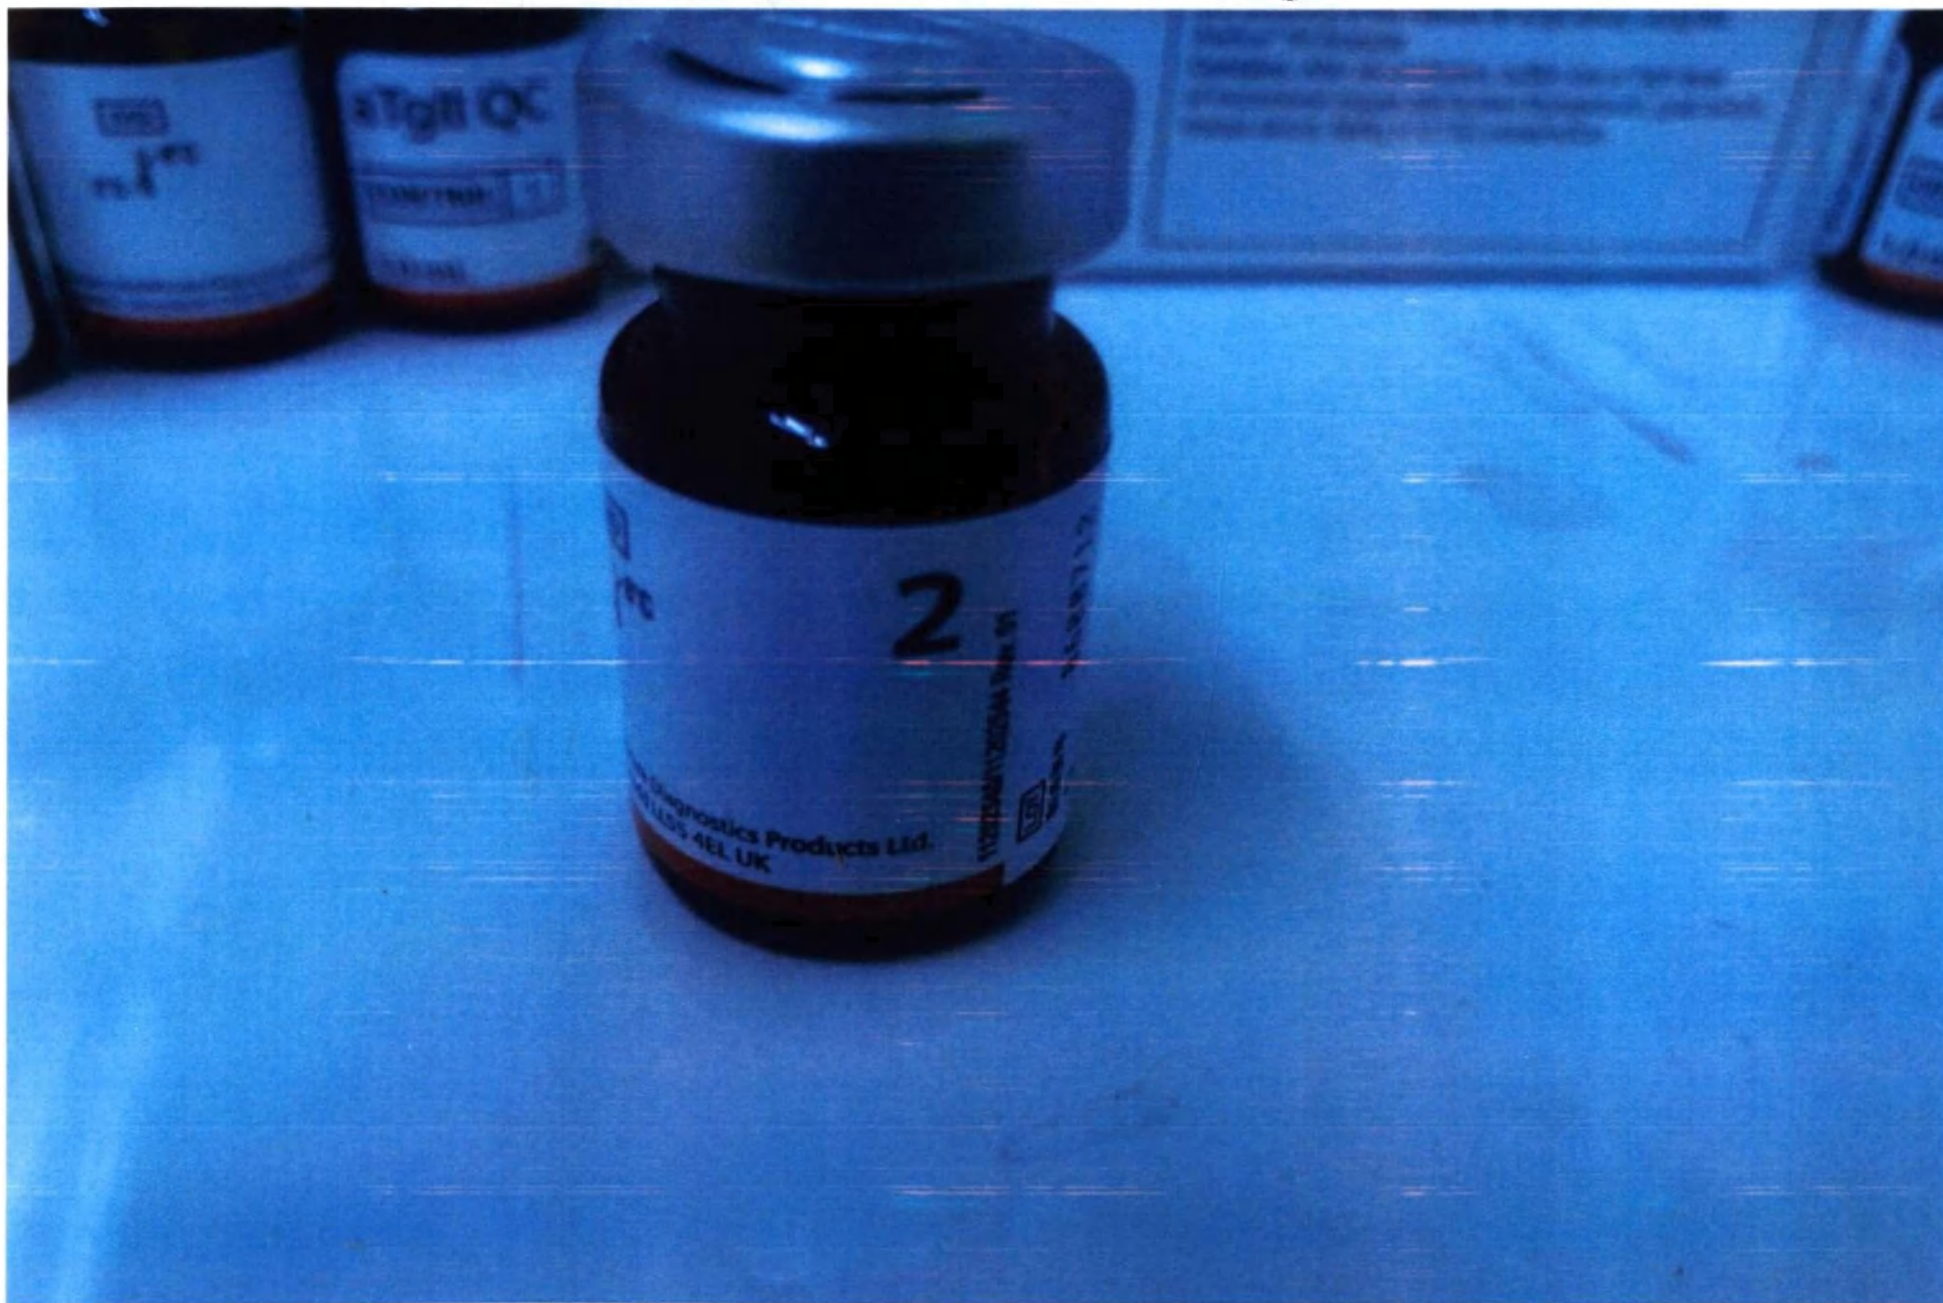


Рисунок 7. Набор реагентов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Anti-Thyroglobulin II (Atellica IM aTgII)): Фасовка 500 тестов. Общий вид

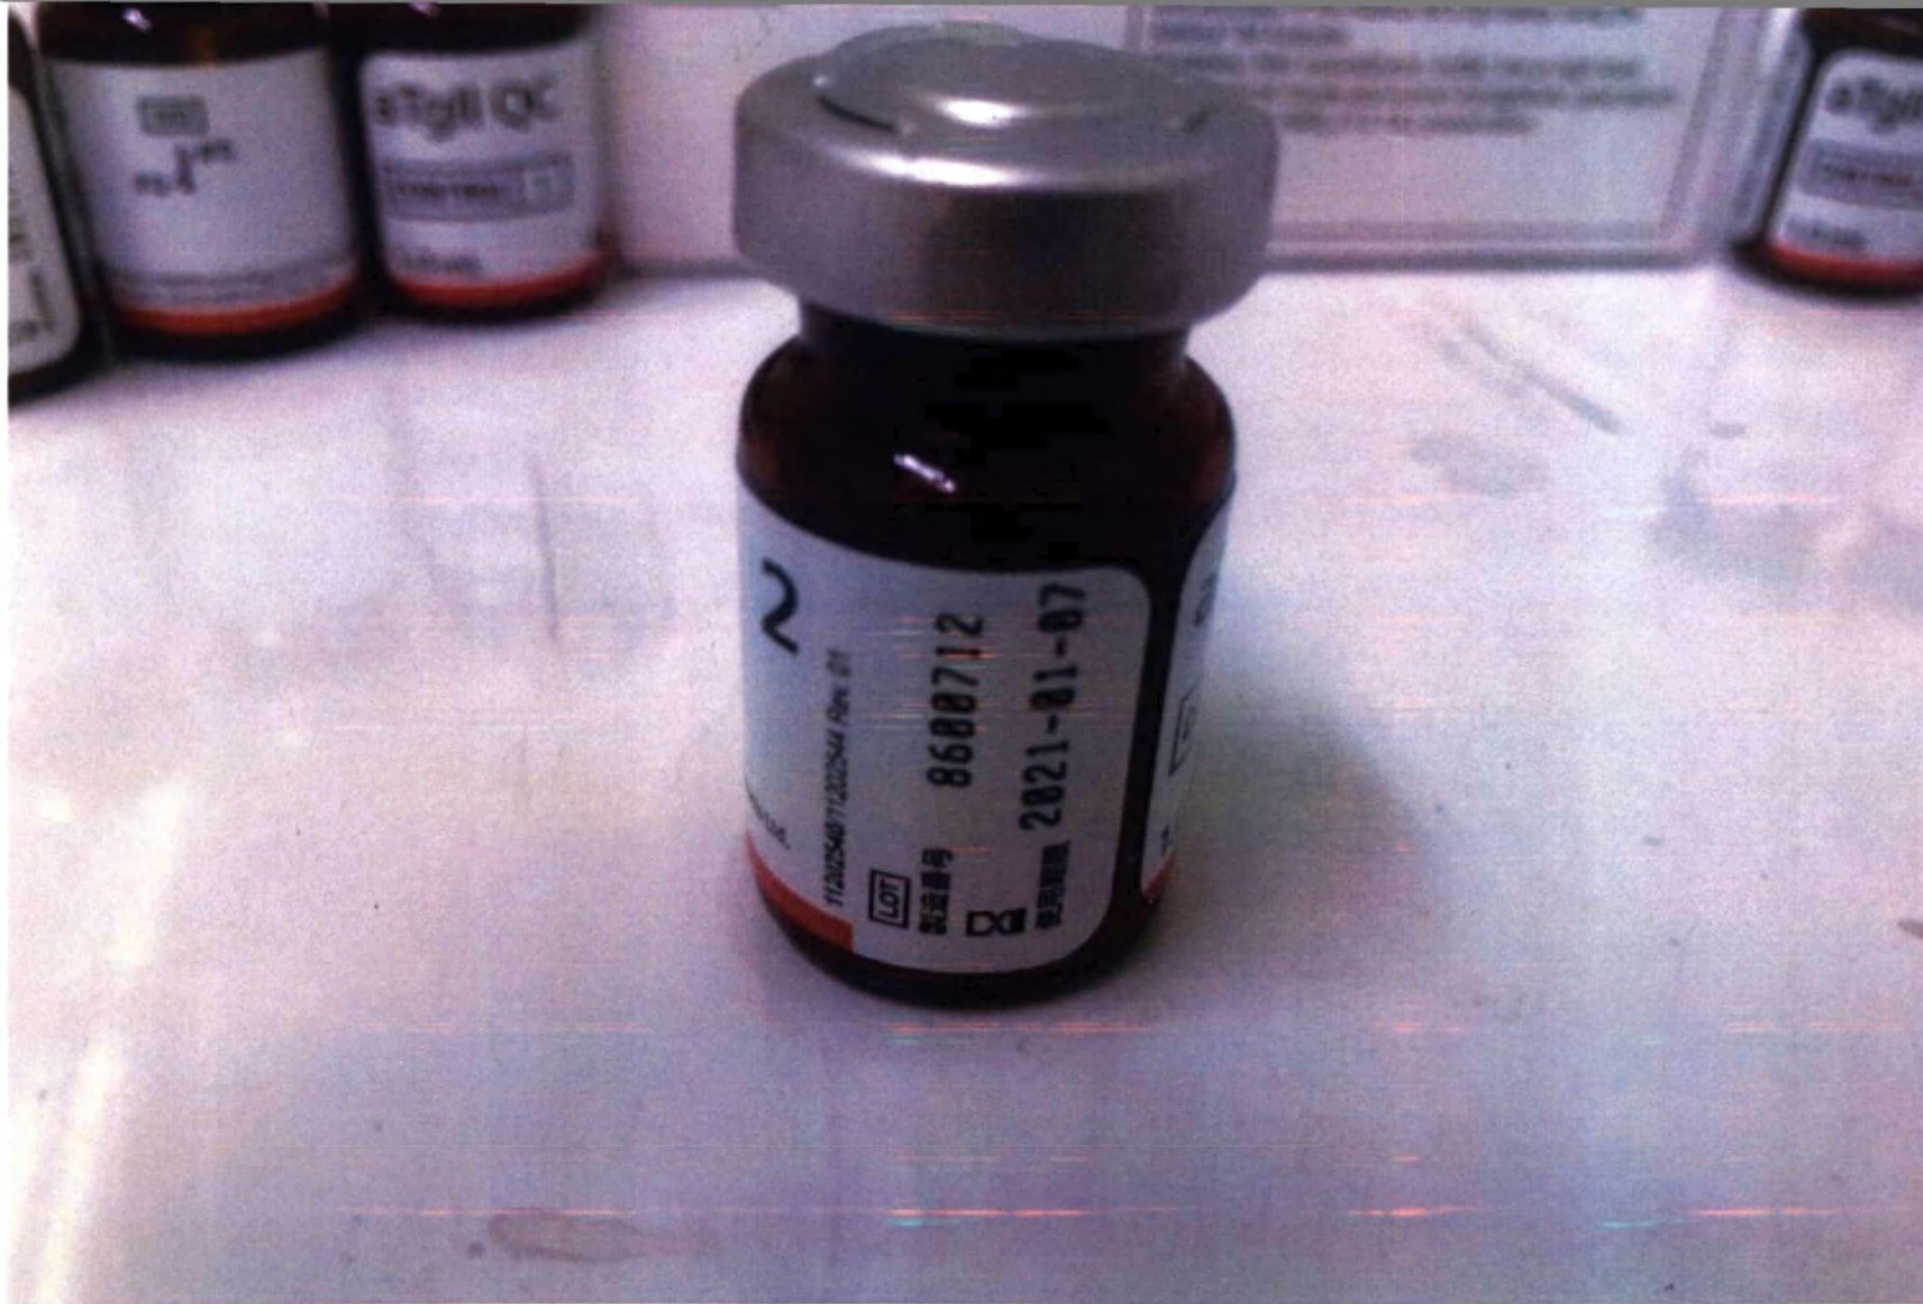


Рисунок 8. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM aTgII QC)): Контрольный материал 2-го уровня Atellica IM aTgII QC CONTROL 2, 1,0 мл

SIEMENS
Healthineers
Atellica® IM
QC

aTgII

CONTROL	LOT	VAL
---------	-----	-----

REF

11201752

2021-01-07

SIEMENS LABORATORY LIBRARY

UNITS

	LOT	U/mL	U/mL
CONTROL 1	8600711	49.2	14.0
CONTROL 2	8600712	481	143

UNITS

	LOT	U/mL	U/mL
CONTROL 1	8600711	49.2	14.0
CONTROL 2	8600712	481	143

10987642 Rev. 04

Рисунок 9. Набор контрольных материалов для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM aTgII Quality Control (Atellica IM aTgII QC)): Лист присвоенных значений контрольных материалов.