

Фотографические изображения медицинских изделий

Фото 1. Внешний вид МИ Реагент VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 Общий 2 в кассете (VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total 2 Reagent Pack) для качественного и полуколичественного иммунодиагностического определения общих антител к коронавирусу SARS-CoV-2, методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS, лот 0520.

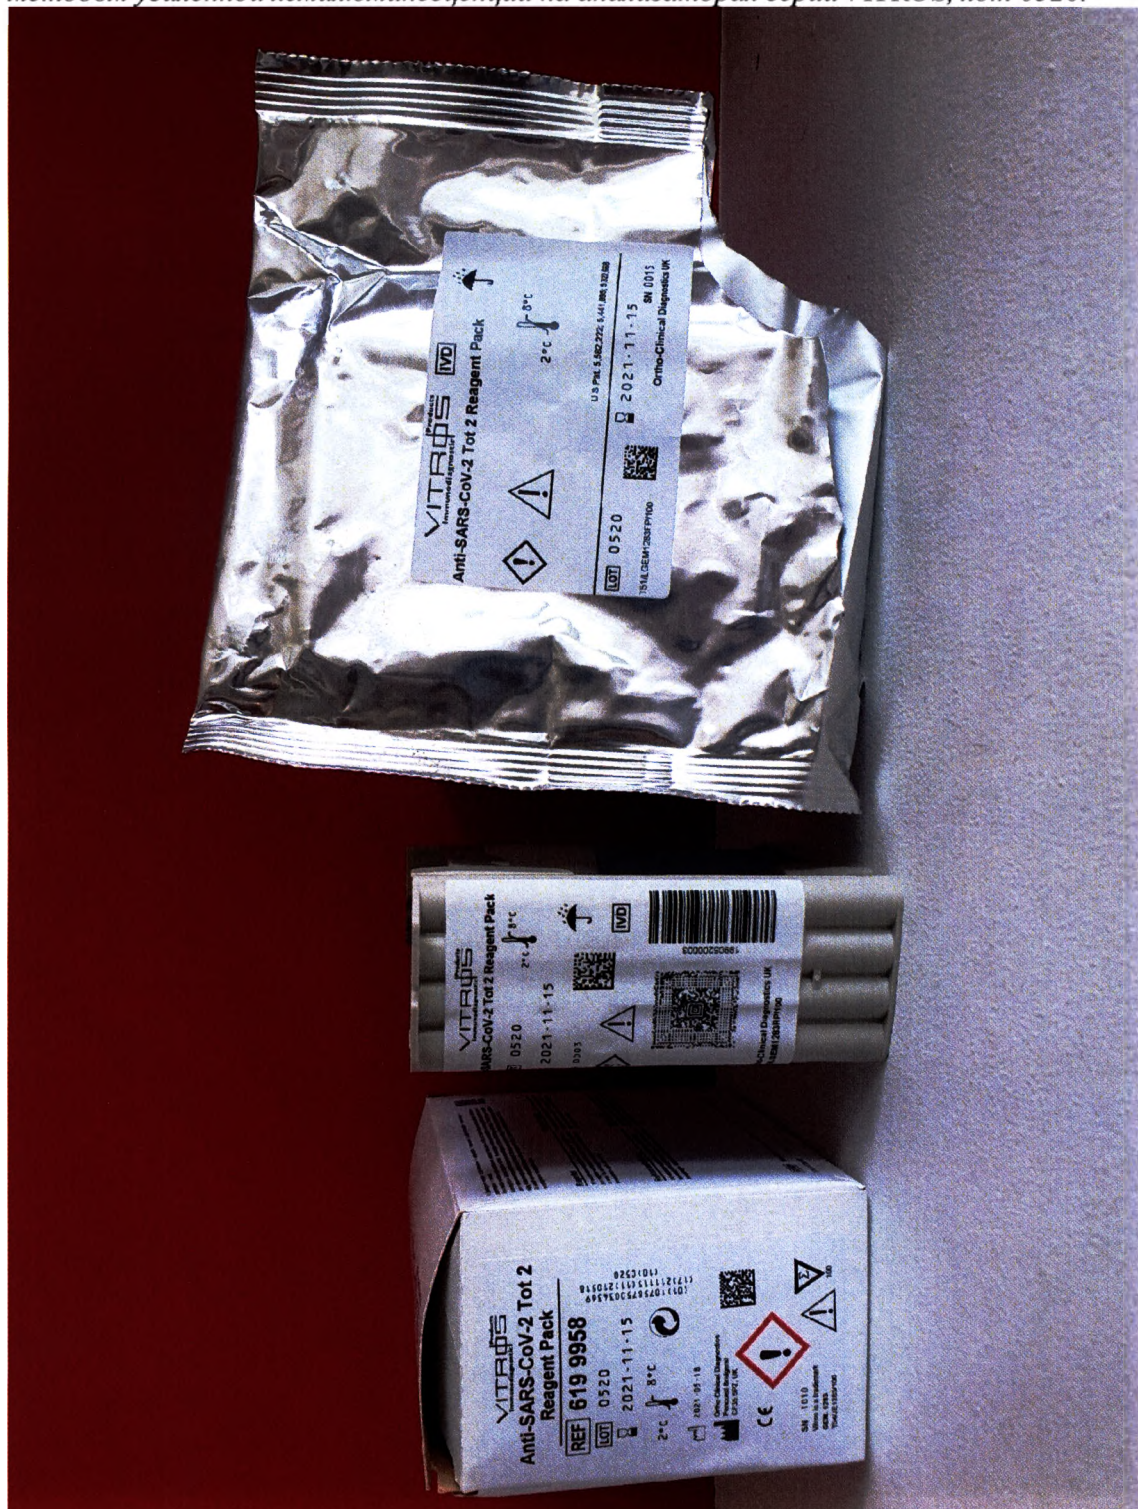


Фото 2. Калибратор VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 Общий 2 (VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total 2 Calibrator) для калибровки анализаторов серии VITROS при качественном и полуколичественном иммунодиагностическом определении общих антител к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS, лот 0520.



Фото 3. Внешний вид МИ Набор контролей VITROS Коронавирус SARS-CoV-2 Общий (VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total Controls) для иммунодиагностического определения общих антител к коронавирусу SARS-CoV-2 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS, лот 0510.

