


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Анализатор полуавтоматический для исследования параметров
плазменного гемостаза HumaClot для лабораторных
исследований in vitro**



Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

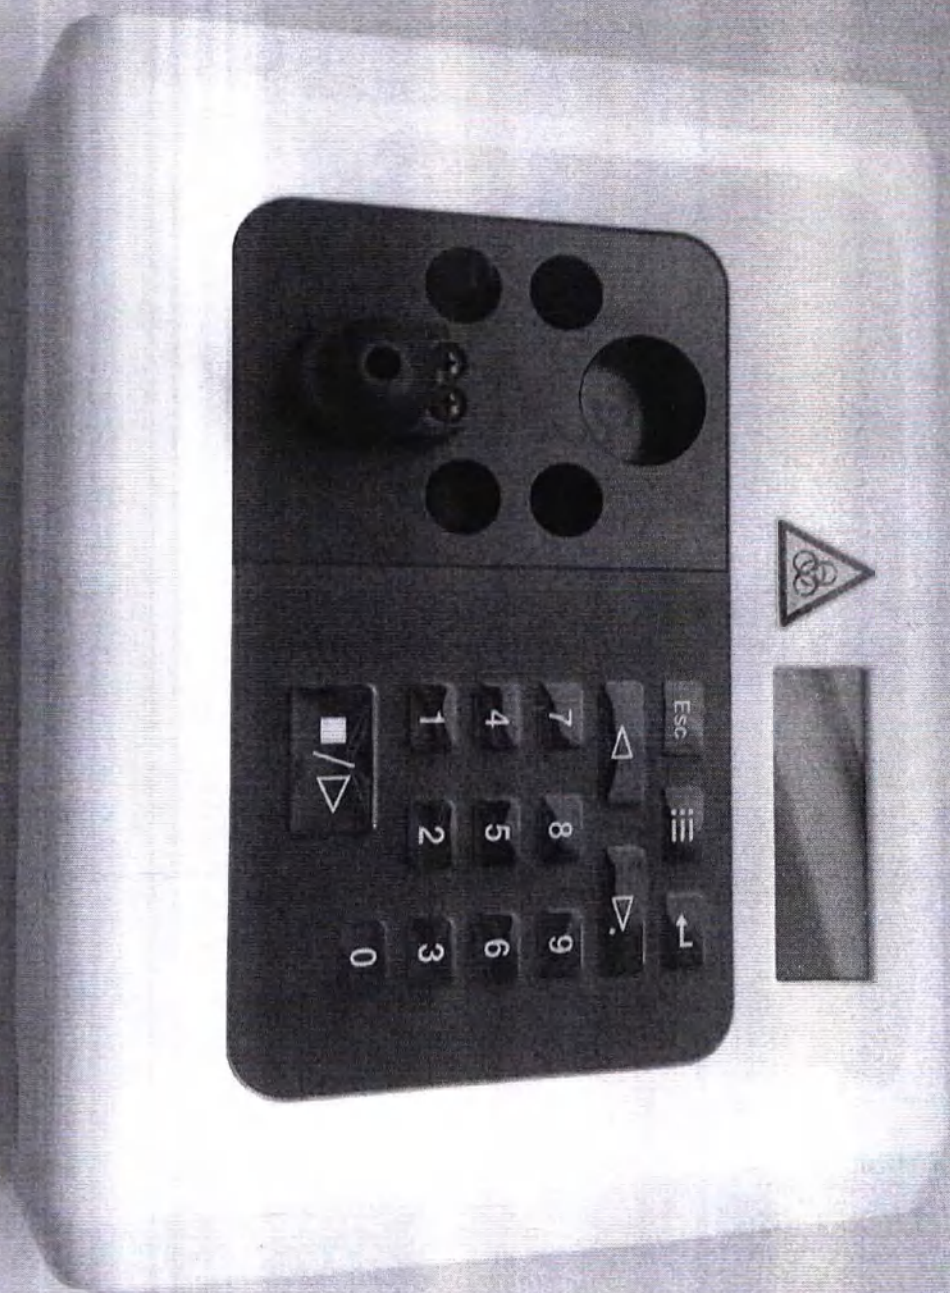

Сетевой адаптер для анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

...жировка, наносимая на сетевой адаптер, предназначенный для обеспечения электропитания анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro



KIOG®

АС АДАПТОР . P4916

MODEL:KSAS0121200100D5

INPUT:100-240V~50/60HZ 0.4A

OUTPUT:12V ---1.0A




I.T.E. POWER SUPPLY

LISTED
90VH
E215890




MADE IN CHINA

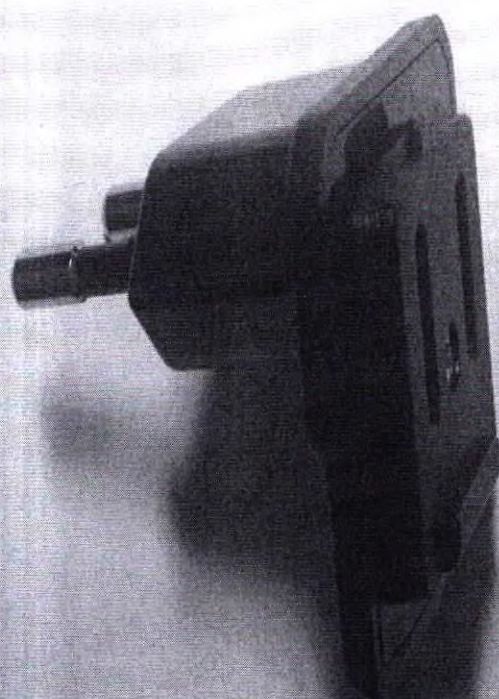


Переходник адаптера для розеток, стандарт EU для анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro




Переходник адаптера для розеток, стандарт UK для анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

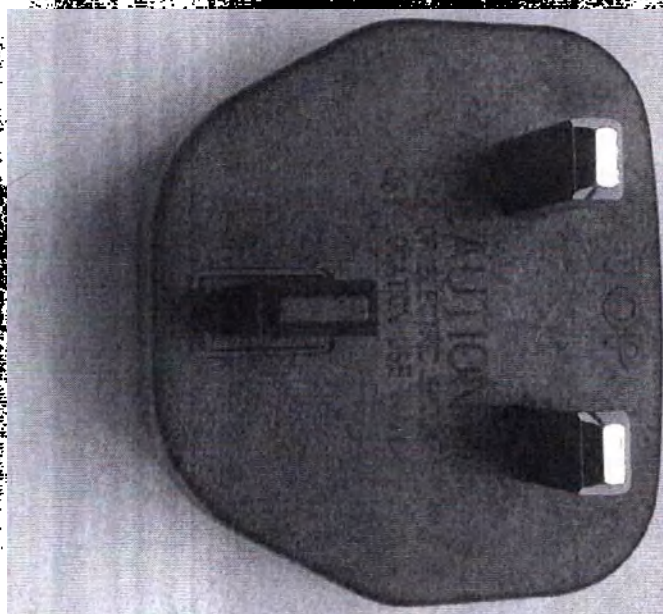


Переходник адаптера для розеток, стандарт USA для анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

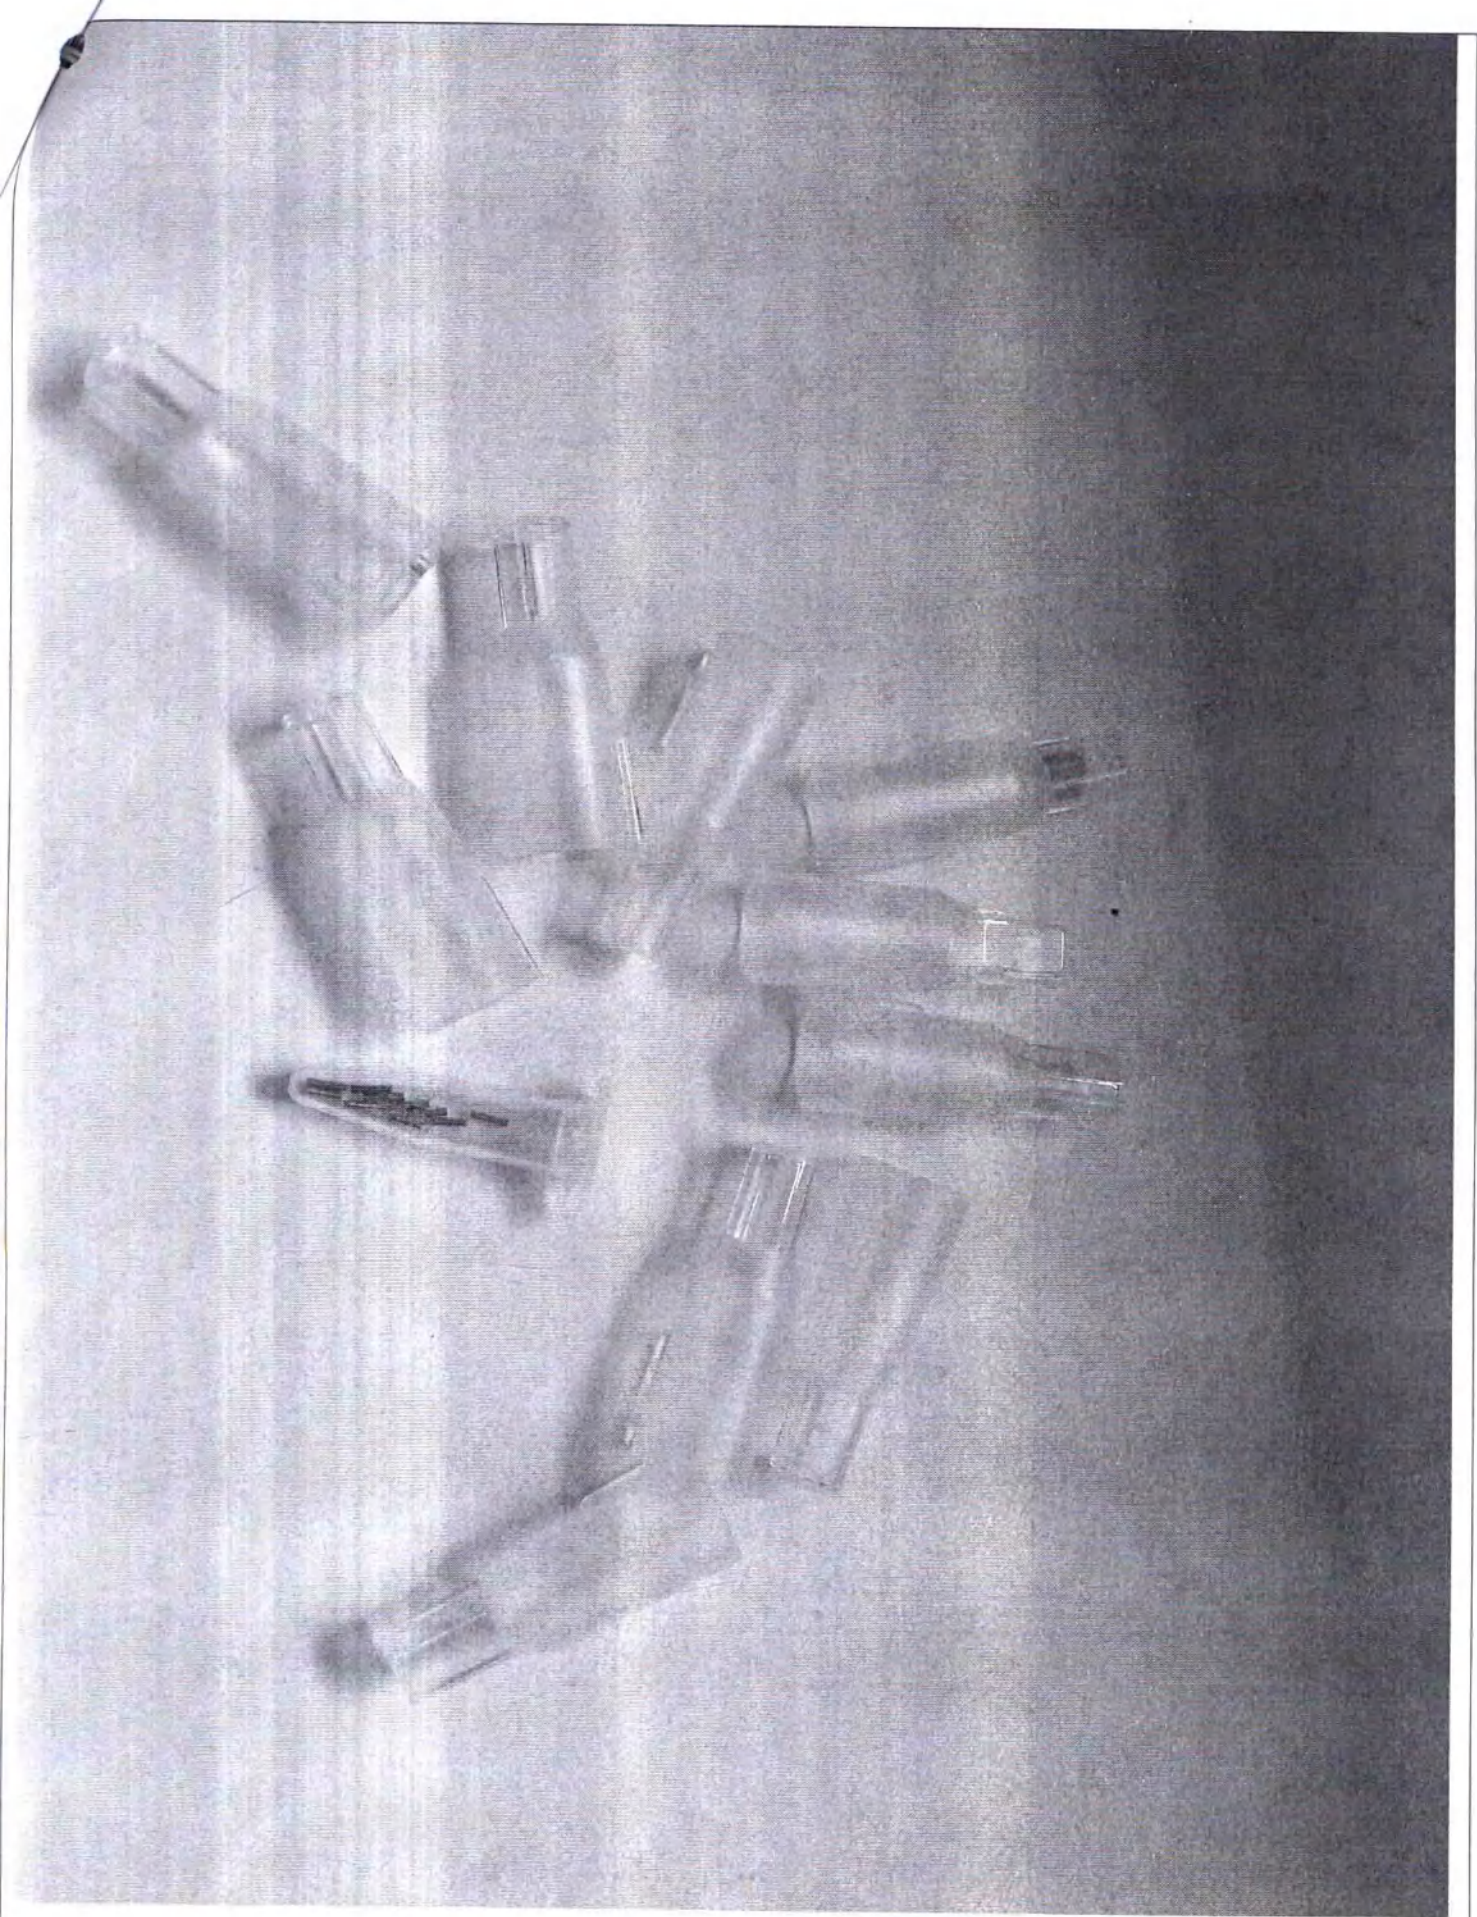

Набор кювет: кювета FL45, 10 шт.; стержень для перемешивания во флаконе Mixer Micro, 10 шт. для анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

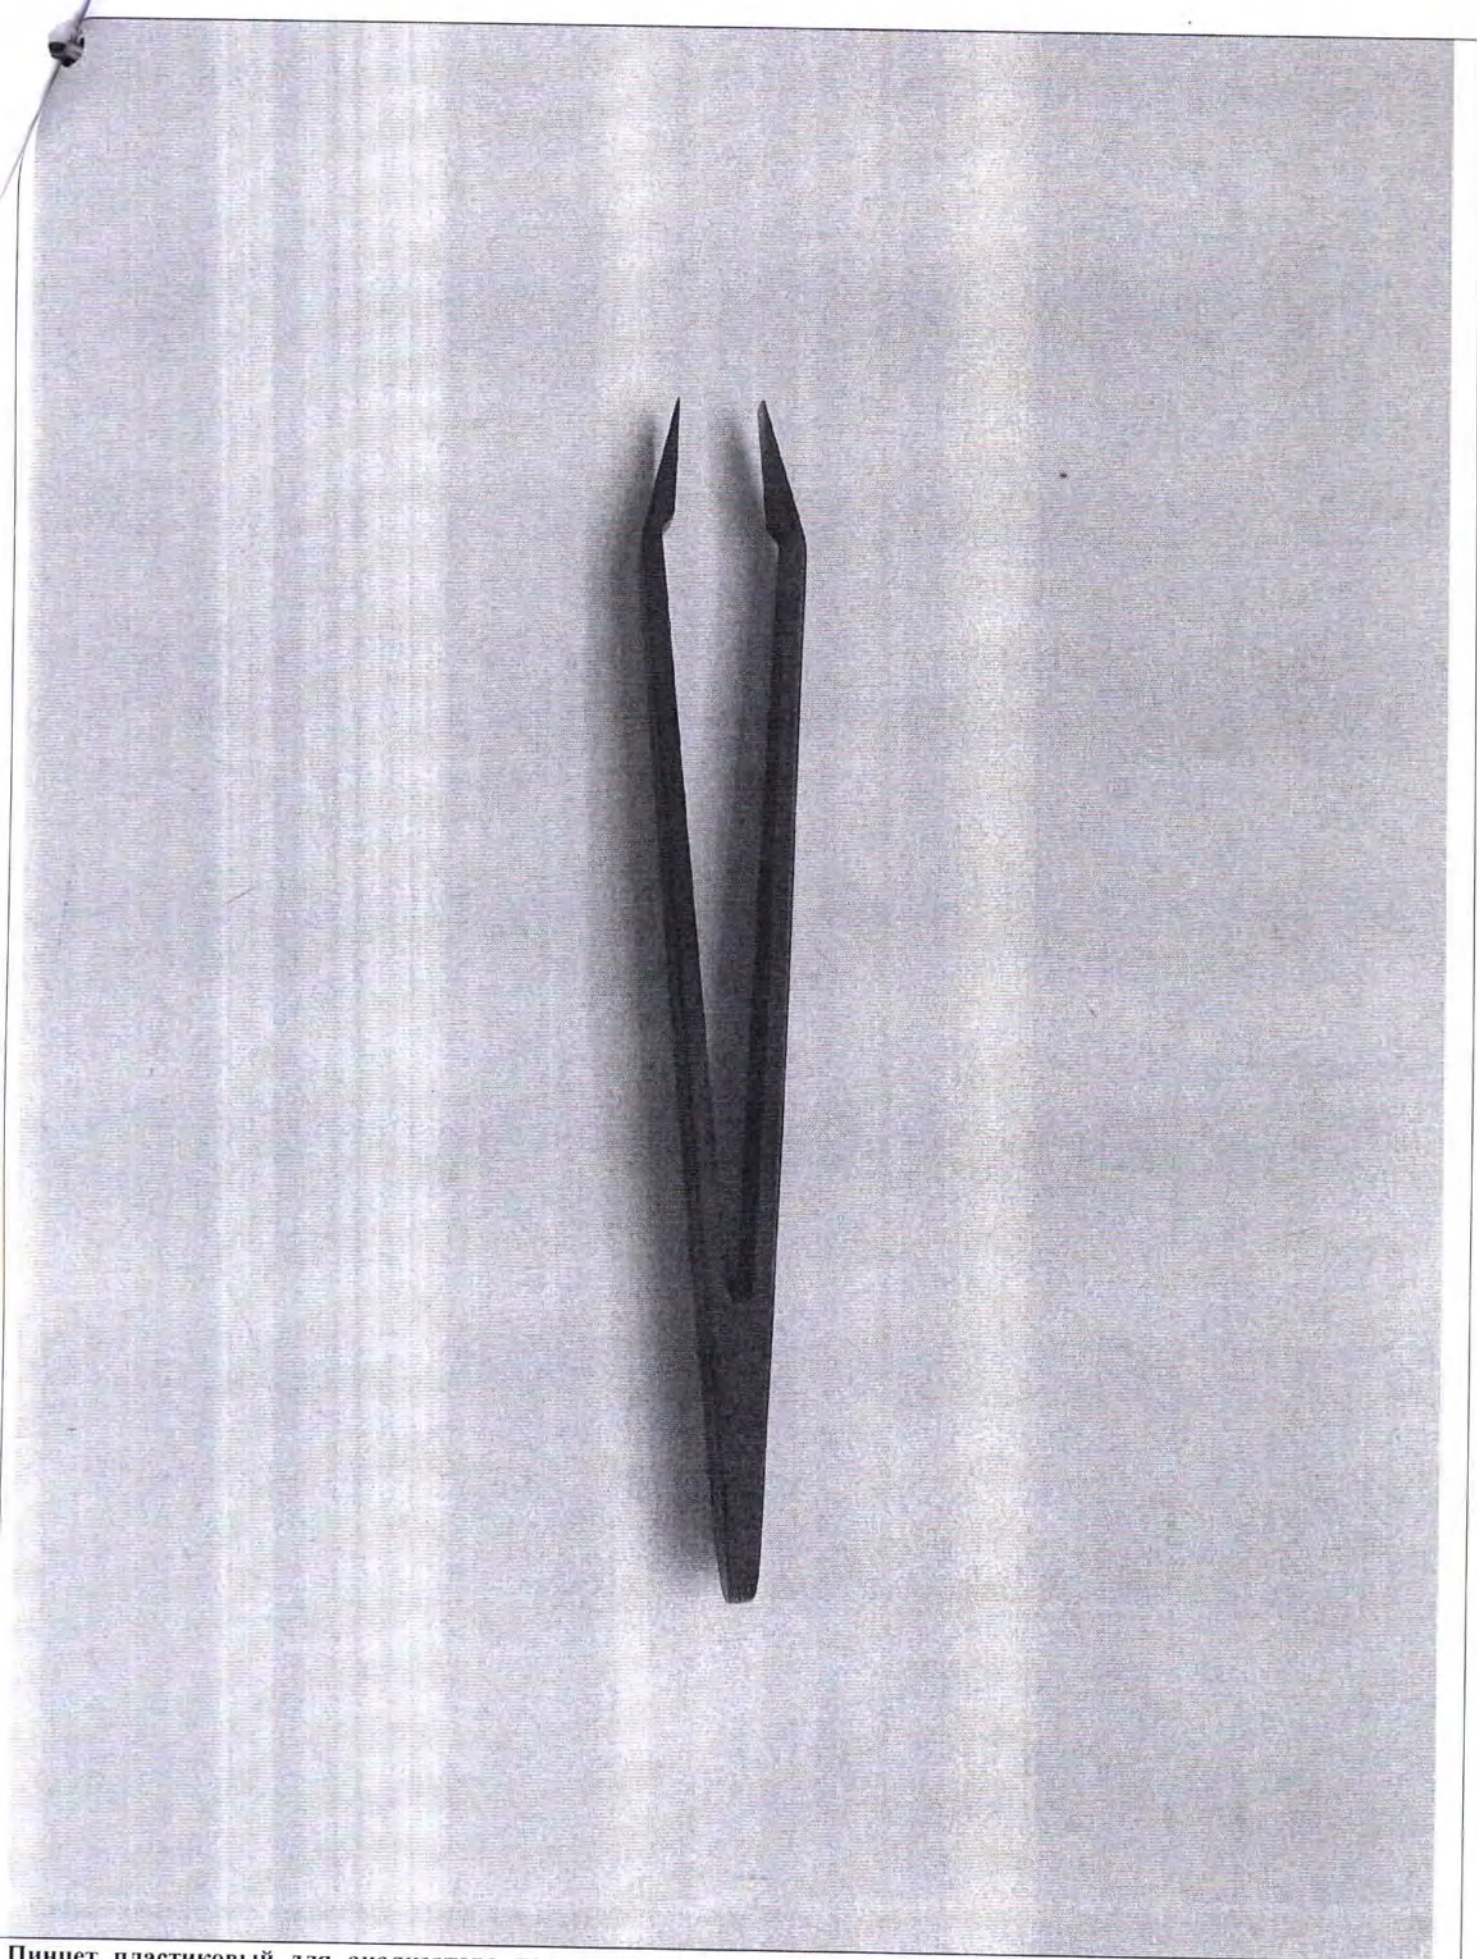

Пинцет пластиковый для анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

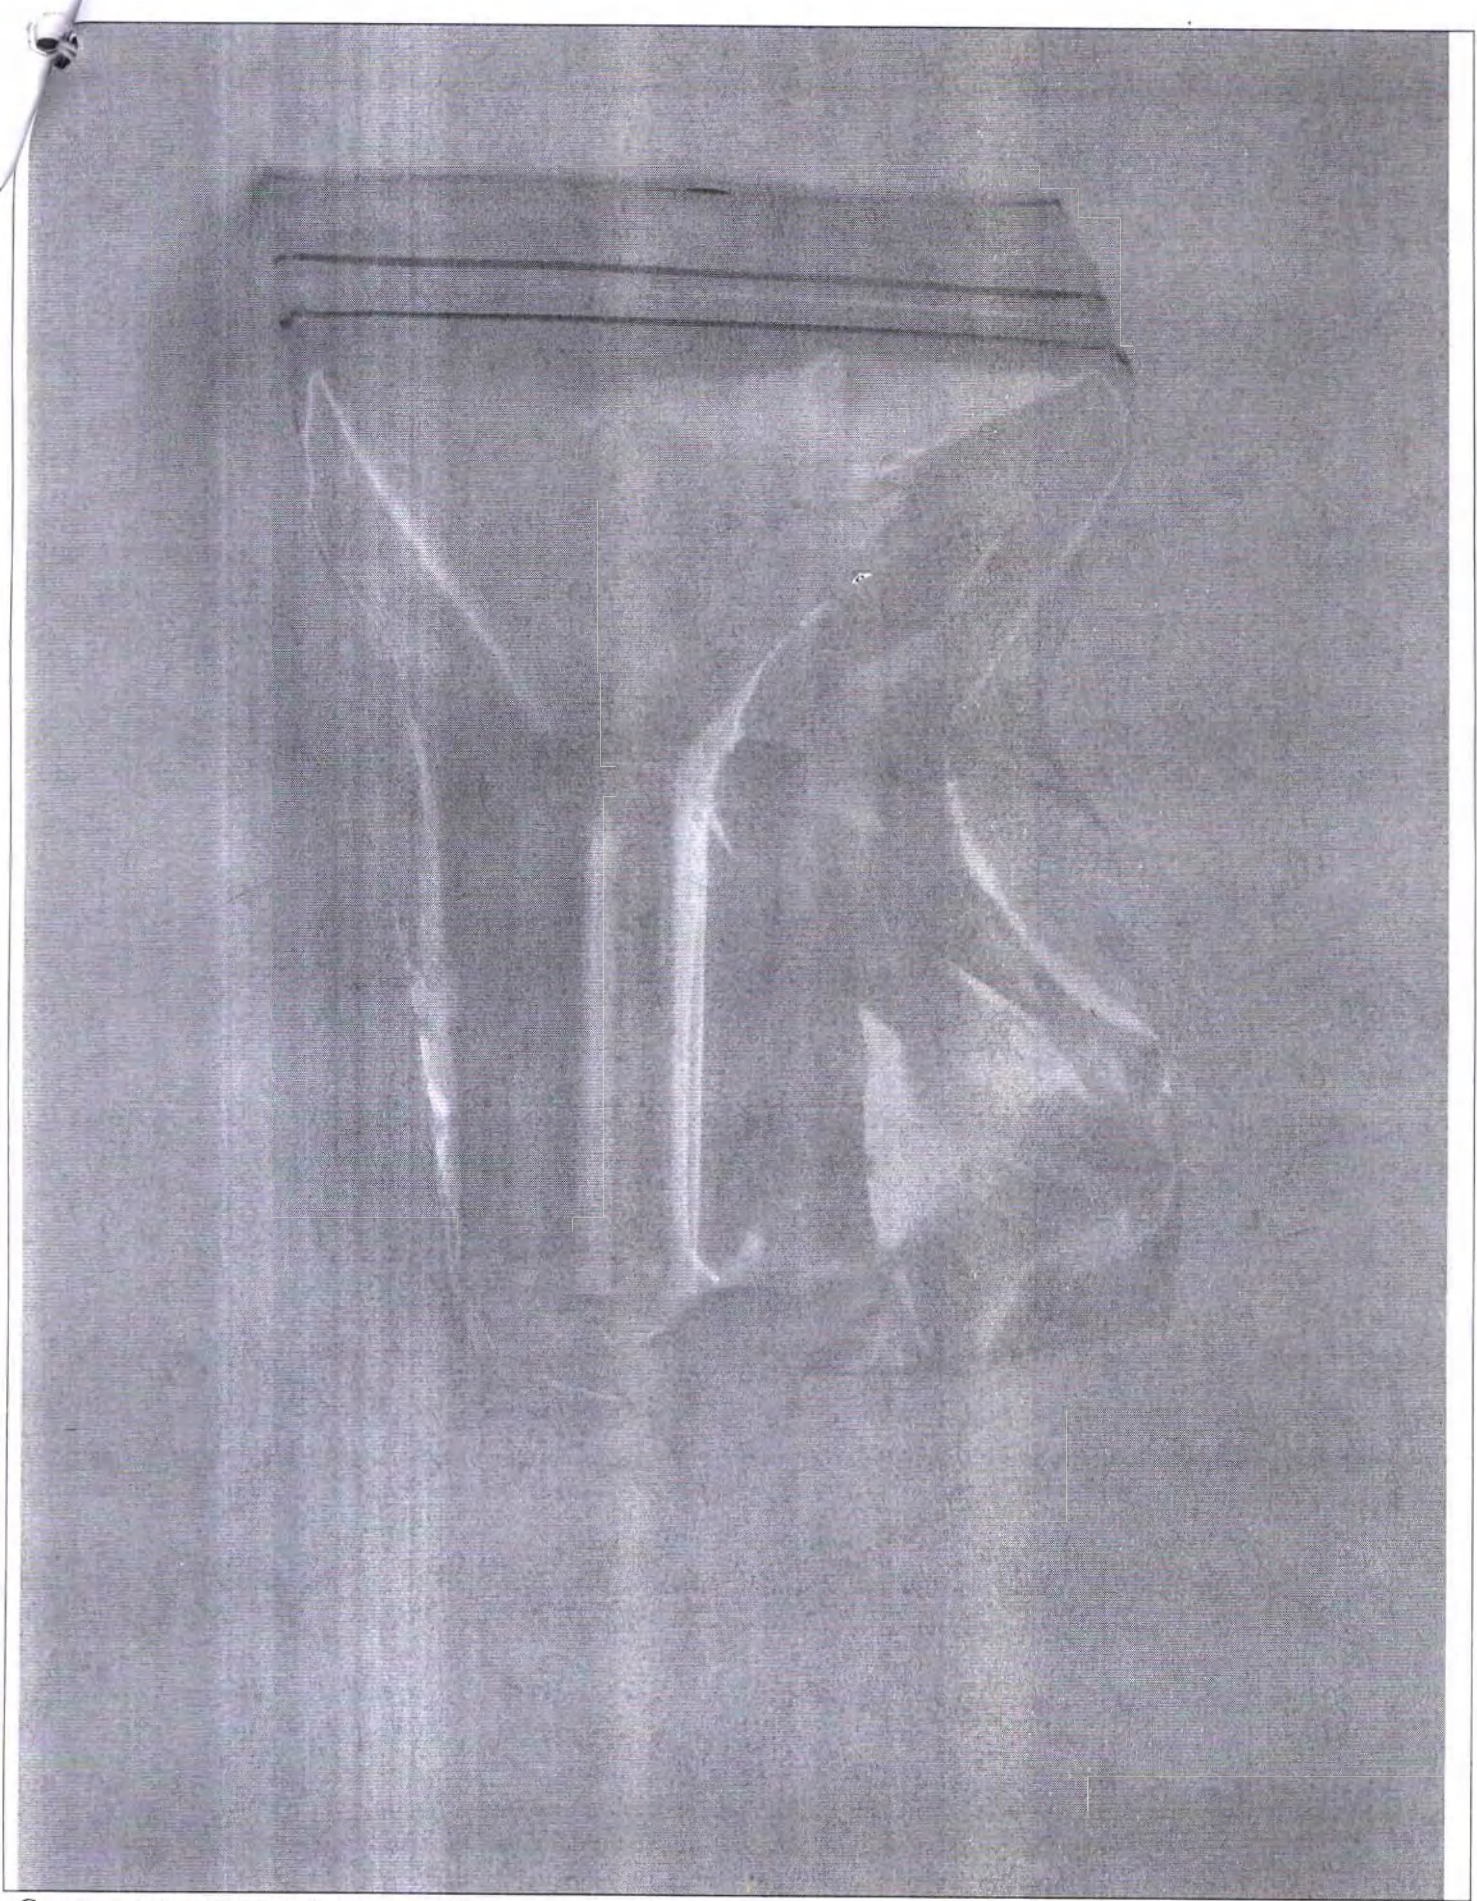



Стаканчик пластиковый с крышкой для анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

Руководство пользователя

Анализатор полуавтоматический для исследования
параметров плазменного гемостаза HumaClot для
лабораторных исследований *in vitro*

Руководство пользователя для Анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior

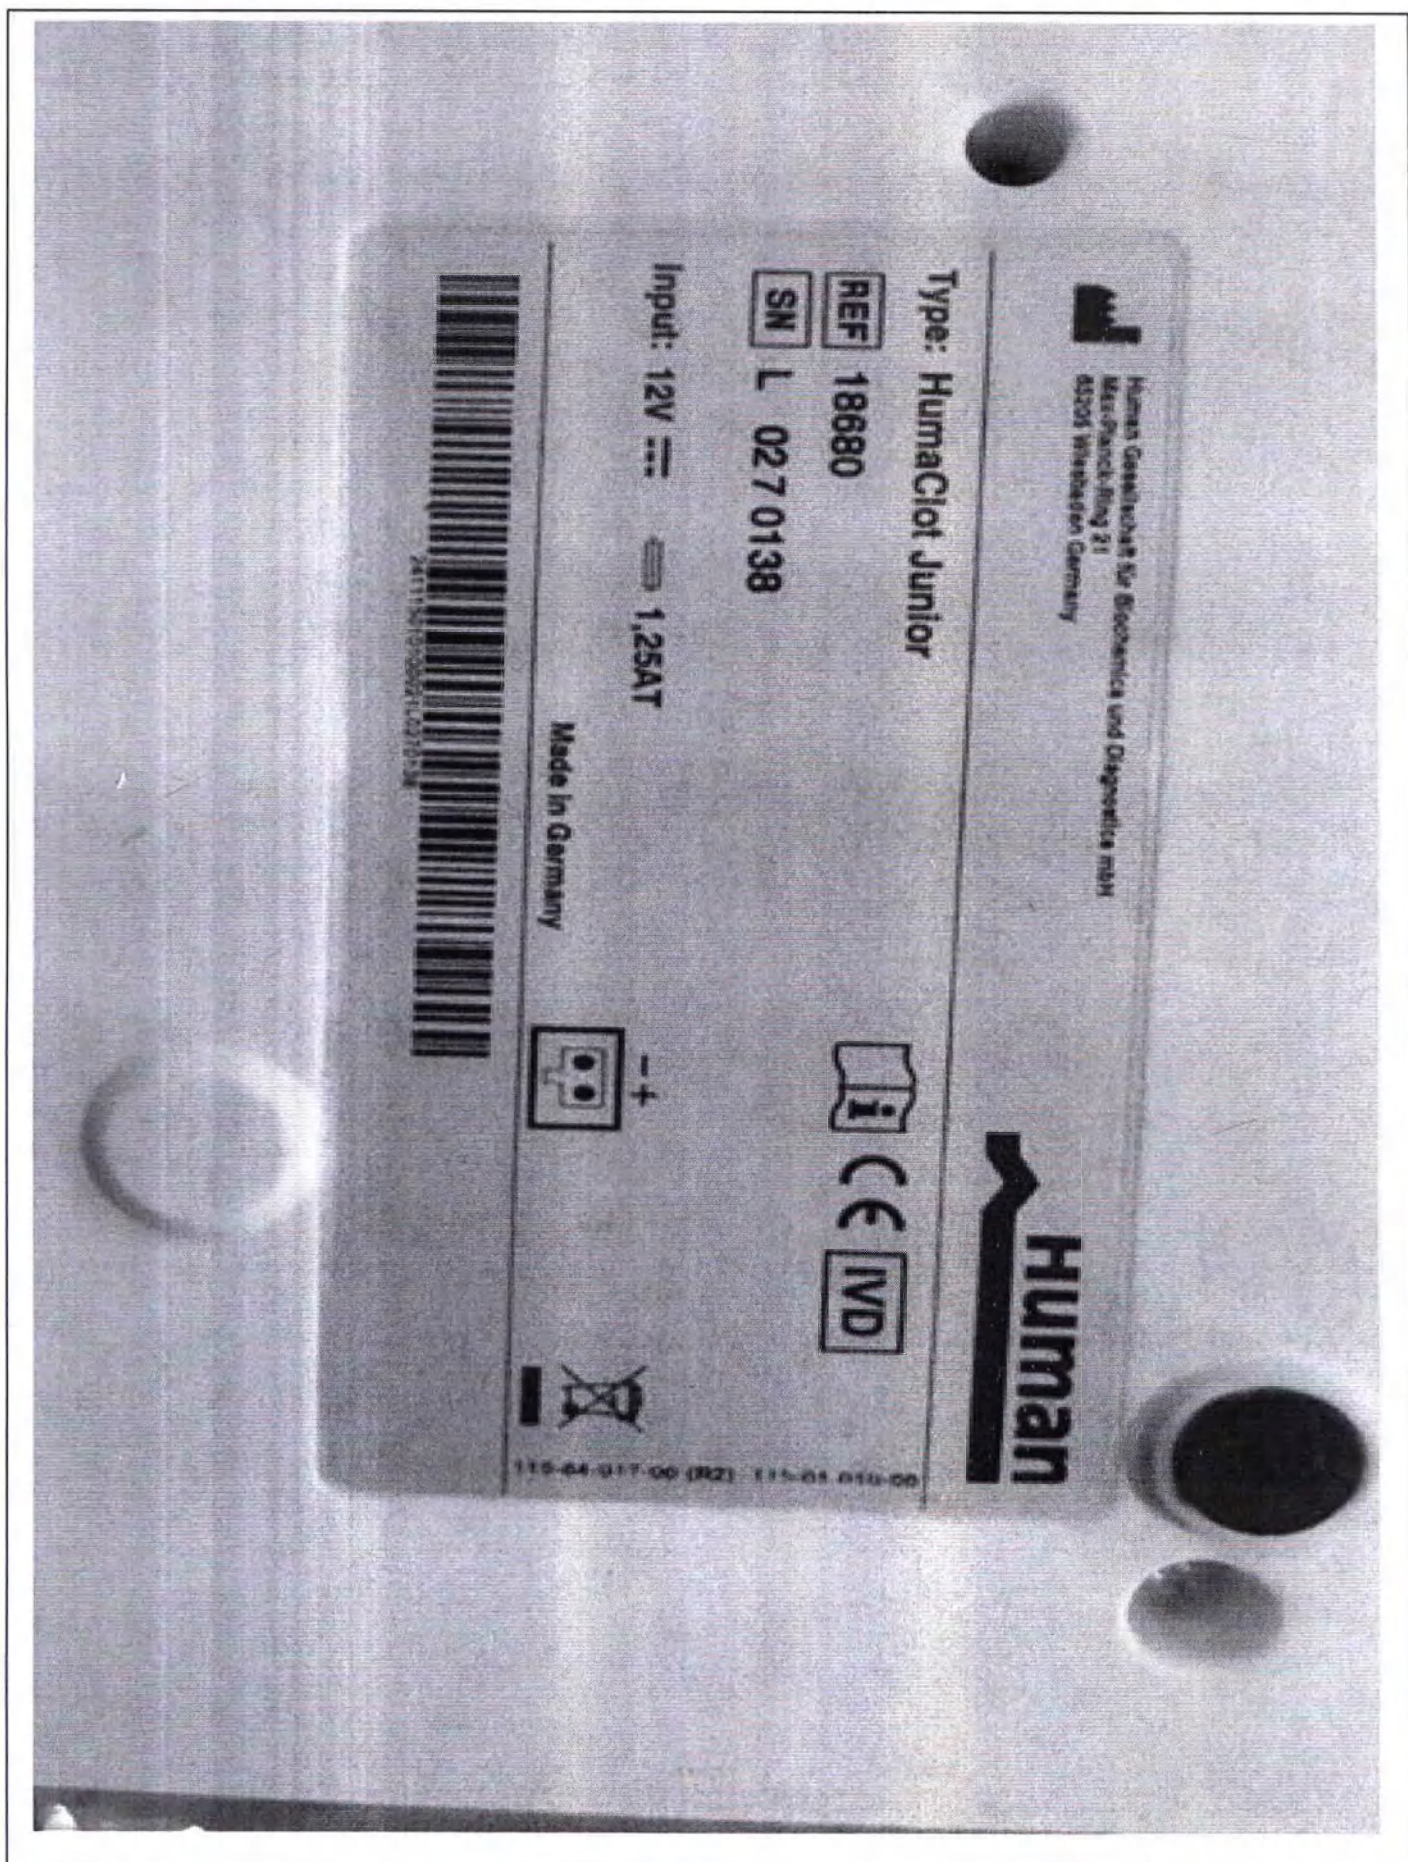

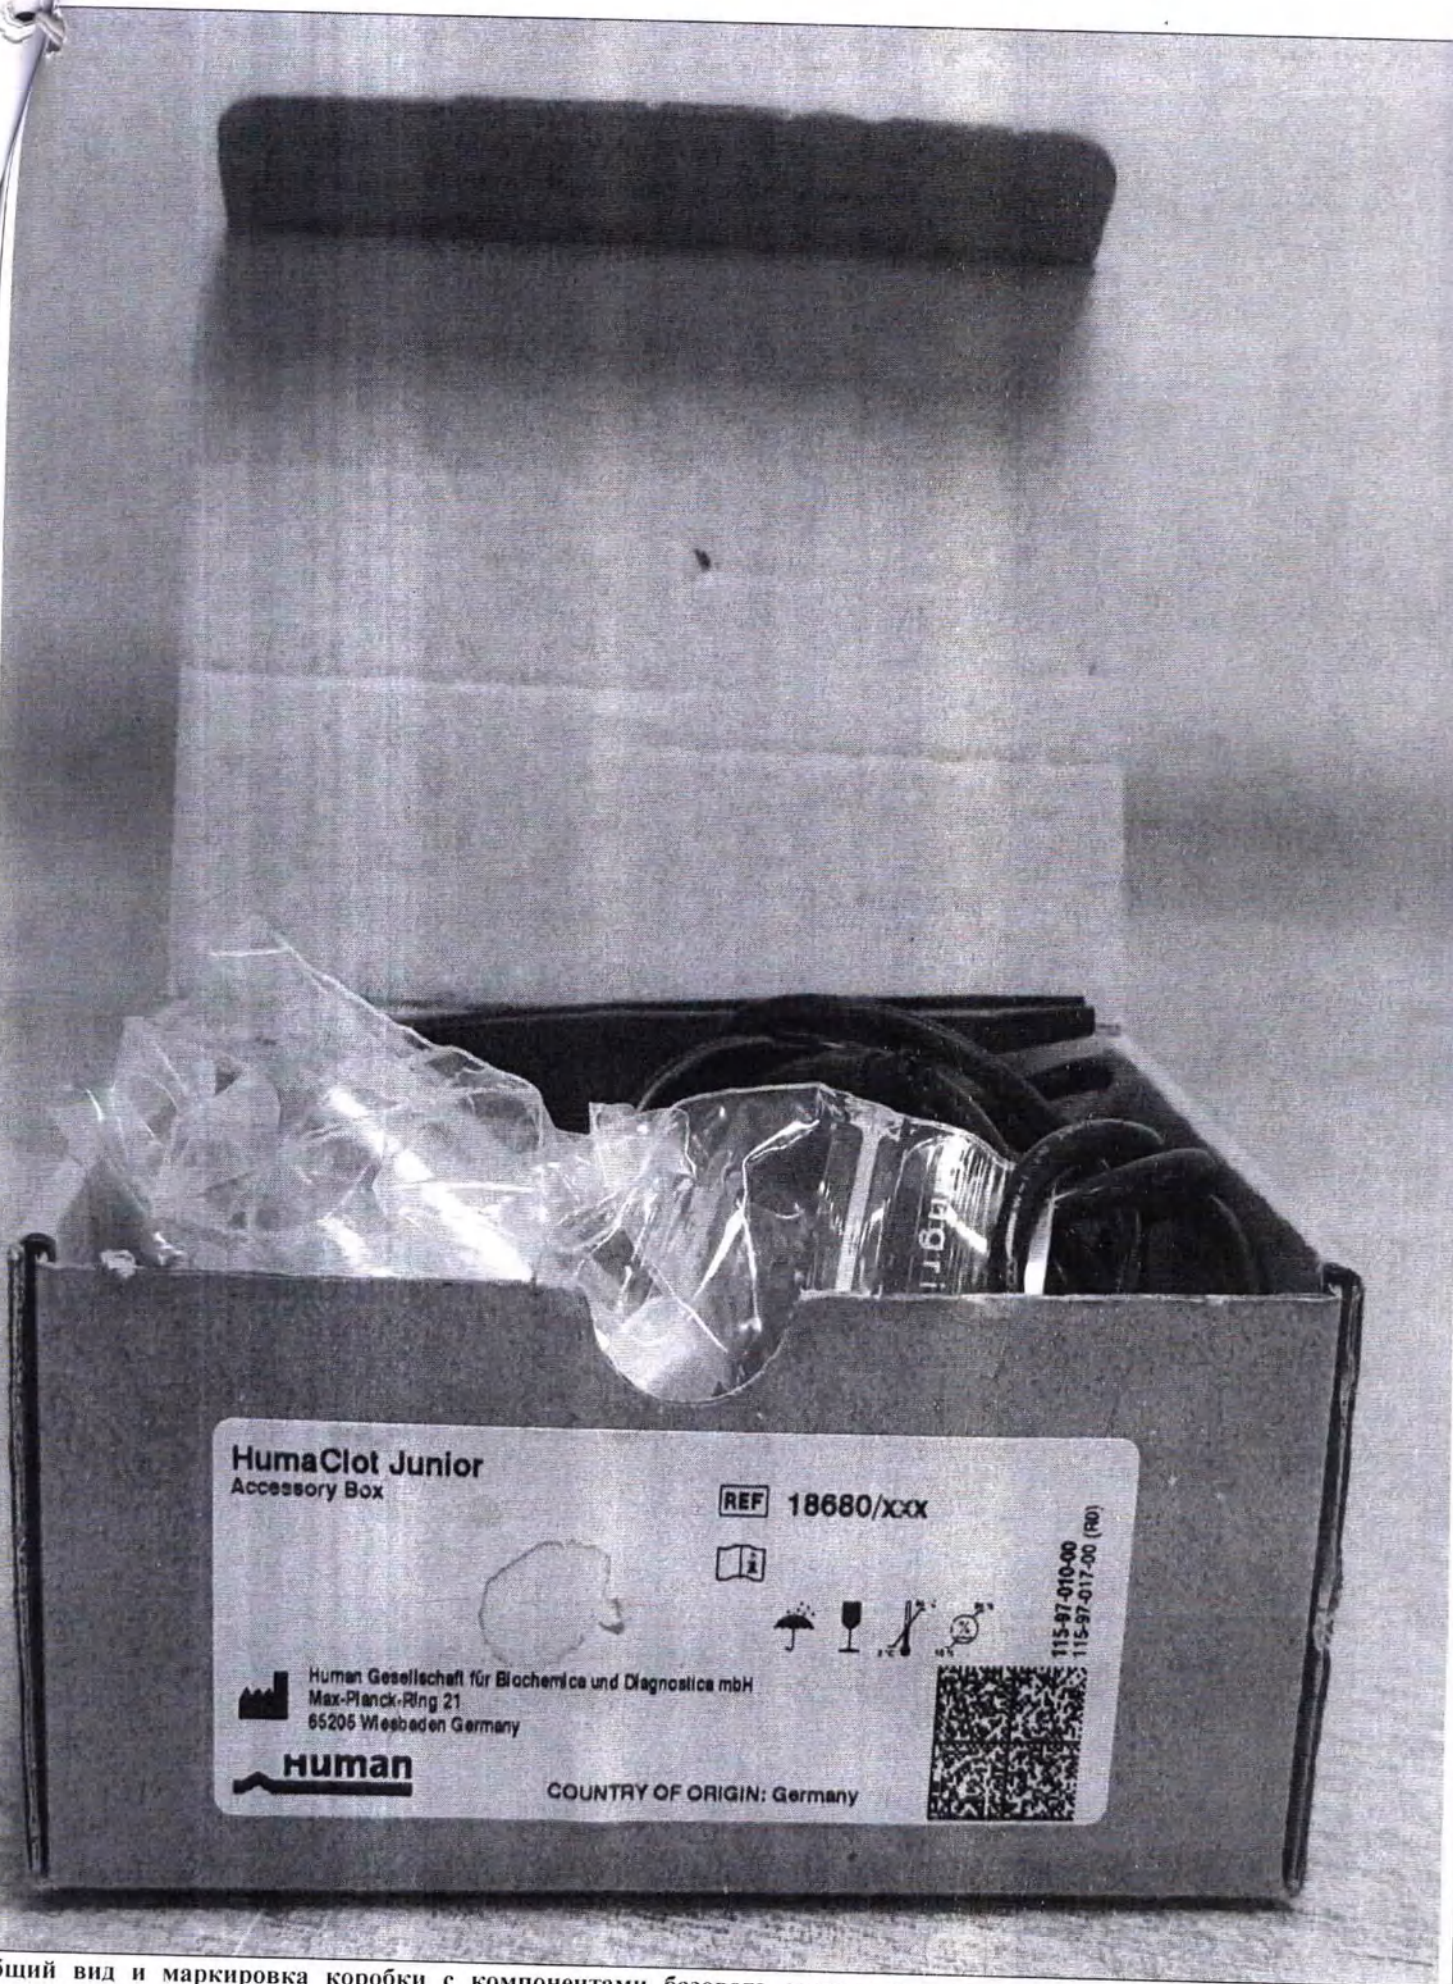

HumaClot Junior
Accessory Box

REF 18680/xxx



Human Gesellschaft für Biochemie und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden Germany


human

COUNTRY OF ORIGIN: Germany



115-97-010-00
115-97-017-00 (RU)

Общий вид и маркировка коробки с компонентами базового состава для анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

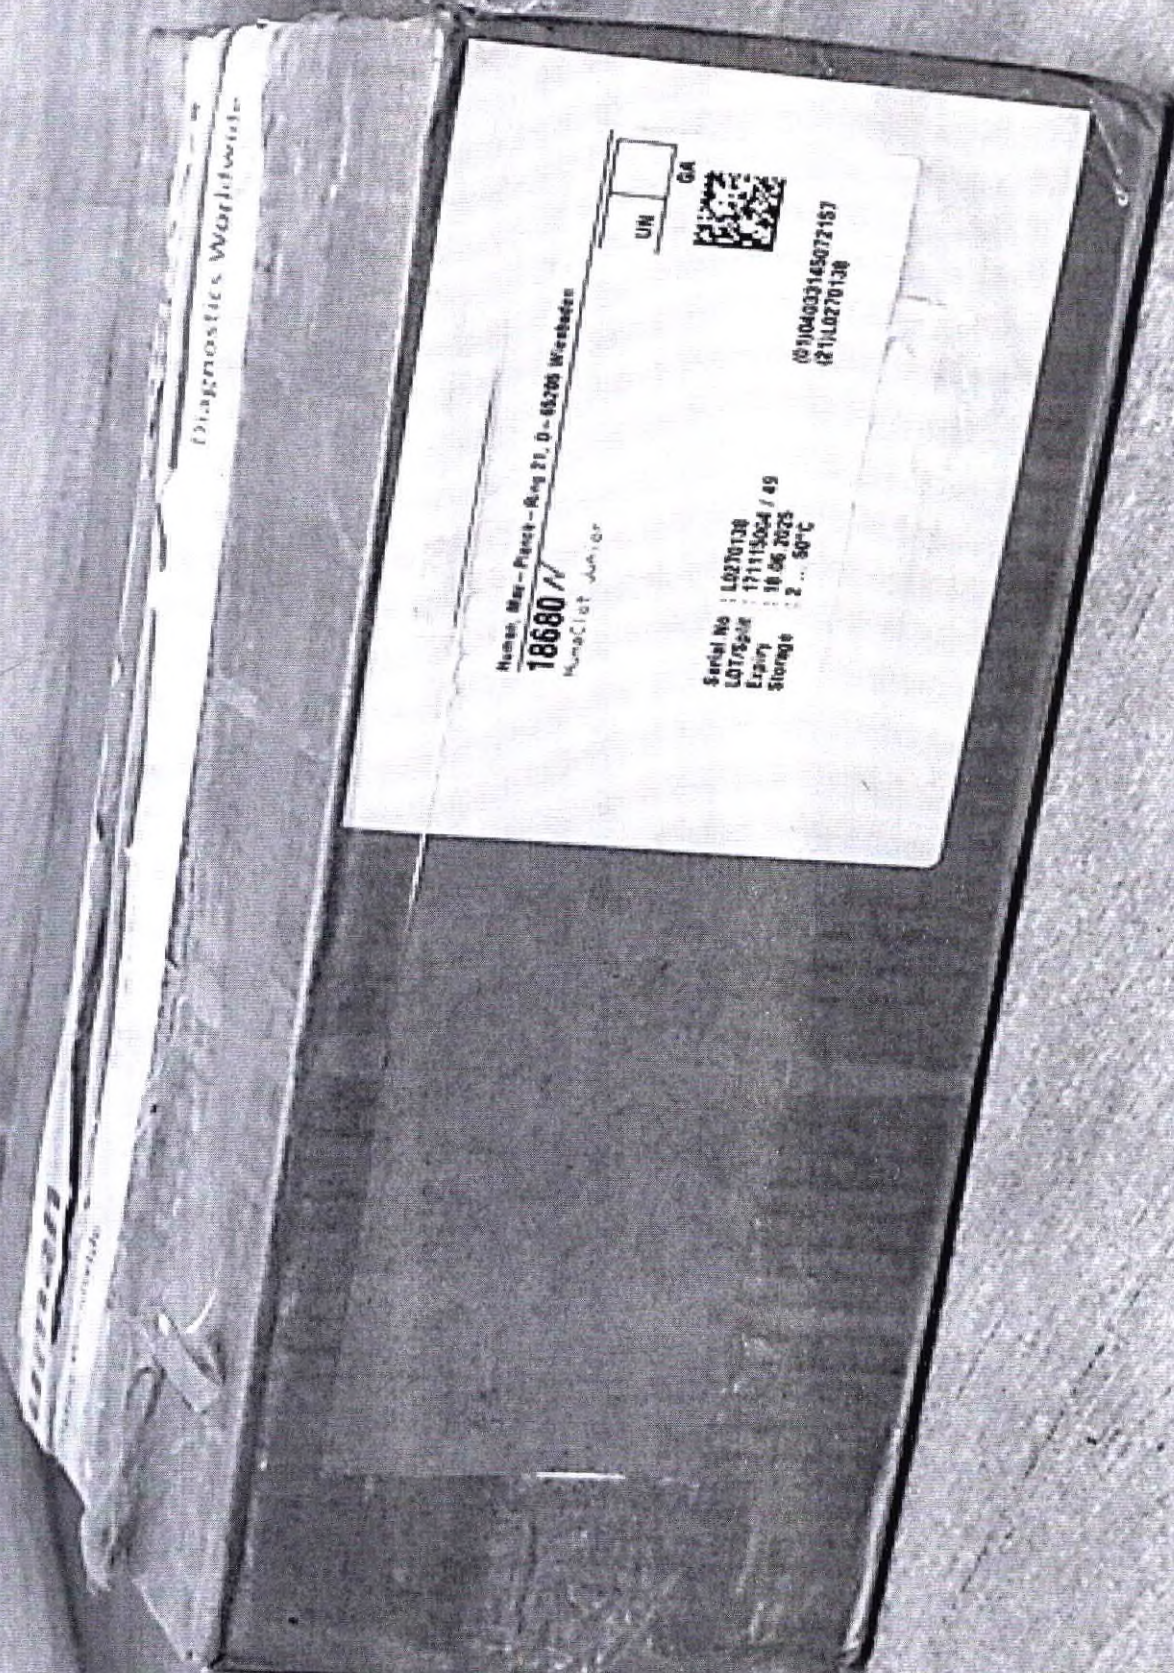

Маркировка упаковочной коробки анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

Huшал, Max-Planck-Ring 21, D-65205 Wiesbaden

18680

HumaClot Junior

Serial.No : L0270138
LOT/Split : 171115004 / 49
Expiry : 18.06.2025
Storage : 2 ... 50°C

(01)04033145072157
(21)L0270138



Маркировка упаковочной коробки анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

HumaClot Junior

Compact 1-Channel Coagulation Instrument

100-240VAC, 50-60Hz, 12VA

Weight: 1.3 Kg

Size: 33 x 21 x 13 cm

SN L0270138



Huma Coagulation Kit Blood Analysis and Diagnostics mH1
1st Floor, Plot 23
675006 Hyderabad, Germany

huma

REF

18680

COUNTRY OF ORIGIN: Germany

118-99-040-00



118-88-080-00 (R1)





Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus для лабораторных исследований in vitro



Huma GmbH
Max-Planck-Platz 31
65309 Wiesbaden Germany

Huma

Type: HumaClot Duo Plus

REF 15650

SN K 24 7 0071

Input: 24V  3,5A

Made in Germany




CE

IVD



116-64-027-00 (R3) 116-01-020-00

Шильдик анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus для лабораторных исследований in vitro

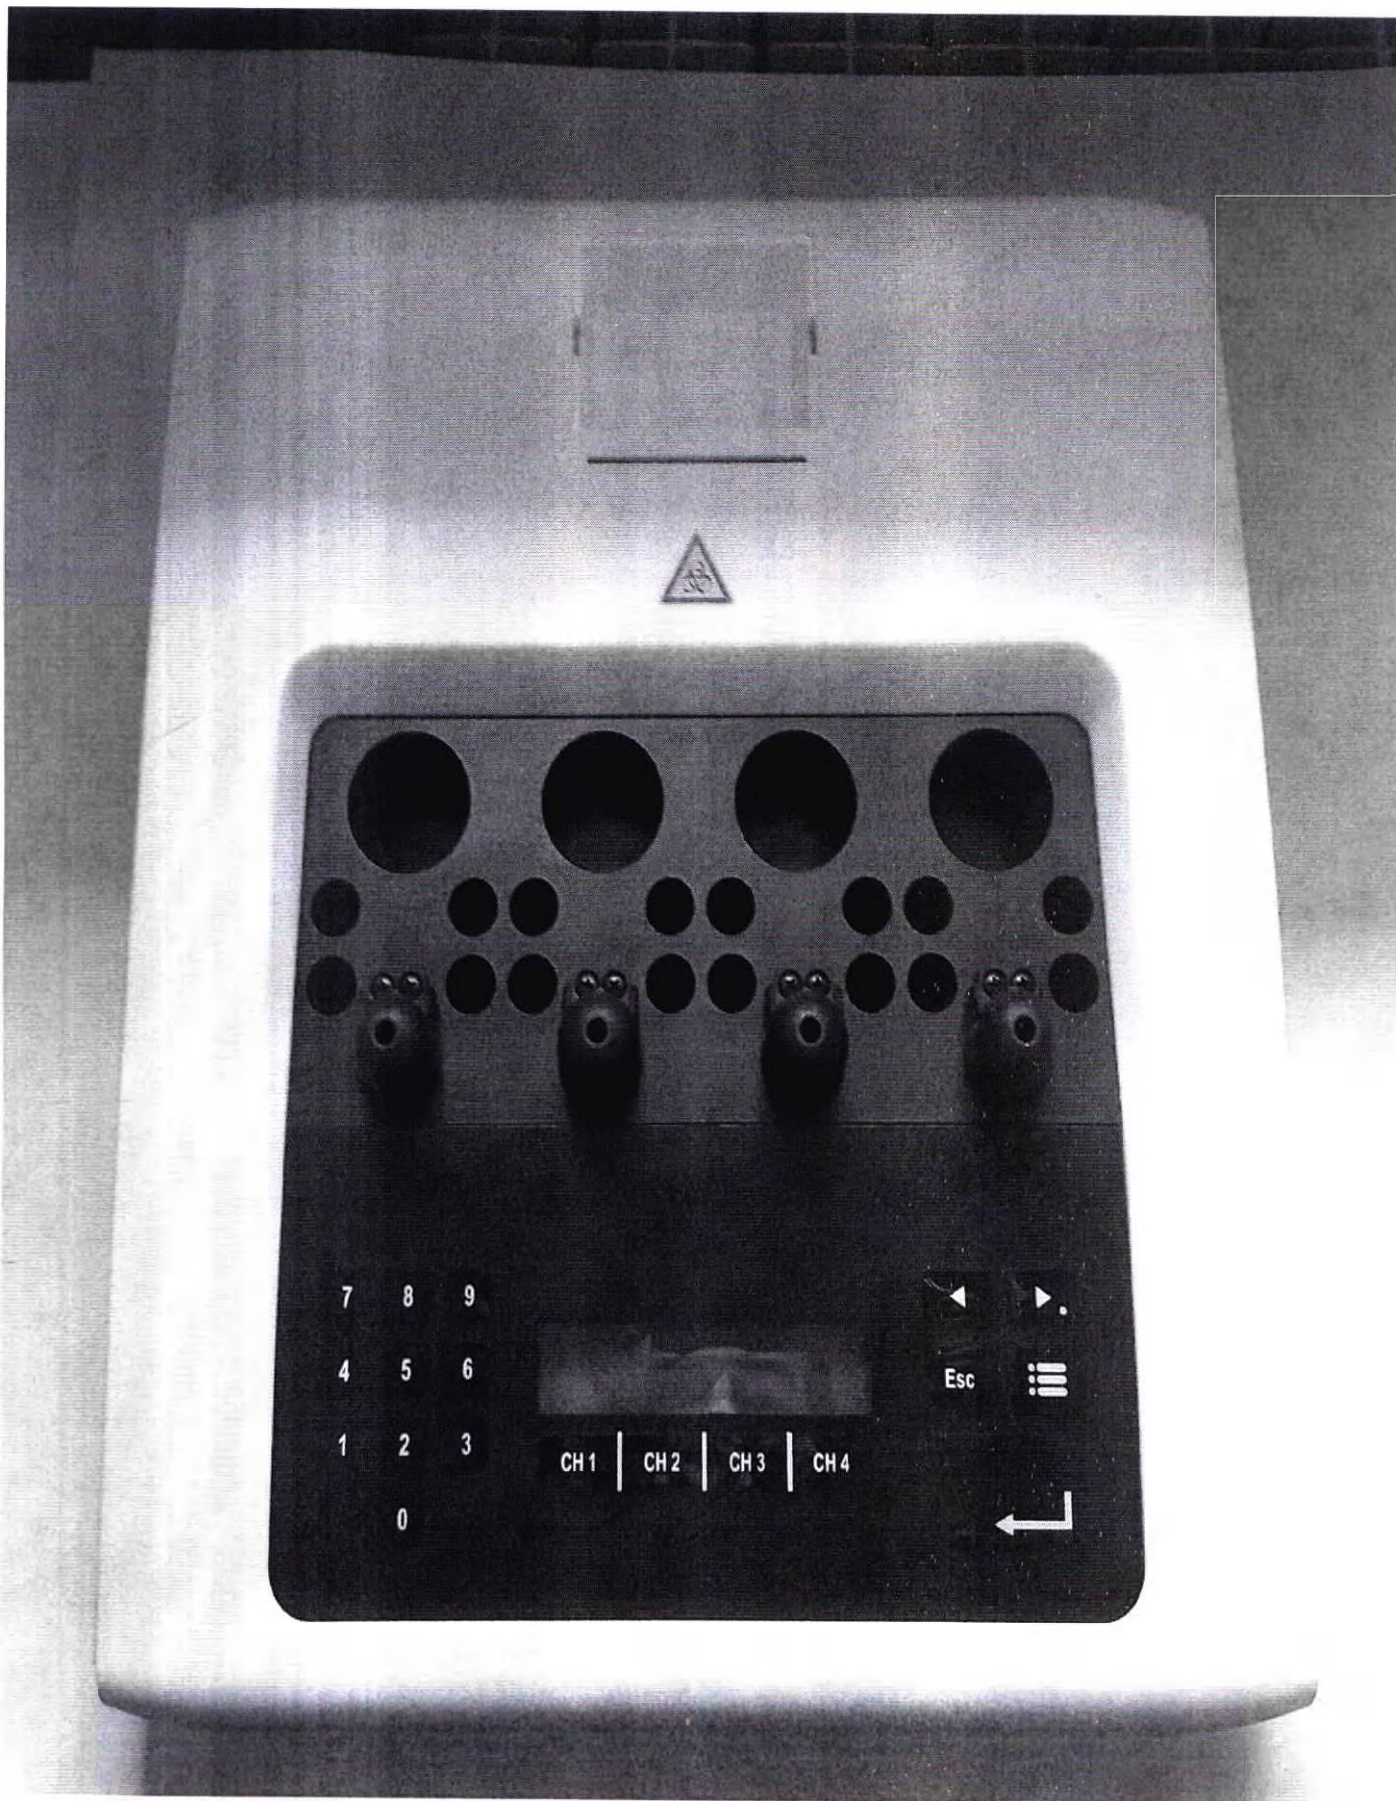

Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Quattro для лабораторных исследований *in vitro*

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden Germany

Human

Type: HumaClot Quattro

REF 15660

SN H 28 7 0041

Input: 24V  $\Rightarrow$ 3,5AT

Made in Germany




IVD



24116010403021H2870041

116-84-047-00 (R3) 116-01-040-00

Шильдик анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro

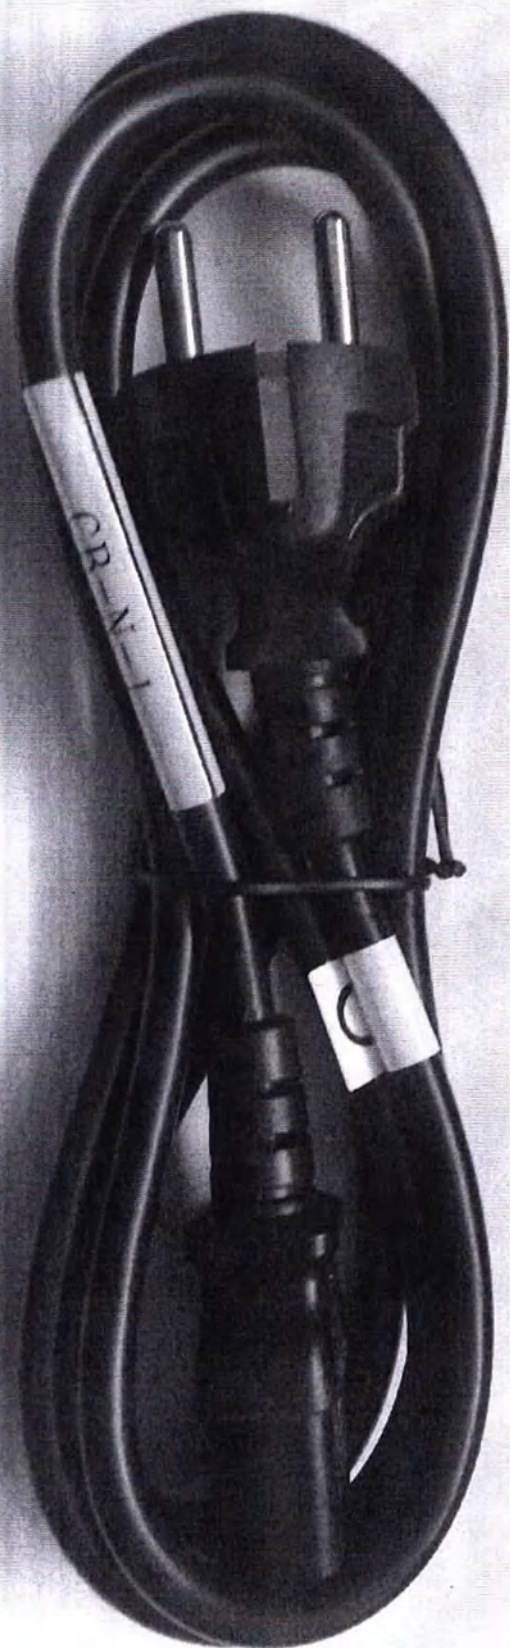

Кабель питания для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro

EDAC POWER ELEC.

Medical AC Adapter

Model: EM10951E

P/N: NITP-1024S-DZN01

Input: 100-240Vac, 2.5-1.0A, 50-60Hz

Output: 24V $\equiv$ 3.75A

DATE CODE:

	18	19				2	3	4	5
	2	3	4	5	6	7	8	9	0



RoHS


S/N: 000157

MADE IN CHINA


Manufacturer: www.edac.com.tw 1312610950002 C3

4374


Маркировка, наносимая на адаптер сетевой, предназначенный для обеспечения электропитания для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro

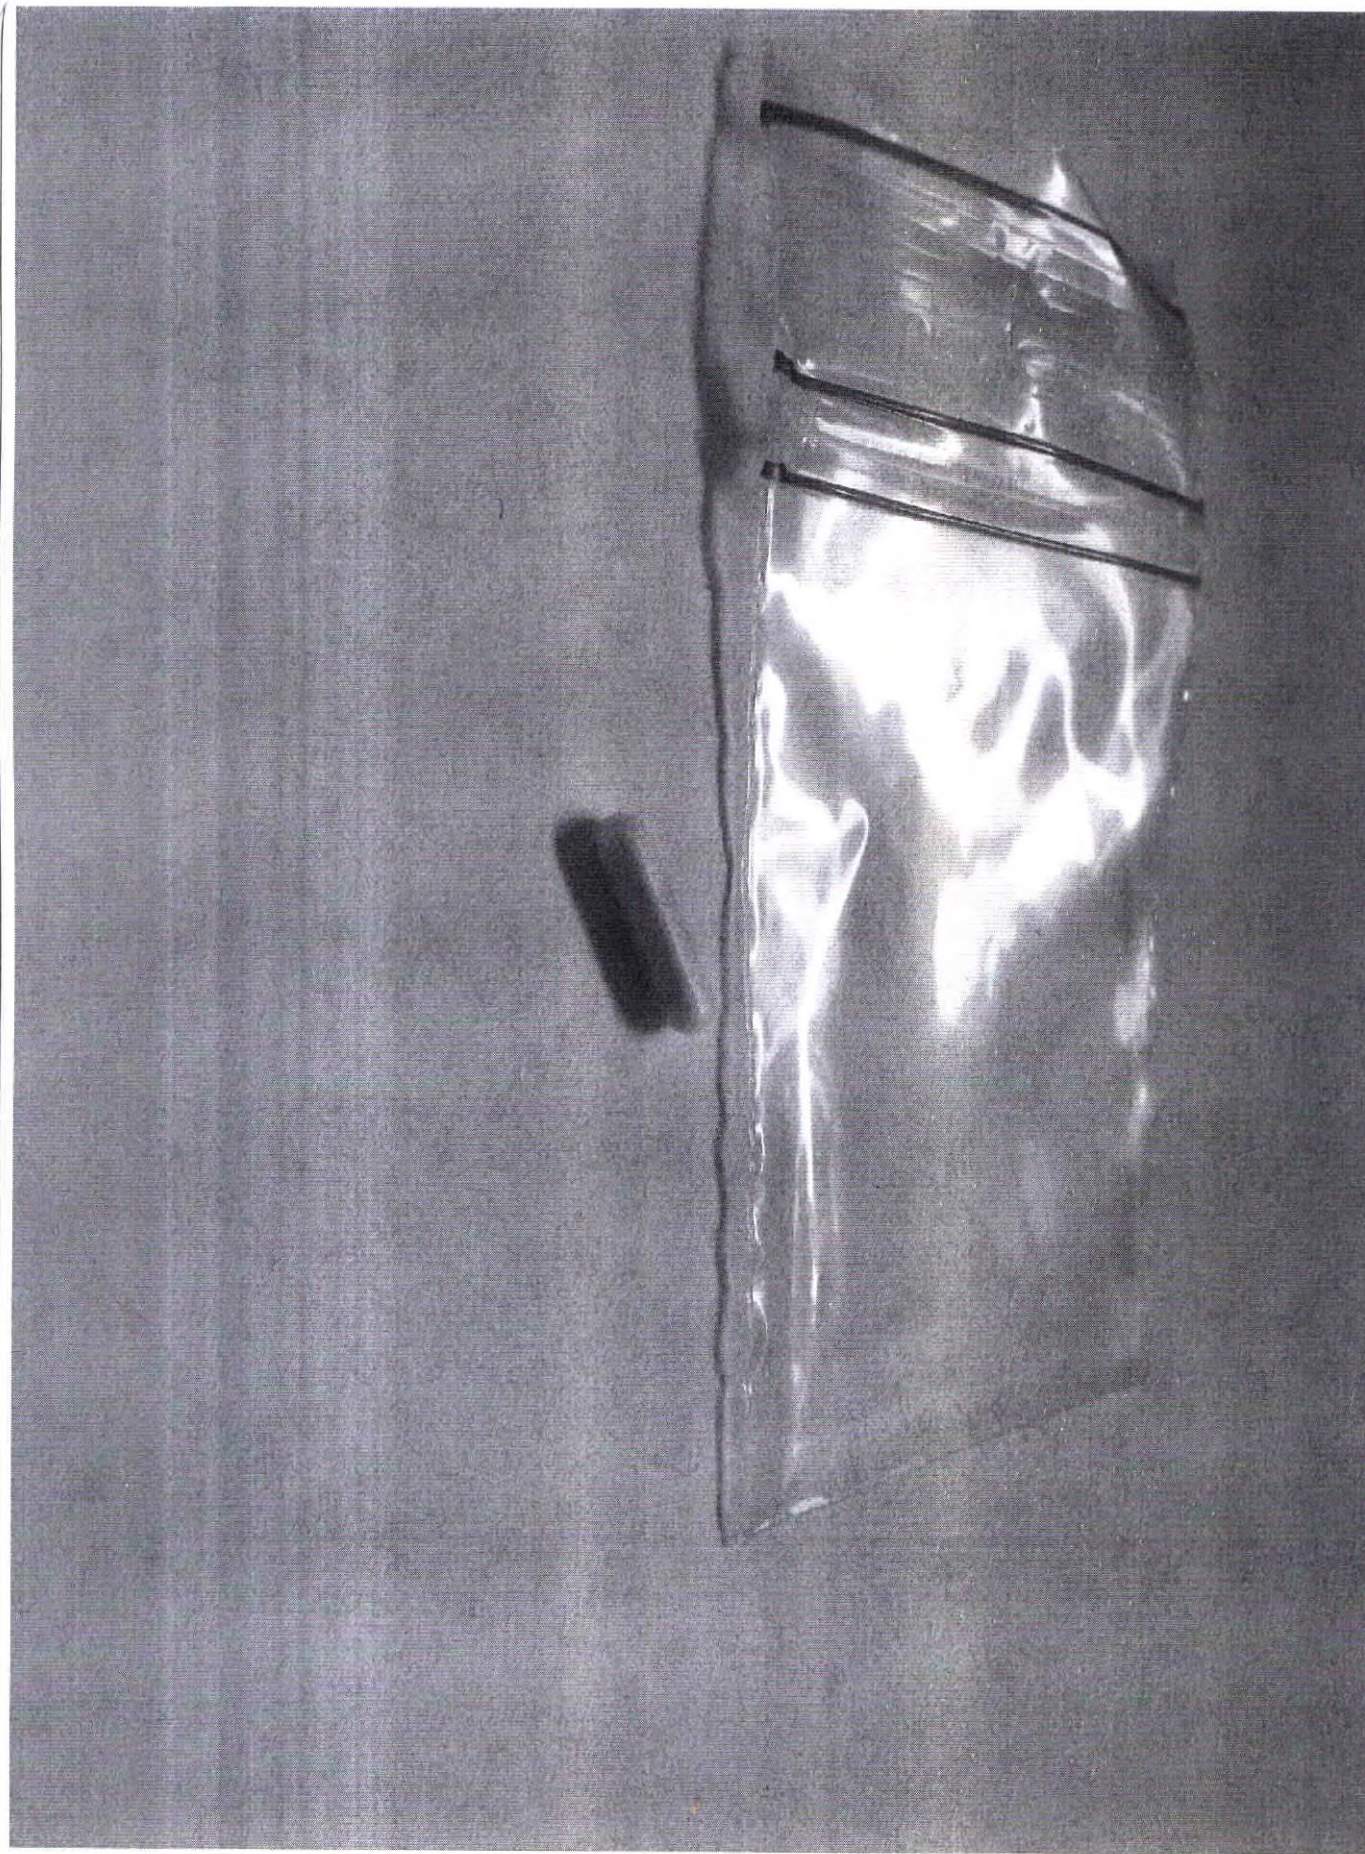


Стержень для магнитной мешалки для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro

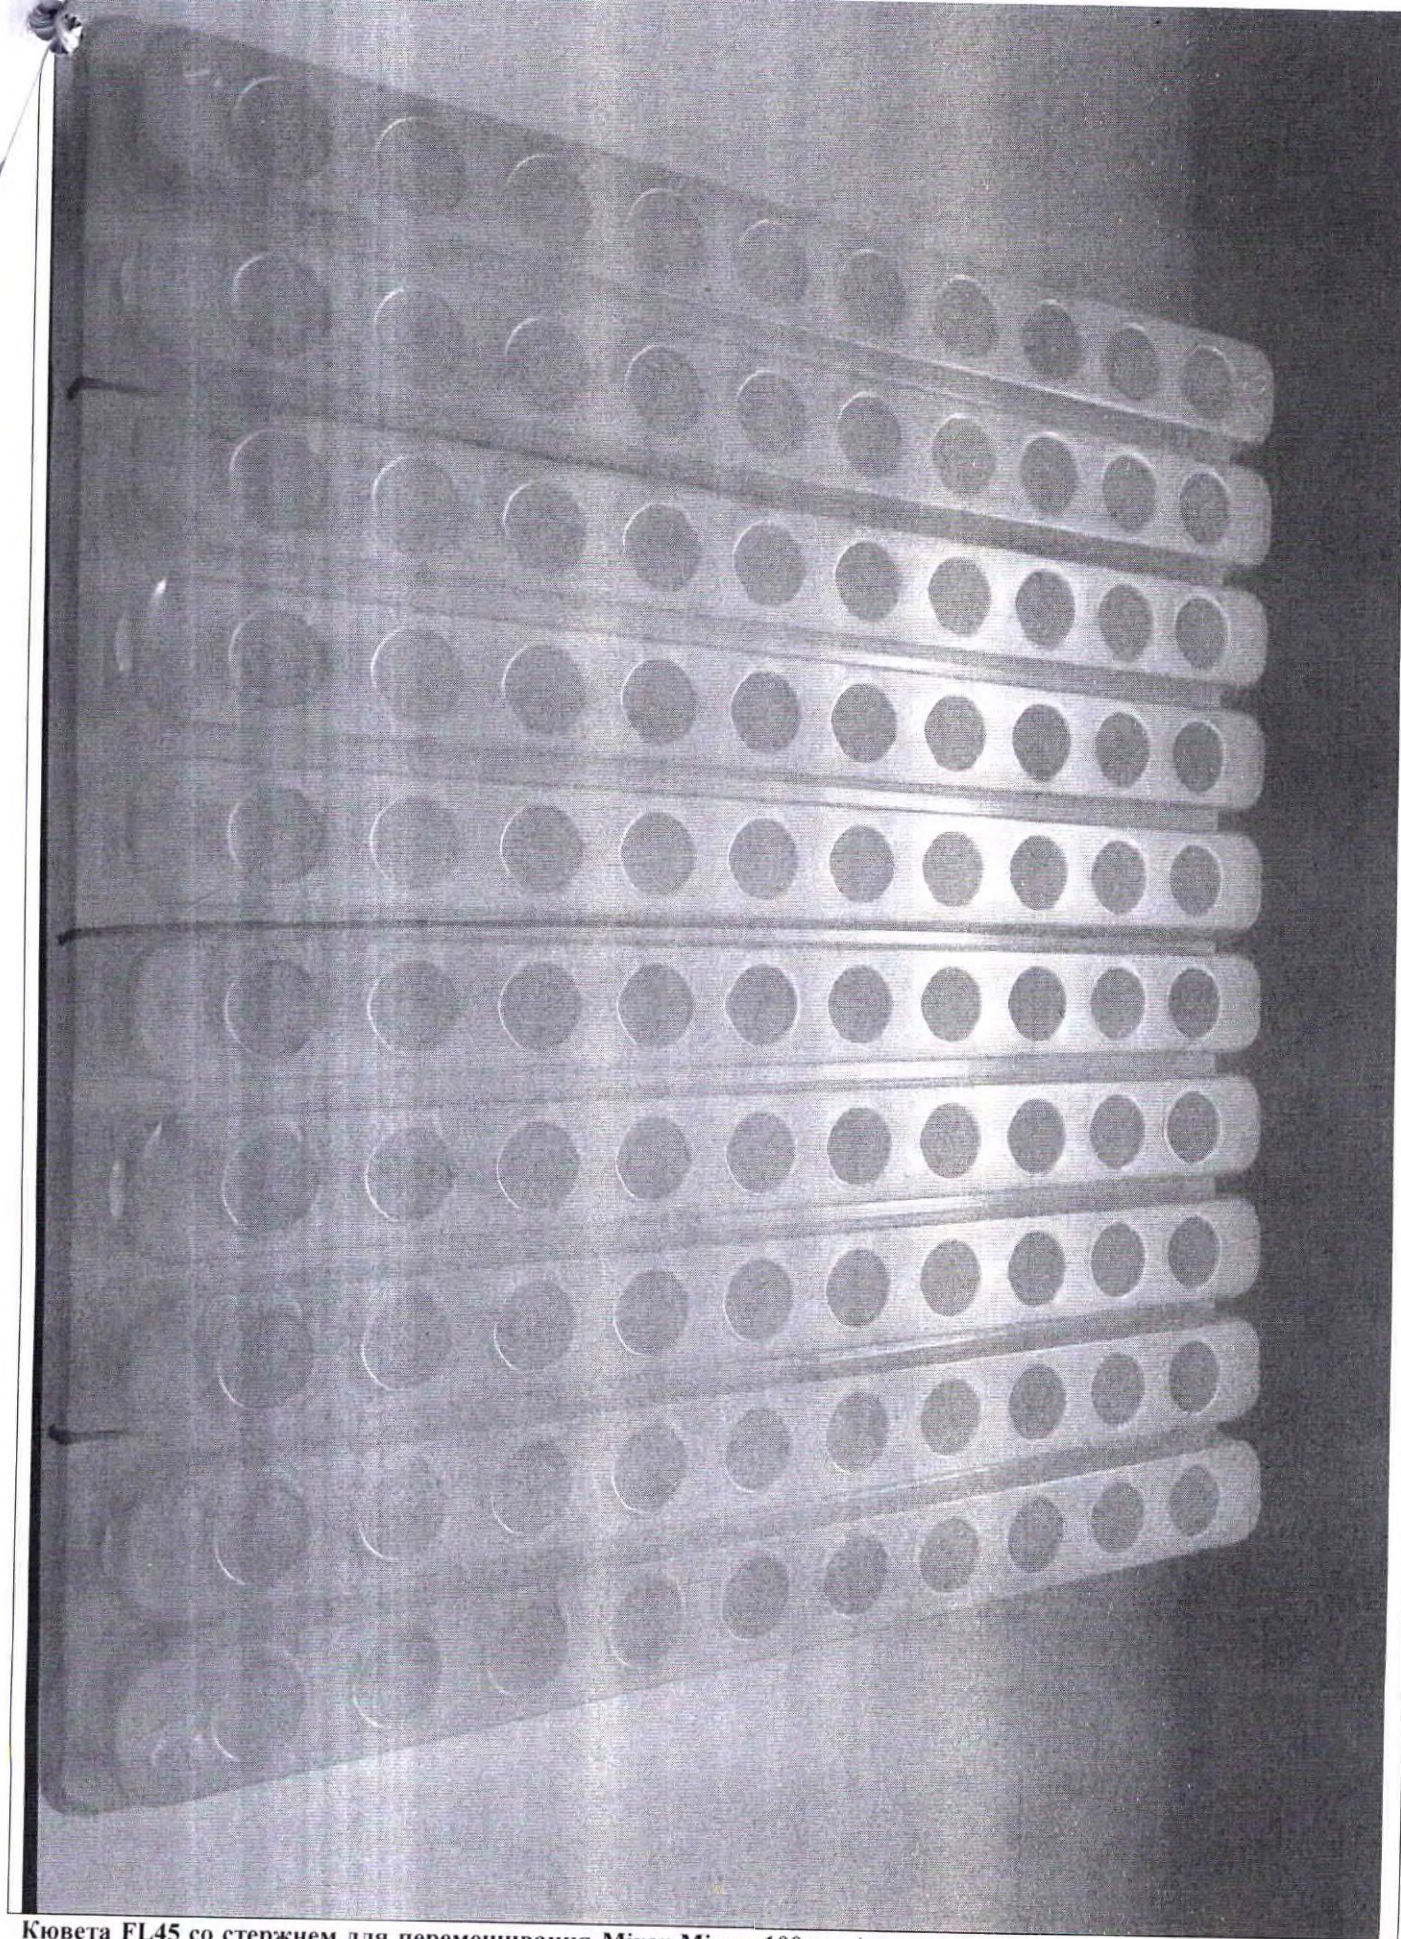

Кювета FL45 со стержнем для перемешивания Mixer Micro, 100 шт./упак. для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований *in vitro*

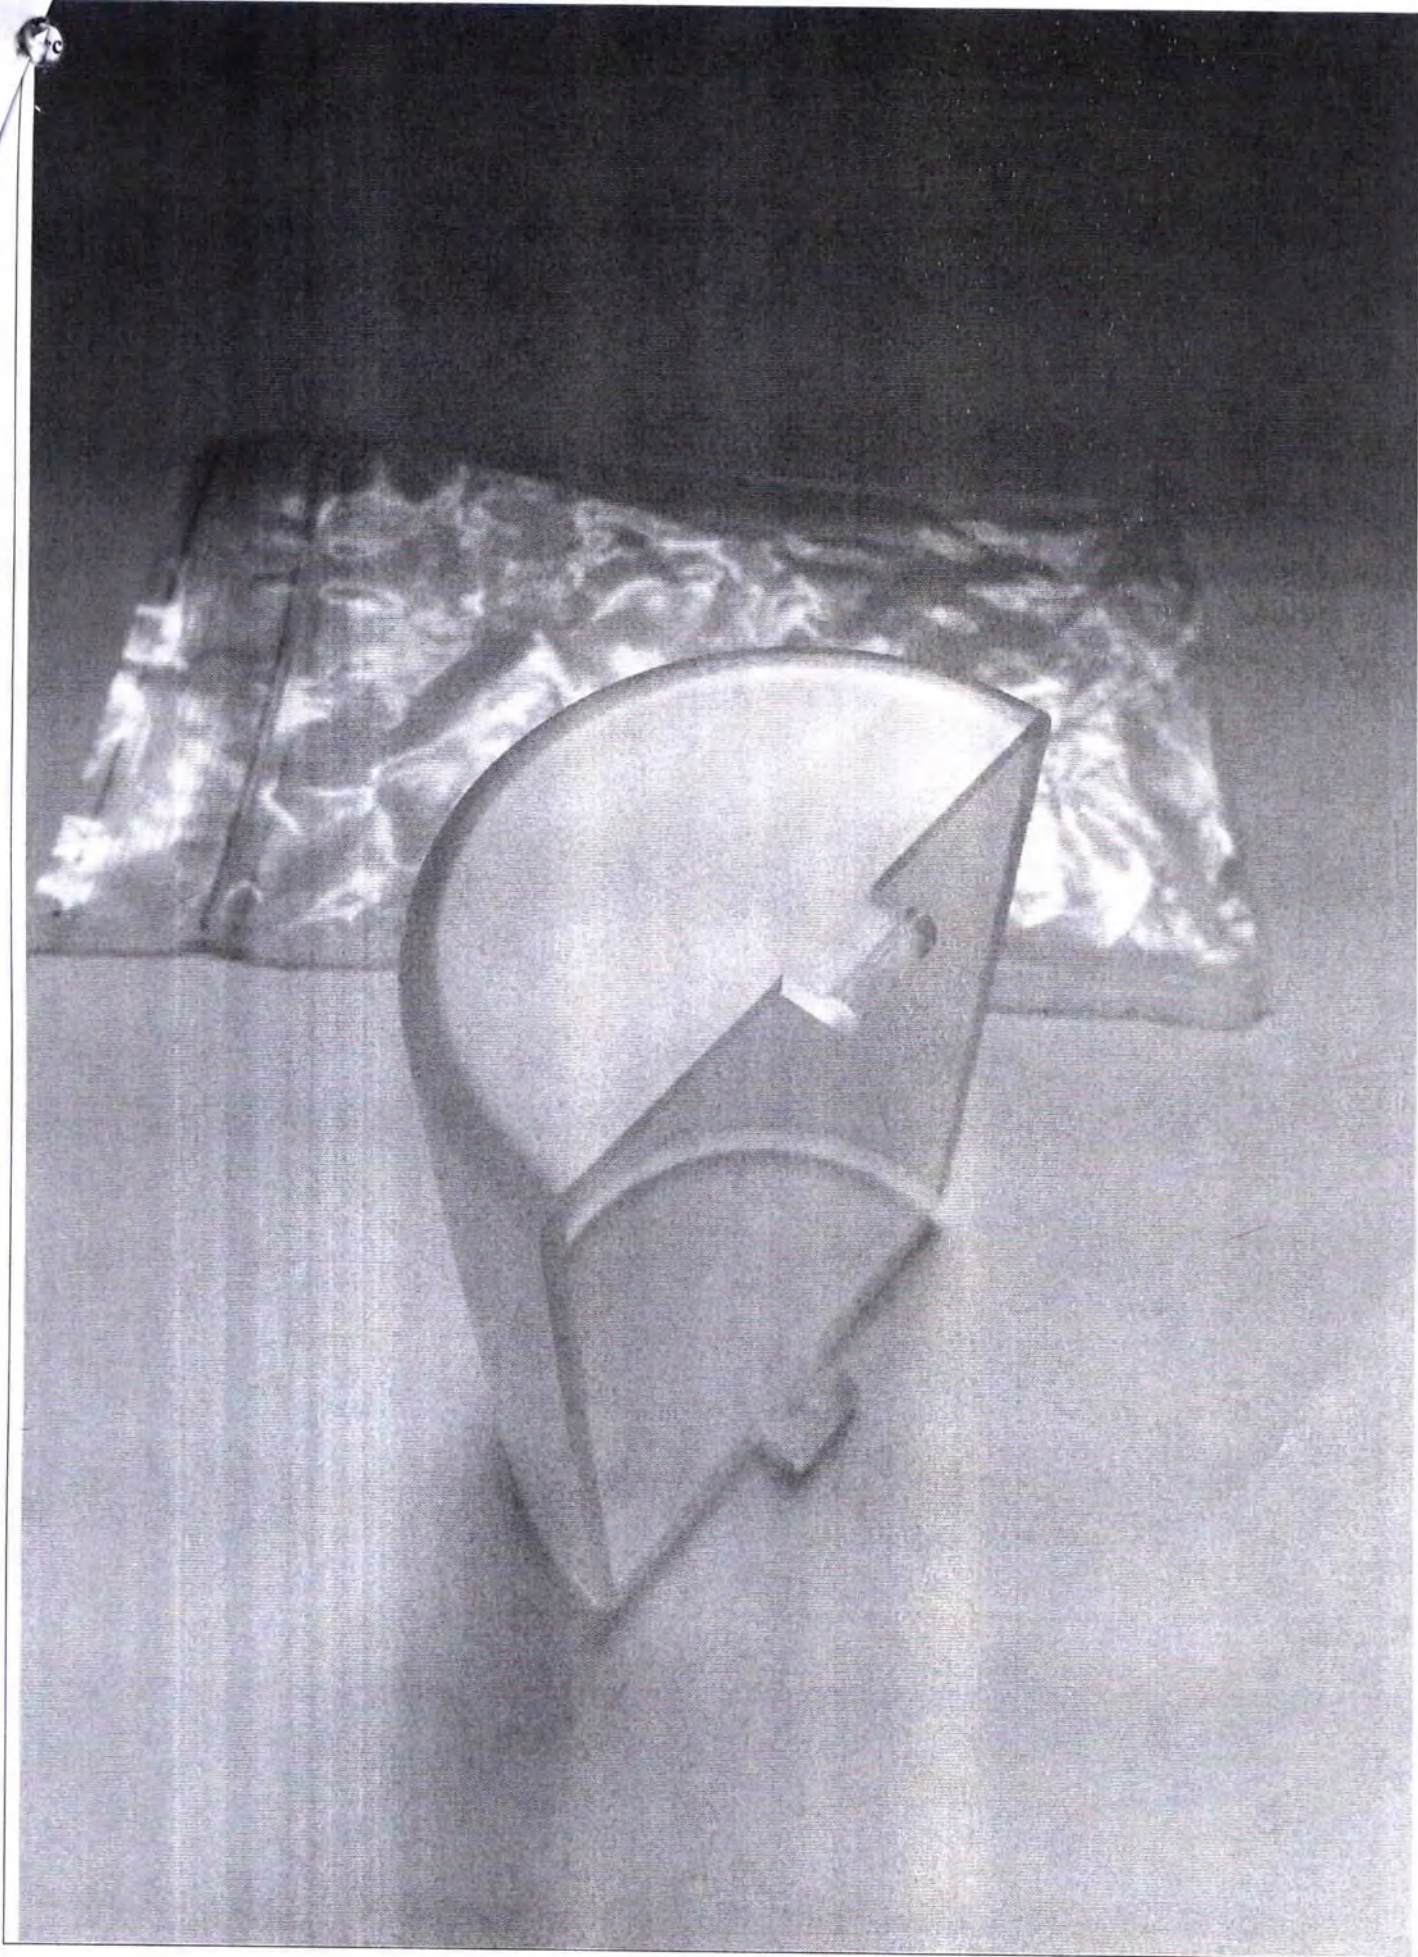

Крышка для встроенного принтера для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований *in vitro*

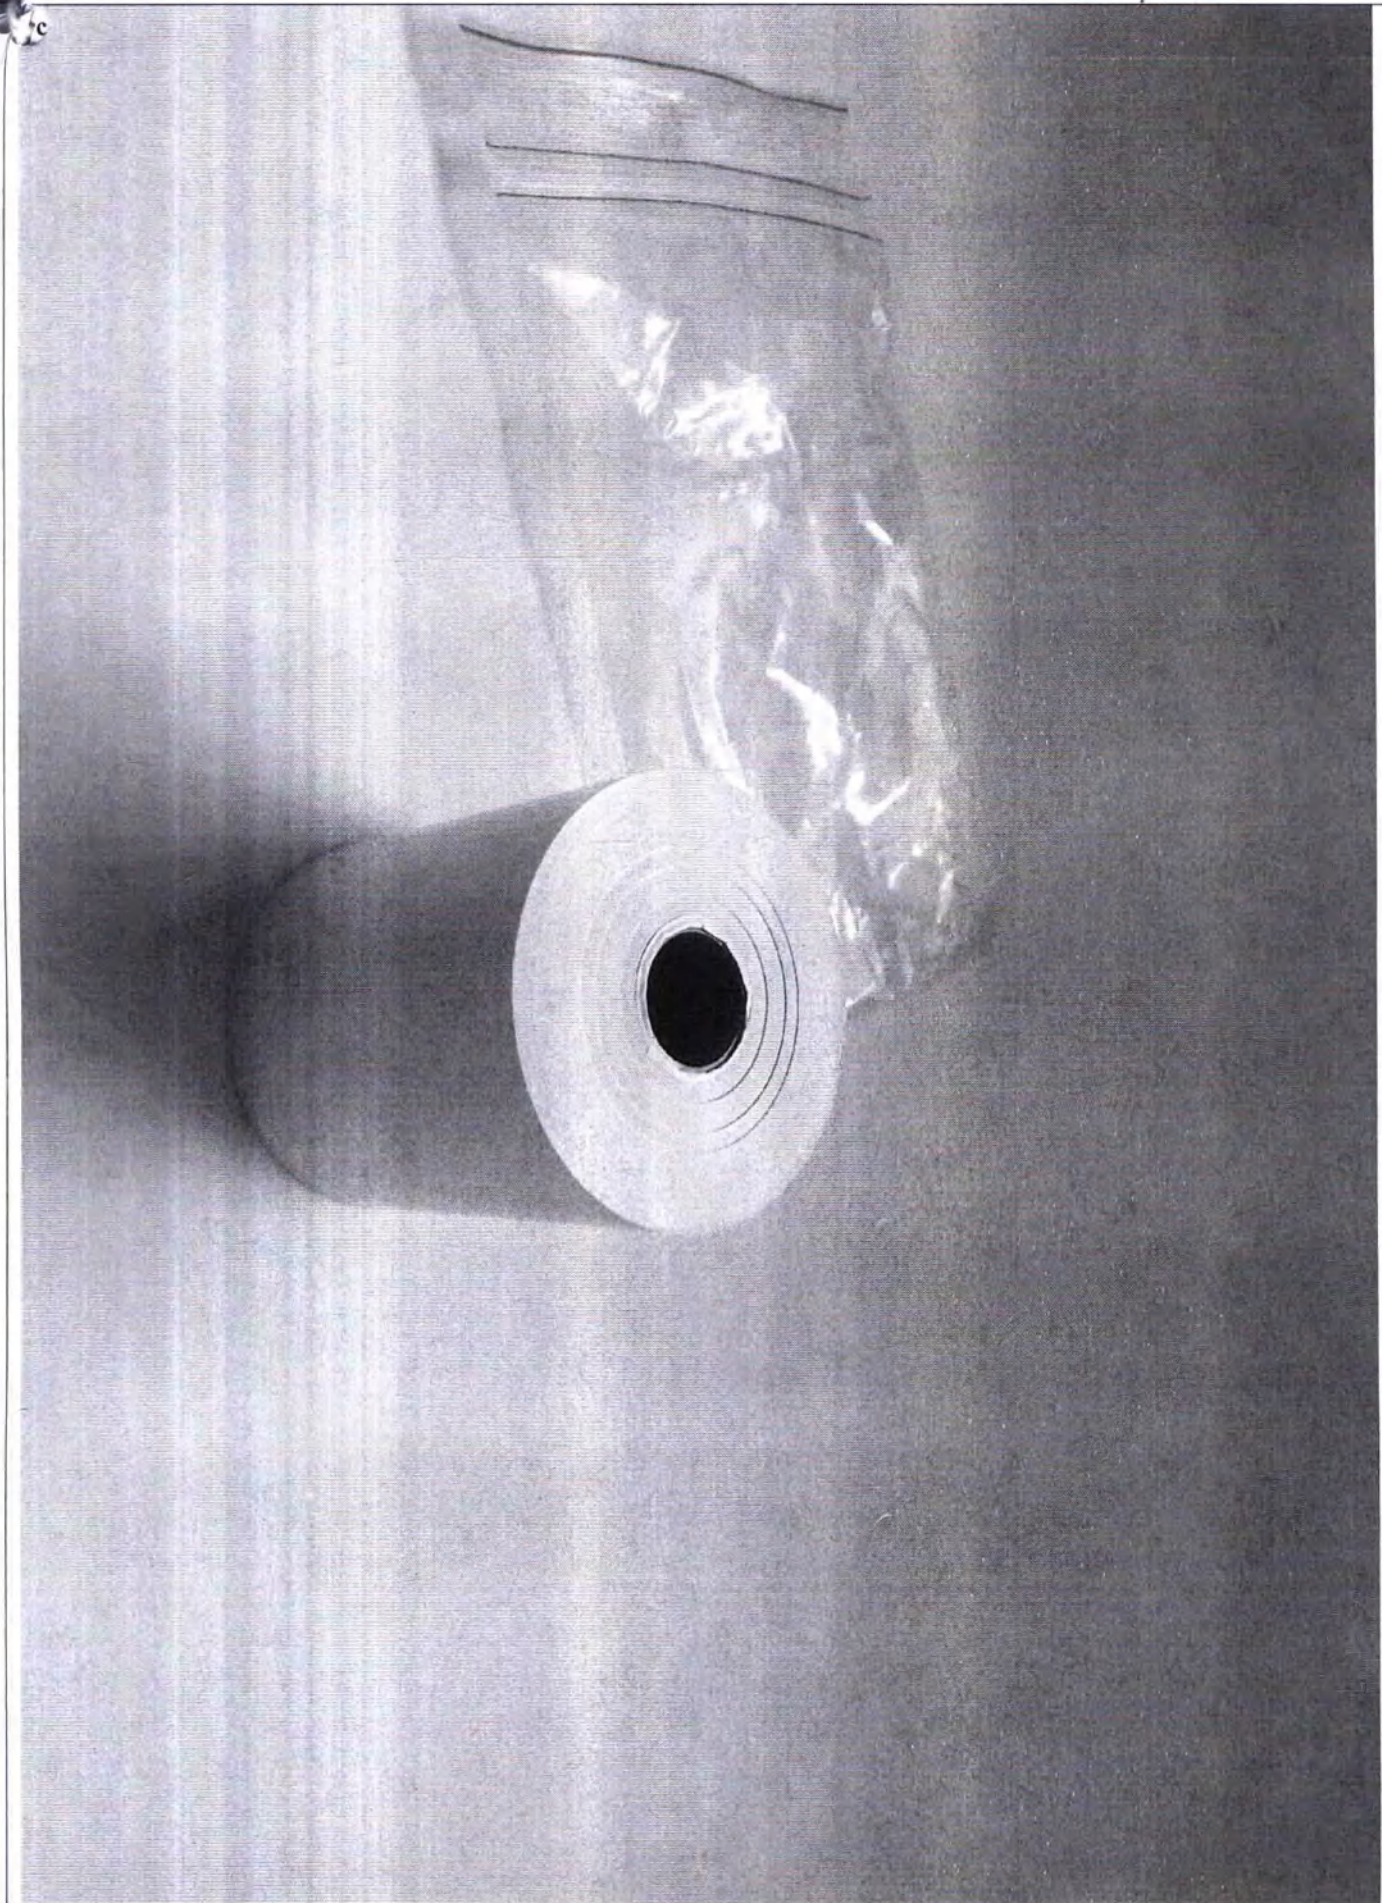

Термобумага для принтера, 1 рулон для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro




Адаптеры кольцевые для реагентов, 2 шт., для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro

Руководство пользователя

Анализатор полуавтоматический для исследования
параметров плазменного гемостаза HumaClot для
лабораторных исследований *in vitro*

Руководство пользователя для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований *in vitro*

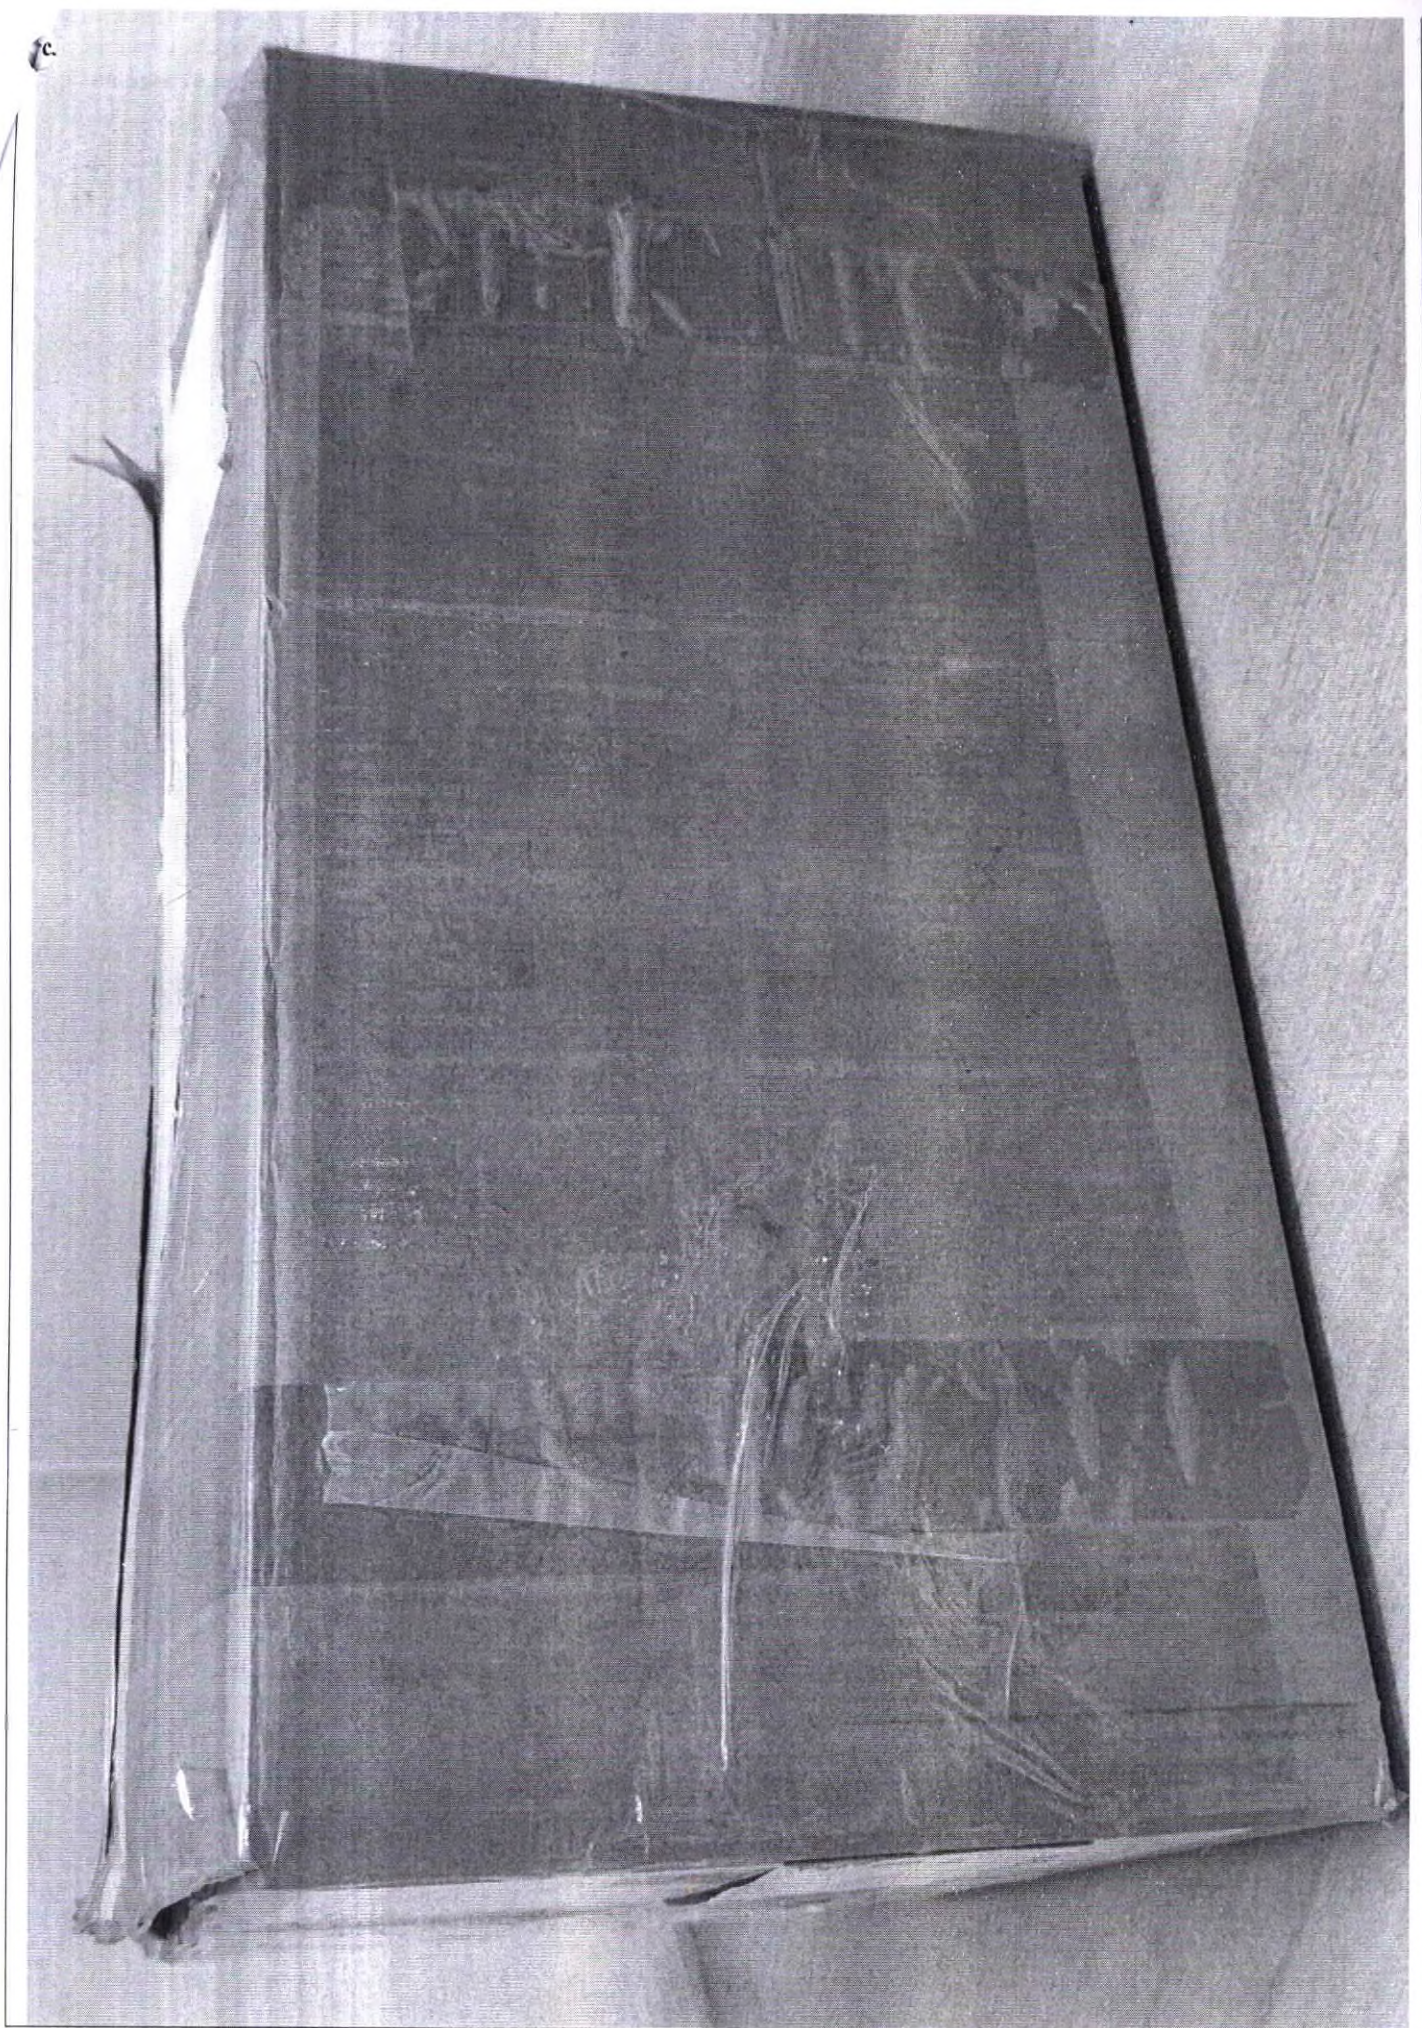

Внешний вид упаковочной коробки для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro

данный вид и маркировка коробки с компонентами базового состава для анализаторов полуавтоматических для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus, HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro



HumaClot Duo Plus / Quattro
Accessory Box

REF 15650/xxx

116-97-020-00 (NO)
116-97-027-00 (NO)

Human Gesellschaft für Biochemie und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden Germany

human

COUNTRY OF ORIGIN: Germany

Маркировка упаковочной коробки анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus для лабораторных исследований in vitro

HumaClot Duo Plus

Compact 2-Channel Coagulation Instrument

100-240VAC, 50-60Hz, 90VA

Weight: 6,1 Kg


Size: 59 x 40 x 11 cm

REF

15650 N

116-89-020-00

COUNTRY OF ORIGIN: Germany




116-88-020-00 (R1)

SN K2470071



Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden Germany

Human

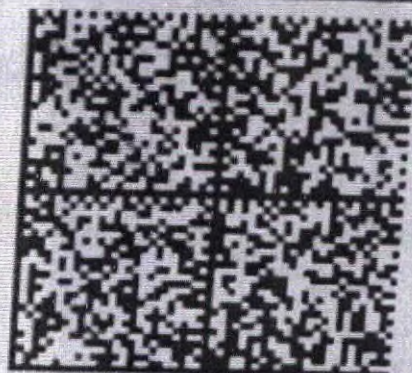

Human, Max – Planck – Ring 21, D – 65205 Wiesbaden

15650 N

HumaClot DUO Plus

UN

GA



Serial.No : K2470071
LOT/Split : 171111063 / 10
Expiry : 20.09.2027
Storage : 2 ... 50°C

(01)04033145118589
(21)K2470071

Маркировка упаковочной коробки анализатора полуавтоматического для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro

HumaClot Quattro

Compact 4-Channel Coagulation Instrument

100-240VAC, 50-60Hz, 90VA

REF


15660

116-99-040-00

COUNTRY OF ORIGIN: Germany

Weight: 6,2 Kg

Size: 59 x 40 x 26 cm



116-99-060-00 (R1)

SN

H2870041



Human Gesellschaft für Biochemie und Diagnostik mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden, Germany

Human



Human, Max-Planck-Ring 21, D-65205 Wiesbaden

15660

HumaClot Quattro

UN

GA



Serial.No : H2870041
LOT/Split : 170905013 / 10
Expiry : 03.09.2027
Storage : 2 ... 50°C

(01)04033145183860
(21)H2870041

Всего пронумеровано,
прешнуровано и скреплено
печатью 33 листов.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБАЕВ С.А.

Проект маркировки на медицинское изделие

**Анализатор полуавтоматический для исследования параметров
плазменного гемостаза HumaClot
для лабораторных исследований in vitro**

Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для лабораторных исследований in vitro, вариант исполнения:

Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Junior для лабораторных исследований in vitro

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

Серийный номер _____

Кат. номер 18680

Дата производства _____

Гожен до _____

Температура хранения и транспортировки: от +2°C до +50°C.

Условия эксплуатации: Внутри помещений, в сухом, хорошо вентилируемом месте, на высоте не более 4000 метров над уровнем моря; Температура от +10°C до +30°C;



Входное напряжение: 12 В

Сила тока: 1.0 А

Потребляемая мощность: 12 ВА

Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для лабораторных исследований in vitro, вариант исполнения:

Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Quattro для лабораторных исследований in vitro

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

Серийный номер _____

Кат. номер 15660

Дата производства _____

Гожен до _____

Температура хранения и транспортировки: от +2°C до +50°C.

Условия эксплуатации: Внутри помещений, в сухом, хорошо вентилируемом месте, на высоте не более 4000 метров над уровнем моря; Температура от +10°C до +30°C;



Входное напряжение: 24 В

Сила тока: 3.75 А

Потребляемая мощность: ≤ 90 ВА

Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot для лабораторных исследований in vitro, вариант исполнения:

Анализатор полуавтоматический для исследования параметров плазменного гемостаза HumaClot Duo Plus для лабораторных исследований in vitro

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Для лабораторной диагностики in vitro

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

Серийный номер _____

Кат. номер 15650

Дата производства _____

Гожен до _____

Температура хранения и транспортировки: от +2°C до +50°C.

Условия эксплуатации: Внутри помещений, в сухом, хорошо вентилируемом месте, на высоте не более 4000 метров над уровнем моря; Температура от +10°C до +30°C;



Входное напряжение: 24 В

Сила тока: 3.75 А

Потребляемая мощность: ≤ 90 ВА

Всего пронумеровано,
прошито, склеено
печатью 2 листов.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБАЕВ С.А.