

Фотографии медицинского изделия:

«Комплекс длительного дистанционного мониторинга ЭКГ "Кардисенс" по ТУ 26.6012-001-02078265-2018»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСОНАЛЬНАЯ МЕДДИАГНОСТИКА» (ООО «ПЕРСОНАЛЬНАЯ МЕДДИАГНОСТИКА») 119285, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Минская, д.1Г, к.2, этаж/помещение. 2/II, ком. 17

Список фото:

Рисунок 1.

Регистратор «Кардисенс-1».

Рисунок 2.

Регистратор «Кардисенс-2».

Рисунок 3.

Внутренние (сменные) источники питания.

Рисунок 4.

Зарядное устройство для внутренних (сменных) источников питания.

Рисунок 5.

Адаптер питания для зарядного устройства ROBITON USB1000

Рисунок 6.

Кабель адаптера питания ROBITON P2 USB-microUSB

Рисунок 7.

USB-флеш-накопитель с программным обеспечением «Vitarrio Holter» для работы на смартфоне

Рисунок 8.

USB-флеш-накопитель с программным обеспечением автоматизированного рабочего места (АРМ) врача «Safe Heart System 24h» и руководство пользователя

Рисунок 9.

USB-флеш-накопитель с программным обеспечением автоматизированного рабочего места (АРМ) врача «СОЮЗ-Диагностика» и руководство пользователя

Рисунок 10.

USB-флеш-накопитель с программным обеспечением «Vitarrio Health»

Рисунок 11.

USB-флеш-накопитель с программным ключом защиты программного обеспечения «Safe Heart System 24h»

Рисунок 12.

USB-флеш-накопитель с программным ключом защиты программного обеспечения «СОЮЗ-Диагностика»

Рисунок 13.

Руководство по эксплуатации.

Рисунок 14.

Этикетка.

Рисунок 15.

Одноразовые электроды ЭКГ Skintact FS-521, ФСЗ 2011/09805.

Рисунок 16.

Одноразовые электроды ЭКГ Ambu A/C, ФСЗ 2008/02776.

Рисунок 17.

Одноразовые электроды ЭКГ Skintact T-VO01, ФСЗ 2011/09805.

ок 18.
образовые электроды ЭКГ Skintact W-601, ФСЗ 2011/09805



Рисунок 1.

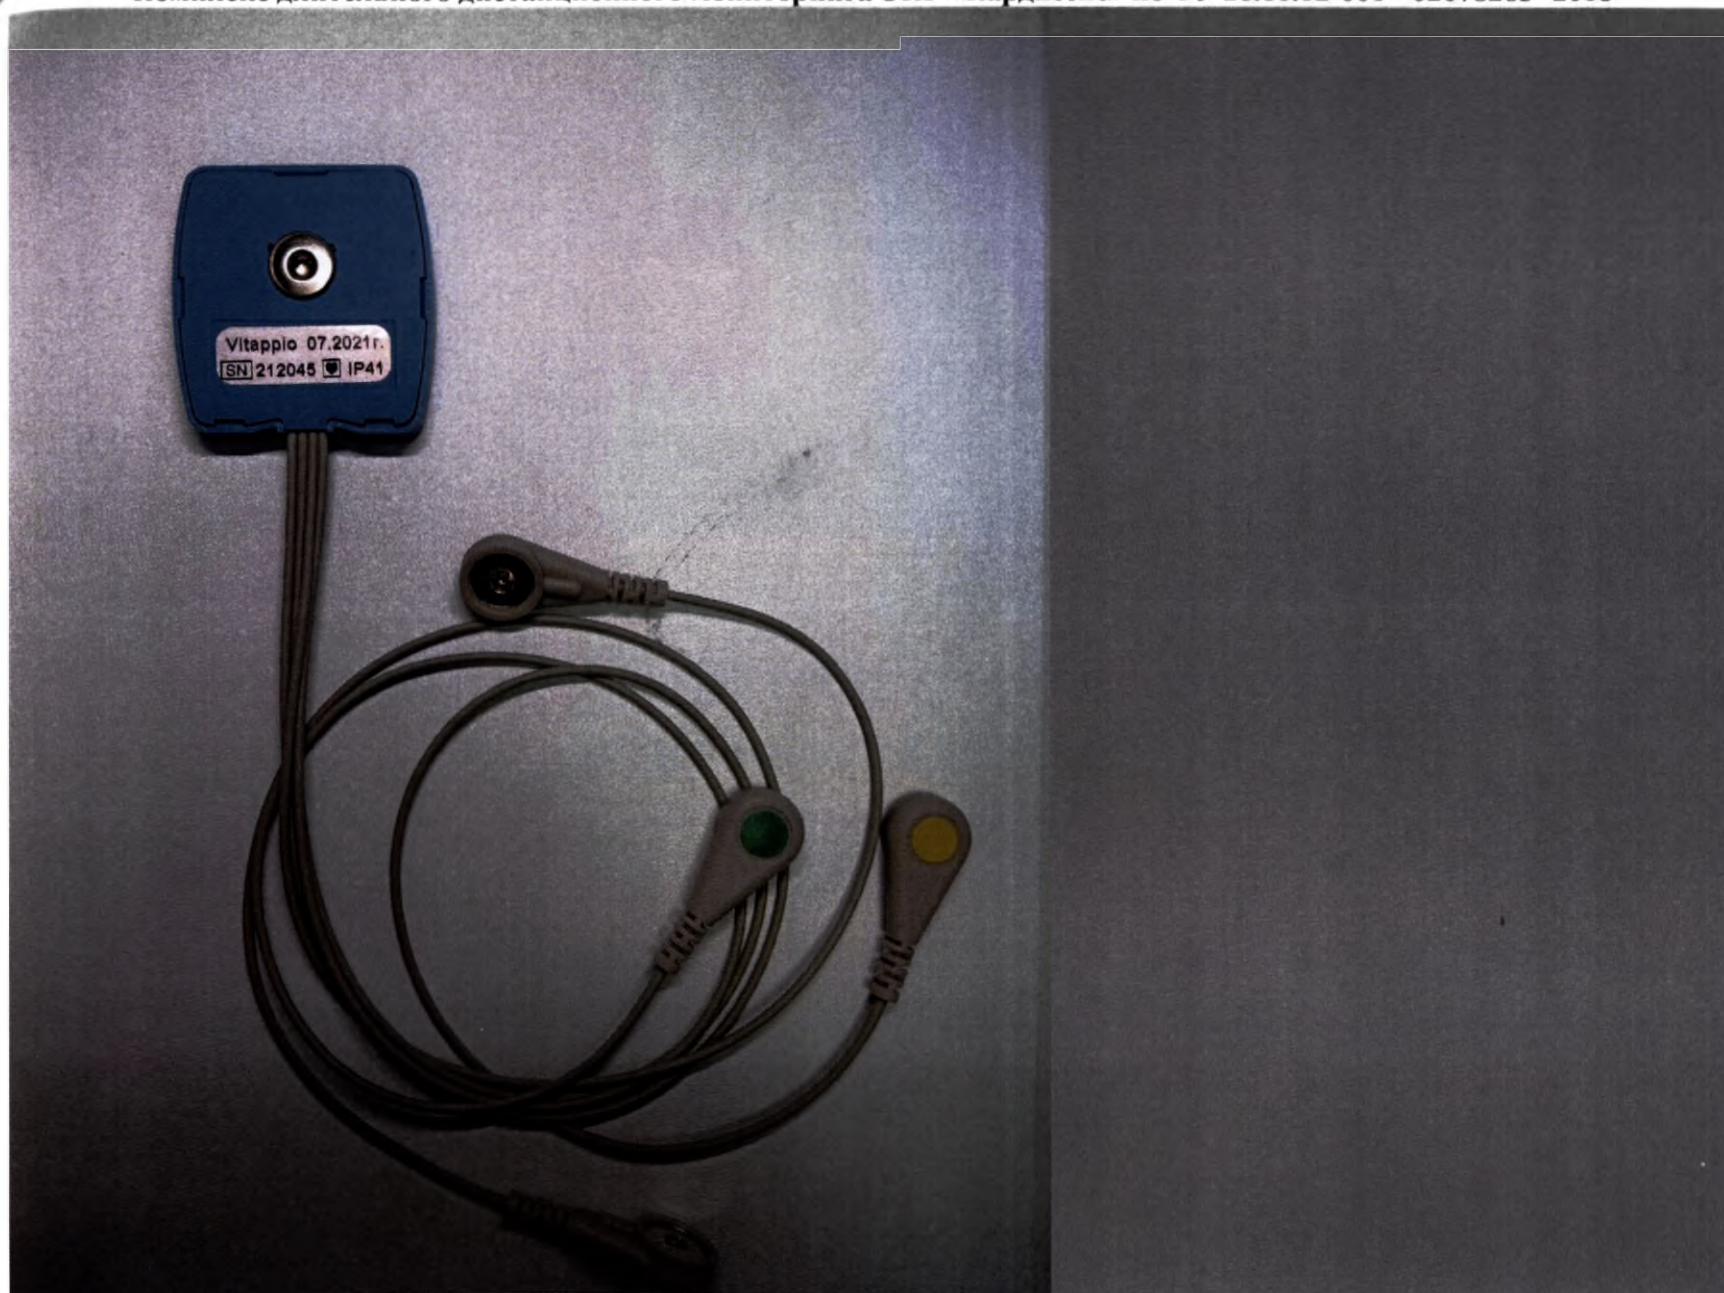


Рисунок 2.



Рисунок 3.

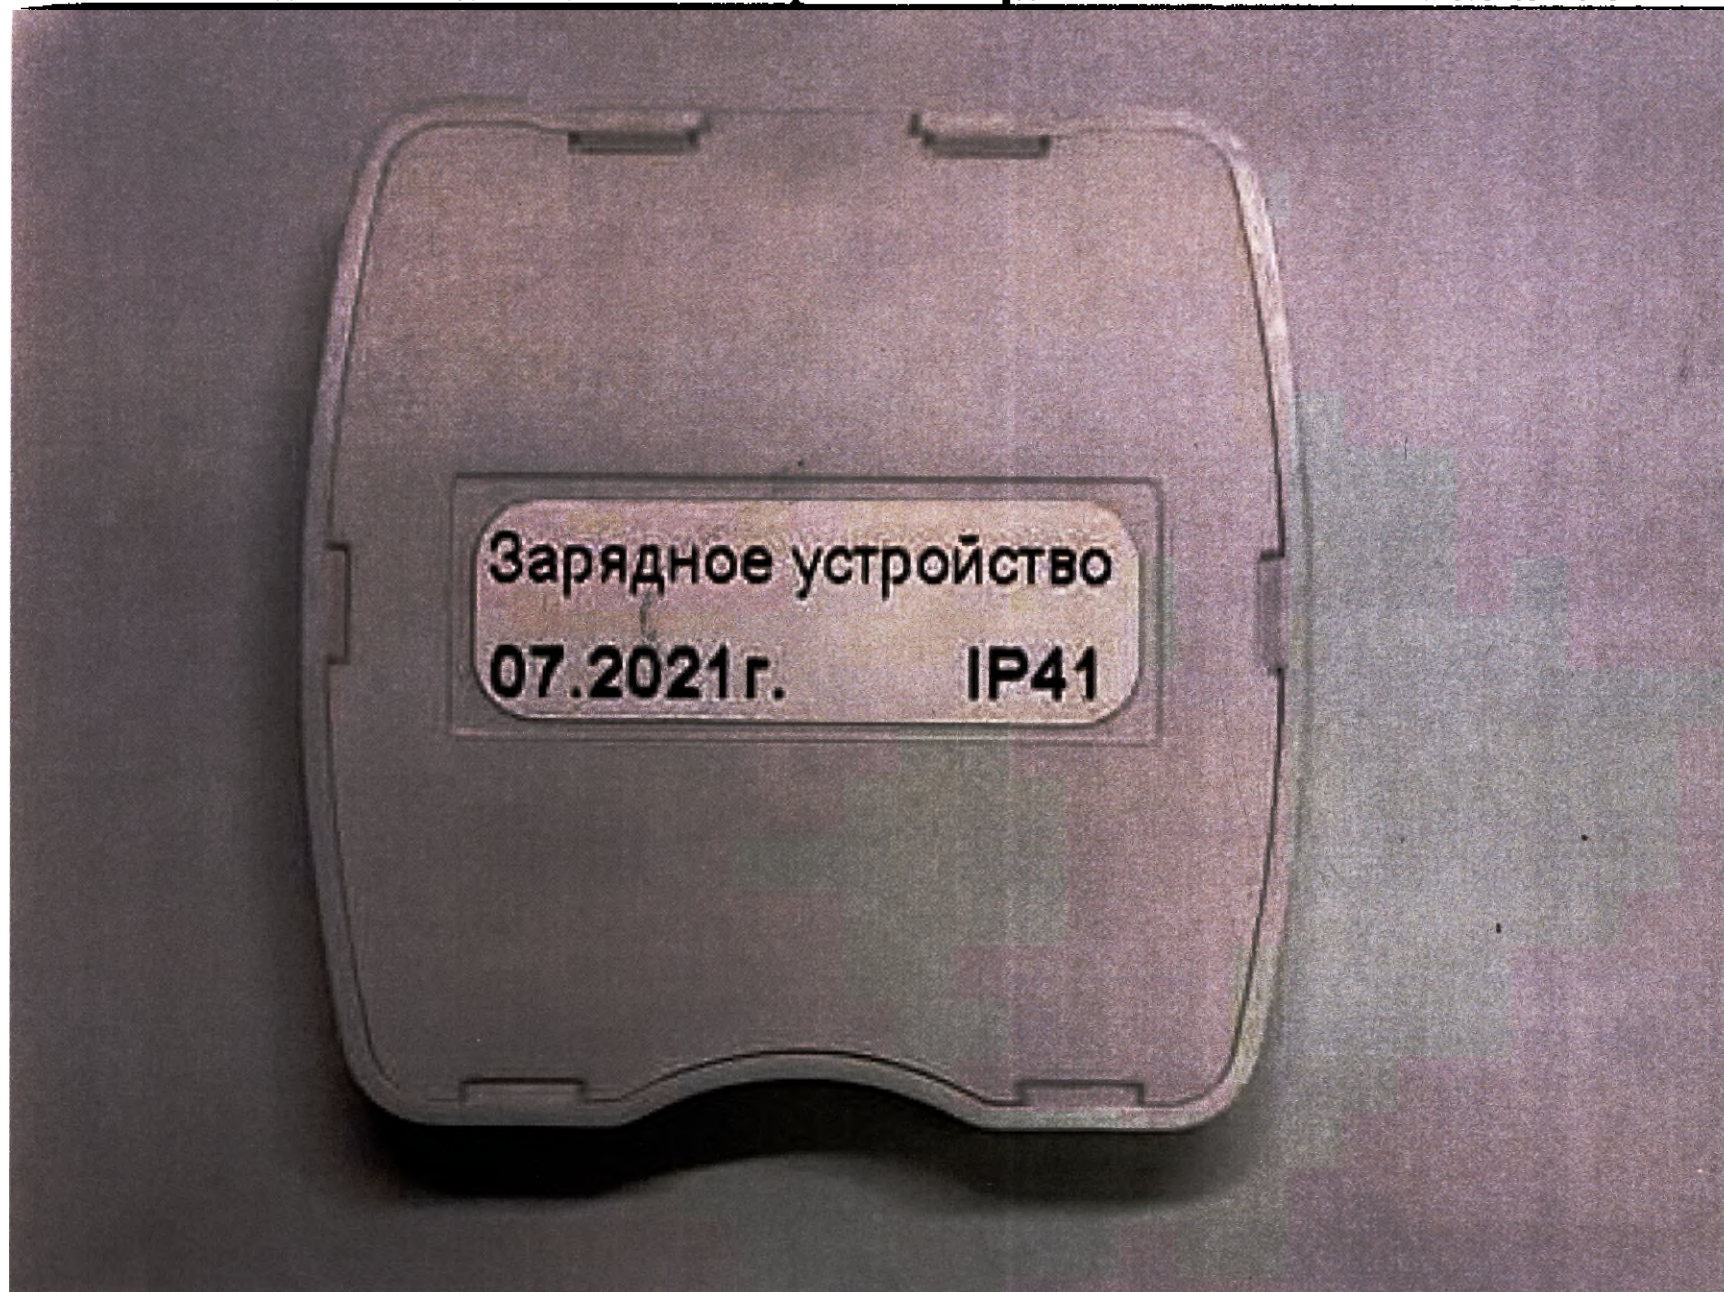


Рисунок 4.

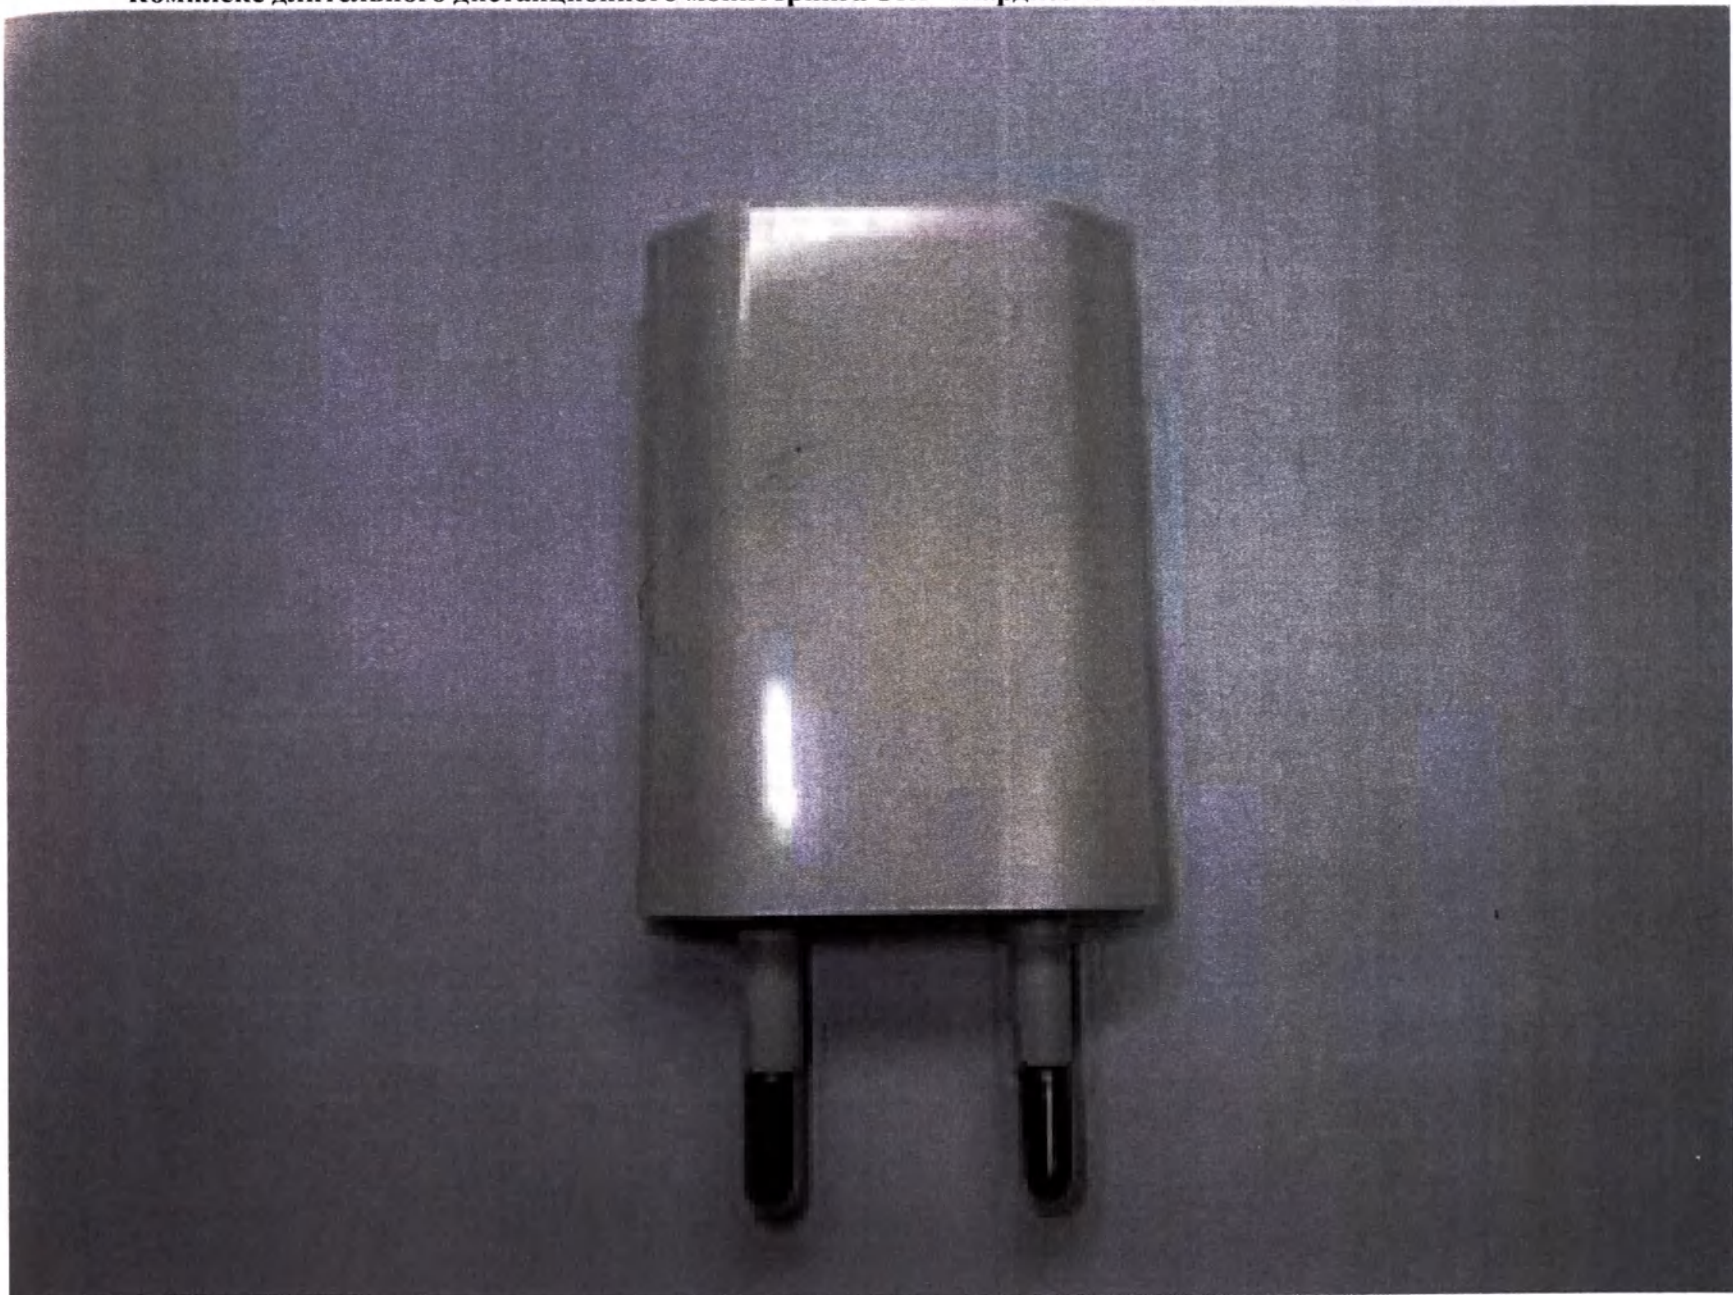


Рисунок 5.

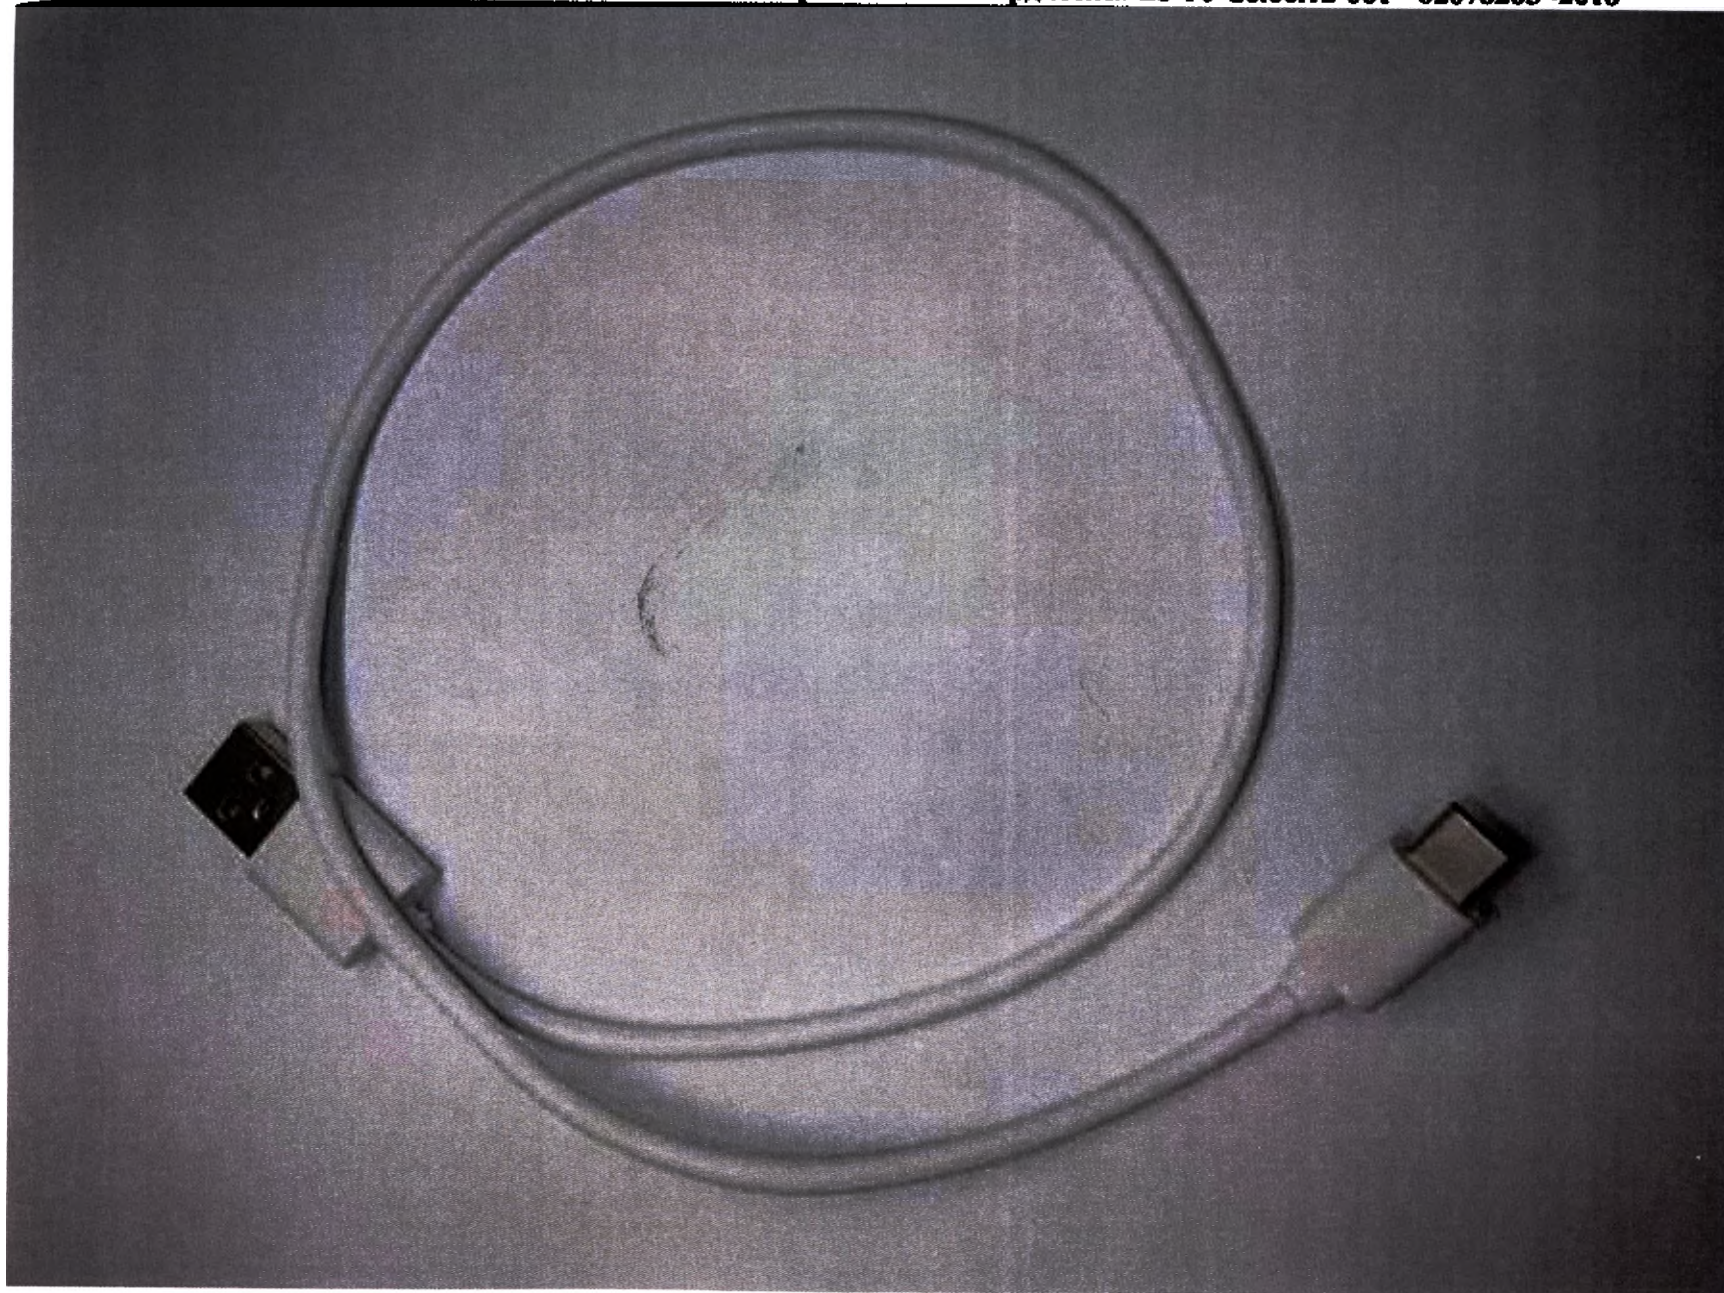


Рисунок 6.



Рисунок 7.



Рисунок 8.



Рисунок 9.

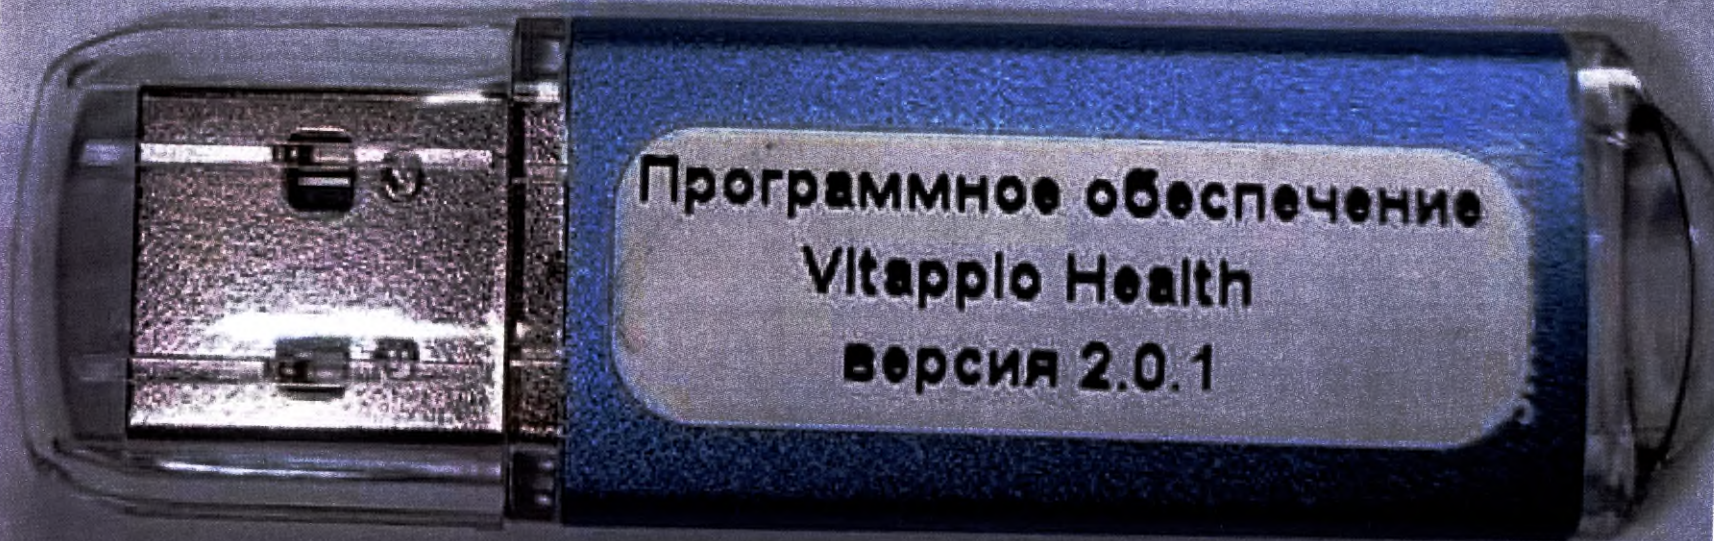


Рисунок 10.

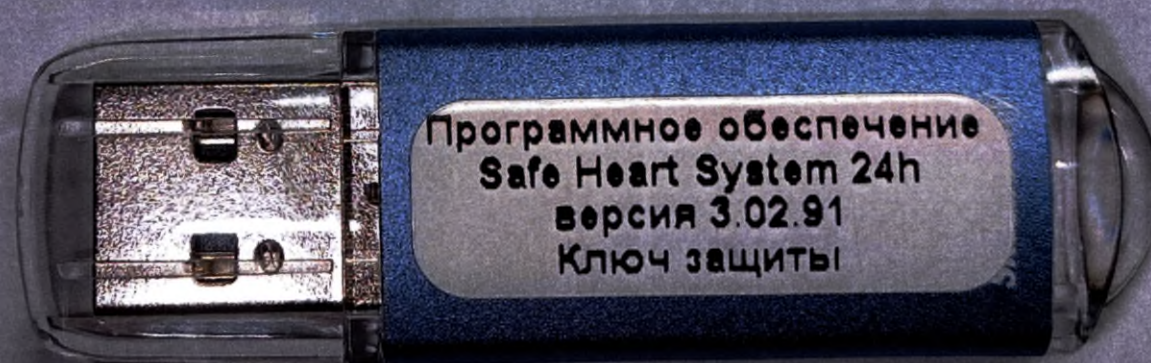


Рисунок 11.



Рисунок 12.

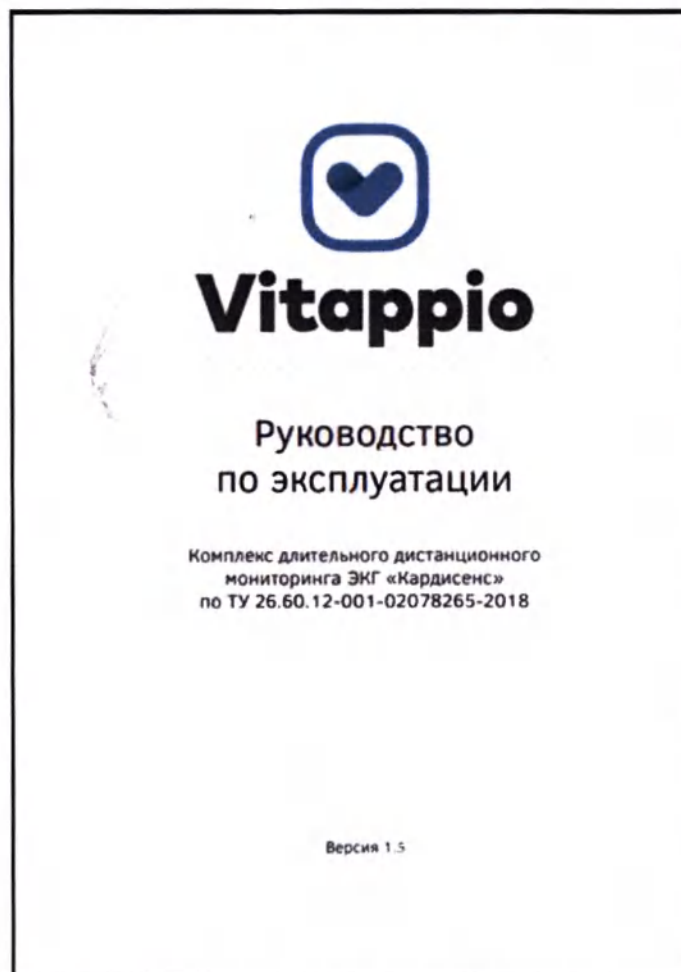


Рисунок 13.

Vitappio

ООО «Персональная меддиагностика»

ТУ 26.60.12-001-02078265-2018

РУ №РЗН 2019/9016 от 08 октября 2019 г.

Комплекс Кардисенс __

Комплектность:

1	Регистратор	1 шт.
2	Внутренние (сменные) источники питания	2 шт.
3	Зарядное устройство для внутренних (сменных) источников питания	1 шт.
4	Адаптер питания для зарядного устройства	1 шт.
5	Кабель адаптера питания	1 шт.
6	Руководство по эксплуатации	1 шт.
7	Этикетка	1 шт.

При необходимости:

- ☐ USB-флеш-накопитель с программным обеспечением «Vitappio Holter» для работы на смартфоне 1 шт.
- ☐ USB-флеш-накопитель с программным обеспечением автоматизированного рабочего места (АРМ) врача «Safe Heart System 24h» и руководство пользователя 1 шт.
- ☐ USB-флеш-накопитель с программным обеспечением автоматизированного рабочего места (АРМ) врача «СОЮЗ-Диагностика» и руководство пользователя 1 шт.
- ☐ USB-флеш-накопитель с программным обеспечением «Vitappio Health». 1 шт.
- ☐ USB-флеш-накопитель с программным ключом защиты программного обеспечения «Safe Heart System 24h» 1 шт.
- ☐ USB-флеш-накопитель с программным ключом защиты программного обеспечения «СОЮЗ-Диагностика». 1 шт.
- ☐ Одноразовые электроды ЭКГ Skintact T-V001, ФСЗ 2011/09805 1 уп.
- ☐ Одноразовые электроды ЭКГ Ambu A/C, ФСЗ 2008/02776 1 уп.

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие Комплекса требованиям ТУ 26.60.12-001-02078265-2018 при соблюдении потребителем Правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации Комплекса:
12 месяцев со дня начала эксплуатации

Свидетельство о приемке:

Комплекс Кардисенс __

№ _____
серийный номер

Изготовлен и принят в соответствие с требованиями действующей документации и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК _____ / _____
подпись расшифровка подписи

МП _____

Год, месяц, число: _____

READ CAREFULLY TO AVOID MISUSE OF ELECTRODES

SKINTACT®

www.skintact.com

ECG ELECTRODES
ELECTRODES ECG
EKG-ELEKTRODEN
ELETTRODI PER ECG
ELECTRODOS PARA ECG
ECG-ELETTRODOS
ECG ELECTRODEN
EKG ELEKTRODEN
EKG-ELEKTRODEJA
ELEKTRODY EKG
НАКЛЮПАЛА EKG
3MT НАКЛЮПАЛА
EKG ELEKTROD
ECG 电极

موصلات ملحطة القلب الكهربي

PREMIER

30 x 40 FS-521





2022-01-08

Made in Austria

CE	Rx ONLY	Ag/AgCl	⊗	ⓘ	MAX 40°C	⚡	⚡
----	---------	---------	---	---	----------	---	---

Lehrhard Lang GmbH, Aachenweg 56, 6820 Wolfstube, Austria, Tel: +43 512 362210, medical@LehrhardLang.at

Рисунок 15.



Рисунок 16.



Рисунок 17.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

20 листов(а)

Генеральный директор ООО «ПМД»
Габриелян А.Р.

