



Фотографические изображения медицинского изделия




Общий вид: Комплекса экзоскелета кисти с двумя степенями свободы и внешним программным управлением (Экзокисть-3)

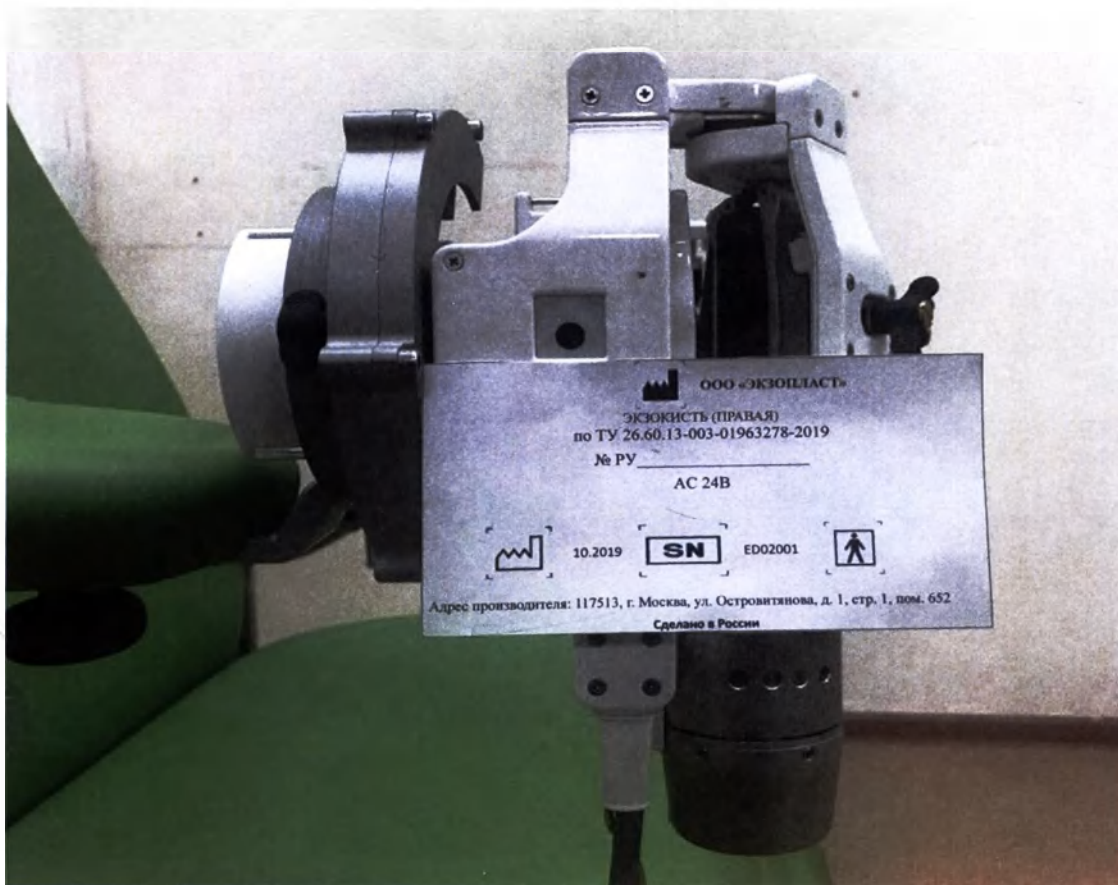

Экзоскелет кисти правой руки

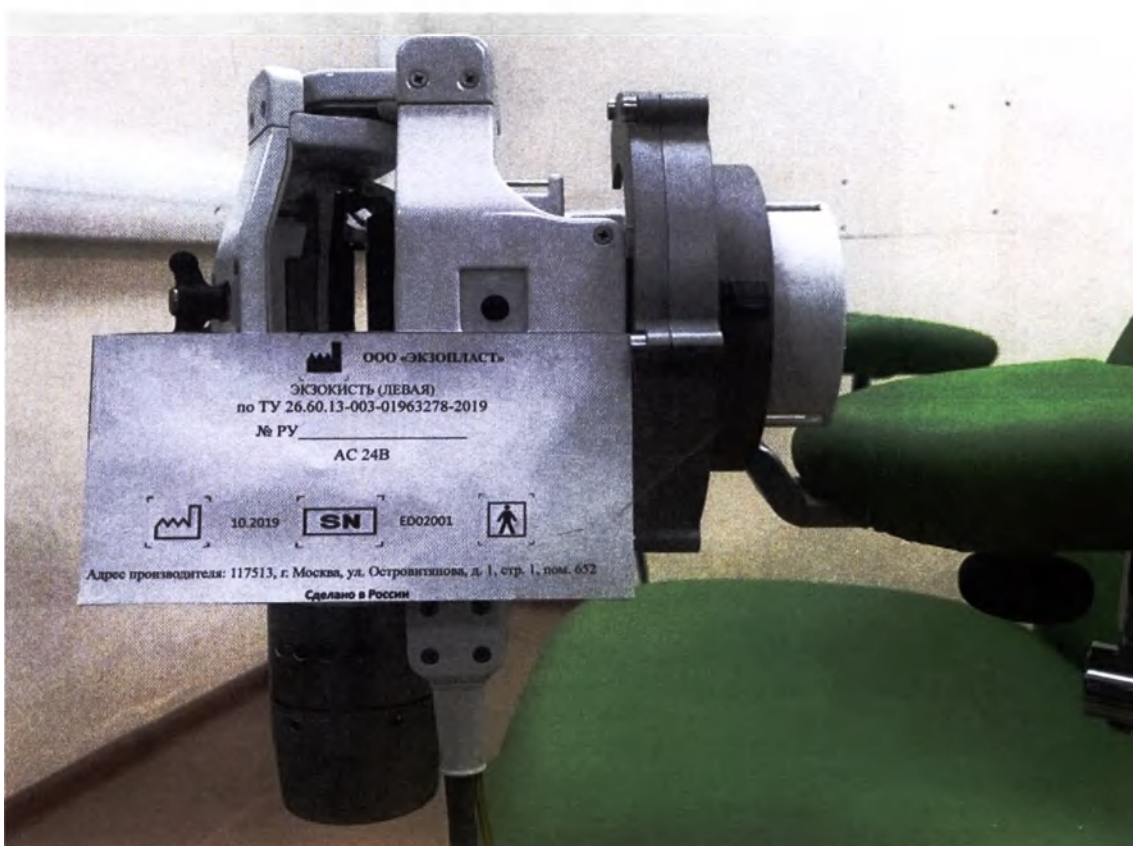


Экзоскелет кисти левой руки

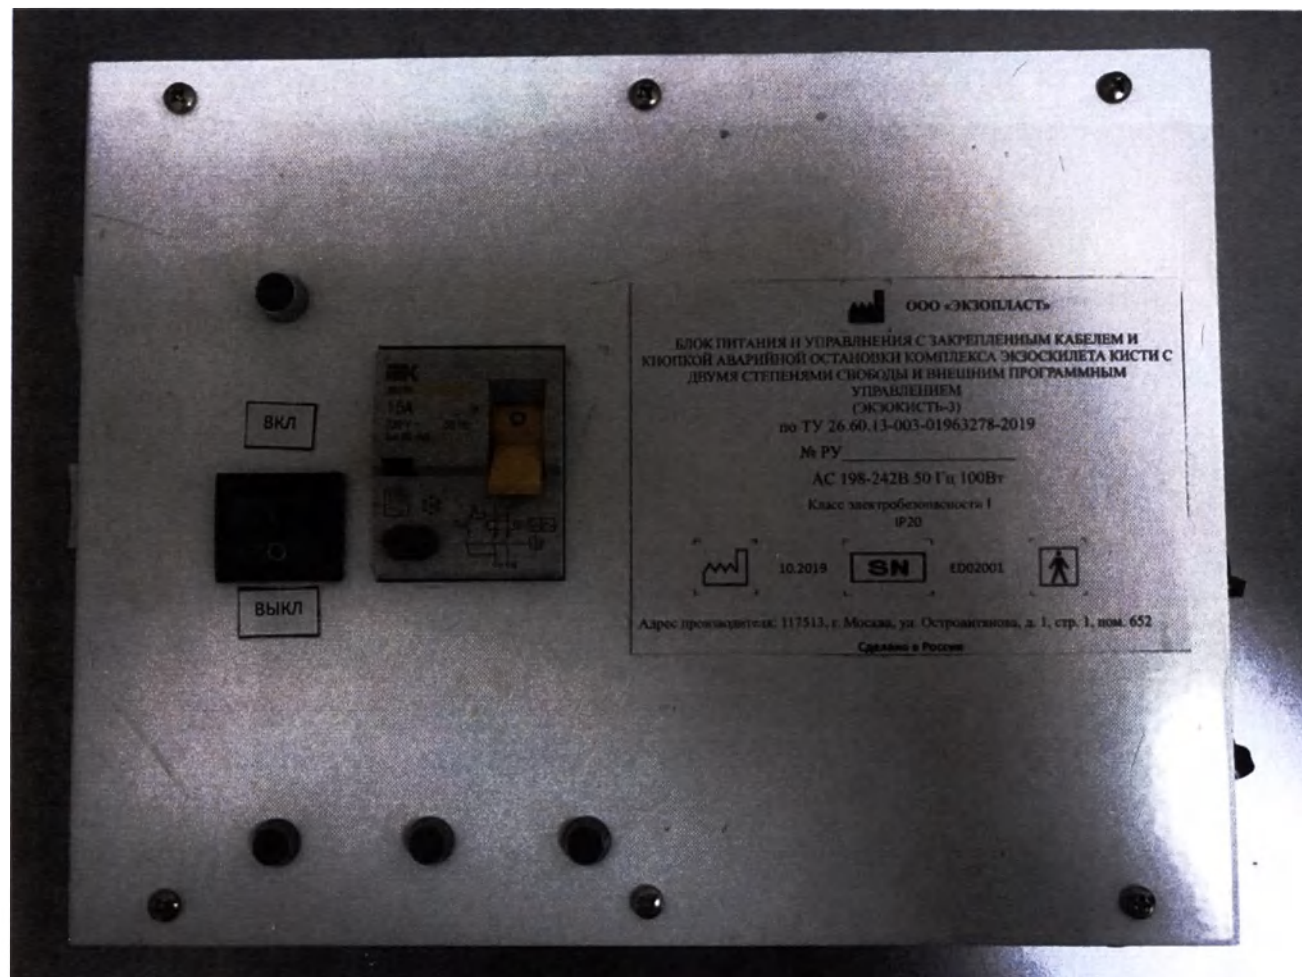

Блок питания и управления с закрепленным кабелем и кнопкой аварийной остановки




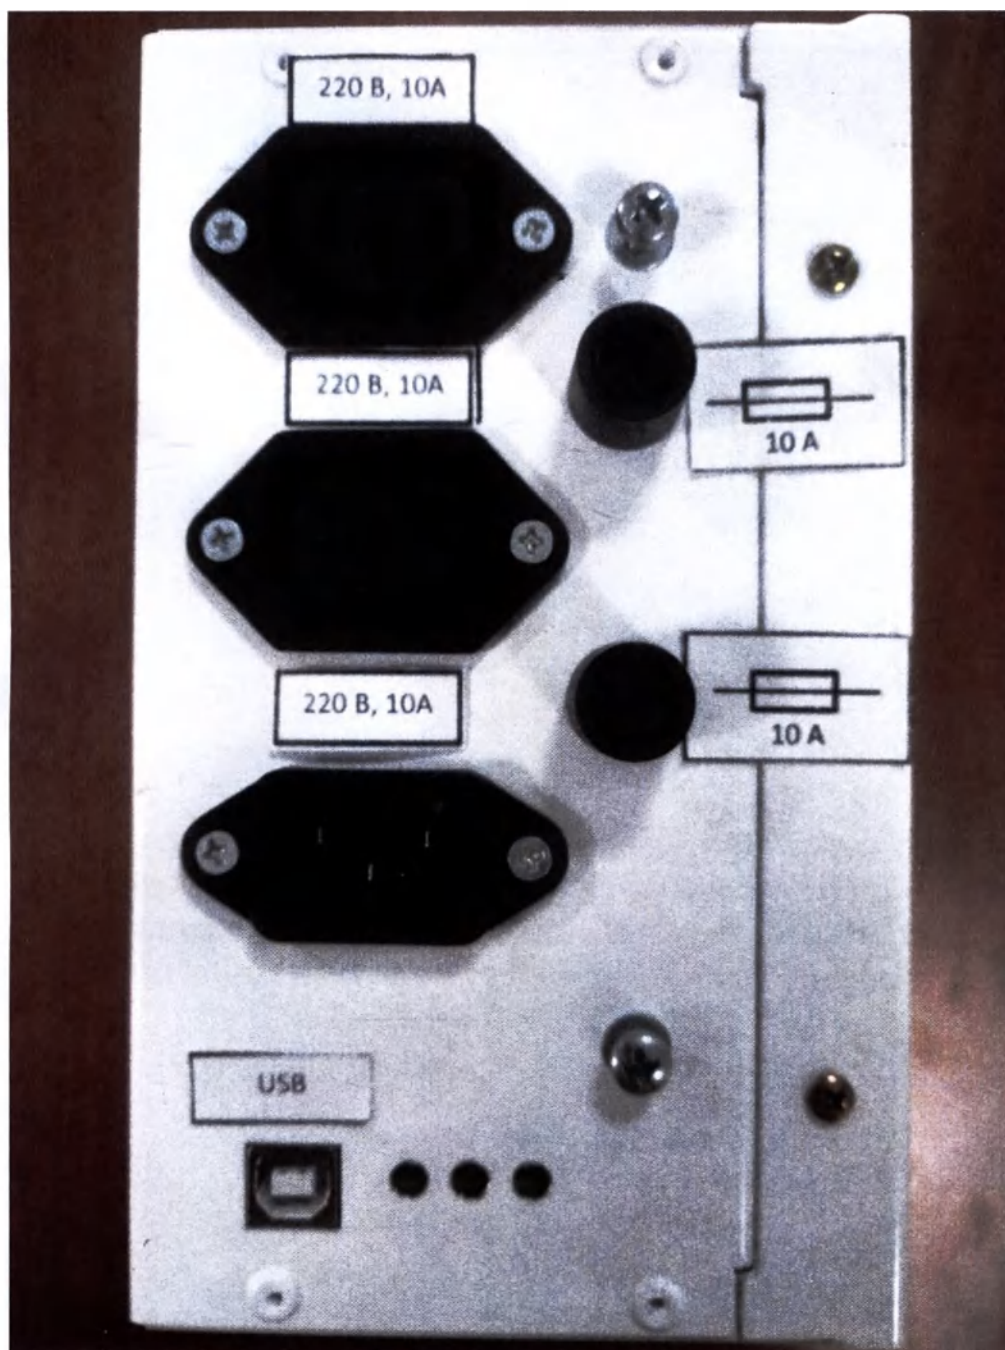


Выходные соединители блока питания и управления с закрепленным кабелем и кнопкой аварийной остановки



Компакт диск, содержащий:
«Программное обеспечение управления экзокистями», PIANIST_RNIMU.EXE
версия 3.0.1., «Программное обеспечение управления проведением
процедуры», «EKZONEAD», версия 1.0.2.899

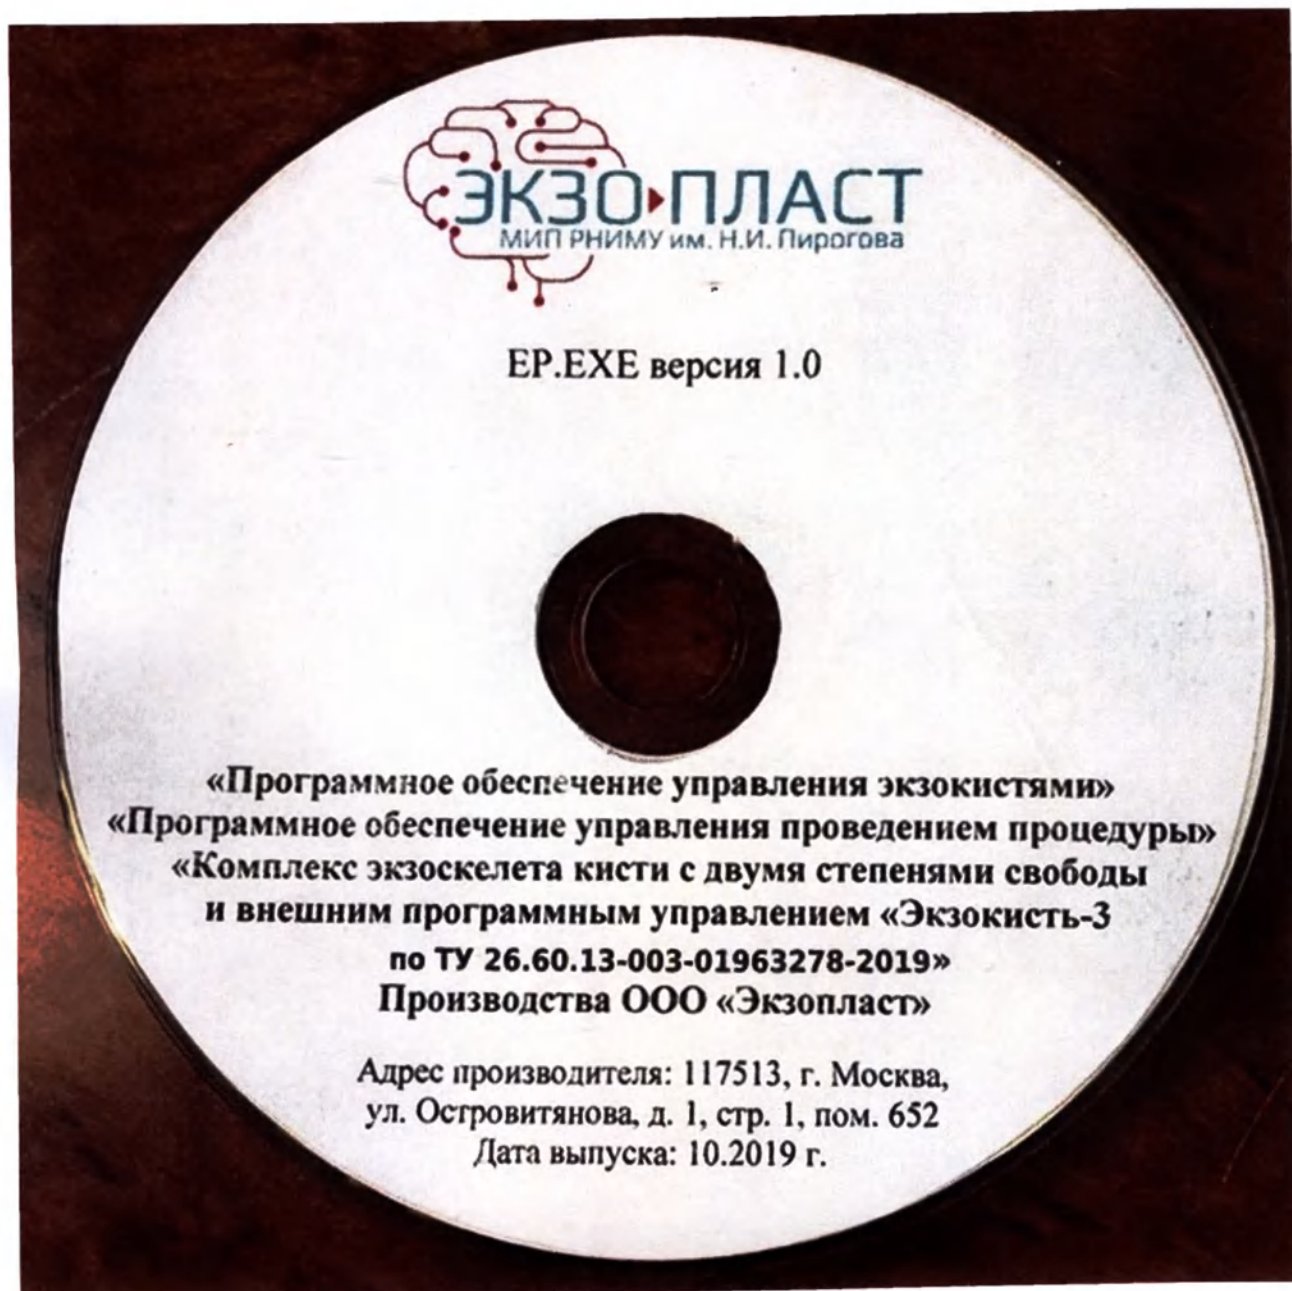

Компакт-диск, содержащий: «Программное обеспечение первичного
конфигурирования и диагностики аппаратной части комплекса», ЕР.EXE
версия 1.0

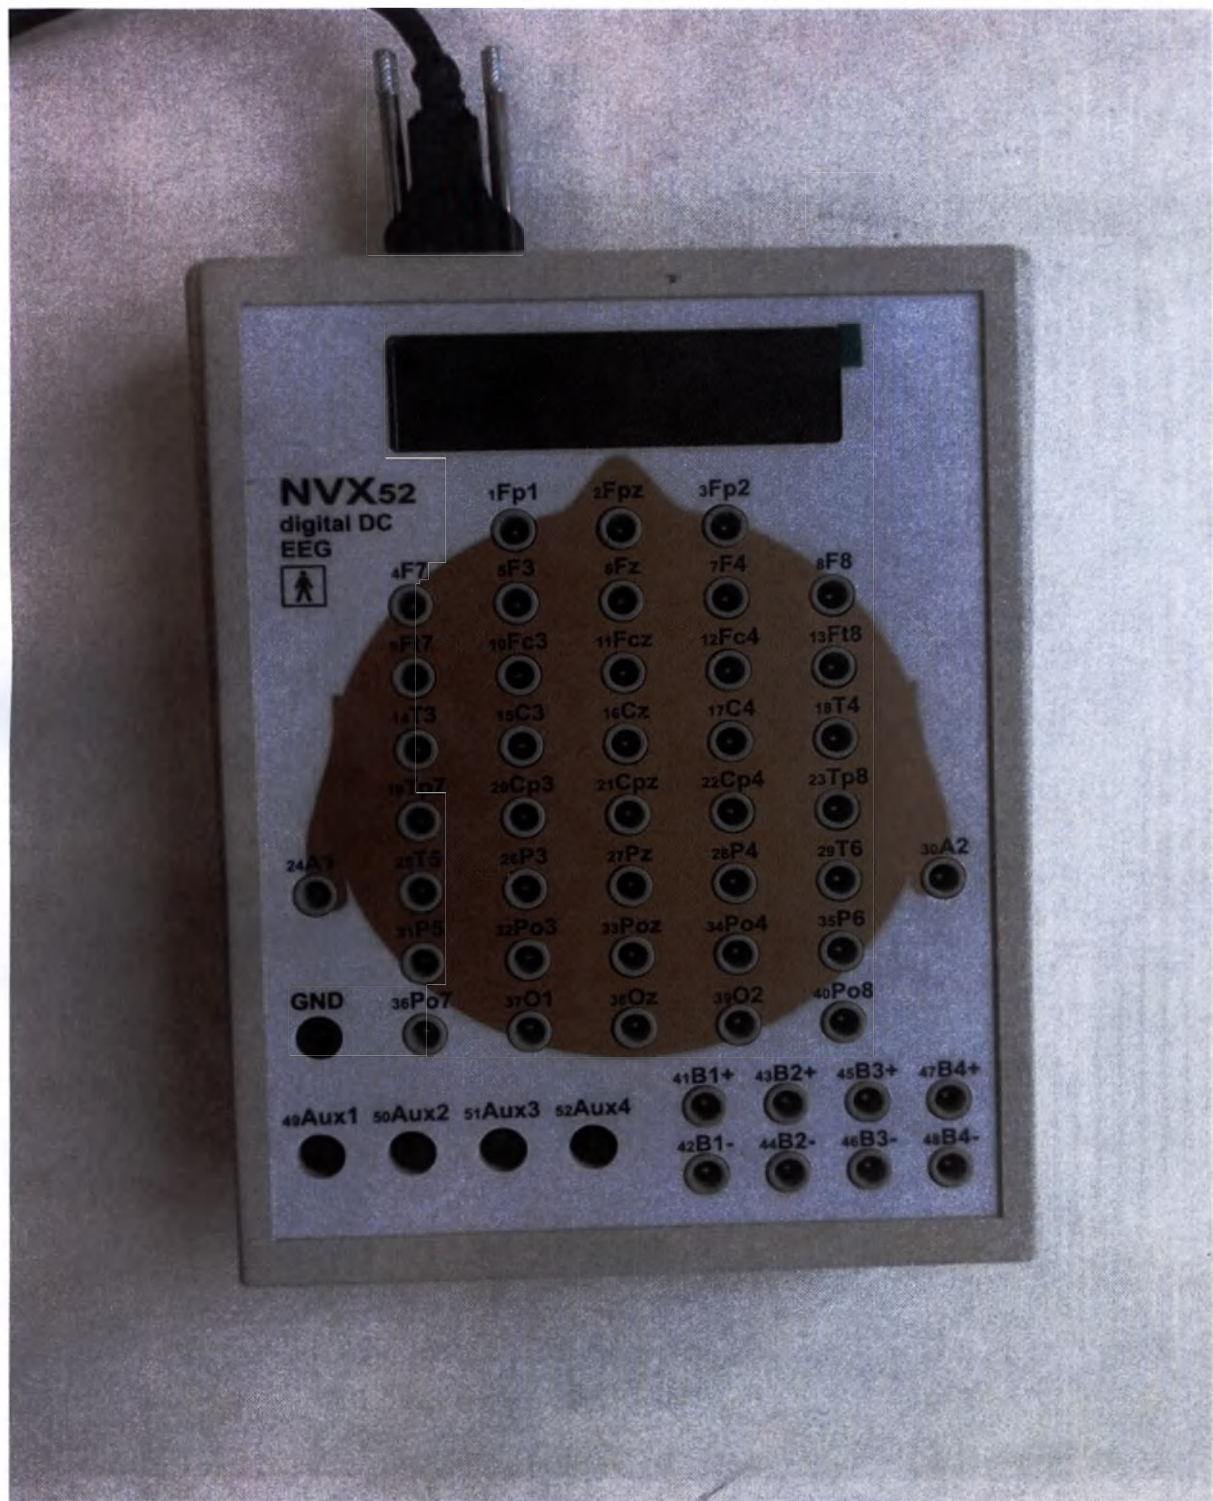

Анализатор-монитор биопотенциалов головного мозга "Нейровизор-БММ" по
ТУ 9441-003-17201375-2002



Система электродная электроэнцефалографическая "МКС-КЭП" по ТУ 9441-029-17635079-2009 в двух исполнениях: МКС-КЭП-26 и МКС-КЭП-52



Монитор пациента




Ноутбук врача



Кабель HDMI для подключения монитора пациента



Кабель подключения персонального компьютера к блоку питания и управления
с закрепленным кабелем и кнопкой аварийной остановки

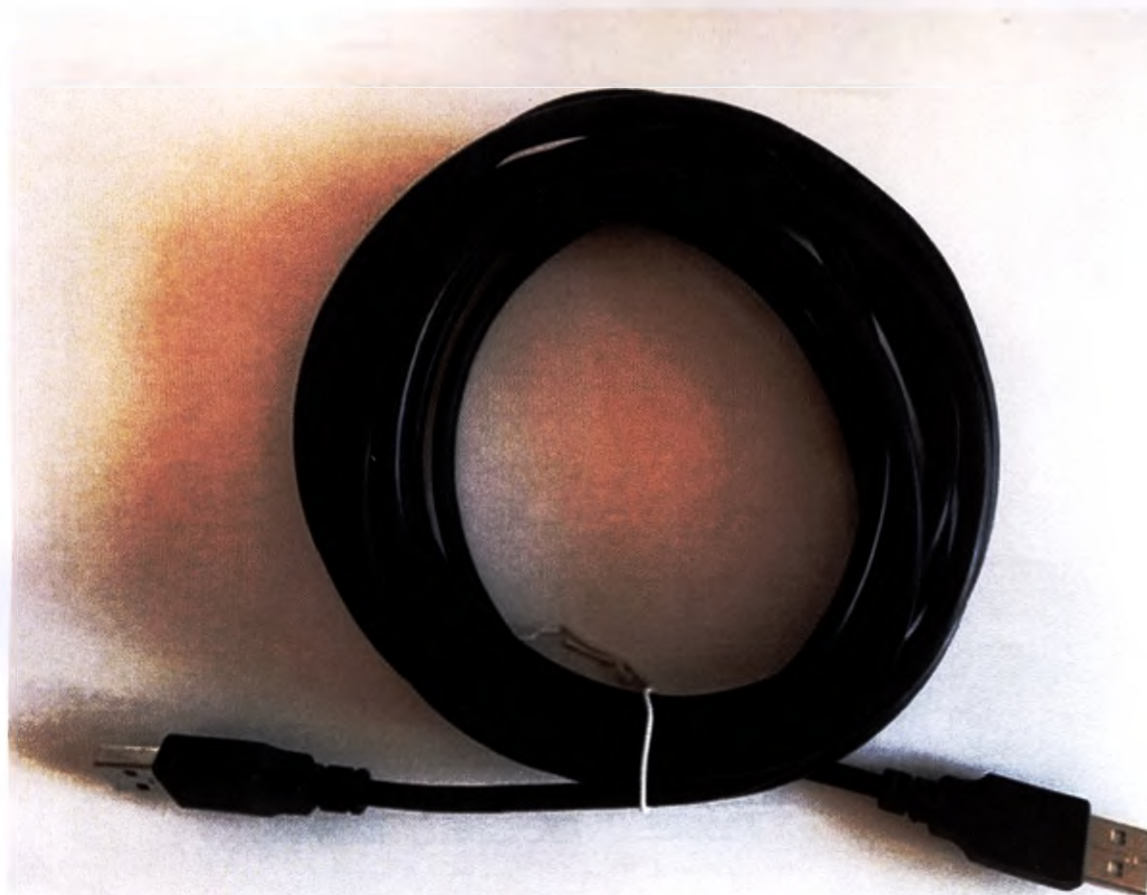

Кабель USB для подключения системы электродной
электроэнцефалографической МКС-КЭП по ТУ 9441-029-17635079-2009 в двух
исполнениях: МКС-КЭП-26 и МКС-КЭП-52 к ноутбуку



Кабель 220В



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Bepony" стерильные и нестерильные

Проректор по научной работе
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России



Д.В. Ребриков 27.09.2021 г.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16
_____ листах

