

Фотографические изображения

**Набор калибраторов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке и плазме
здорового человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических
cobas e (IL-6 CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе»**

«Набор калибраторов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (IL-6 CalSet Elecsys and cobas e analyzers)»

IL-6 CalSet

Elecsys and
cobas e analyzers

REF 05109469 190

CONTENT

Cal1 → 2 x 2.0 mL

Cal2 → 2 x 2.0 mL



COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

06444857001(1)

002

IVD **CE**  2-8 °C

 05109469190
<http://e-labdoc.roche.com>

cobas[®]



«Набор калибраторов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (IL-6 CalSet Elecsys and cobas e analyzers)»

IL-6 CalSet

For USA:

CONTENT

For Emergency Use Authorization only
Refer to Reagent Bulletin TP-00936

Cal1 IL-6 in equine serum matrix
Cal2 IL-6 in equine serum matrix

Rx only

04



REF 05109469190

LOT 49201201



2023-04-30



2020-05-27

GTIN 04015630924233



«Набор калибраторов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (IL-6 CalSet Elecsys and cobas e analyzers)»

Уполномоченный представитель производителя ООО «Рос
Диагностика Рус» 107031, Москва, Трубинная площадь, д.2 Тел: +7 495
229-89-89, факс: +7 495 229-82-64
E-mail: moscow_reception_dia@roche.com

05109469190 IL6 CalSet Elecsys, cobas e

**Набор калибраторов для определения IL6
(интерлейкин 6)**

Регистрационное удостоверение
ФСЗ 2009/04416


Выдано 29.01.2016

Страна происхождения: Германия

Производитель: Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse, 116 D-68305 Mannheim,
Germany

Срок годности 30.04.2023

«Набор калибраторов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (IL-6 CalSet Elecsys and cobas e analyzers)»

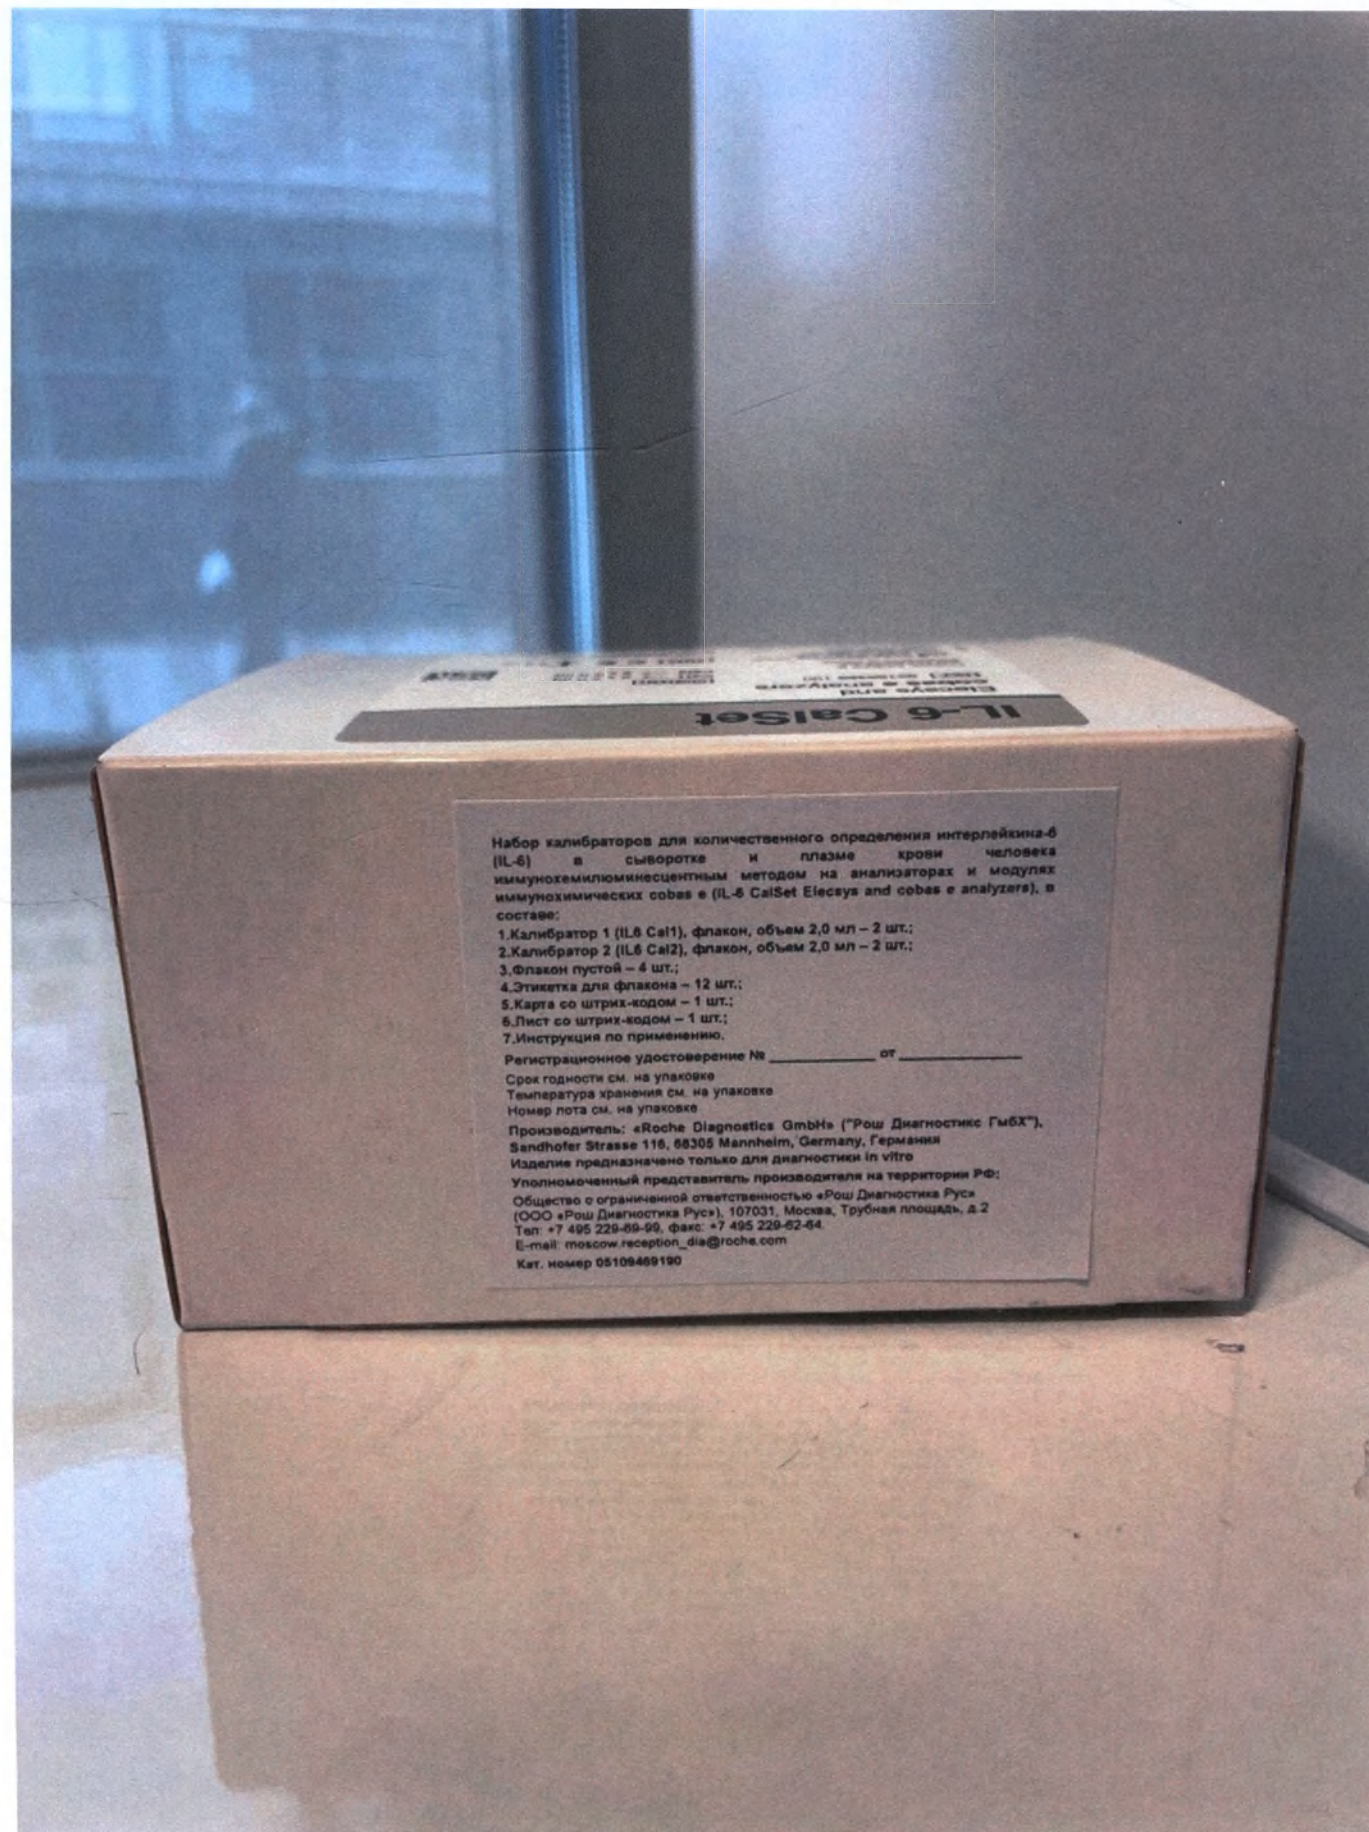

Набор калибраторов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (IL-6 CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Калибратор 1 (IL6 Cal1), флакон, объем 2,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (IL6 Cal2), флакон, объем 2,0 мл – 2 шт.;
3. Флакон пустой – 4 шт.;
4. Этикетка для флакона – 12 шт.;
5. Карта со штрих-кодом – 1 шт.;
6. Лист со штрих-кодом – 1 шт.;
7. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ").

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус»

(ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д 2

Тел. +7 495 229-69-69, факс: +7 495 229-62-64


E-mail: moscow_reception_dia@roche.com

Кат. номер 05109469190

«Набор калибраторов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (IL-6 CalSet Elecsys and cobas e analyzers)»




Калибратор 1 (IL6 Cal1), флакон, объем 2,0 мл

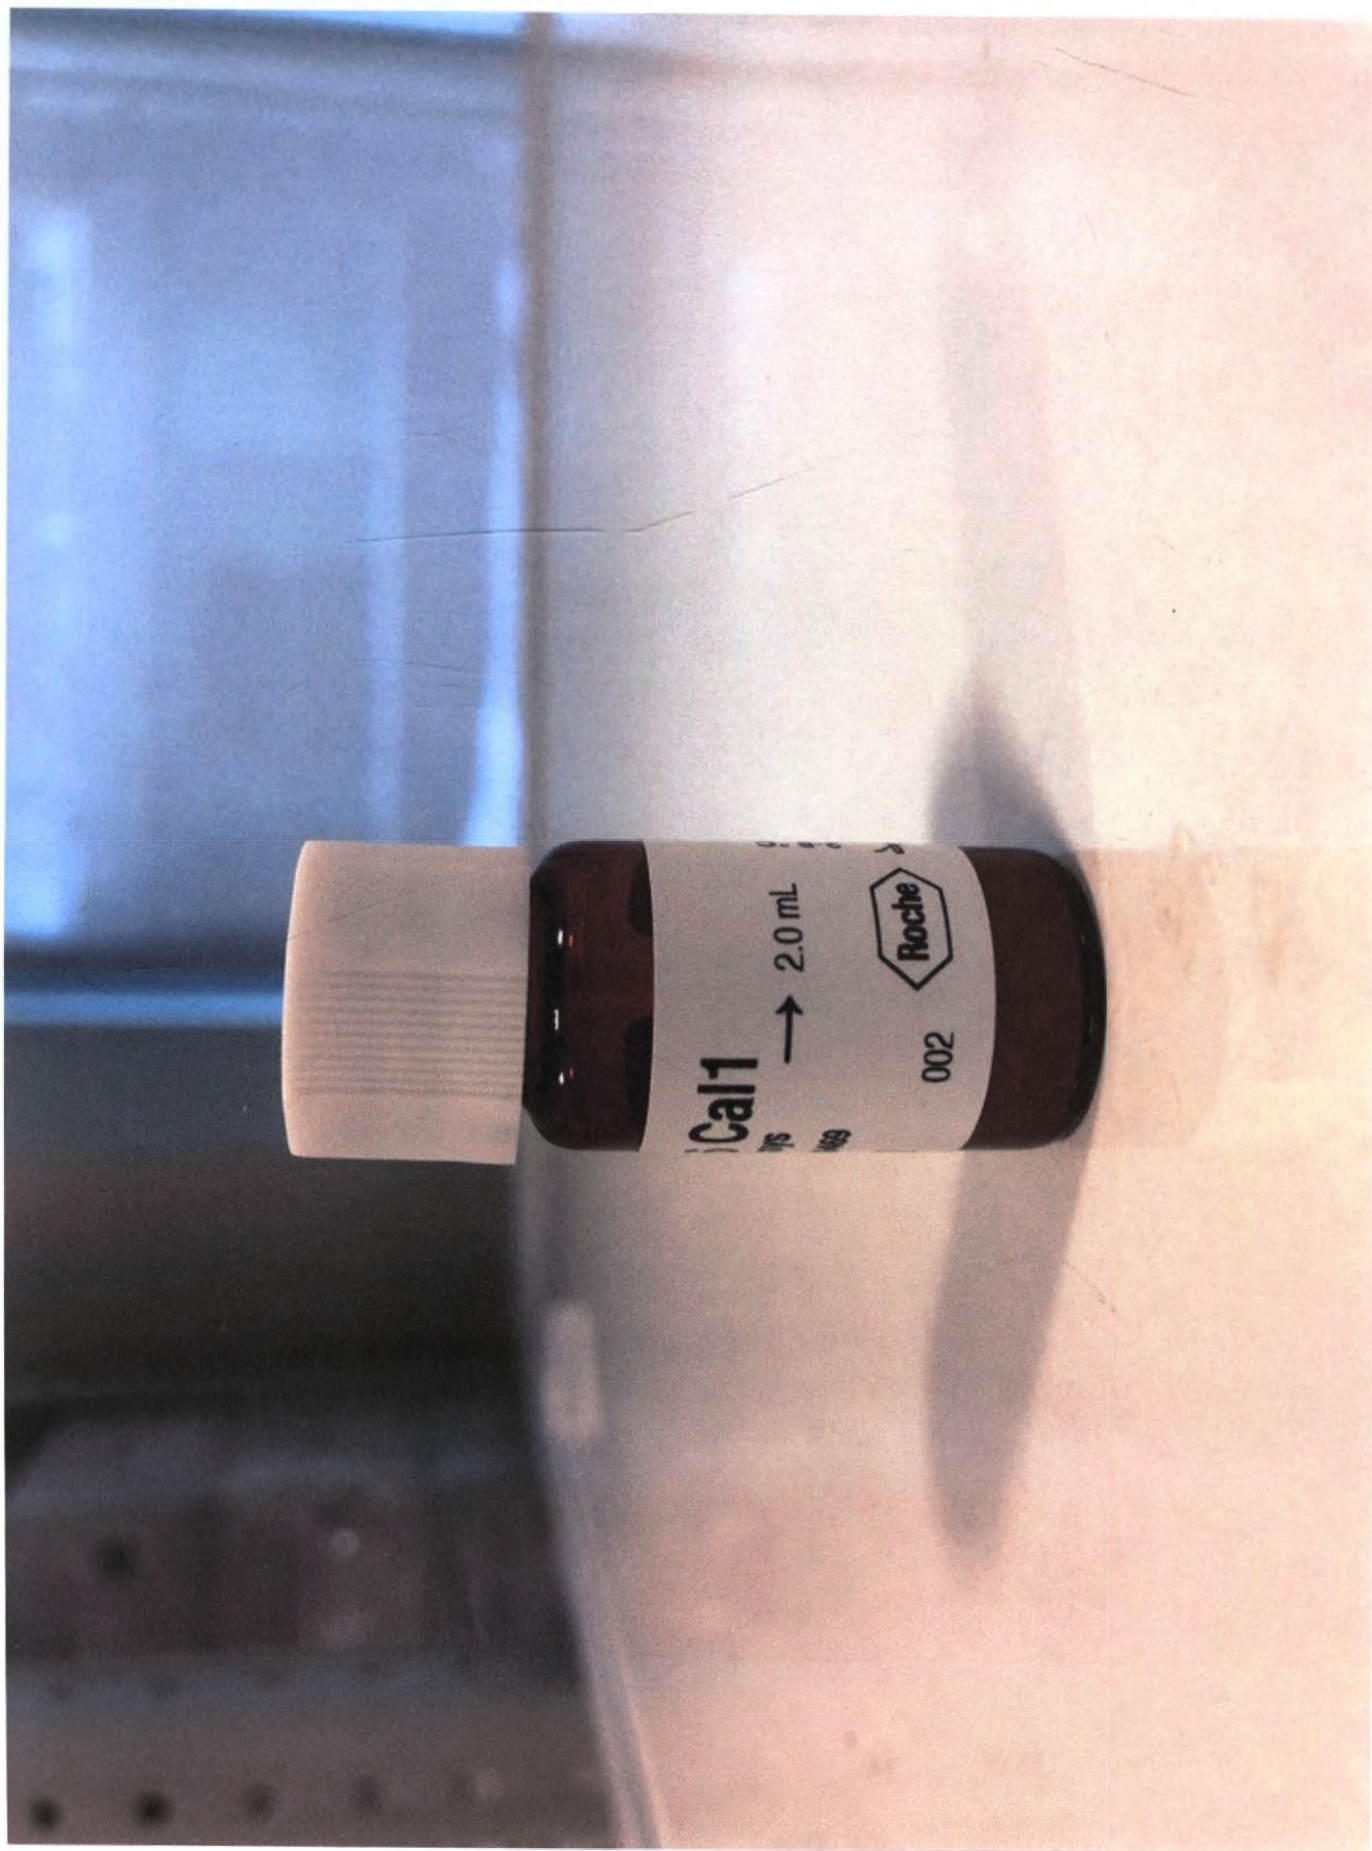








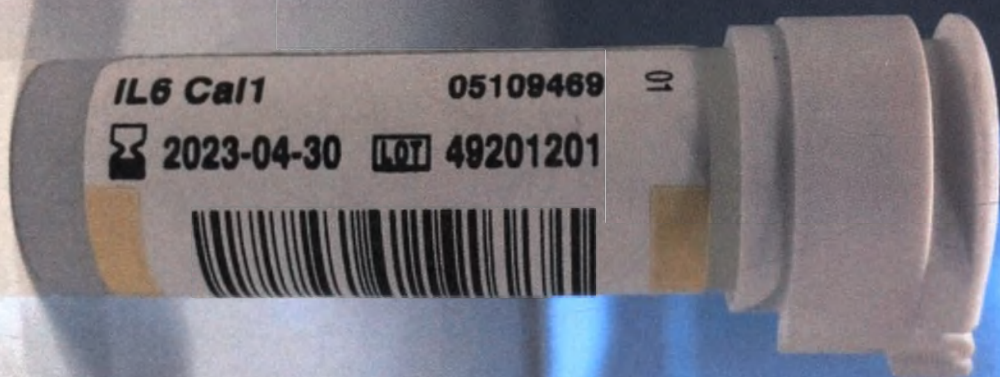





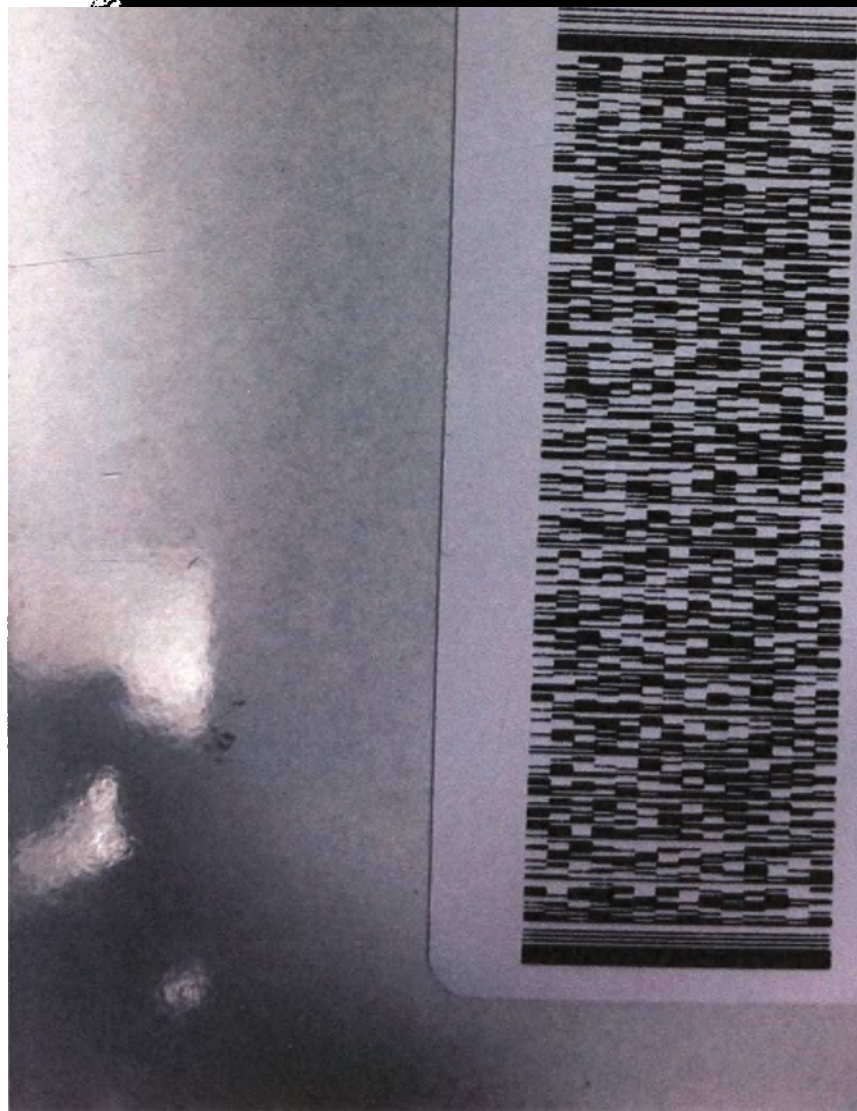

IL-6 CalSet

05109469190


[LOT] 501113

2022-04

Calibrator Barcode



2020-06





IL-6 CalSet

REF 05109469190

→ 4 x 2.0 mL

05109469190 V 6
dialog.roche.com**English****Precautions and warnings**

For in vitro diagnostic use.
Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.
Disposal of all waste material should be in accordance with local guidelines.
Safety data sheet available for professional user on request.

Avoid foam formation in all reagents and sample types (specimens, calibrators and controls).

Method Sheet download

The box at the top of this document shows the product code together with the respective document version.
Please go to dialog.roche.com to download this document.

The website displays either the version listed here or, if available, any later version that is also valid for this product code. If you have no internet access, please contact your local Roche affiliate to obtain the document free of charge.

Deutsch**Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise**

In-vitro-Diagnostikum.
Die beim Umgang mit Laborreagenzien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.
Die Entsorgung aller Abfälle sollte gemäß den lokalen Richtlinien erfolgen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.
Schaumbildung bei allen Reagenzien und Probenarten (Proben, Kalibratoren und Kontrollen) vermeiden.

Download von Methodenblättern

Der eingerahmte Text am Beginn des Dokumentes zeigt den Produkt-Code sowie die dazugehörige Version des Dokumentes.
Dieses Dokument kann von der folgenden Webseite heruntergeladen werden: dialog.roche.com.

Die Webseite zeigt die hier referenzierte Version oder aber, falls bereits verfügbar, eine ebenfalls für diesen Produkt-Code gültige höhere Version.
Sollten Sie keinen Internetzugang haben, erhalten Sie bei Ihrer Roche-Vertretung das Dokument kostenlos.

Français**Précautions d'emploi et mises en garde**

Pour diagnostic in vitro.
Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire.
L'élimination de tous les déchets devrait être effectuée conformément aux dispositions légales.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Éviter la formation de mousse dans les réactifs et les échantillons de tous types (échantillons de patients, calibrateurs et contrôles).

Téléchargement de fiches techniques

Le cadre en haut de la page montre le code du produit et la version du document.
Ce document est téléchargeable sur dialog.roche.com.
Le site affiche la version indiquée ci-dessus ou toute autre version ultérieure disponible correspondant au code du produit. Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez contacter le représentant Roche de votre pays pour obtenir ce document gratuitement.

Español**Medidas de precaución y advertencias**

Producto sanitario para diagnóstico in vitro.
Observe las medidas de precaución habituales para la manipulación de reactivos.
Elimine los residuos según las normas locales vigentes.
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.

cobas®

Evite la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo (especímenes, calibradores y controles).

Descargar la metodología

El recuadro en la parte superior de la página indica el código del producto junto con la versión del documento.
El documento puede descargarse a través de dialog.roche.com.
La página web muestra la versión aquí indicada o, en su caso, una versión posterior que corresponde al código del producto. Si no tiene acceso a Internet, contacte con su representante de Roche para recibir un documento gratuito.

Italiano**Precauzioni e avvertenze**

Per uso diagnostico in vitro.
Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di laboratorio.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Evitare la formazione di schiuma in tutti i reattivi e tipi di campione (campioni, calibratori e controlli).

Scaricamento della metodica

Nel box riportato all'inizio di questo documento è indicato il codice prodotto insieme alla versione della rispettiva metodica.
Per scaricare tale metodica, andate a dialog.roche.com.
Il sito Web indica la versione riportata qui o, se disponibile, una versione più recente, comunque valida per questo codice prodotto. Se non dispone di alcun accesso Internet, rivolgetevi al rappresentante locale di Roche per ottenere il documento gratuitamente.

Português**Precações e avisos**

Para utilização em diagnóstico in vitro (IVD).
Respeite as precauções normais de manuseamento de reagentes laboratoriais.
Elimine todos os resíduos de acordo com os regulamentos locais.
Ficha de dados de segurança fornecida a pedido, para uso profissional.
Evite a formação de espuma em todos os reagentes e tipos de amostras (amostras de pacientes, calibradores e controles).

Download de folhas de método

A caixa de texto no topo deste documento apresenta-lhe a referência do produto juntamente com a versão do respectivo documento.
Visite dialog.roche.com para transferir este documento.
O website apresenta a versão indicada neste documento ou, se disponível, qualquer versão posterior também válida para esta referência de produto.
Caso não disponha de acesso à Internet, contacte a afiliada local da Roche para receber o documento em questão sem custos adicionais.

Dansk**Forholdsregler og advarsler**

Til in vitro-diagnostisk brug.
Udvis de normale forholdsregler, der kræves ved håndtering af alle laboratoriereagenser.
Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer.
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

Undgå skumdannelse ved alle reagenser og prøvetyper (prøver, kalibratorer og kontroller).

Downloadning af metodeblade

Følgte øverst på dette dokument angiver katalognummeret samt dokumentets versionsnummer.
Gå til dialog.roche.com for at downloade dette dokument.
Web siden viser enten den version, der er angivet her, eller, hvis de findes, eventuelle senere versioner, som også gælder for dette katalognummer. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du få et gratis eksemplar af dokumentet ved at kontakte det lokale Roche-kontor.

2020-04, V 3



1/5

cobas e analyzers

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)

16



Володина Г. А.

по доверенности
от 04.02.2021