

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «КАЛИБР»

А.А. Рябухина

2021 г.



**Фотографическое изображение
общего вида медицинского изделия**

Наименование медицинского изделия: Венолокатор NAVI-60, с
принадлежностями


Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
(МЕДКЕПТЕЙН МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.)

Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями

1. Основной блок «венолокатор NAVI-60»




2. Кабель питания переменного тока

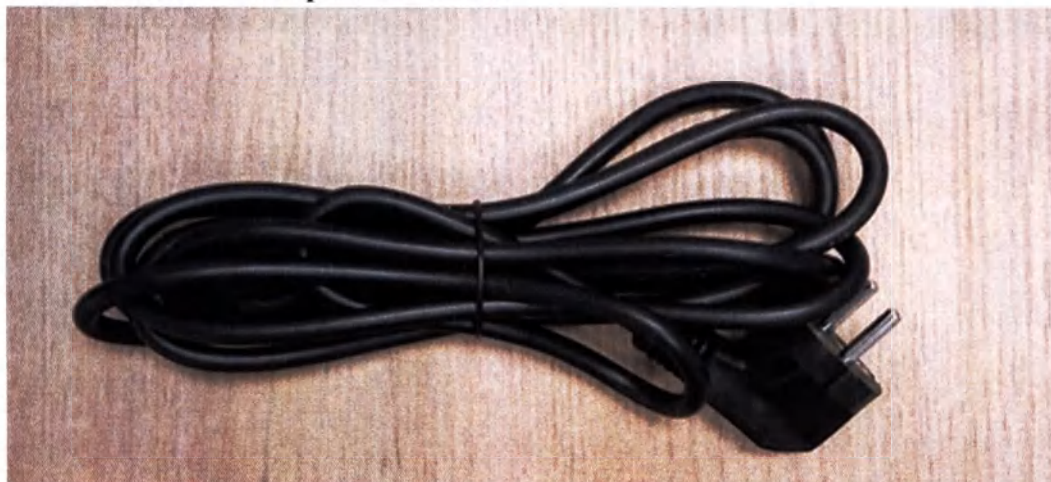

3. Адаптер питания



4. Карта тестирования точности

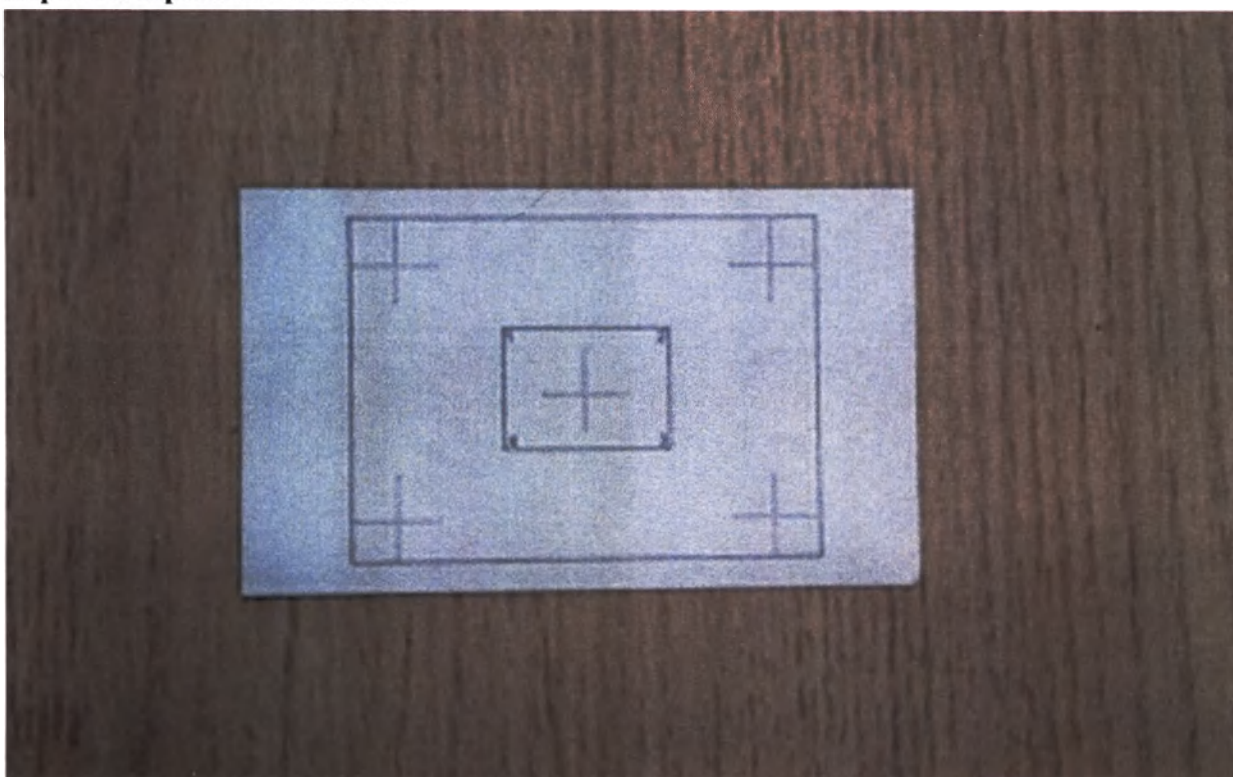

Принадлежности

1. Стойка мобильная NAVI-MS



2. Стойка настольная NAVI-FS



Болты



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов

Подпись _____

М.П.





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Калибр»

А.А. Рябухина

29 2021 г.

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями»

Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD,

1. Маркировка изделия

1.1 Маркировка производителя «Основной блок «венолокатор NAVI-60»»



Макет стикера для Российской Федерации «Основной блок «венолокатор NAVI-60»»

Основной блок венолокатор NAVI-60

МОДЕЛЬ: NAVI-60



см. на упаковке

Входная мощность адаптера: 100-240 В
переменного тока, 50/60 Гц 1,5 А макс.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Калибр»

Юридический адрес: 420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 13А, помещение 1

тел./факс: Тел. 8-922-182-80-14

Kalibr.kzn@gmail.com



: см. на упаковке.



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.


Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158, Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие: № РЗН 20XX/XXXX от XX
20XX года.

Срок службы: не более 5 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

1.2 Маркировка производителя «Адаптер питания»

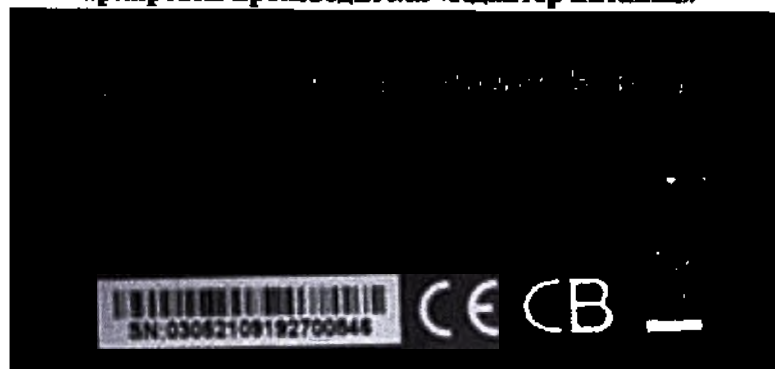

Макет стикера для Российской Федерации «Адаптер питания»

Медицинский внешний блок питания

Модель: см на маркировке



Входящий ток: 100-240 Vac., 50/60 Гц, максимальная сила тока – 1.5 А.

Выходящий ток: 12 V, 3.5 A

Shenzhen Longxc Power Supply Co., LTD

SN: см. на упаковке

1.3 Маркировка производителя принадлежности «Стойка мобильная NAVI-MS»

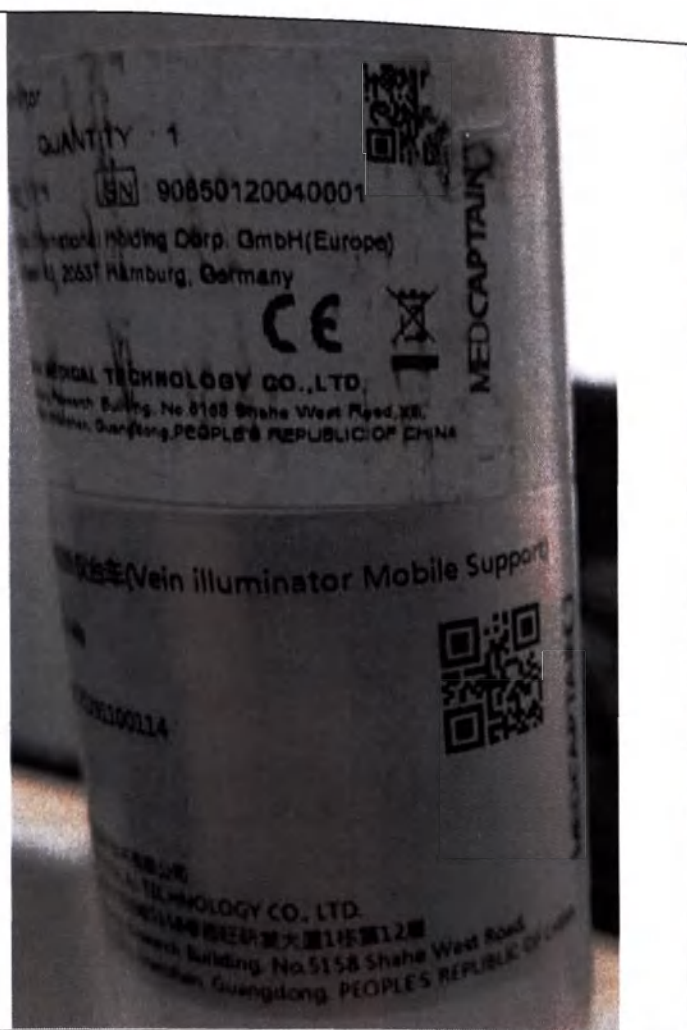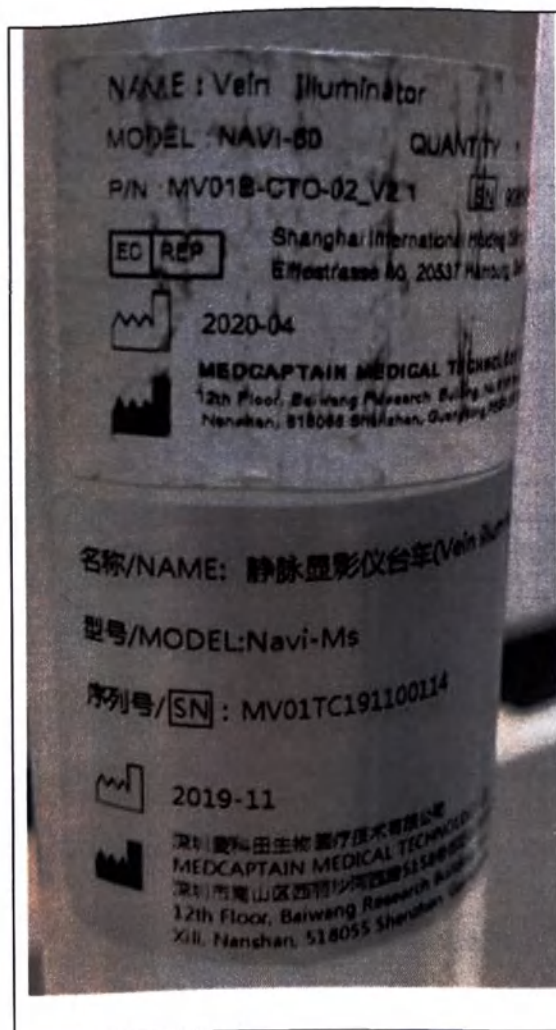

Макет стикера для Российской Федерации «Стойка мобильная NAVI-MS»

Наименование: Основной блок венолокатор NAVI-60

Модель: NAVI-60 Кол-во: 1

P/N: см. на упаковке SN: см. на упаковке

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Калибр»

Юридический адрес: 420000, Республика Татарстан, г.

Казань, ул. Московская, д. 13А, помещение 1

тел./факс: Тел. 8-922-182-80-14

Kalibr.kzn@gmail.com



см. на упаковке



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158, Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Наименование: Мобильная стойка NAVI-MS

Модель: NAVI-MS

SN см. на упаковке

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Калибр»

Юридический адрес: 420000, Республика Татарстан, г.

Казань, ул. Московская, д. 13А, помещение 1

тел./факс: Тел. 8-922-182-80-14

Kalibr.kzn@gmail.com



см. на упаковке



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY
CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158,
Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen,
Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортере	
№ Регистрационного удостоверения	
Срок службы	
Условия хранения	
	Наименование изделия
	Модель изделия
	Обозначение требований к источнику электропитания Диапазон входного напряжения, частота напряжения электропитания, максимальная входная мощность блока питания
	Мощность
	Выходная мощность
	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
	Знак соответствия CE и номер
	Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации. Указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с важной информацией инструкции по применению, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут по разным причинам, размещены на медицинском изделии
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
	Обратитесь к Руководству по эксплуатации

LOT	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
	Знак соответствия RoHS
	Обозначение полярности разъёма, центральный отрицательный разъём
	Использовать в закрытых помещениях

2. Маркировка на упаковке:

2.1 Маркировка производителя на упаковке «Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями»

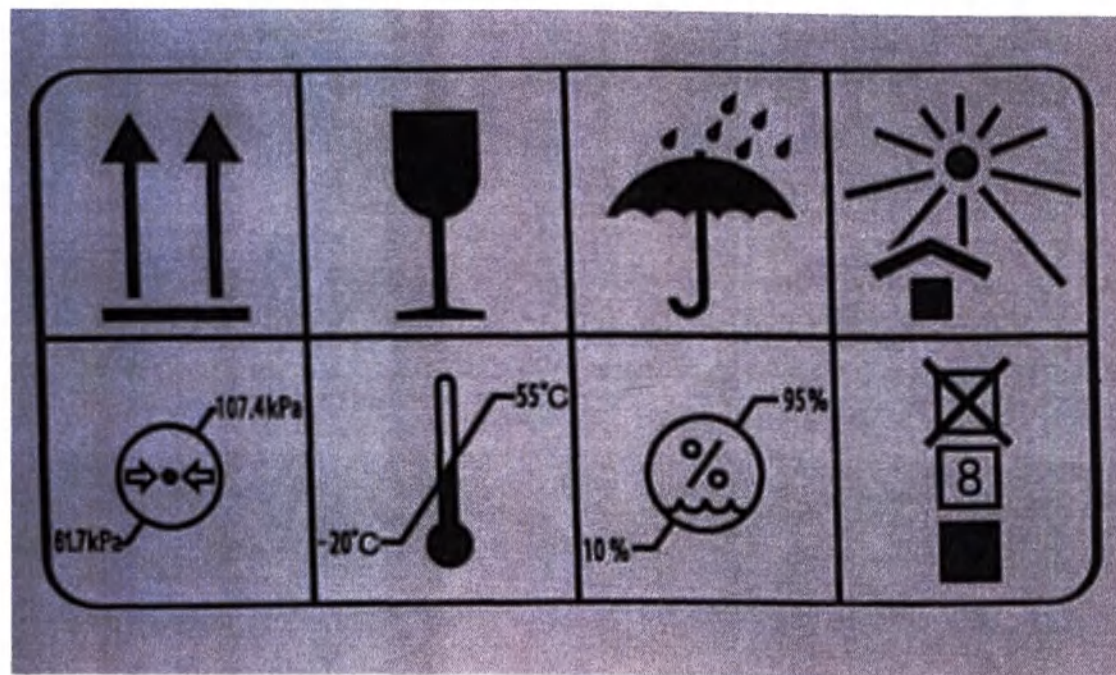

Макет стикера для Российской Федерации «Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями»

Наименование: Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями

Модель: NAVI-60

Кол-во: 1

P/N: см. на упаковке

SN: см. на упаковке

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Калибр»

Юридический адрес: 420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 13А, помещение 1
тел./факс: Тел. 8-922-182-80-14

Kalibr.kzn@gmail.com




MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055
Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Срок службы: не более 5 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

2.2 Маркировка производителя на транспортной упаковке «Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями»

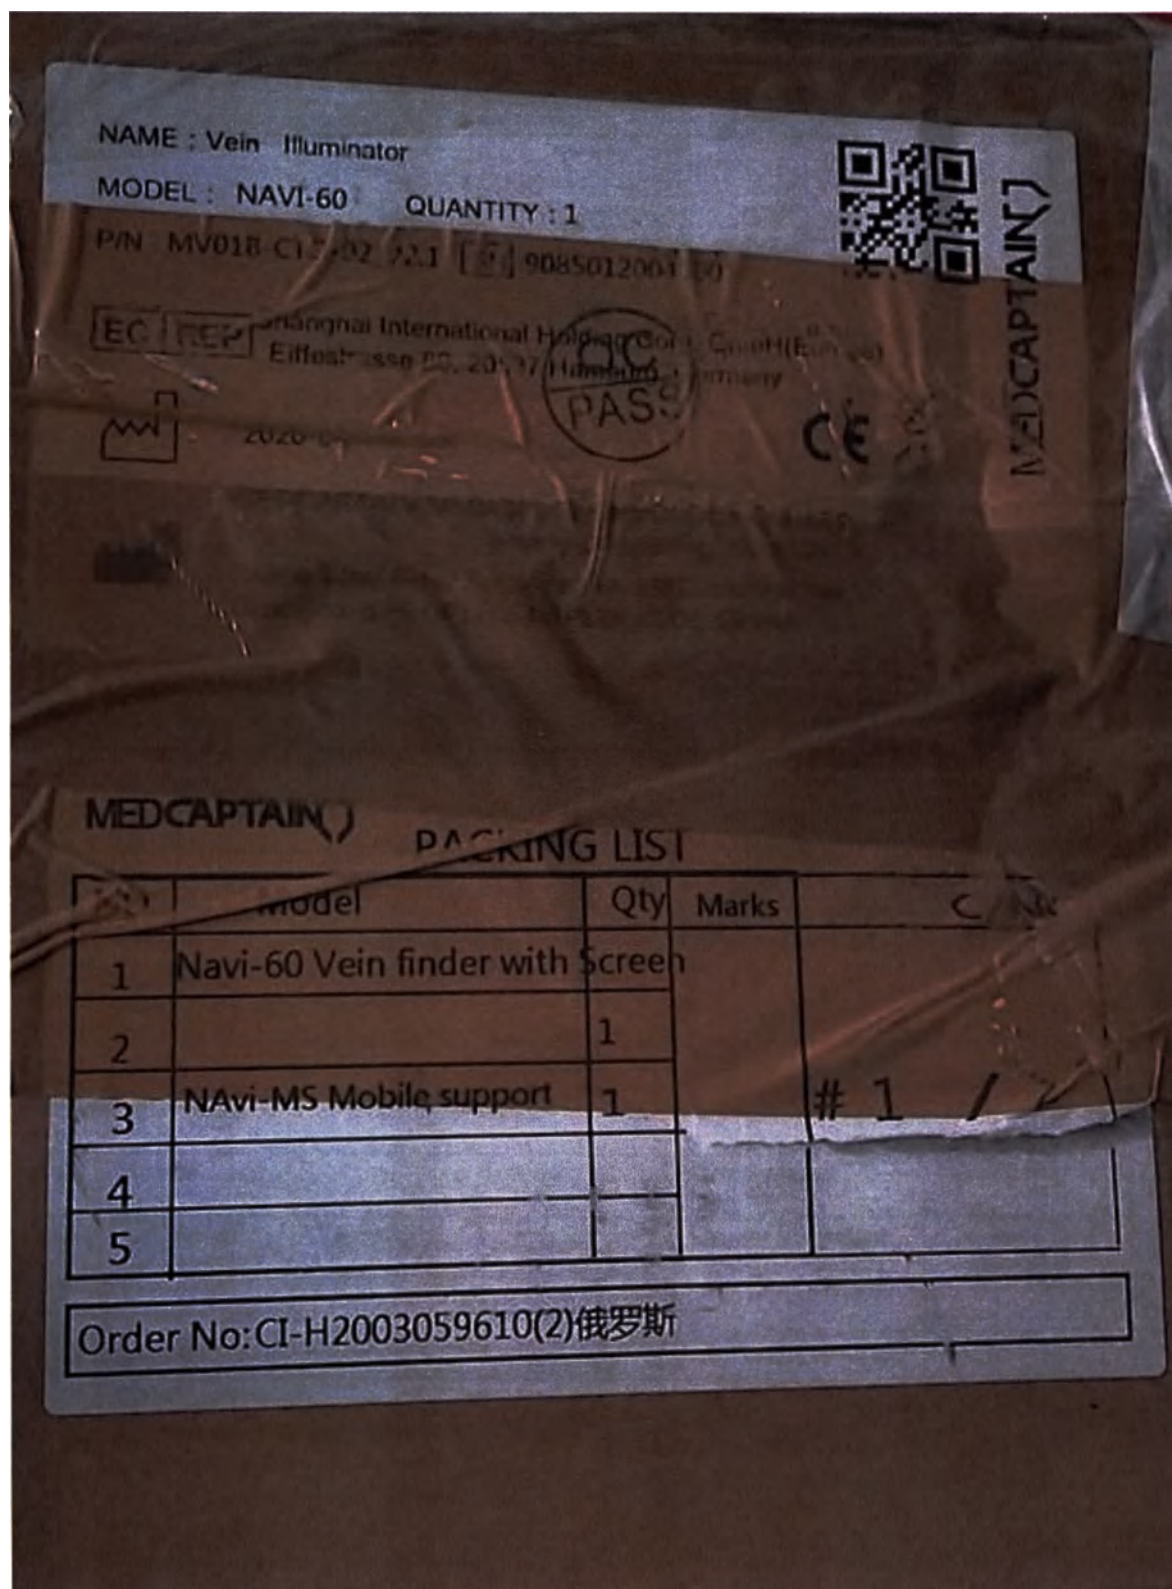



Макет стикера на транспортной упаковке для Российской Федерации «Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями»

Наименование: Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями

Модель: NAVI-60, с принадлежностями

Кол-во: 1

P/N: см. на упаковке

SN: см. на упаковке

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Калибр»

Юридический адрес: 420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 13А, помещение 1
тел./факс: Тел. 8-922-182-80-14

Kalibr.kzn@gmail.com



: см. на упаковке.



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055
Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Срок службы: не более 5 лет

Условия хранения и применения: см. вложенную инструкцию, только для профессионального применения.

Упаковочный лист

№	Модель	Кол-во	Примечание	Номер партии
1	Венолокатор NAVI-60, с принадлежностями	1	См. на упаковке	См. на упаковке
2				
3	Принадлежность Венолокатора NAVI-60, с принадлежностями «Стойка мобильная NAVI-MS»	1		
4				
5				
Номер посылки: см. на упаковке				


2.3 Маркировка производителя на упаковке принадлежности Венолокатора NAVI-60, с принадлежностями «Стойка настольная NAVI-FS»

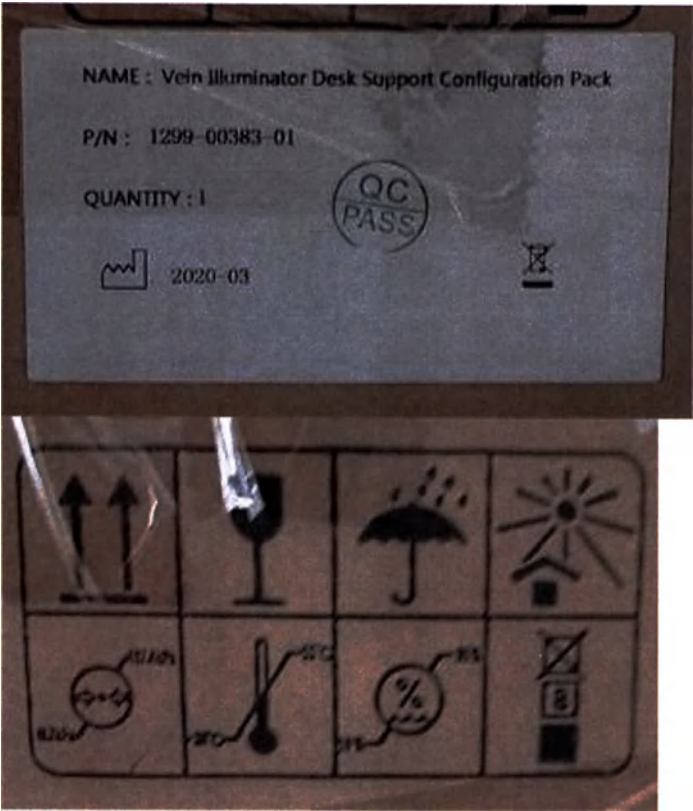

Макет стикера для Российской Федерации с переводом «Устройство для вызова медсестры»

Наименование:	
Принадлежность Венолокатора NAVI-60, с принадлежностями Стойка настольная NAVI-FS	
P/N: см. на упаковке	
Кол-во 1	
	см. на упаковке

Маркировка содержит:

Наименование изделия	
Информация о производителе	
Информация об импортёре	
Срок службы	
Условия хранения	
	Наименование изделия
	Модель изделия

QUANTITY	Количество
P/N :	Заводской номер
SN	Серийный номер: технический код изделия
	Производитель (название и адрес компании)
	Дата производства (год, месяц)
EC REP	Обозначение представителя в ЕС: Включает в себя обозначение представителя в ЕС, название компании, почтовый адрес.
CE 0123	Знак соответствия CE и номер
	УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE): Этот символ используется для защиты окружающей среды, он указывает, что утилизация электрооборудования и электронного оборудования не должна проводиться как утилизация несортированных отходов, а должна проводиться отдельно.
LOT	Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
	«Пределы температуры» Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
	«Хрупкое. Осторожно.» Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	«Беречь от влаги» Необходимость защиты груза от воздействия влаги
	«Беречь от солнечных лучей» Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	«Вверх» Указывает правильное вертикальное положение груза
	«Диапазон влажности» Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	«Ограничение атмосферного давления» Указывает значения атмосферного давления, в пределах которых медицинское изделие надежно сохраняется
	Максимальное количество одинаковых грузов, которое можно штабелировать один на другой, где n-предельное количество ярусов


3. Транспортная упаковка:

Основной блок NAVI-60 помещается в полупрозрачный полиэтиленовый пакет, который помещается в амортизирующий материал (вспененный полиэтилен) и укладывается в картонную коробку.

Принадлежности упакованы в полиэтиленовый пакет

Коробка с основным блоком и коробка с принадлежностями упаковывается в картонный короб.



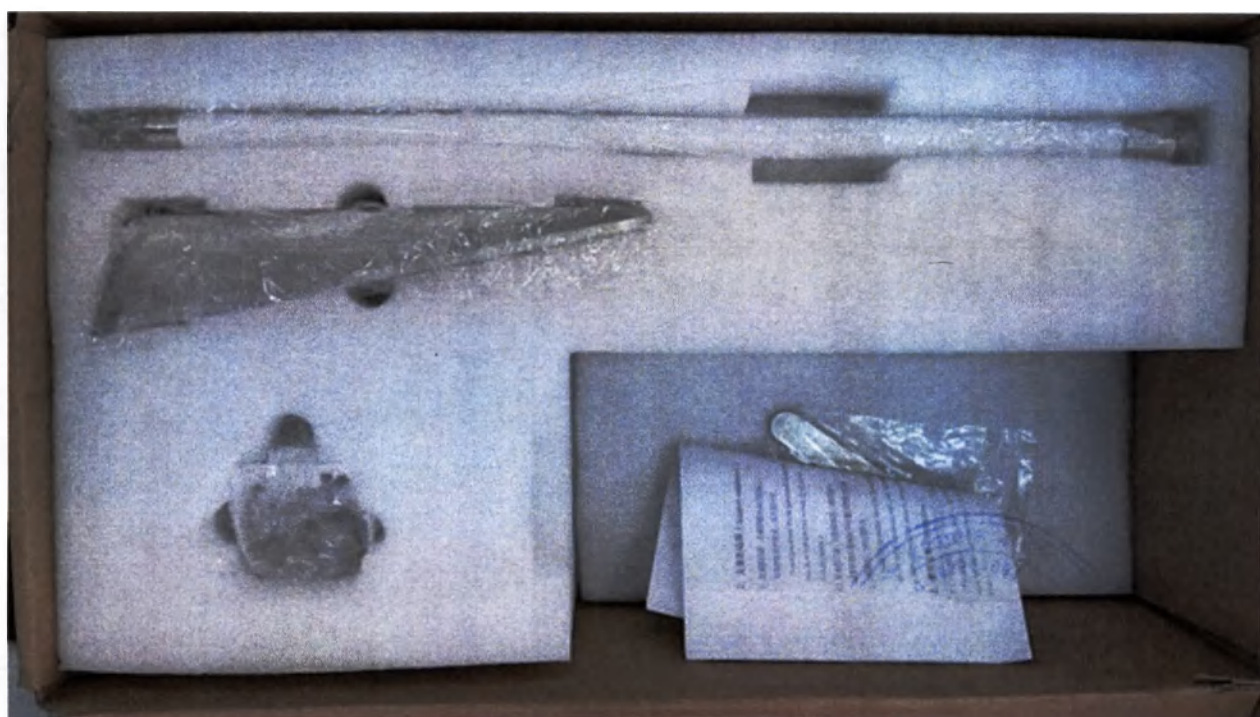

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов
Подпись _____



М.П.