

Общество с ограниченной ответственностью
«ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

.....
640014 Курган ул. М. Ульяновой, д. 4, литера «А»
ИНН / КПП 4501198937 / 450101001 ОГРН 1144501037999

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»



И.А. Белов

201 6 г.

М.П.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Система электростимуляции
центральной нервной системы «ЭлСИ.10.ice»
поТУ 9444-003-11059002-2015 в составе
(см. Приложение на 1 листе)»

ООО «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Россия, 640014, Курганская область,
г. Курган, ул. Марии Ульяновой, д. 4

2016 г.

Система электростимуляции центральной нервной системы «ЭлСИ.10.ice»

Электрод лепестковый

Электрод плоский спинальный

Электрод цилиндрический для тестовой стимуляции

Электрод цилиндрический для постоянной (хронической) стимуляции

Промежуточный кабель

Якорь электрода
(не более 2 шт. к
одному электроду)

Модуль обмена и заряда

Генератор ГА.4

Генератор ГБ.4

Генератор ГТ

Туннелизатор

Проводник для установки
цилиндрических электродов

Отвертка динамометрическая

Зарядное устройство

Пульт Управления -
Программатор

Генератор импульсов в вариантах исполнения:

ГБ-1
















Электроды в вариантах исполнения:


Электроды цилиндрические для тестовой стимуляции, вариант 8 контактов, дистальный шаг 4 мм, длина 450 мм




Электроды цилиндрические для тестовой стимуляции, вариант 4 контакта, дистальный шаг 6 мм, длина 450 мм

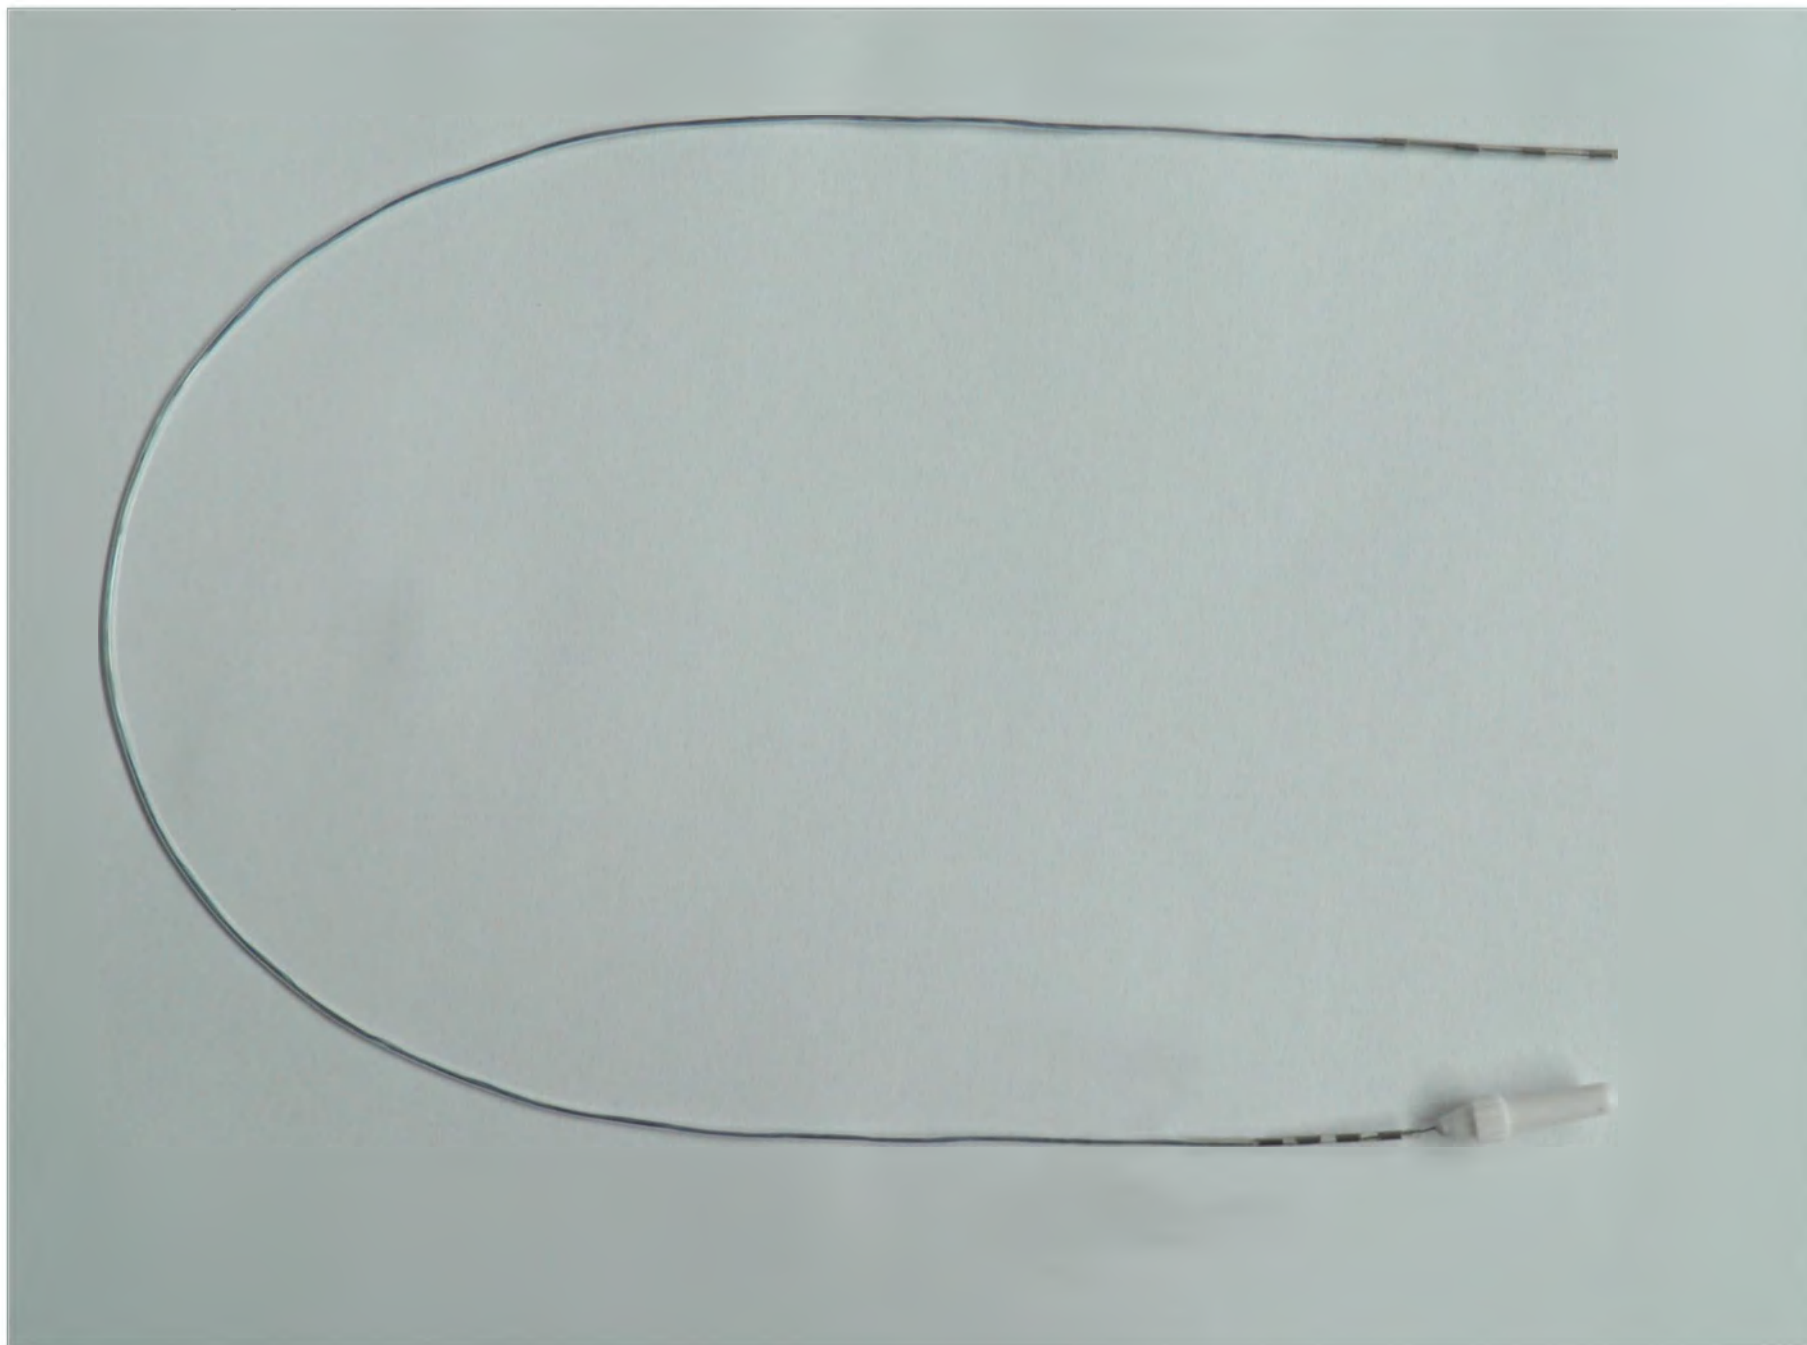

Электроды цилиндрические для тестовой стимуляции, вариант 4 контакта, дистальный шаг 9 мм, длина 450 мм

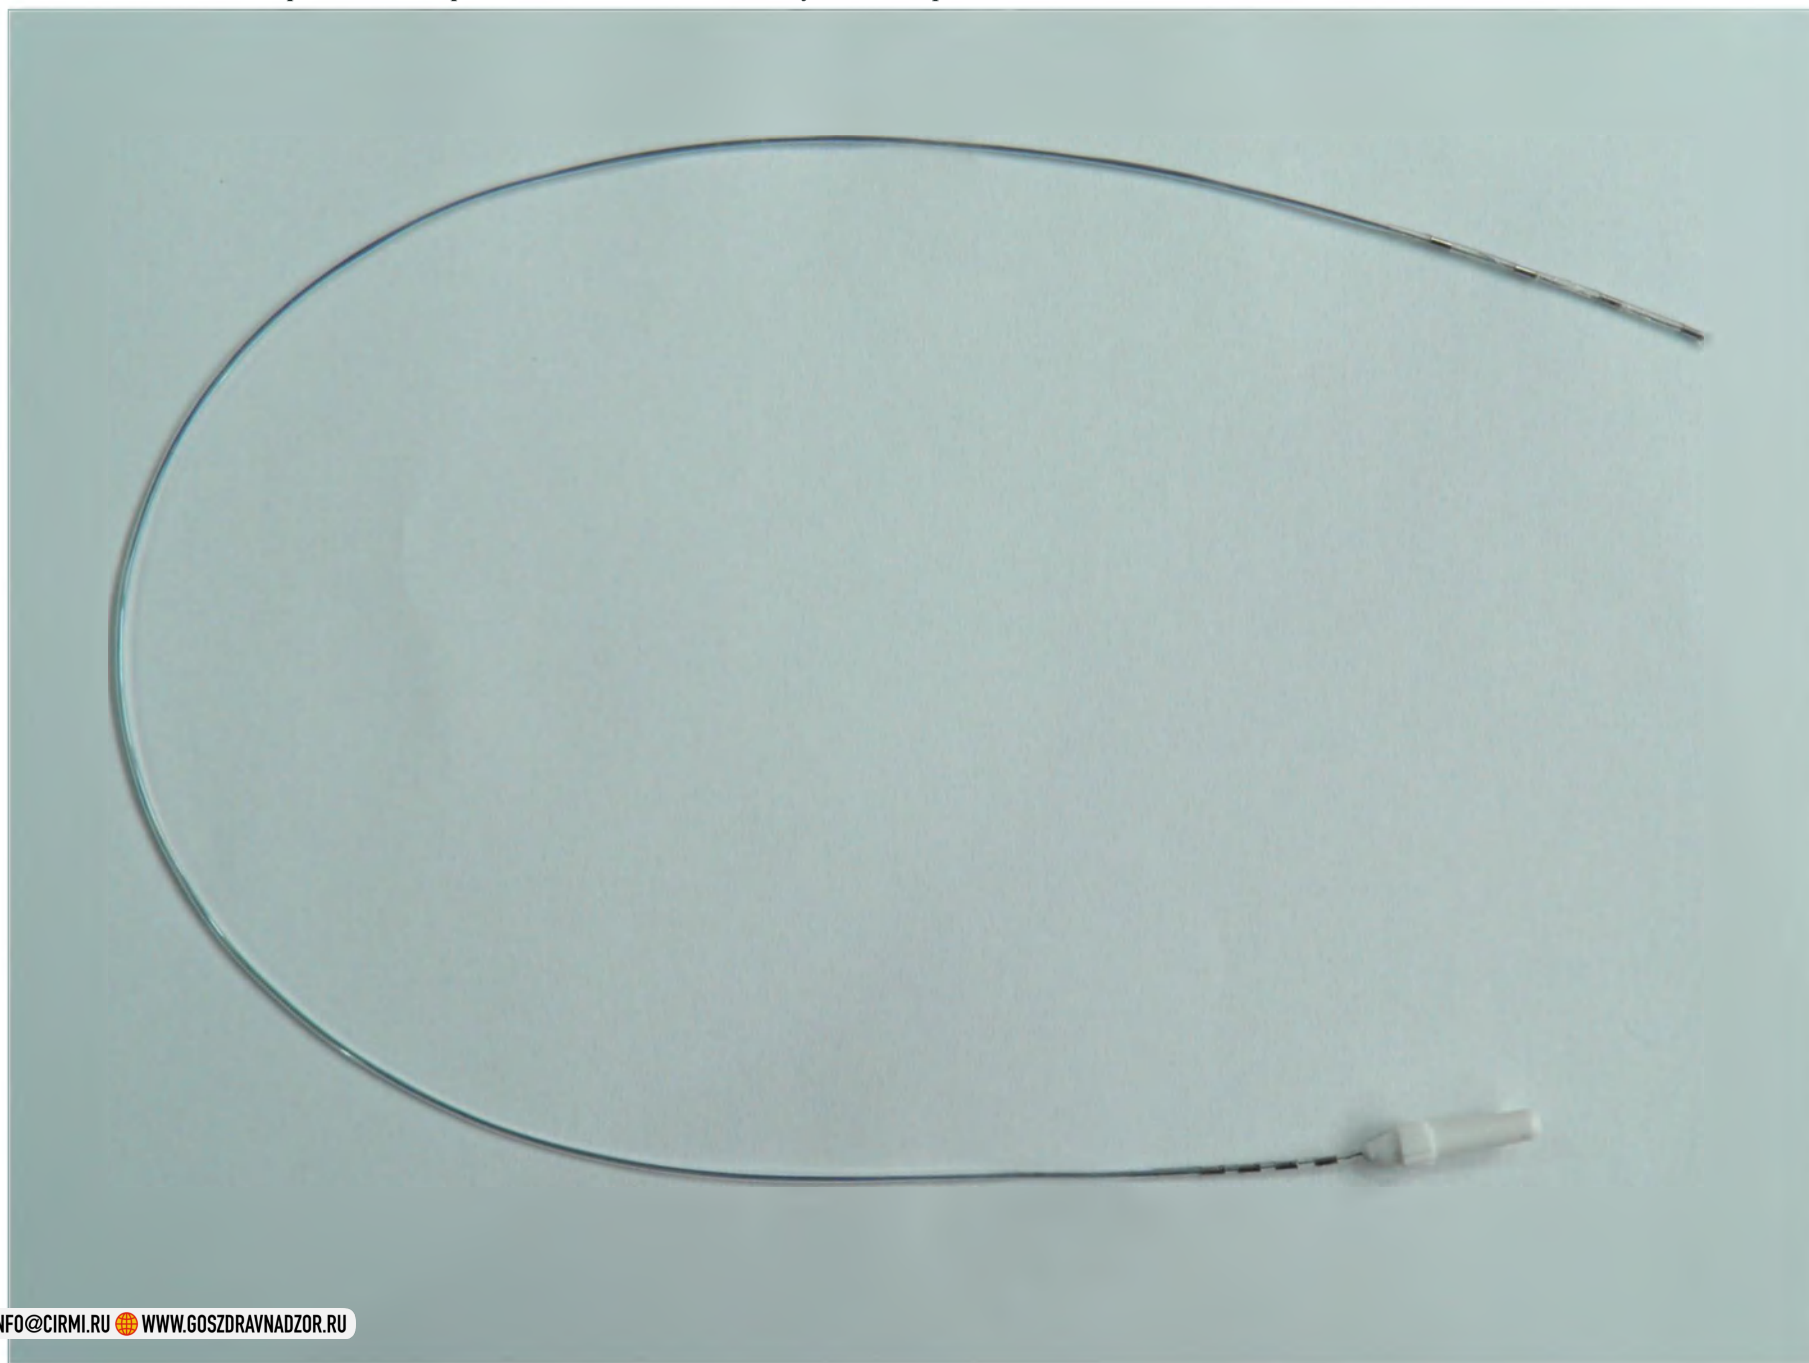


Электроды цилиндрические для тестовой стимуляции, вариант 4 контакта, дистальный шаг 12 мм, длина 450 мм

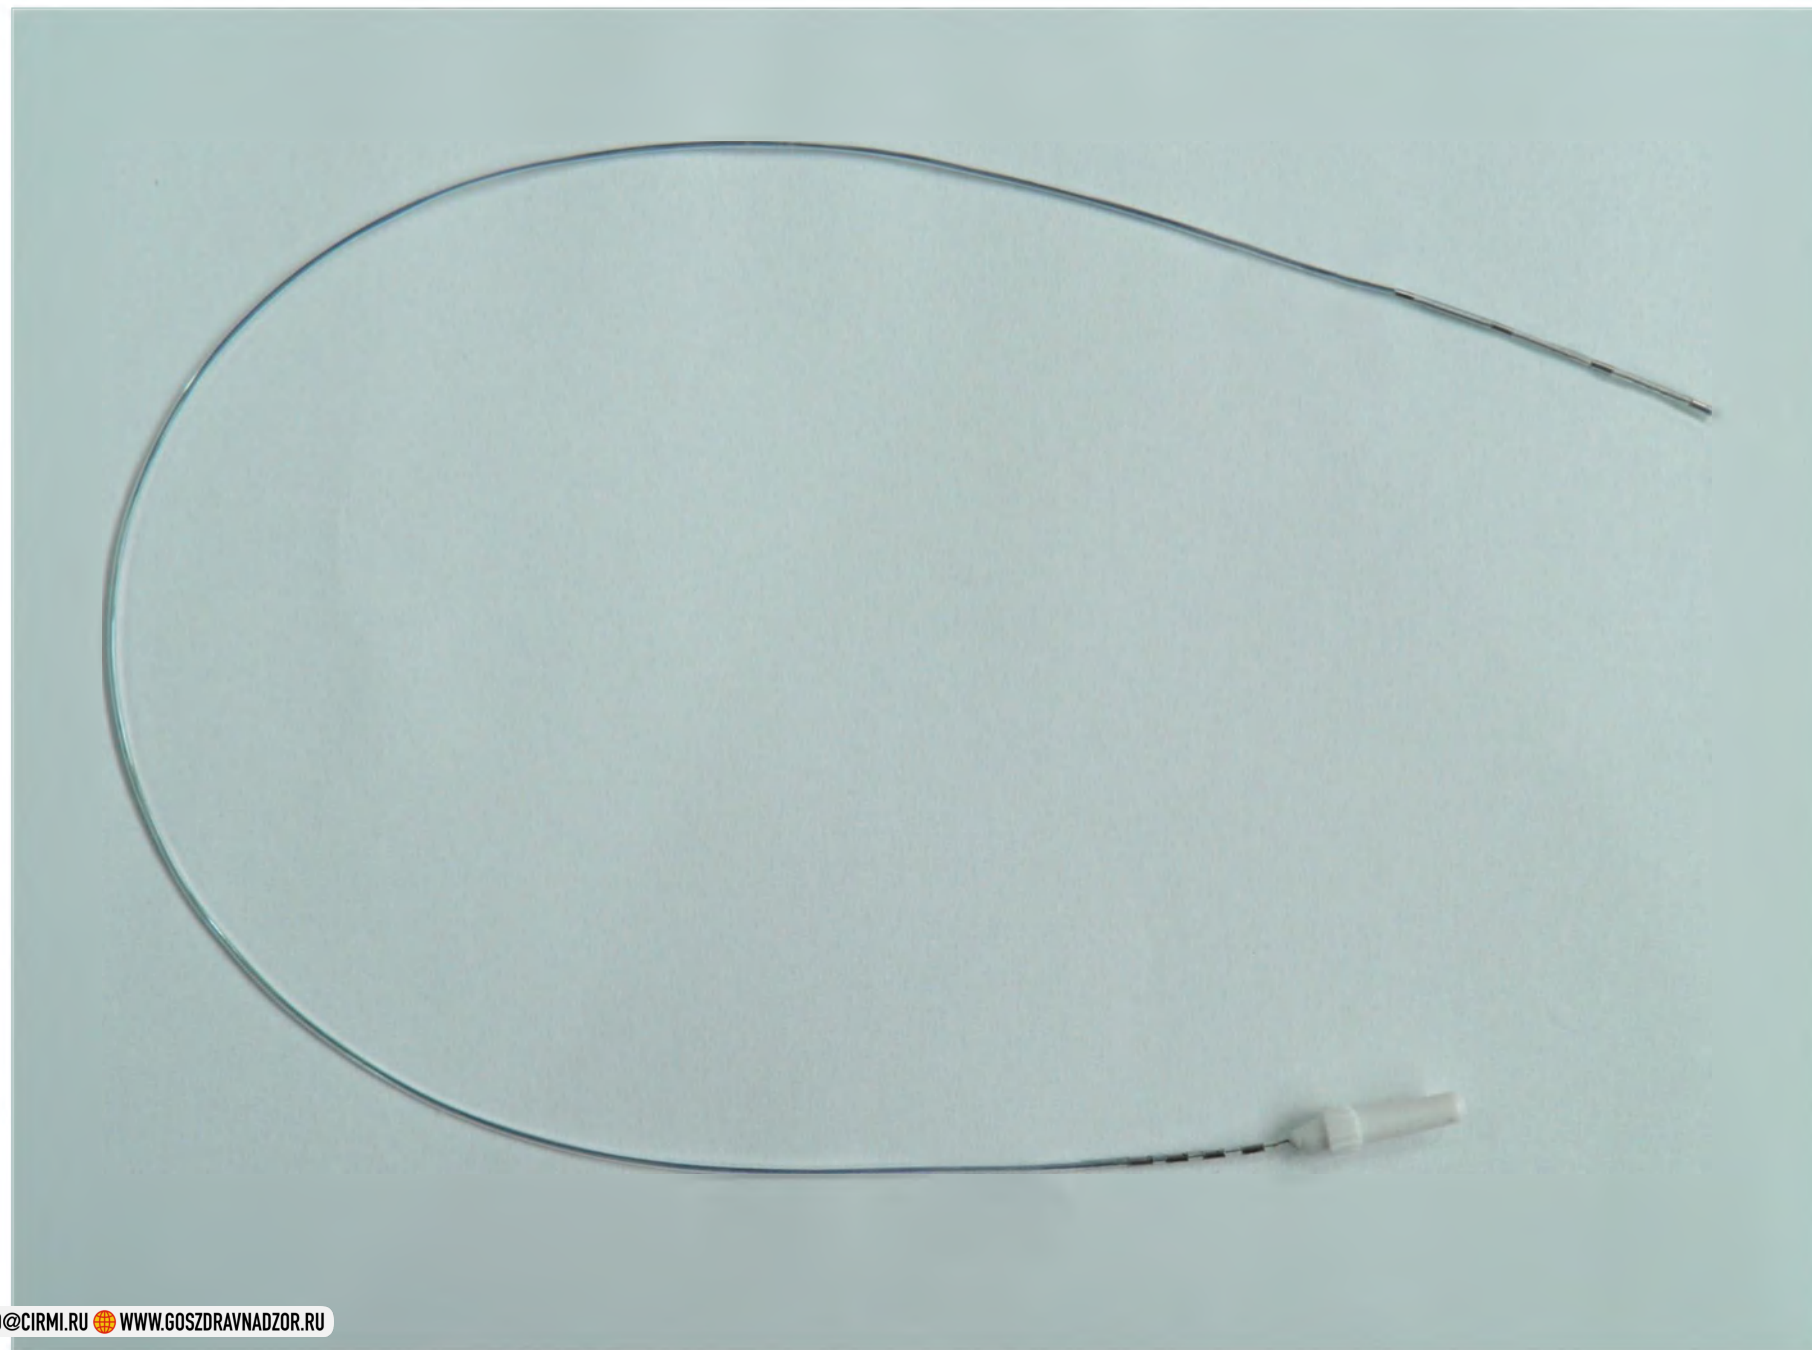


Электроды цилиндрические для постоянной (хронической) стимуляции, вариант 8 контактов, дистальный шаг 4 мм, длина 450 мм




Электроды цилиндрические для постоянной (хронической) стимуляции, вариант 4 контакта, дистальный шаг 6 мм, длина 450 мм

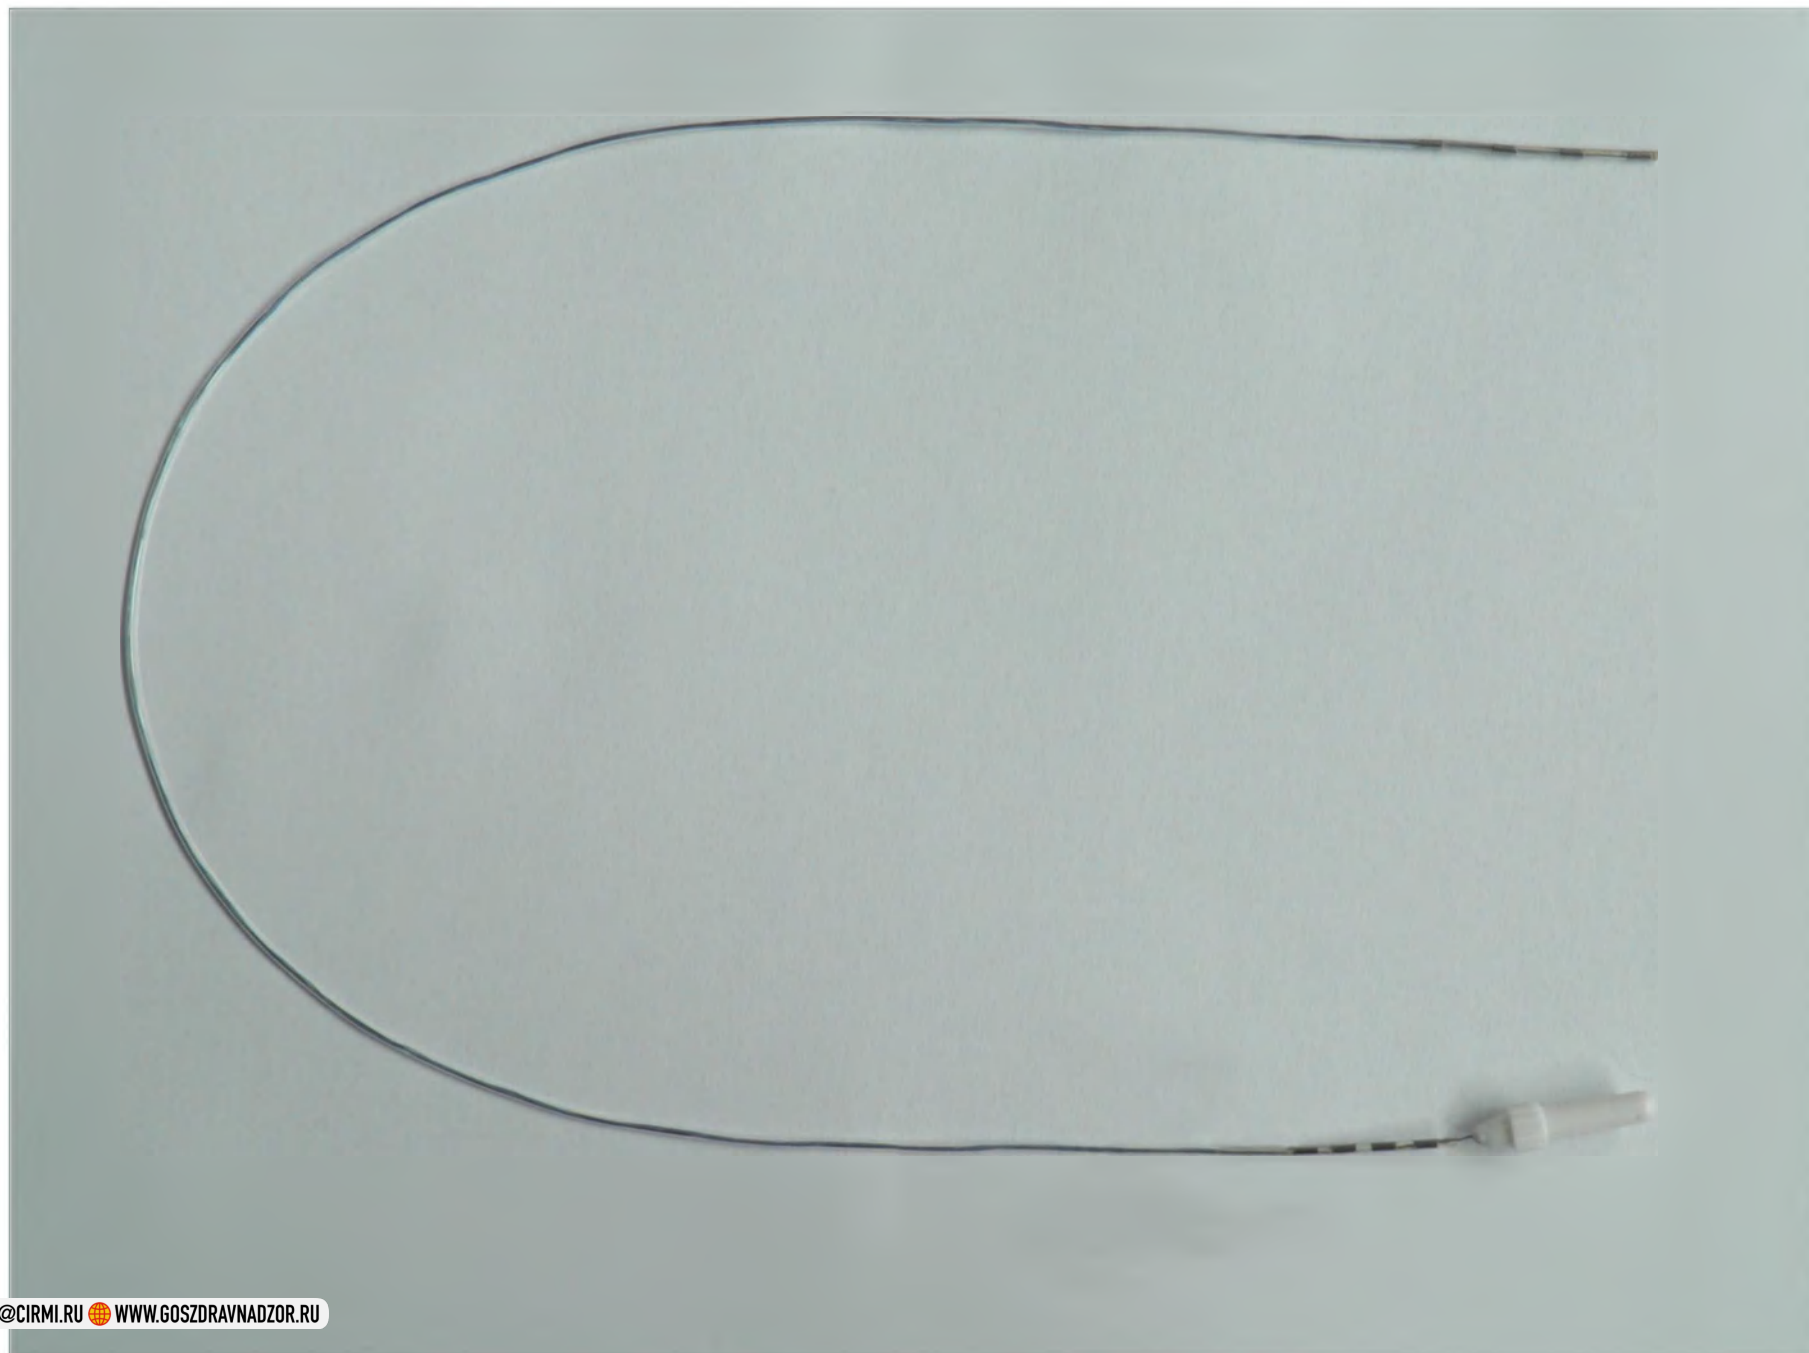


Электроды цилиндрические для постоянной (хронической) стимуляции, вариант 4 контакта, дистальный шаг 9 мм, длина 450 мм

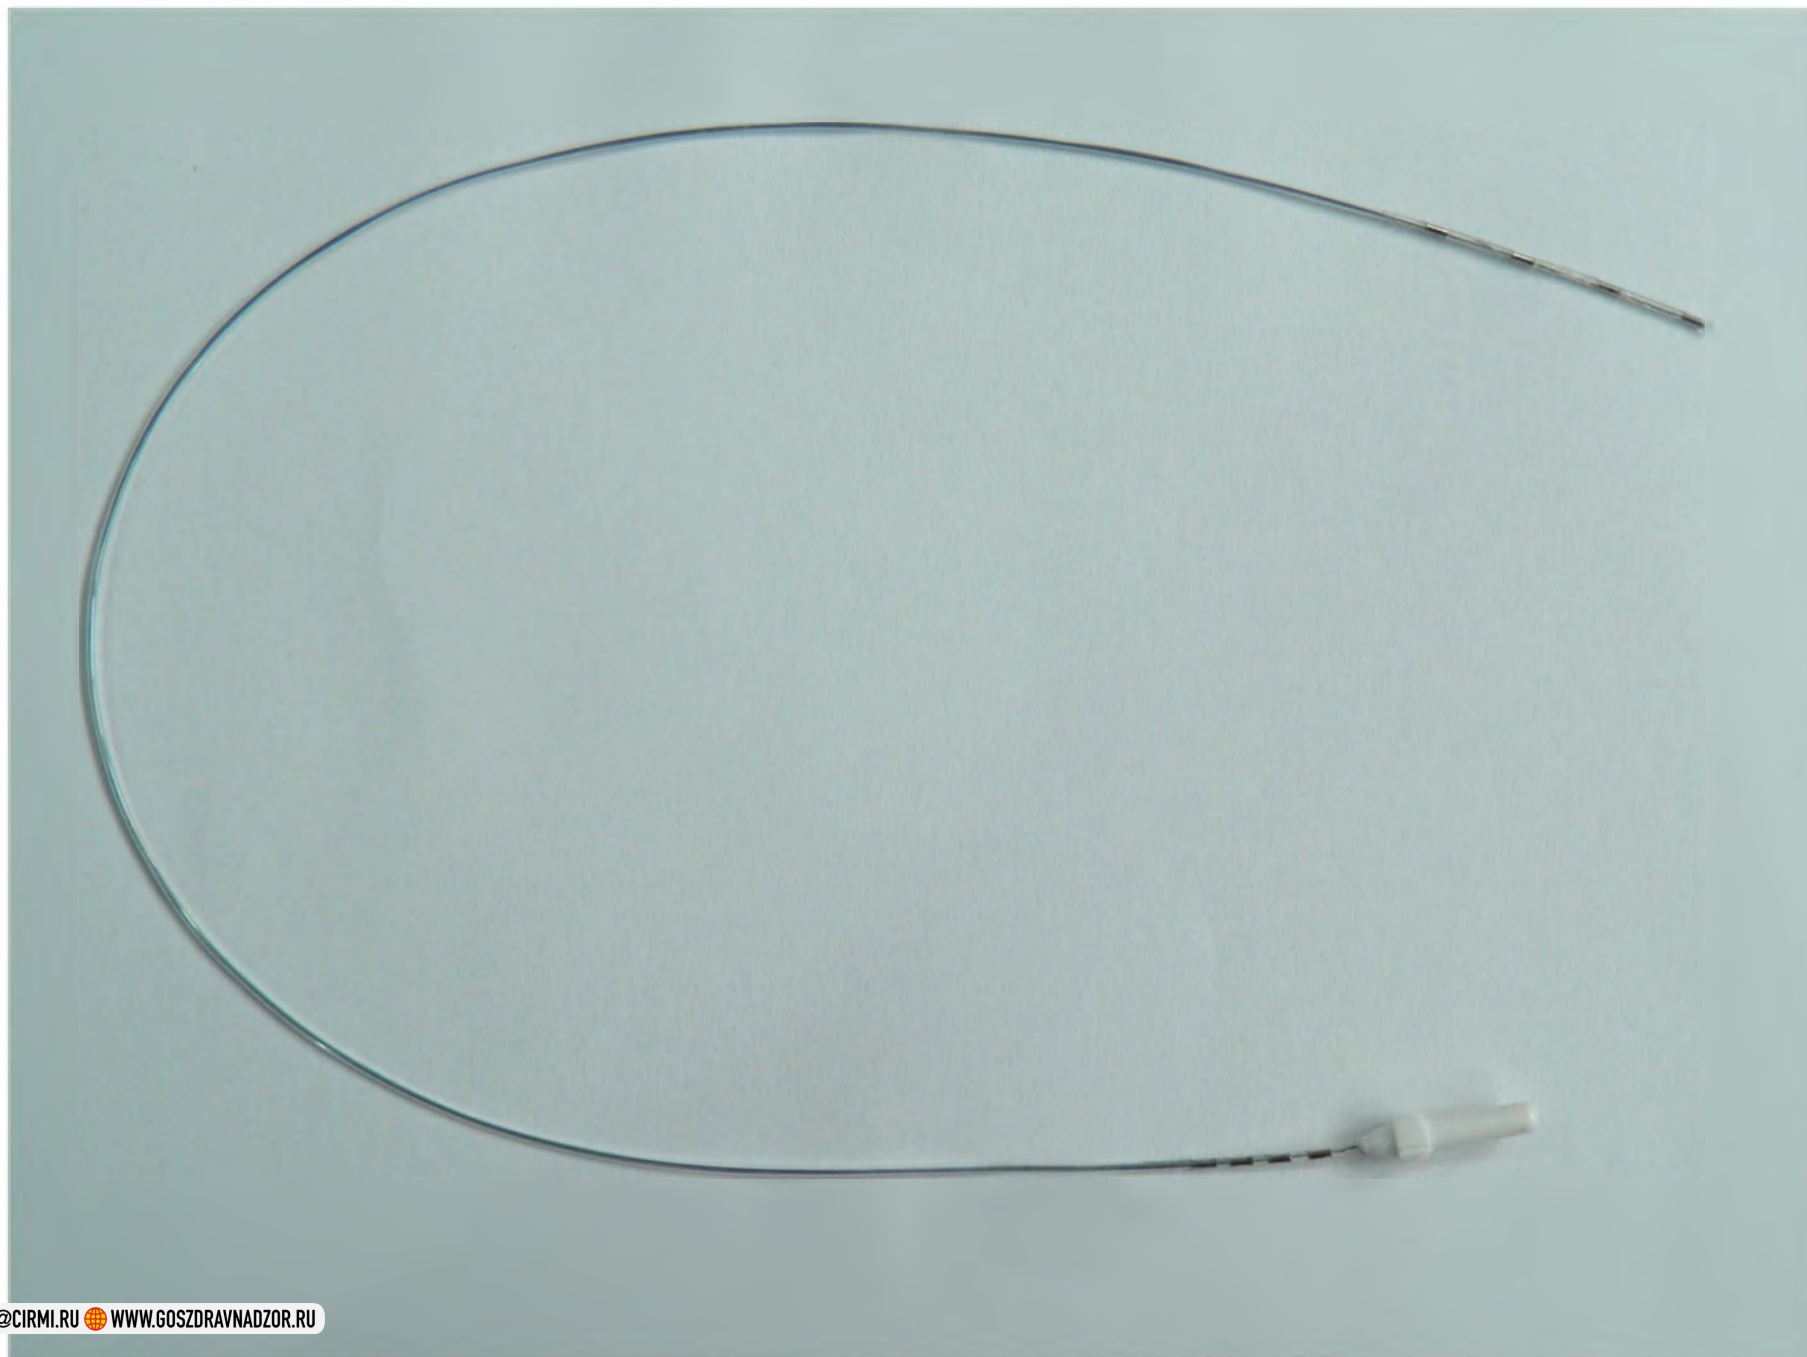


Электроды цилиндрические для постоянной (хронической) стимуляции, вариант 4 контакта, дистальный шаг 12 мм, длина 450 мм

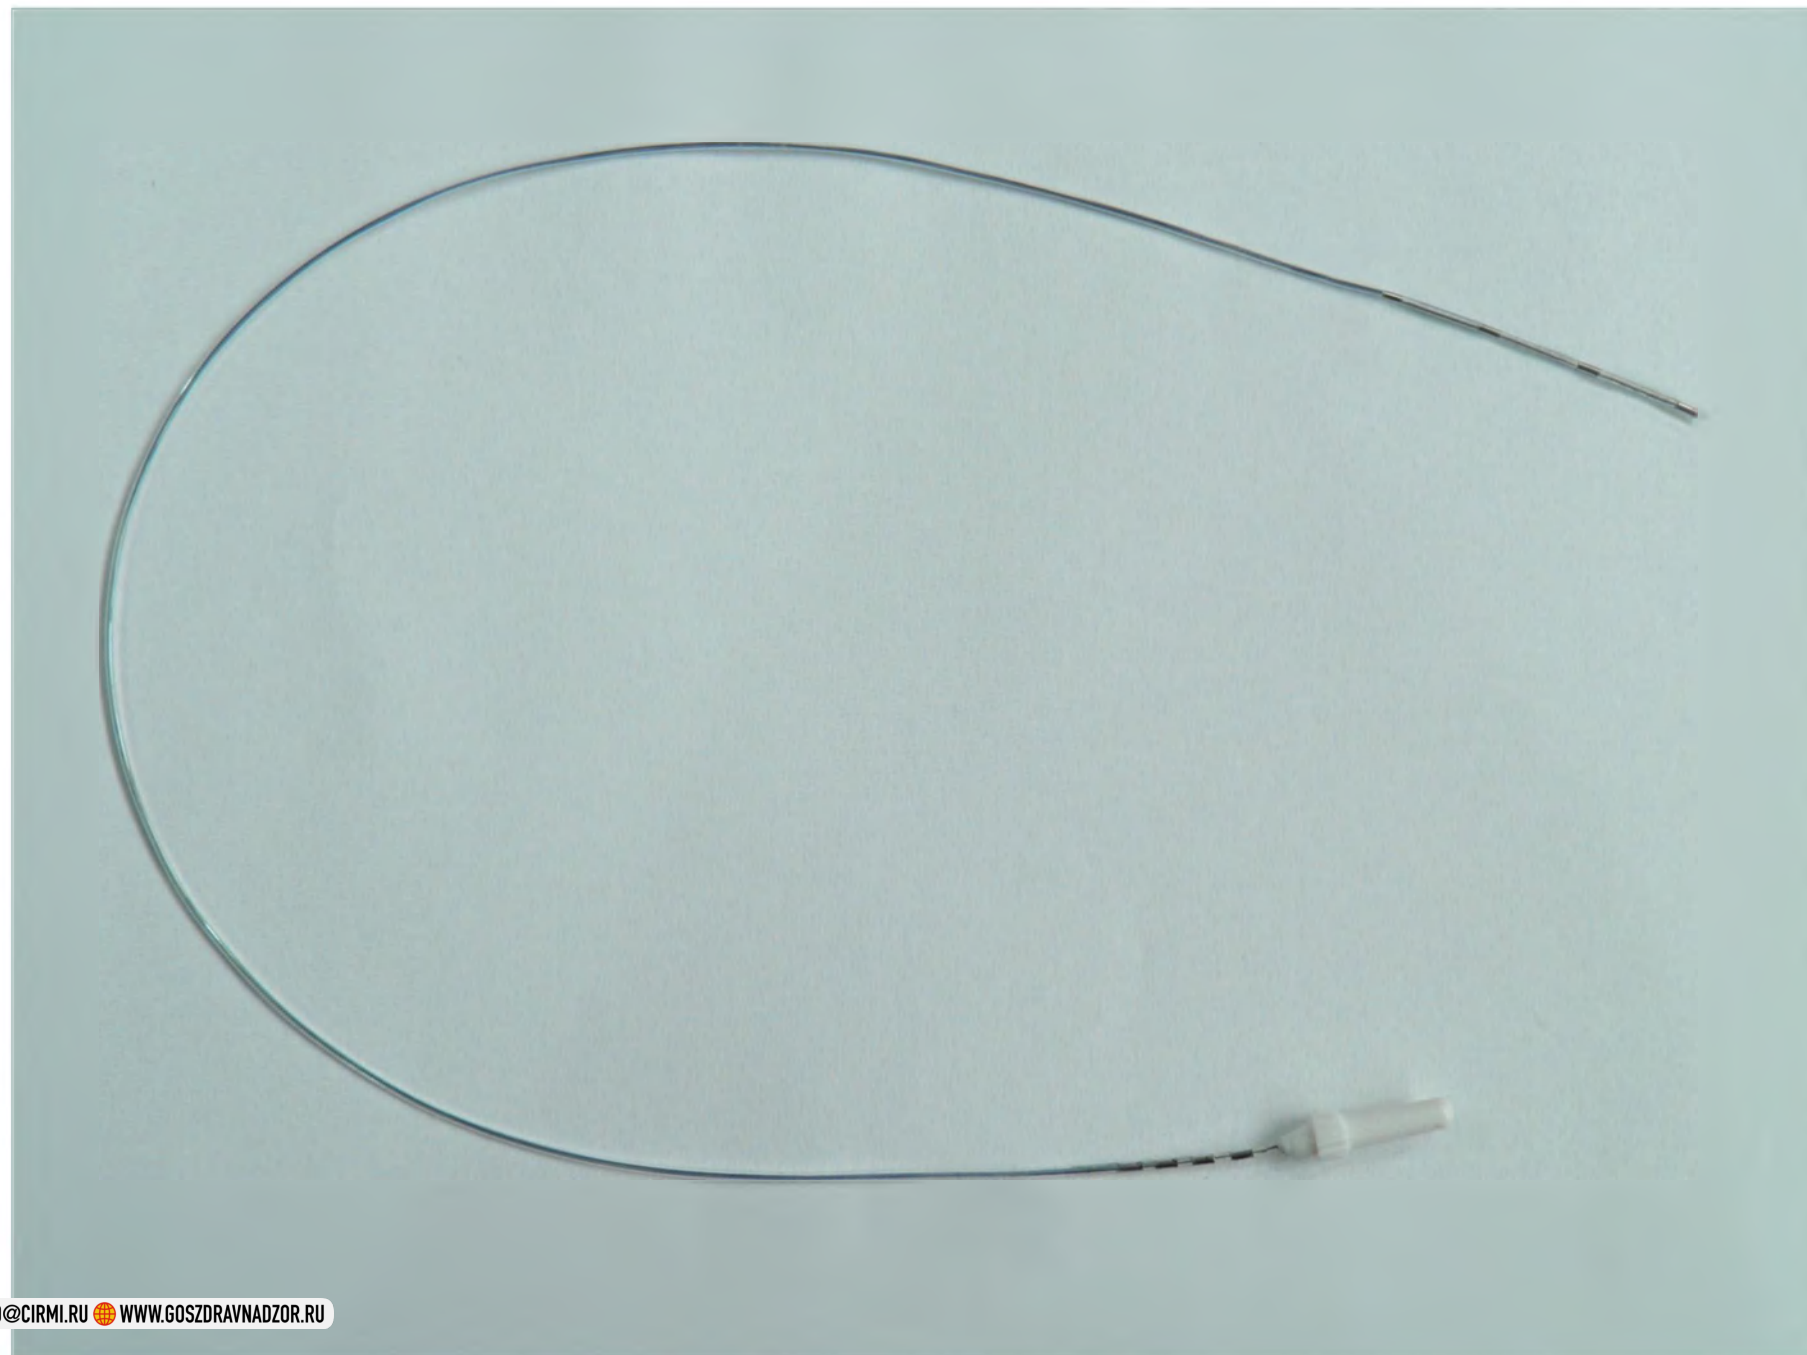


Электроды плоские спинальные, вариант 4 контакта, длина 450 мм

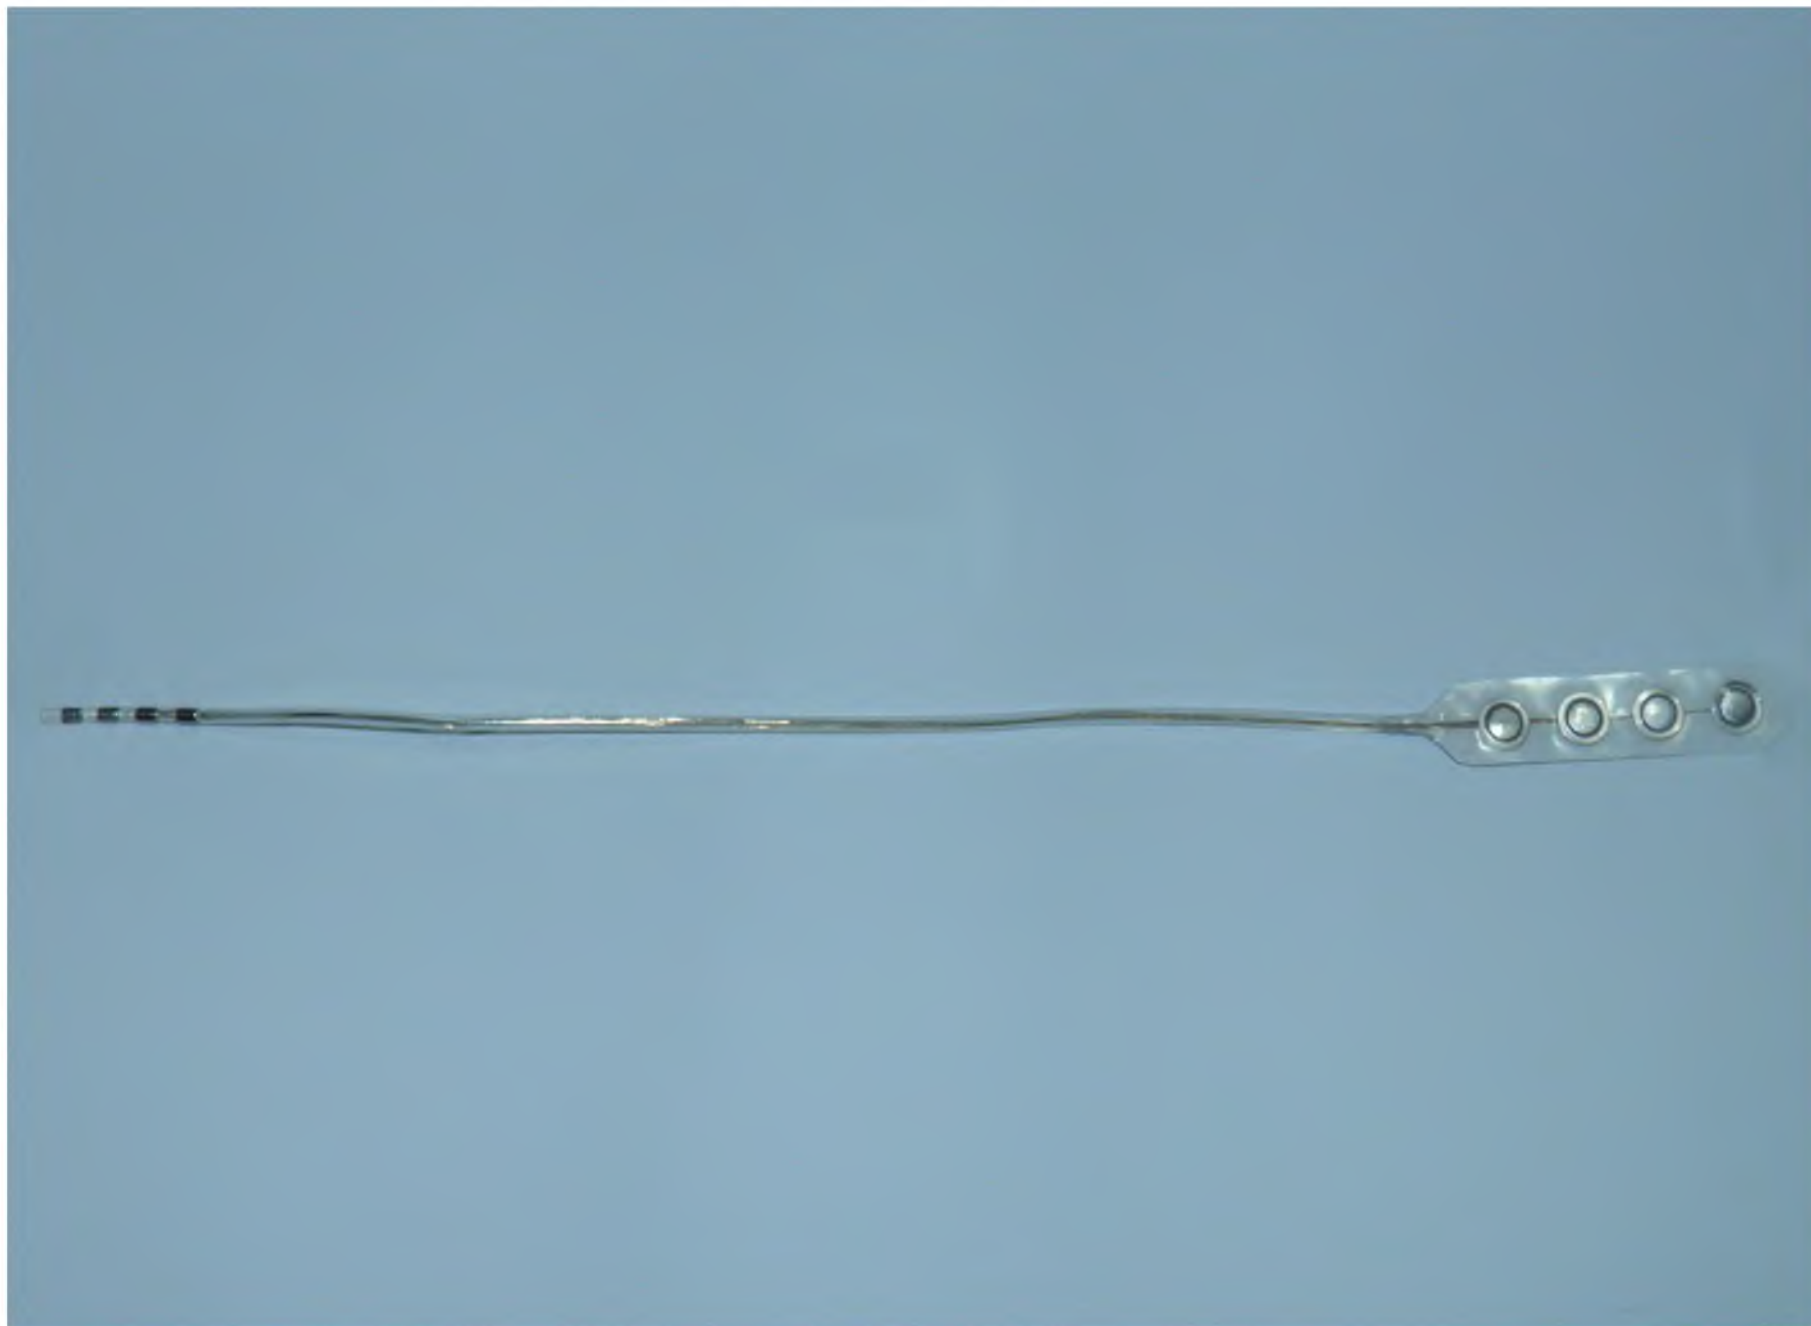

Электроды плоские спинальные, вариант 8 контактов, длина 450 мм

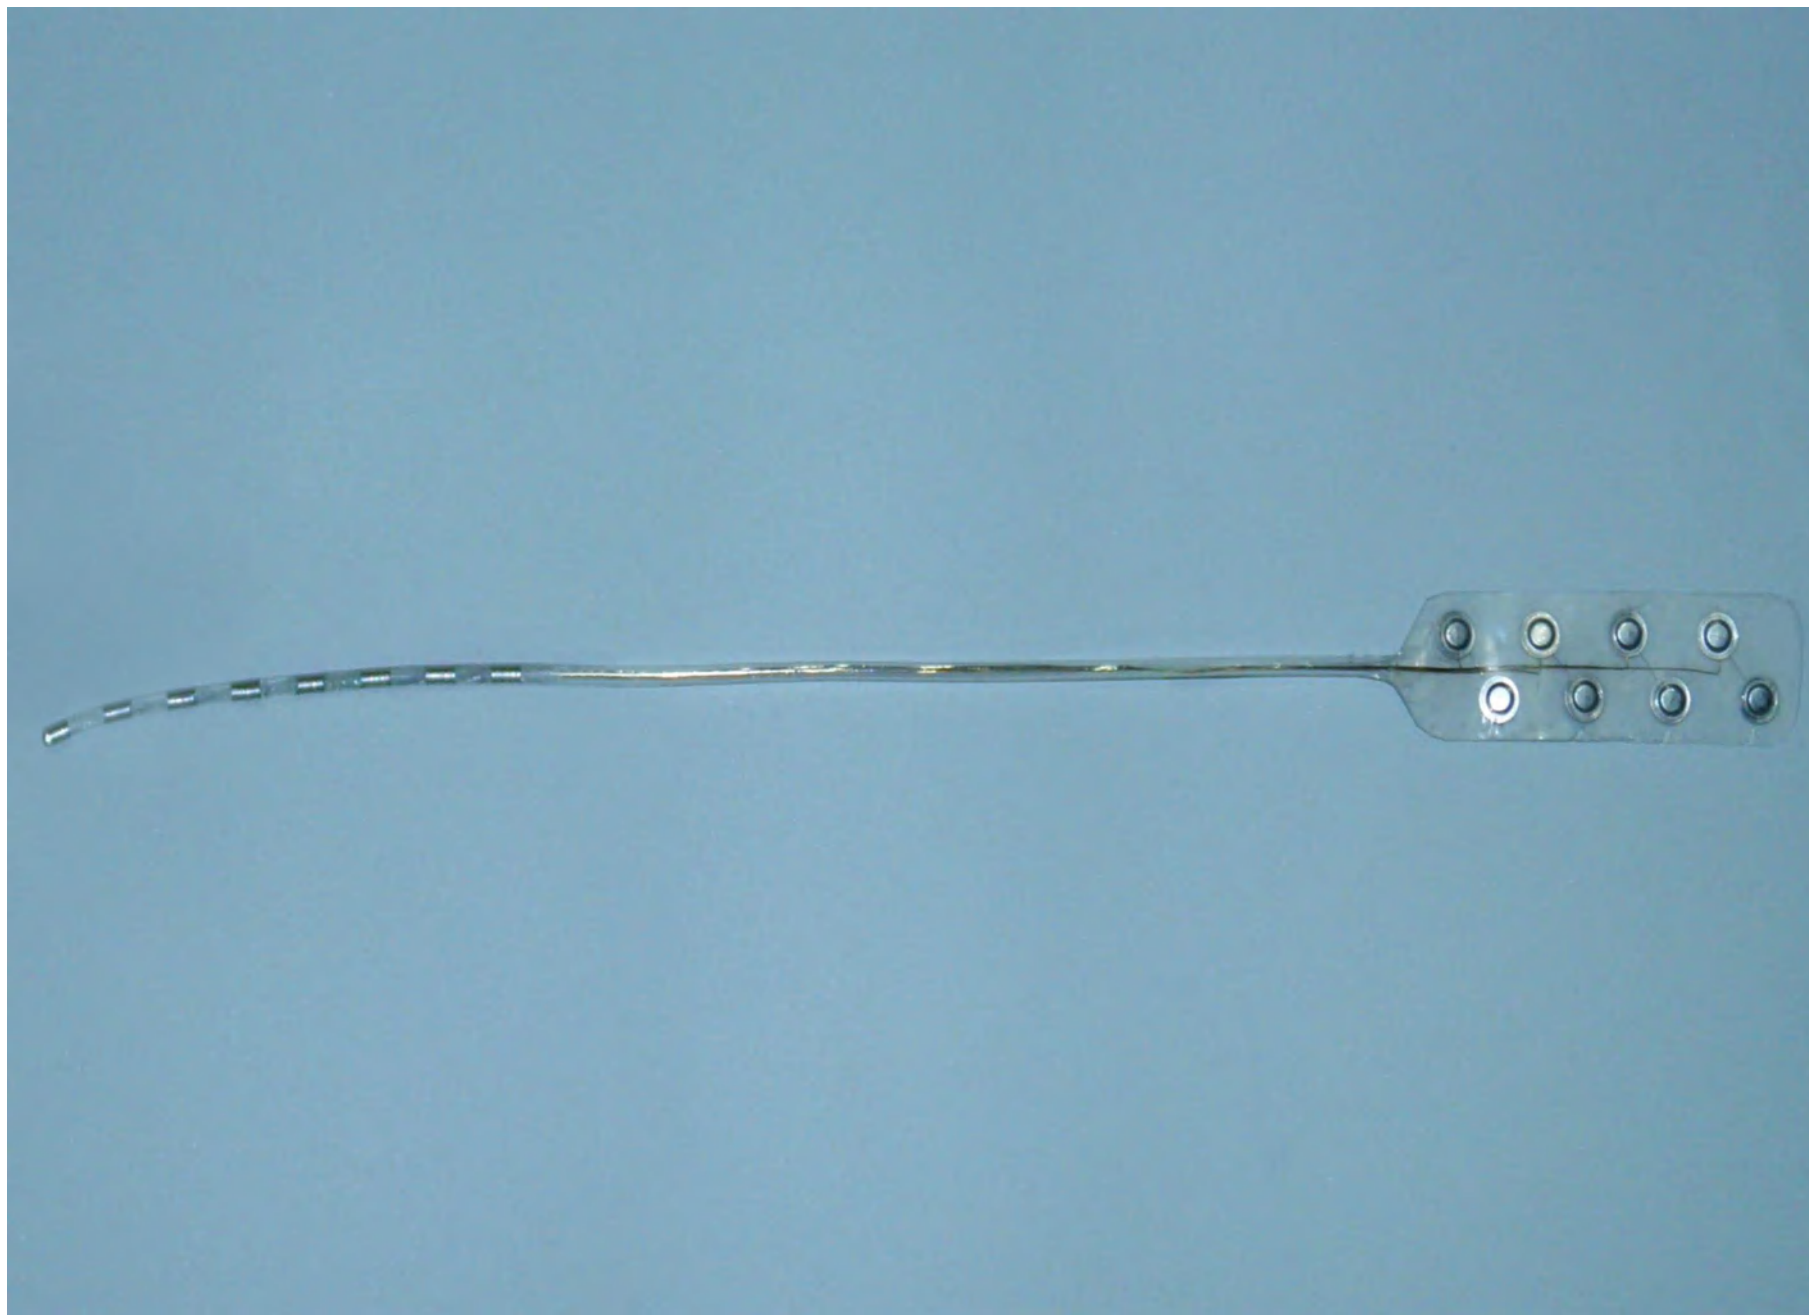


Электроды лепестковые, вариант 2 контакта, длина 200 мм

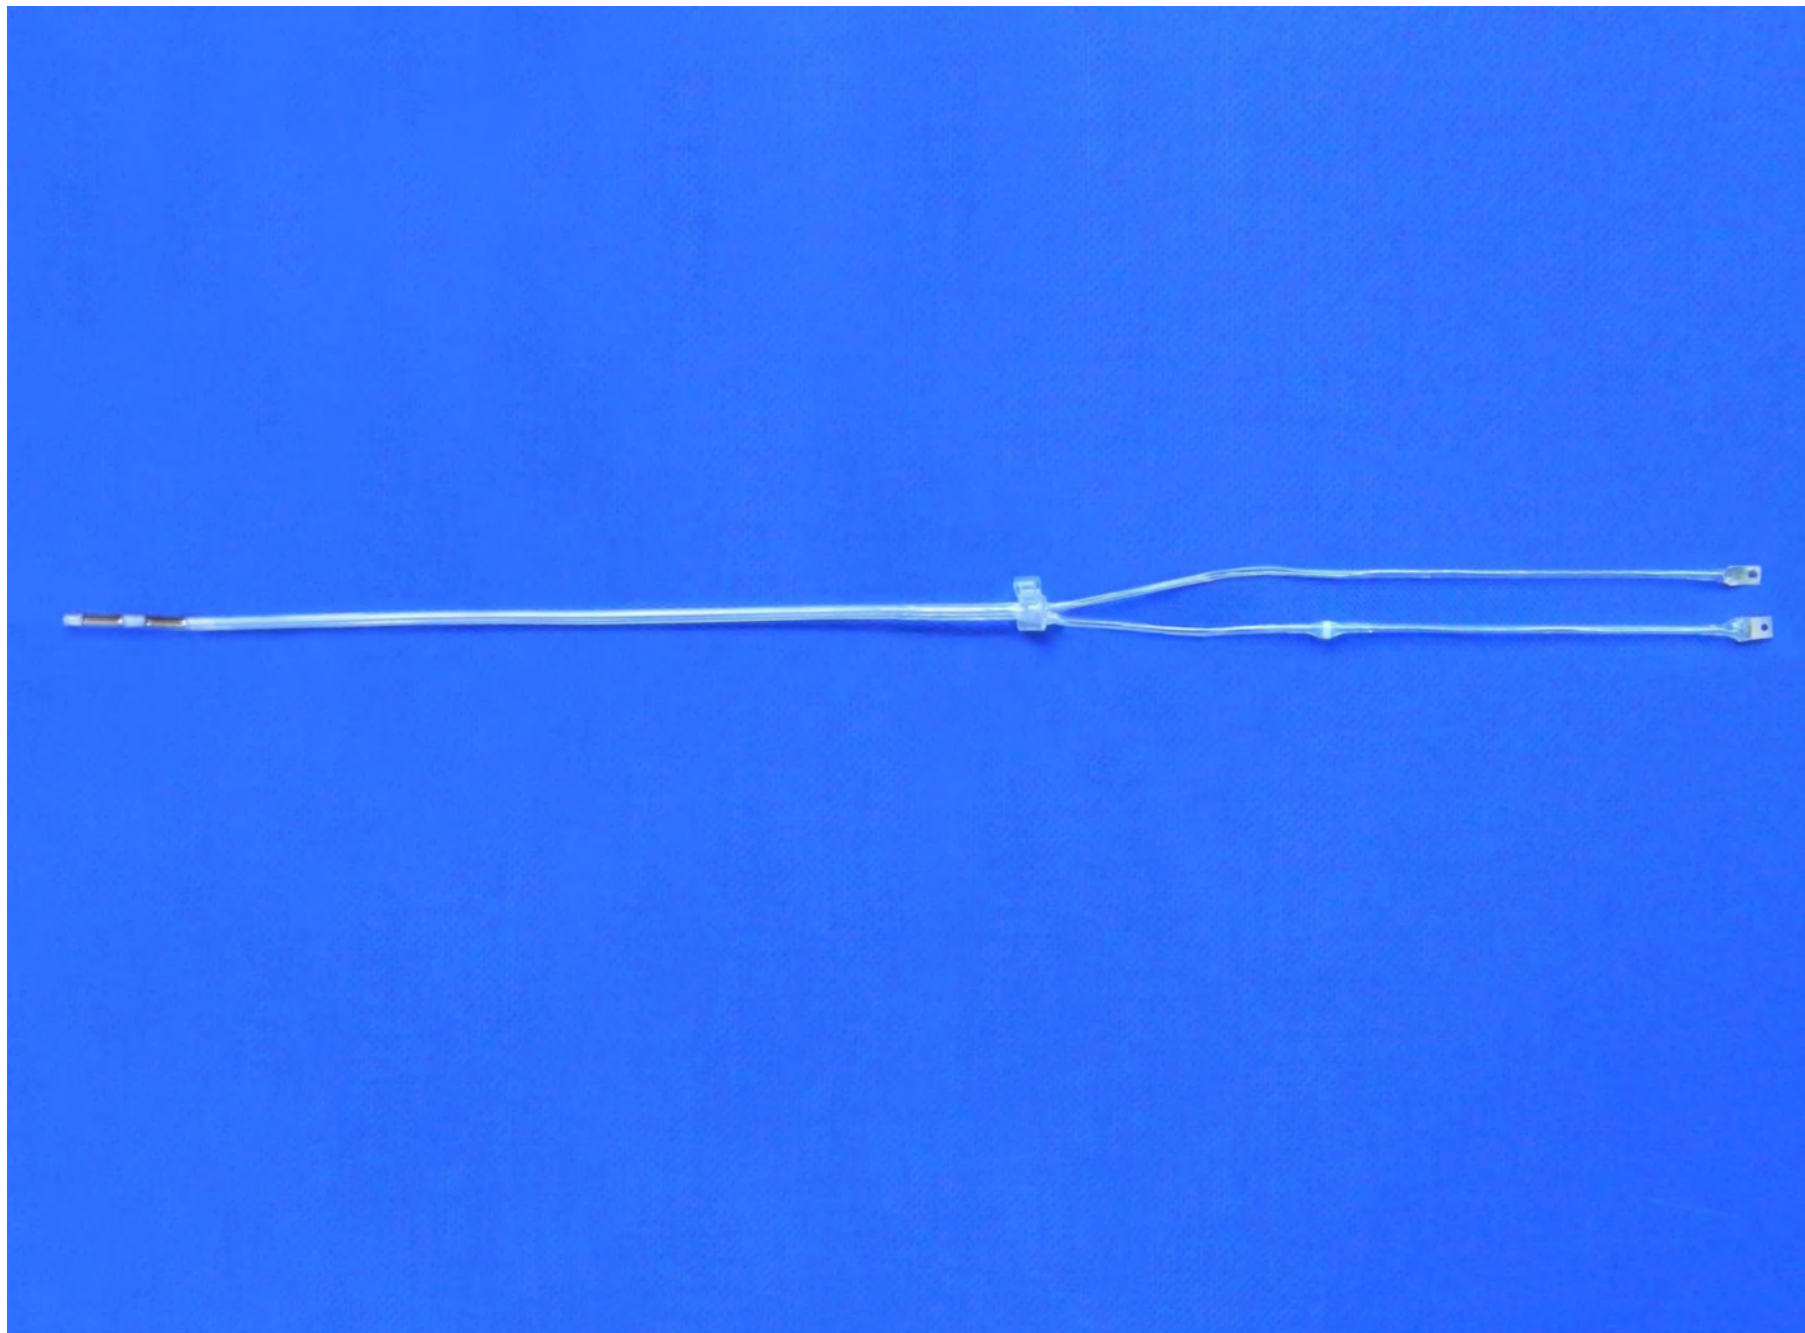


Электроды лепестковые, вариант 4 контакта, длина 200 мм




Электроды лепестковые, вариант 8 контактов, длина 200 мм

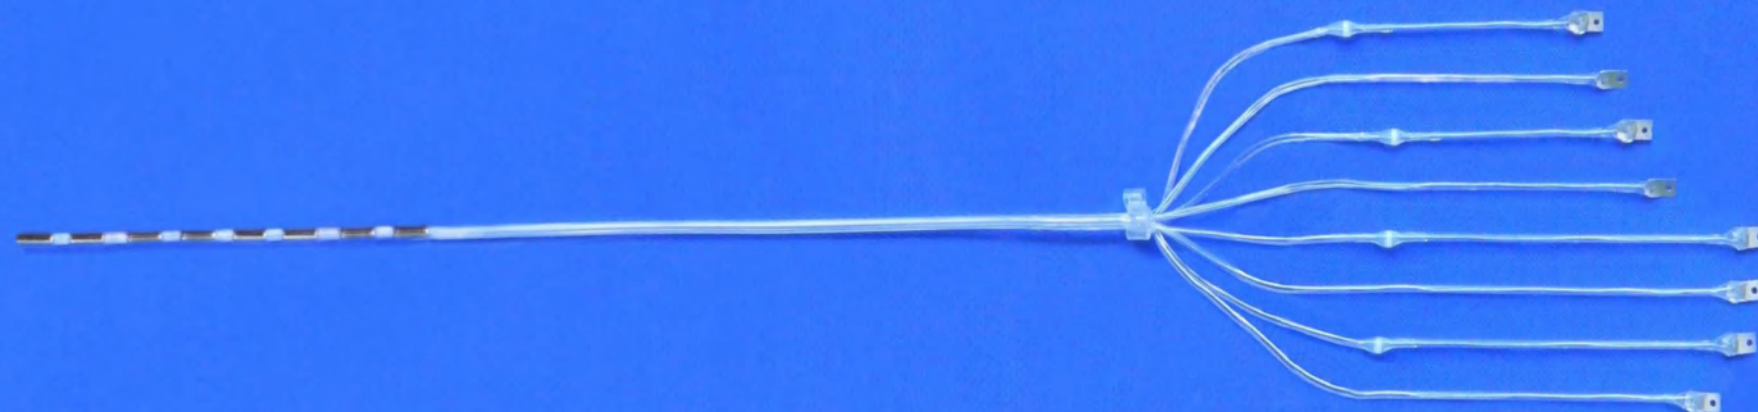


Промежуточный кабель, вариант 4 контакта, длина 450 мм

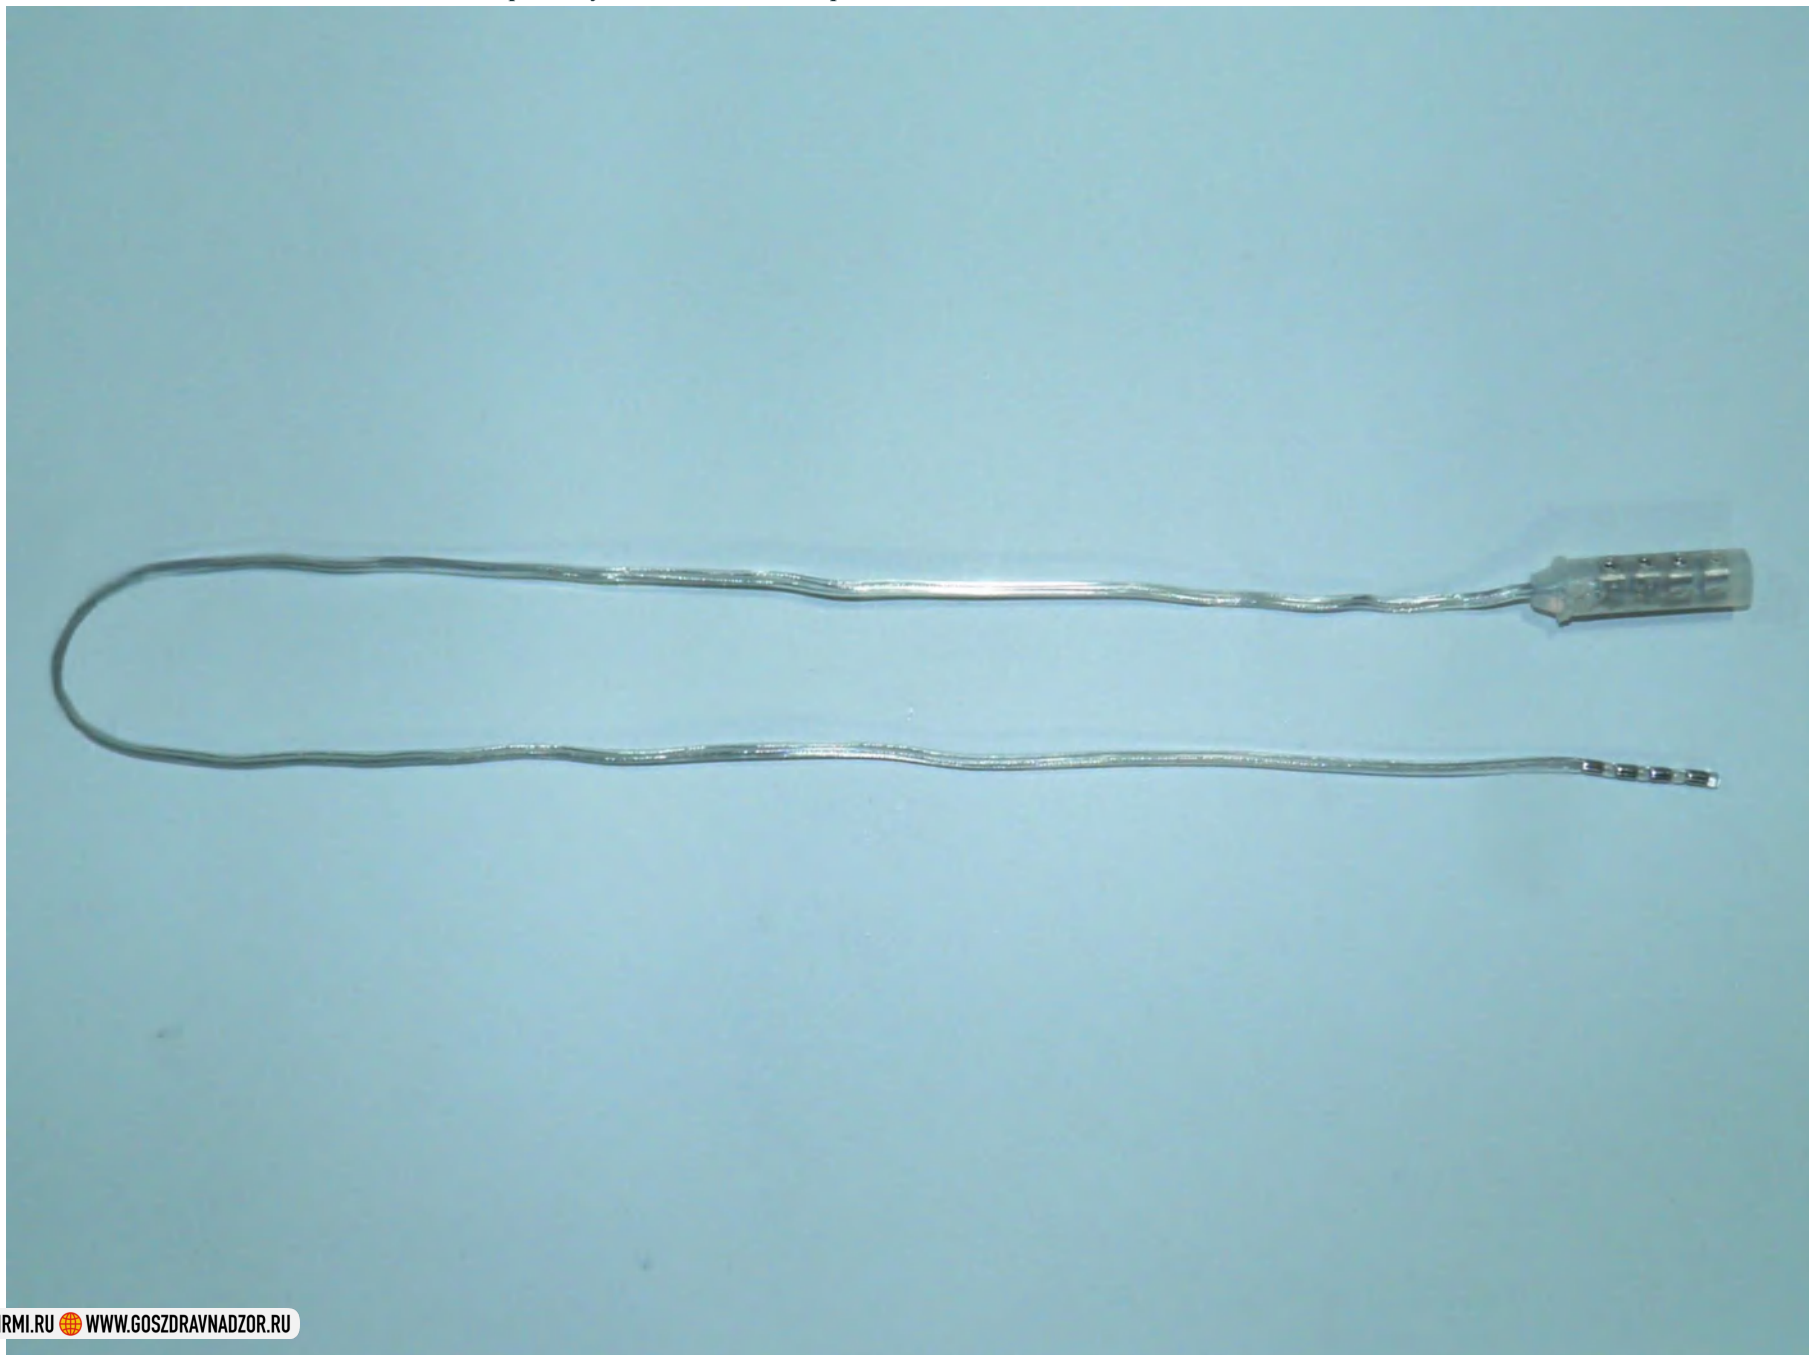

Промежуточный кабель, вариант 8 контактов, длина 450 мм

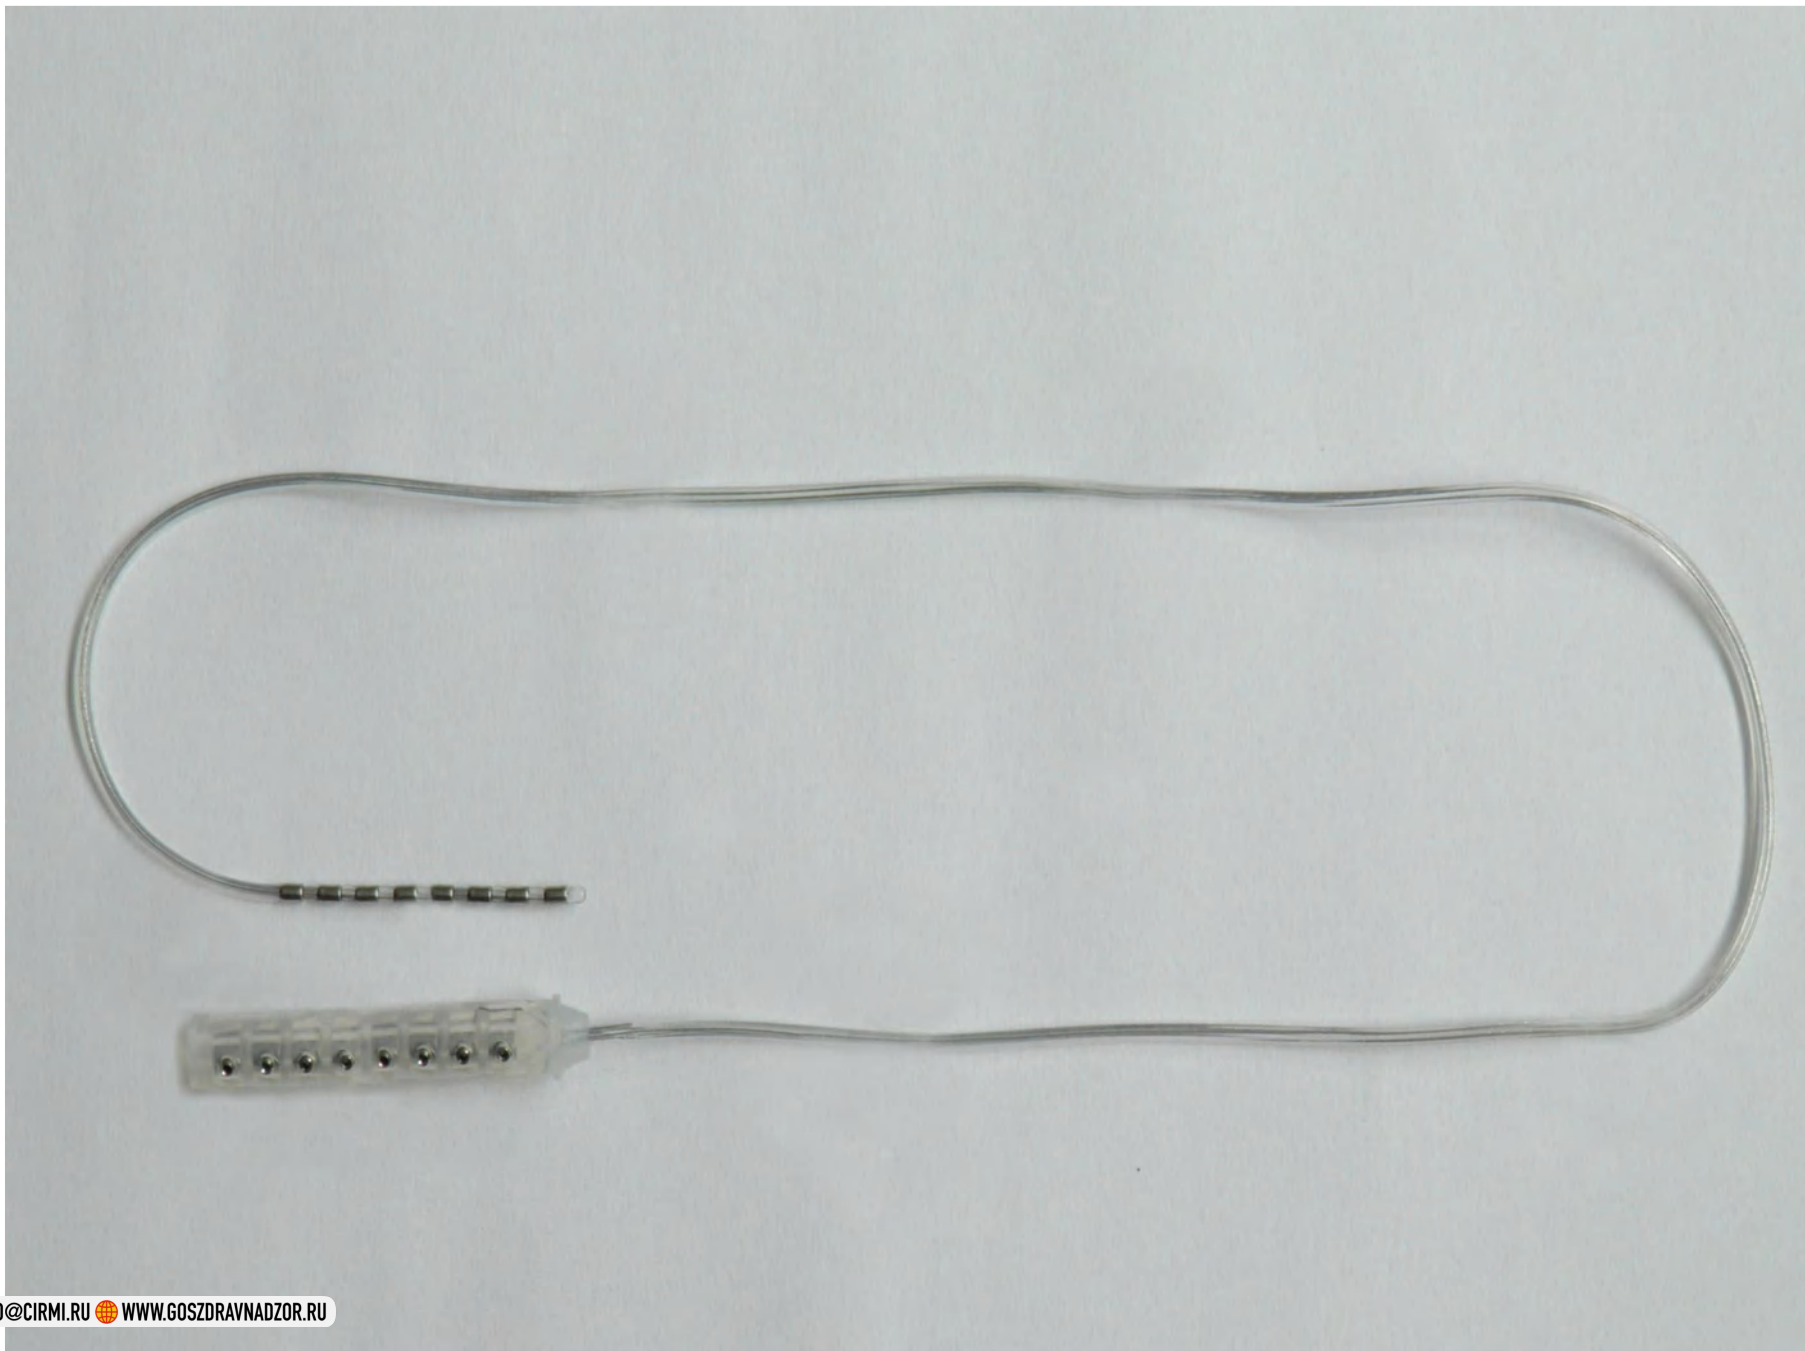

Якорь электрода (не более 2 шт. к одному электроду)

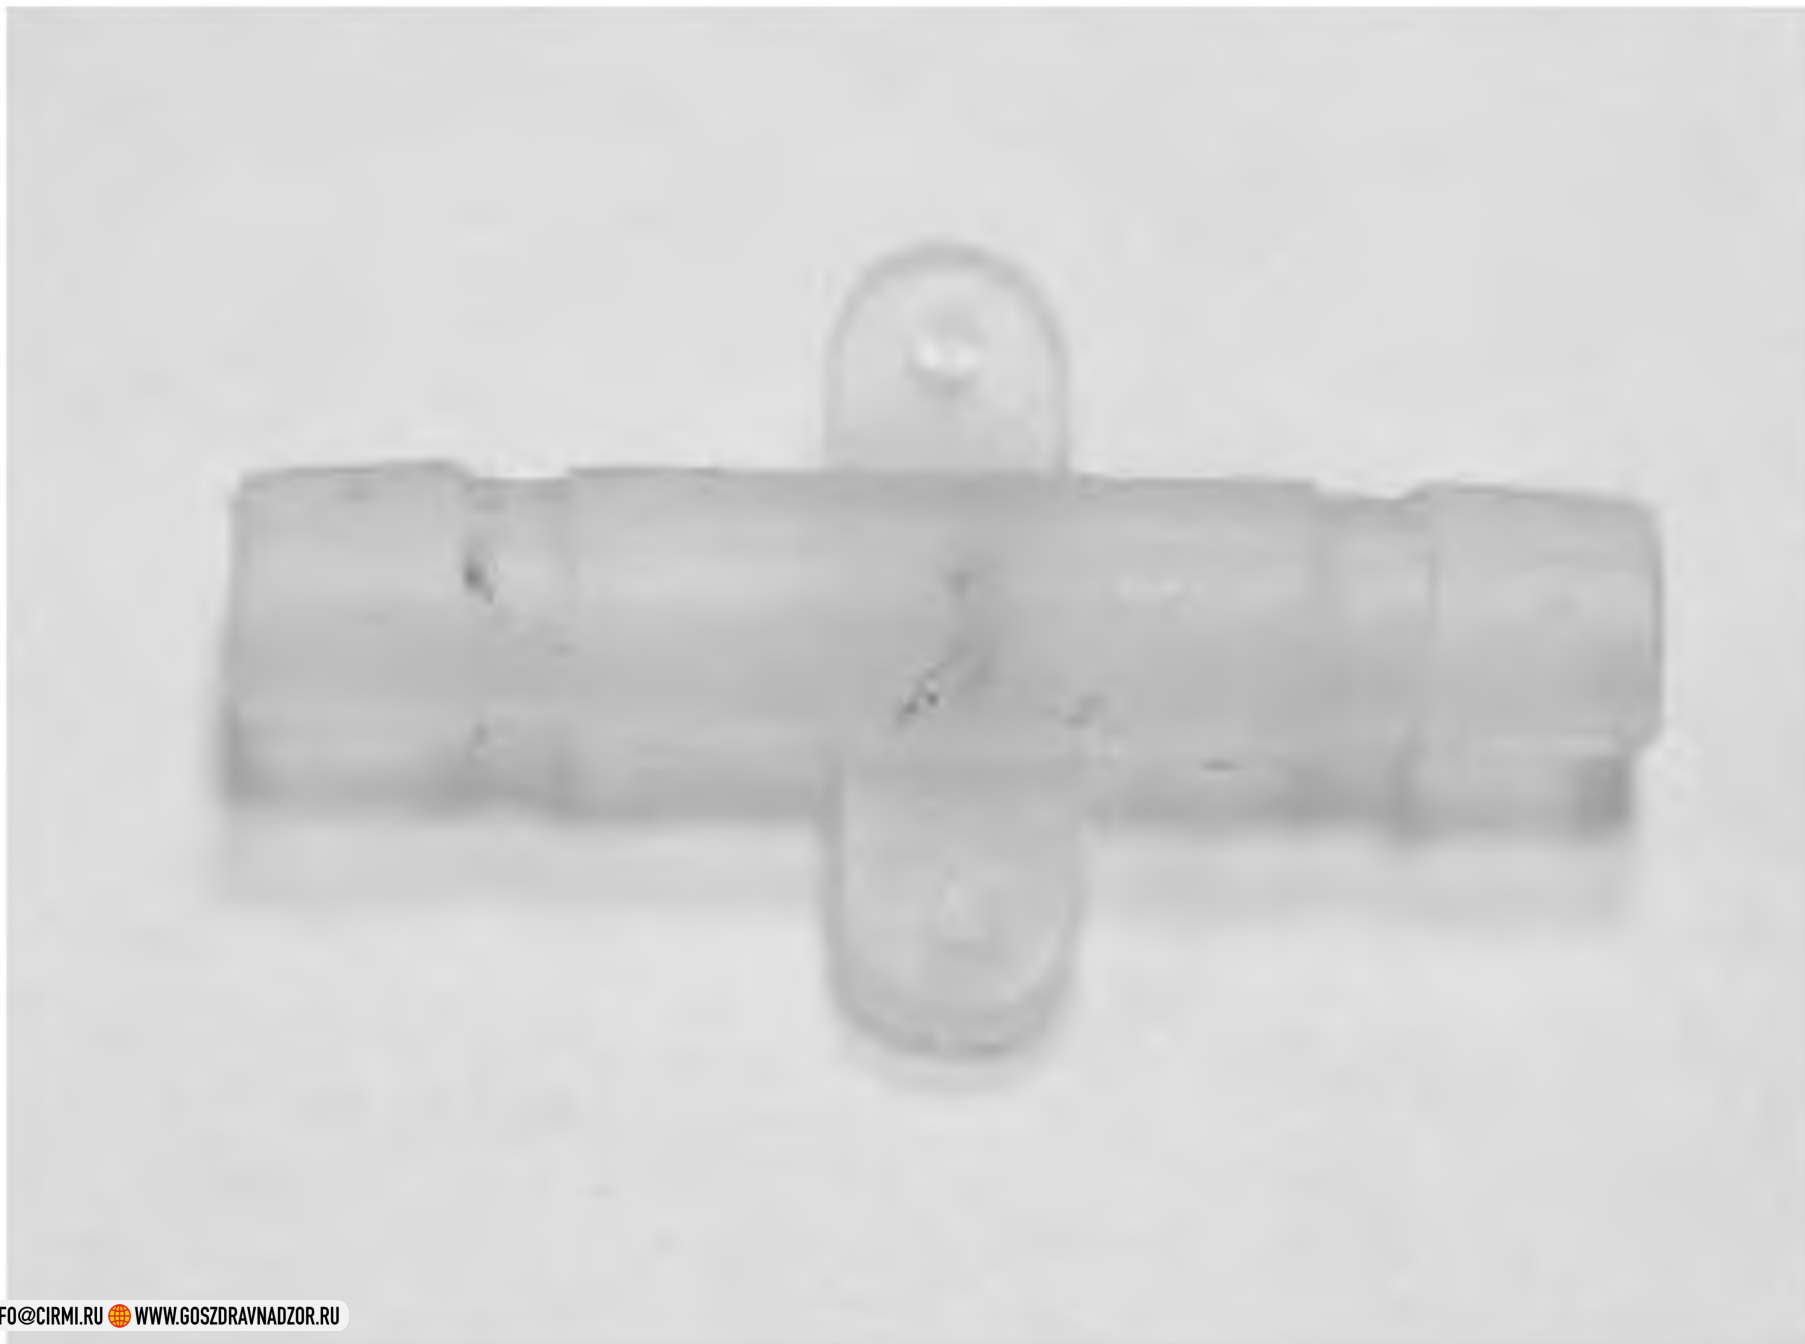


Пульт управления – Программатор




Модуль обмена и заряда



Инструменты:
Проводник для установки цилиндрических электродов

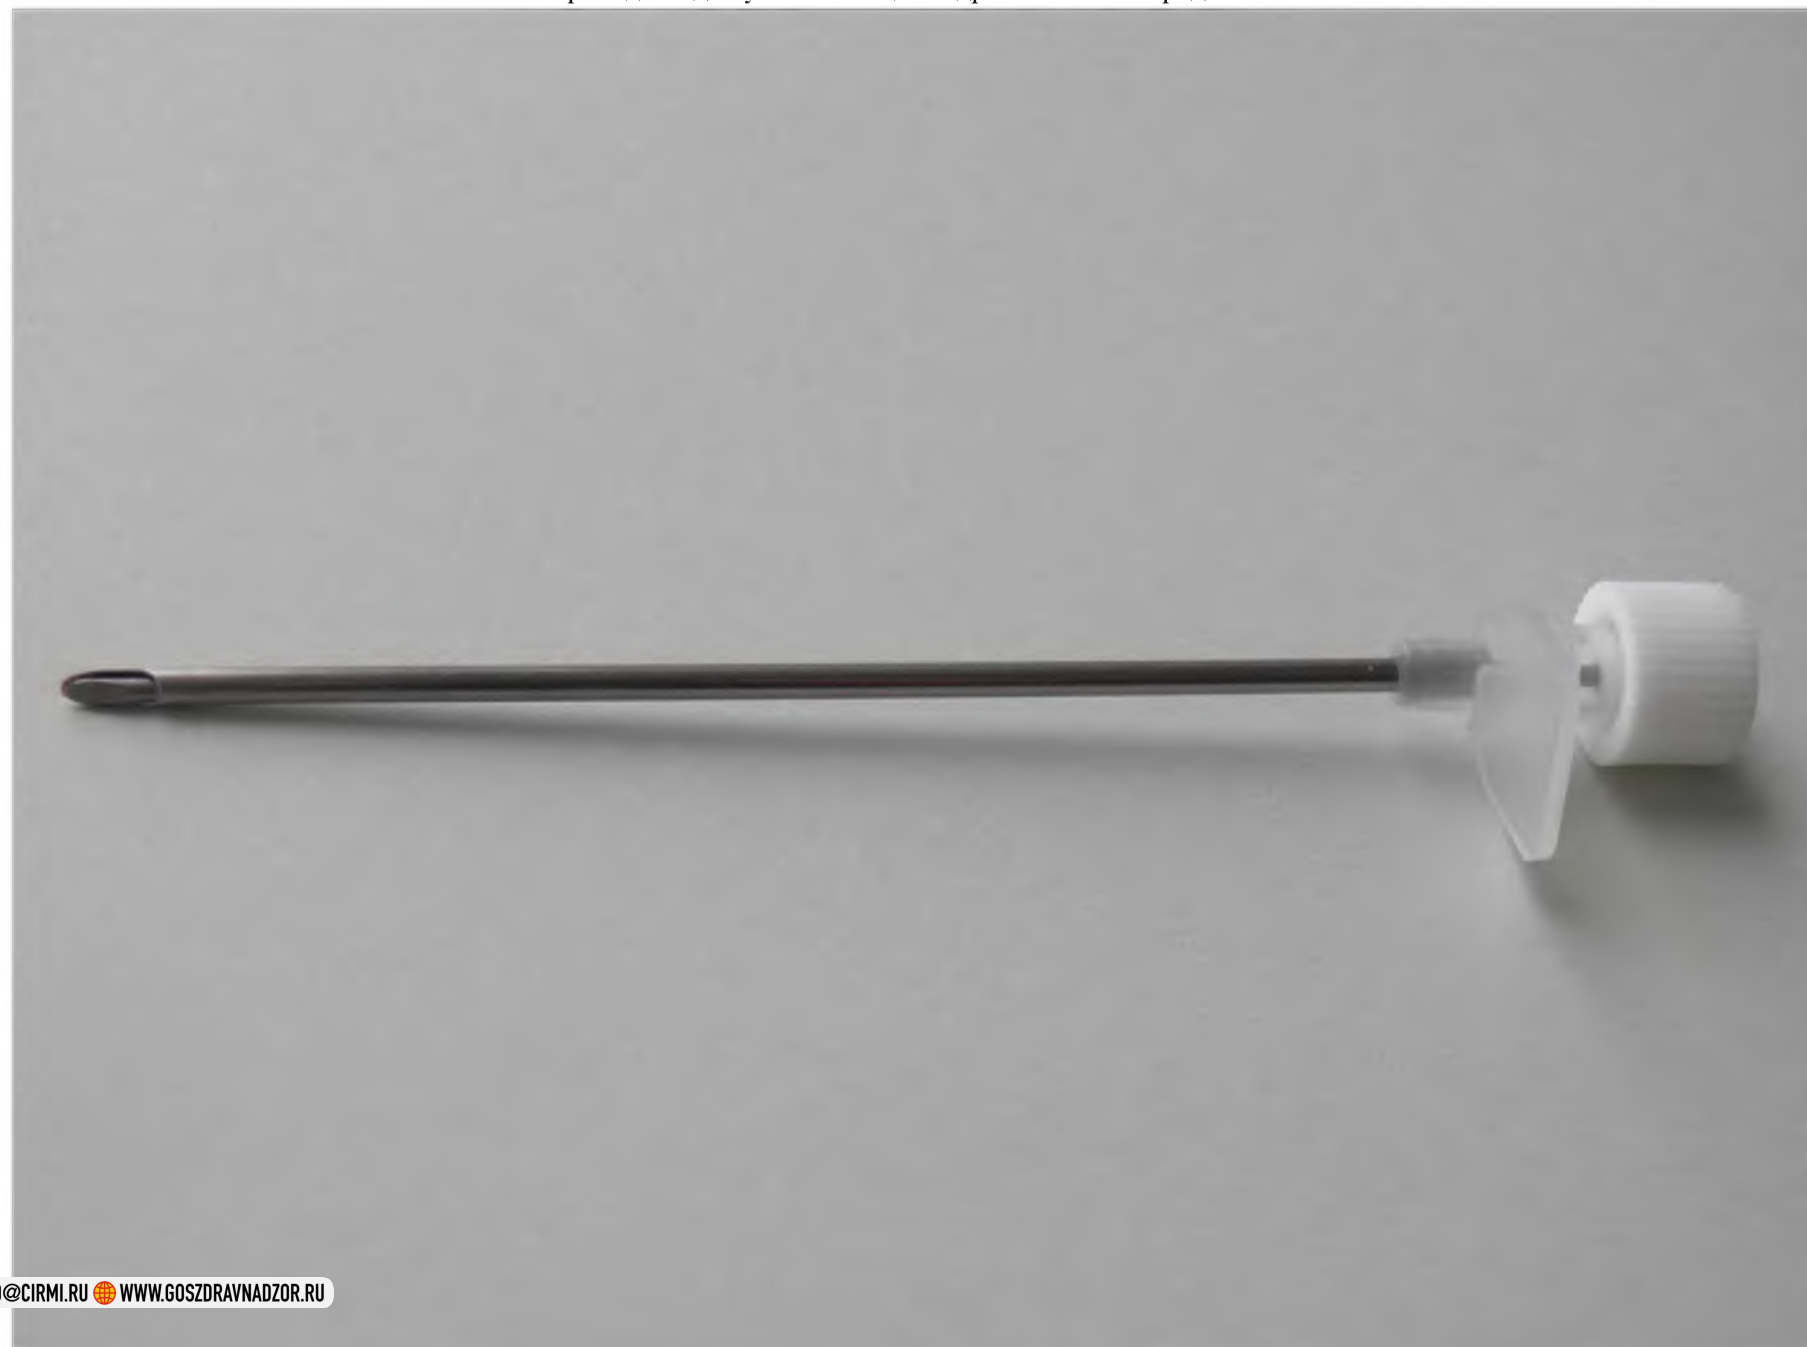

Туннелизатор

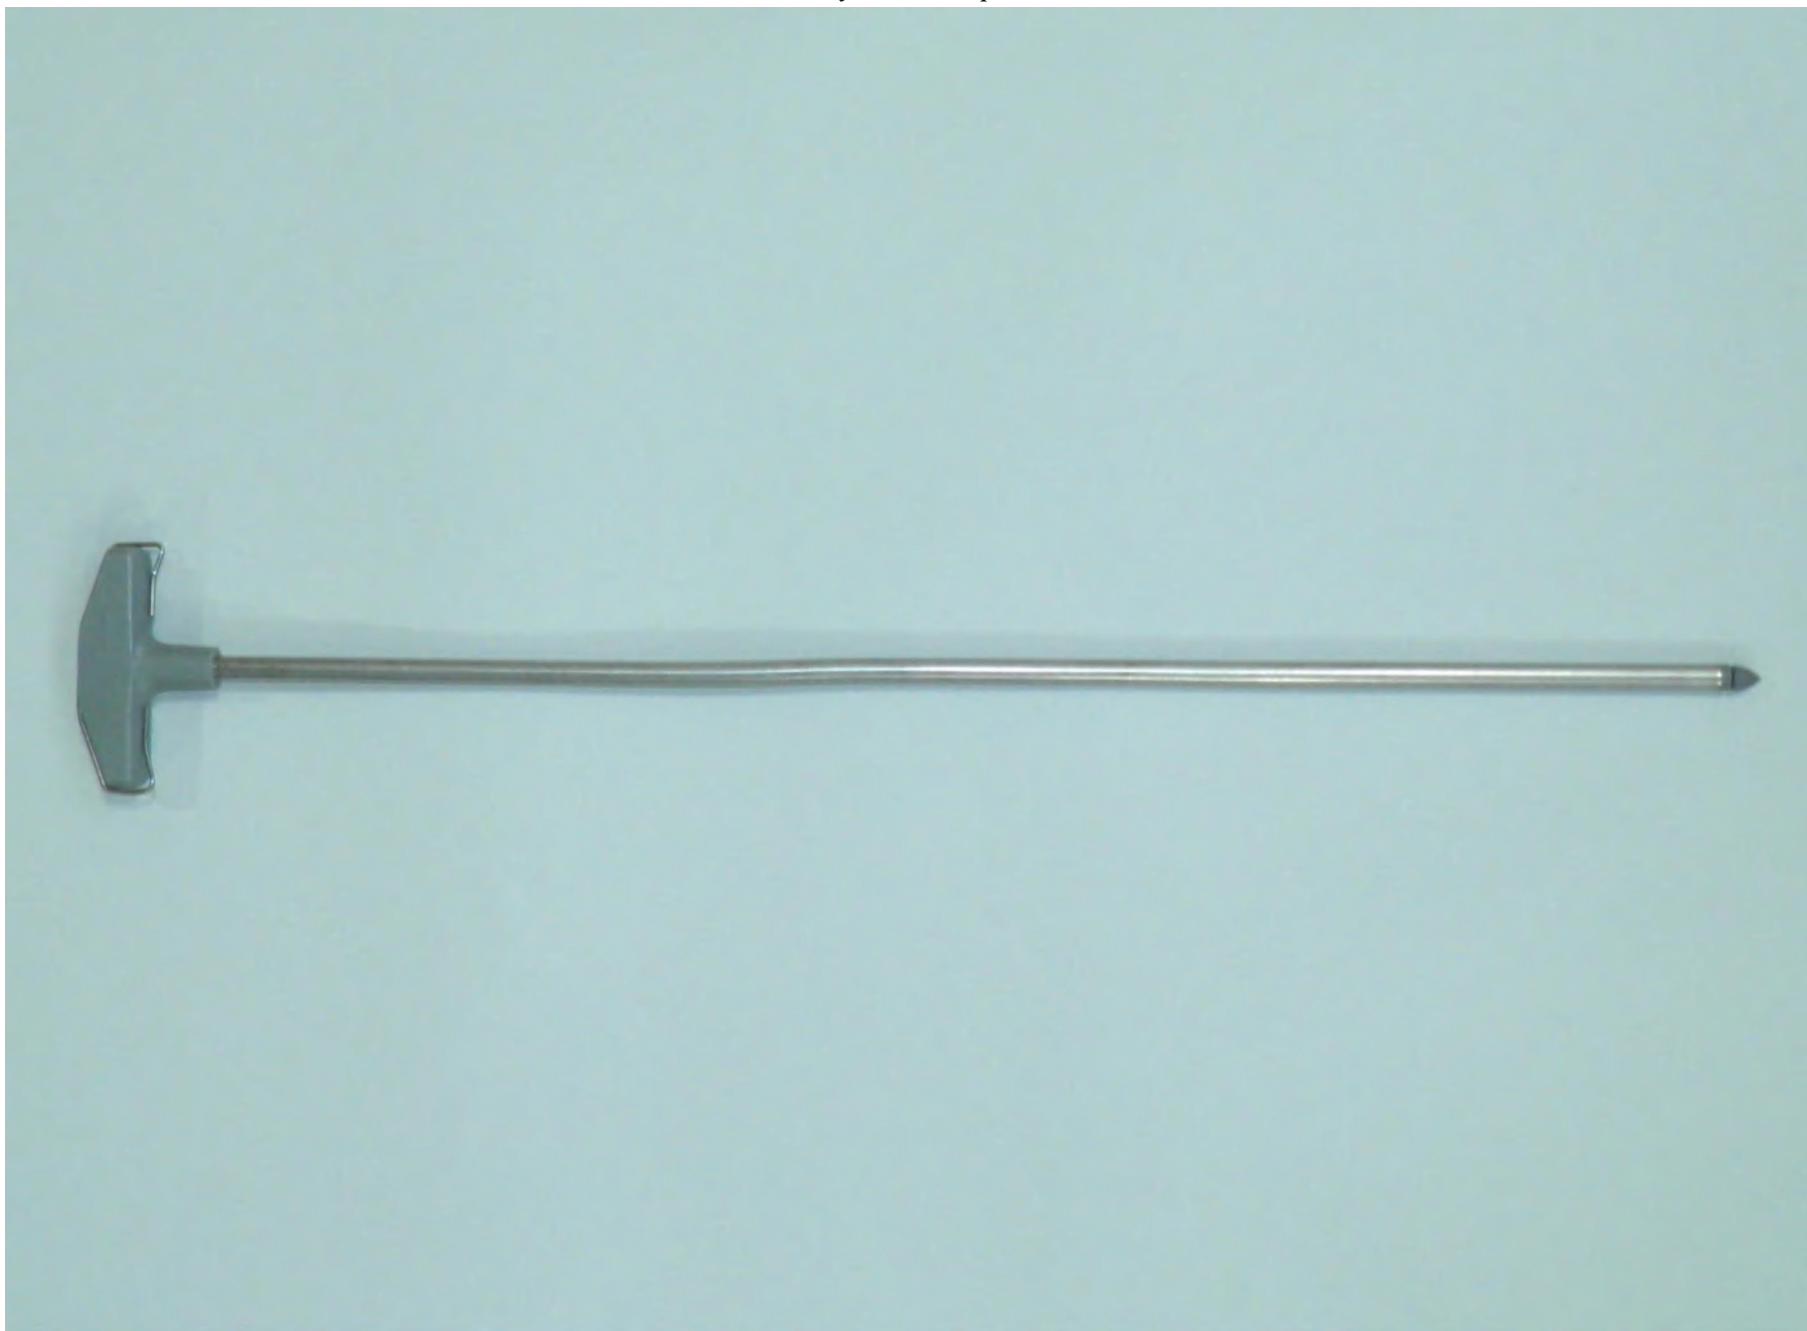

Отвертка динамометрическая



Принадлежности: Зарядное устройство



В документе пронумеровано

и прошито 31 листов

заместитель директора



ООО «ВМТ»

Белов И. А.

Общество с ограниченной ответственностью
«ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

640014 Курган ул. М. Ульяновой, д. 4, литера «А»
ИНН / КПП 4501198937 / 450101001 ОГРН 1144501037999

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
ООО «ВМТ»
И.А. Белов
«30» 2016 г.

М.П.


**Дополнение к Фотографическим изображениям
медицинского изделия
«Система электростимуляции
центральной нервной системы «ЭлСИ.10.ise»
по ТУ 9444-003-11059002-2015 в составе
(см. Приложение на 1 листе)»**

ООО «ВМТ»

**Россия, 640014, Курганская область,
г. Курган, ул. Марии Ульяновой, д. 4
2016 г.**

Система электротехнических
измерений серии «ЭЗСК» 10.100
двухфазного реверса (1А-2)
(исполнение реверса LC 10.8.600.04)
исполнение электроскоп LC 10.8.600.02-2015
по ТУ 9444-003-11059002-2015
SN 03.01.30.1

ООО «ВМТ»
Росстат 640014.1.1.Киреев
ул. М. Ульянова д. 4
дата выпуска 08.2016 г.



Система электротехнических
измерений серии «ЭЗСК» 10.100
двухфазного реверса (1А-2)
(исполнение реверса LC 10.8.600.04)
исполнение электроскоп LC 10.8.600.02-2015
по ТУ 9444-003-11059002-2015
SN 03.01.30.1

ООО «ВМТ»
Росстат 640014.1.1.Киреев
ул. М. Ульянова д. 4
дата выпуска 08.2016 г.





Система электростимуляции
«ЭлСИ.10.1се»

генератор импульсов

имплантируемый ГБ.1

ВМТ.10.11059002.001.Б.1

ТУ 9444-001-11059002-2015

SN: 03.01.21.1

ООО «ВМТ»

Россия, 640014, г. Курган

ул. М. Ульяновой, д. 4

Дата стерилизации: 25.08.2016г.


Срок годности: 24.08.2017г.



STERILE EO




Генератор импульсов ГБ.1.




Генератор импульсов ГА.1.



Генератор импульсов ГТ

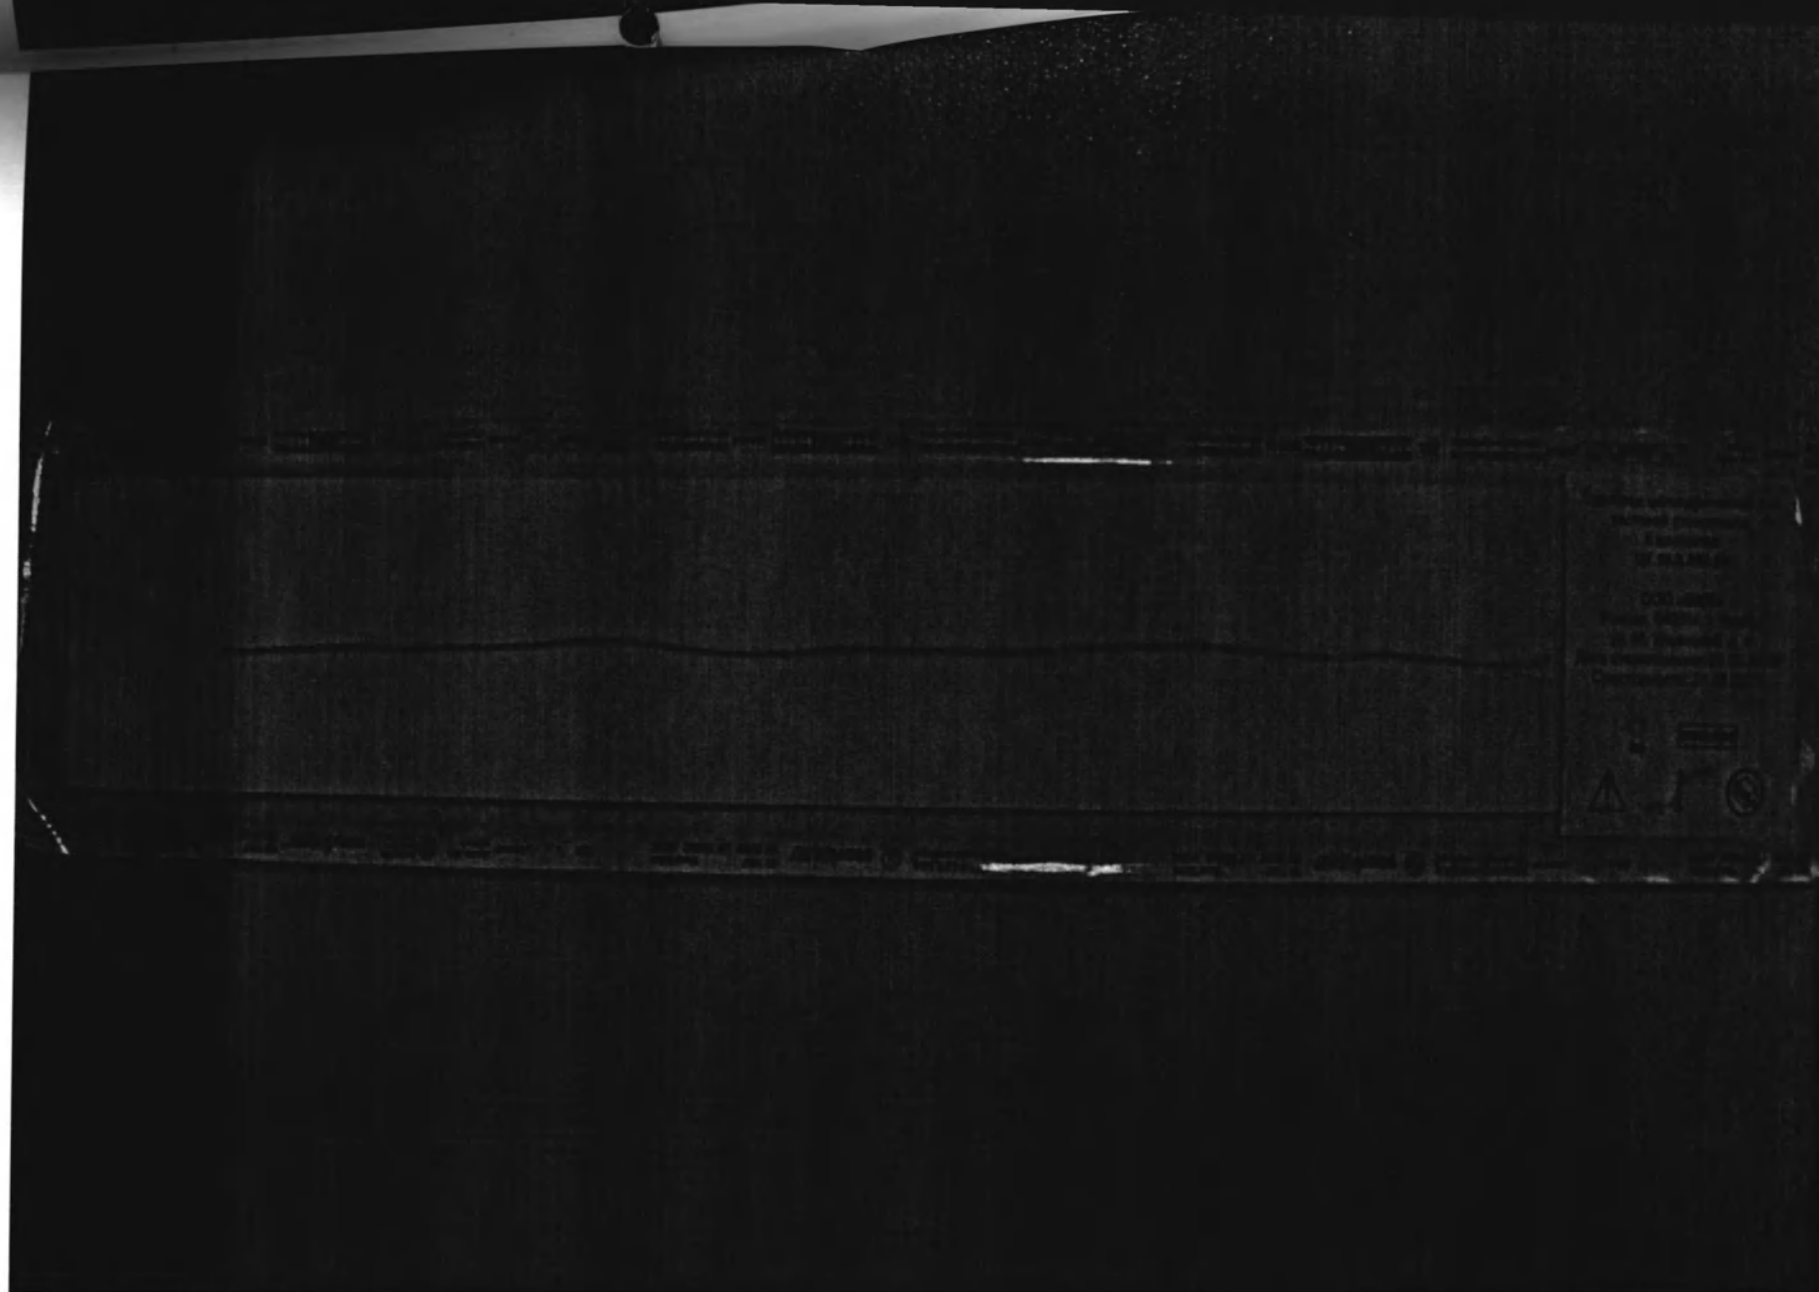


Электроды цилиндрические для тестовой стимуляции, вариант 8 контактов

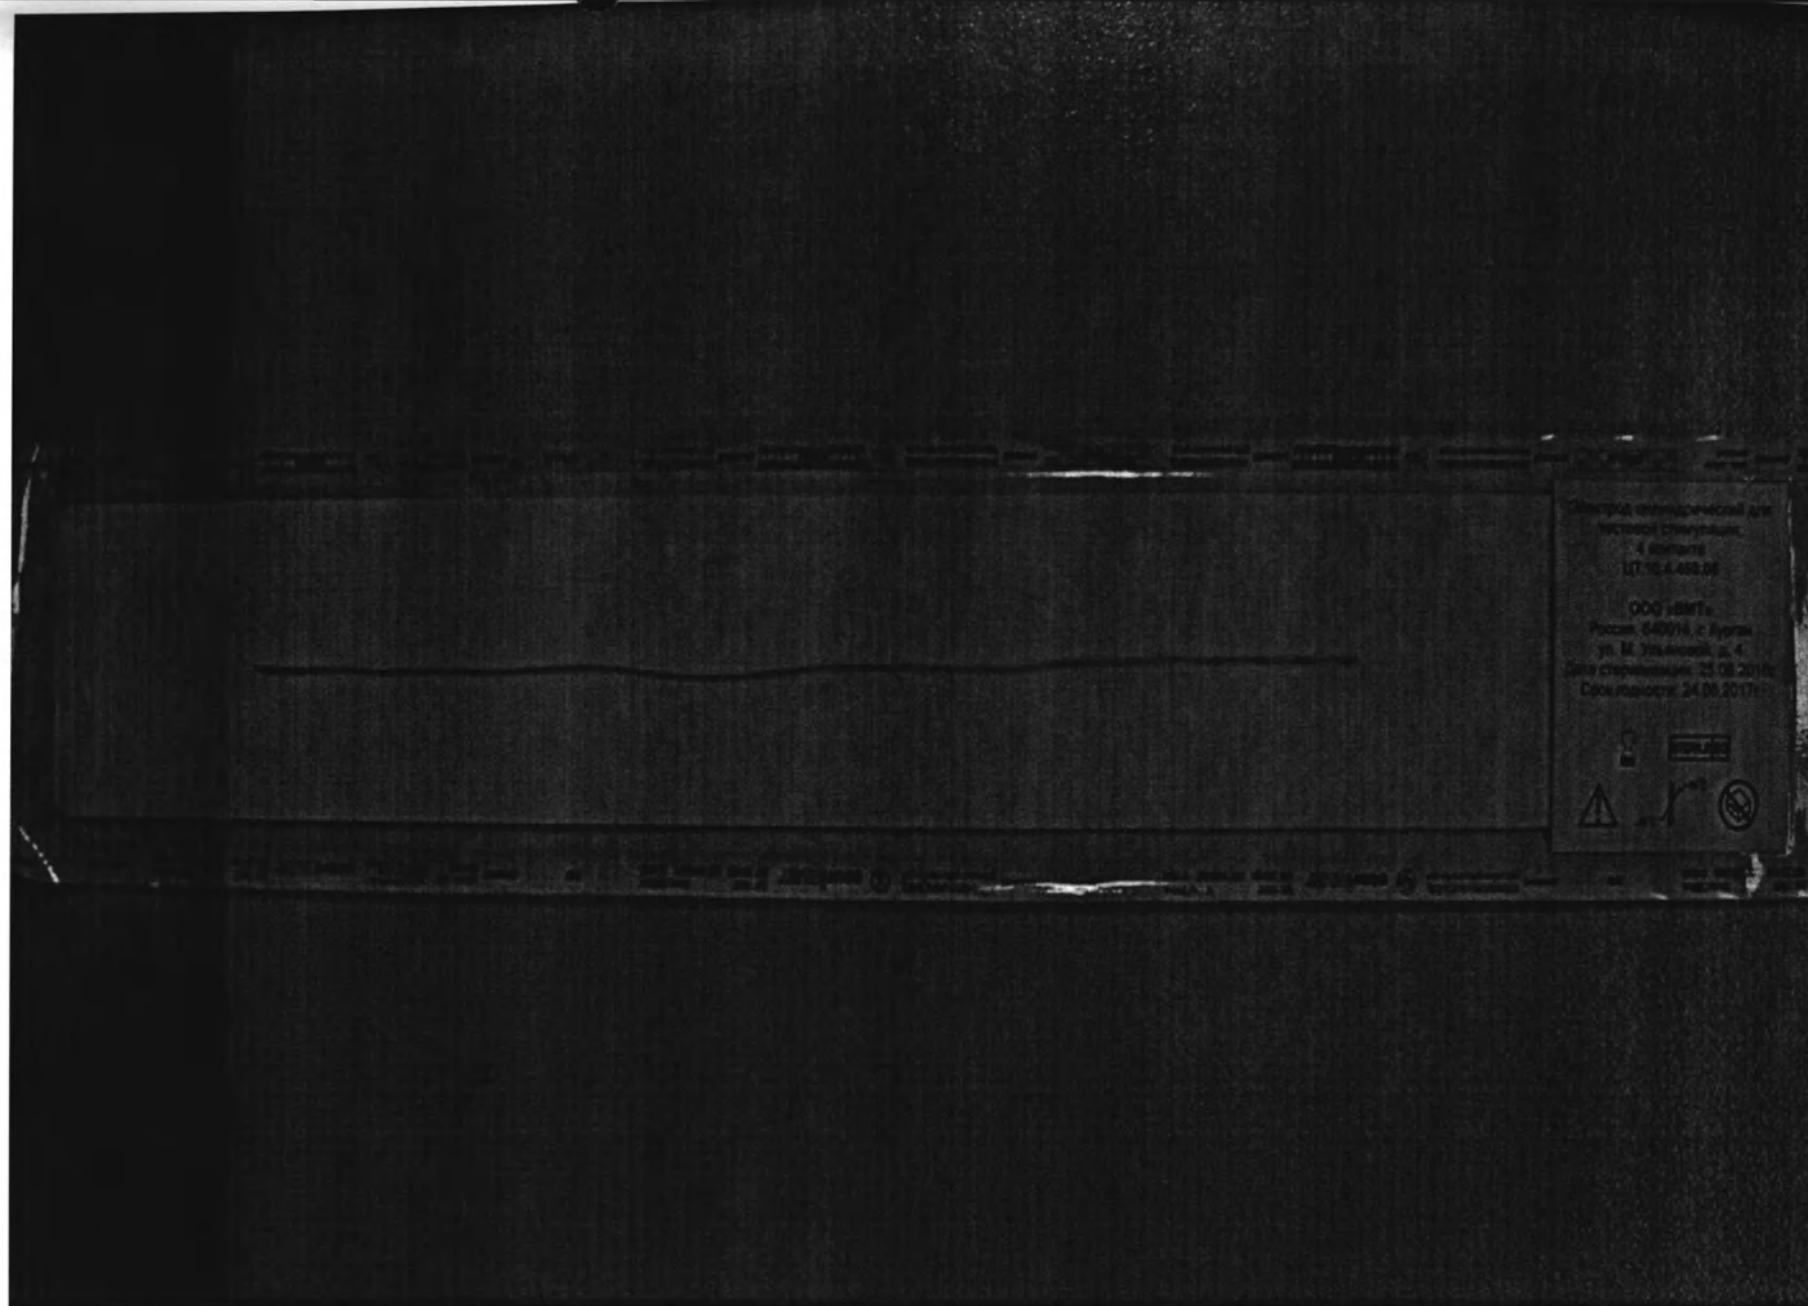


Электроды цилиндрические для тестовой стимуляции, вариант 4 контакта


Электроды цилиндрические для постоянной (хронической) стимуляции, вариант 8 контактов

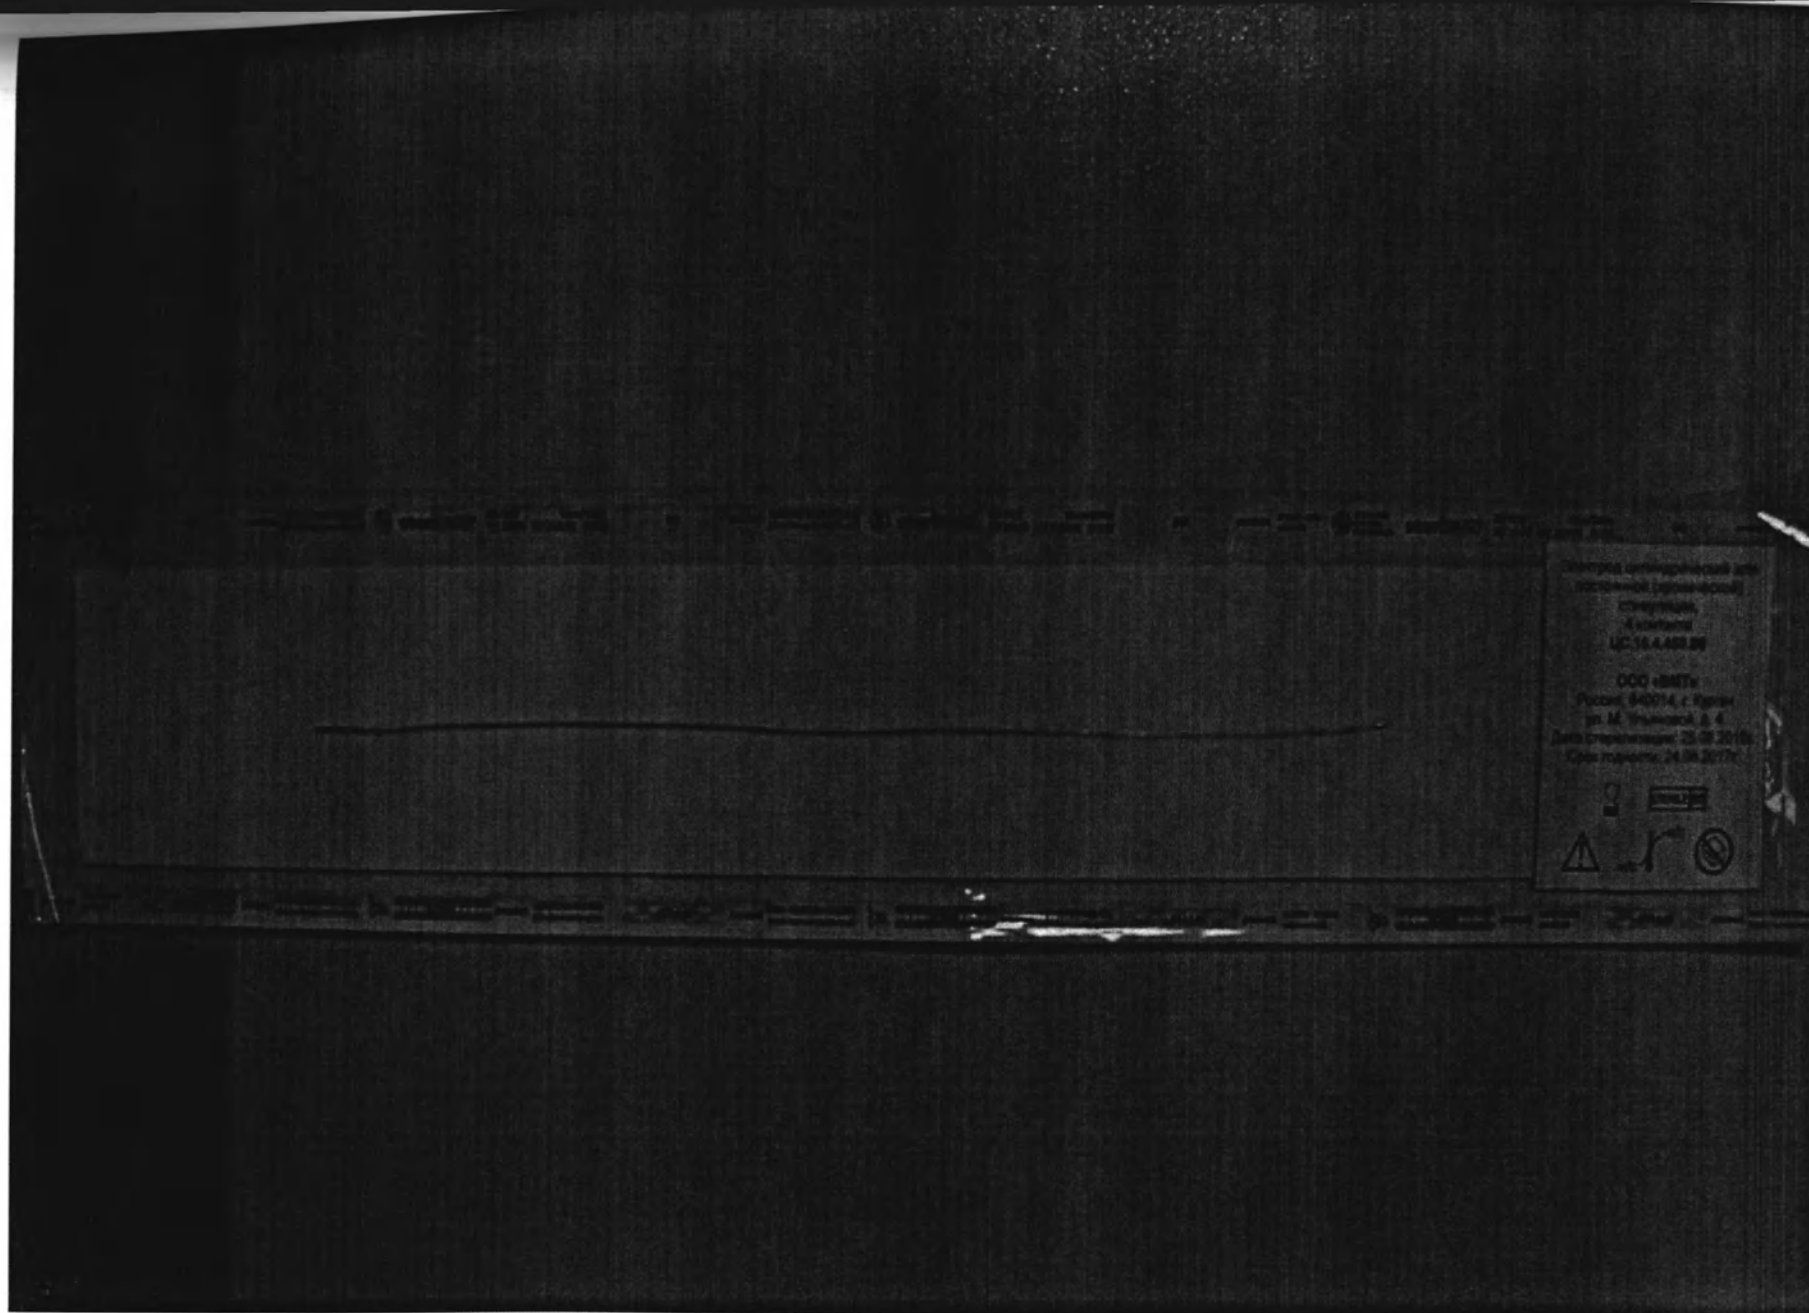

Электроды цилиндрические для постоянной (хронической) стимуляции, вариант 4 контакта

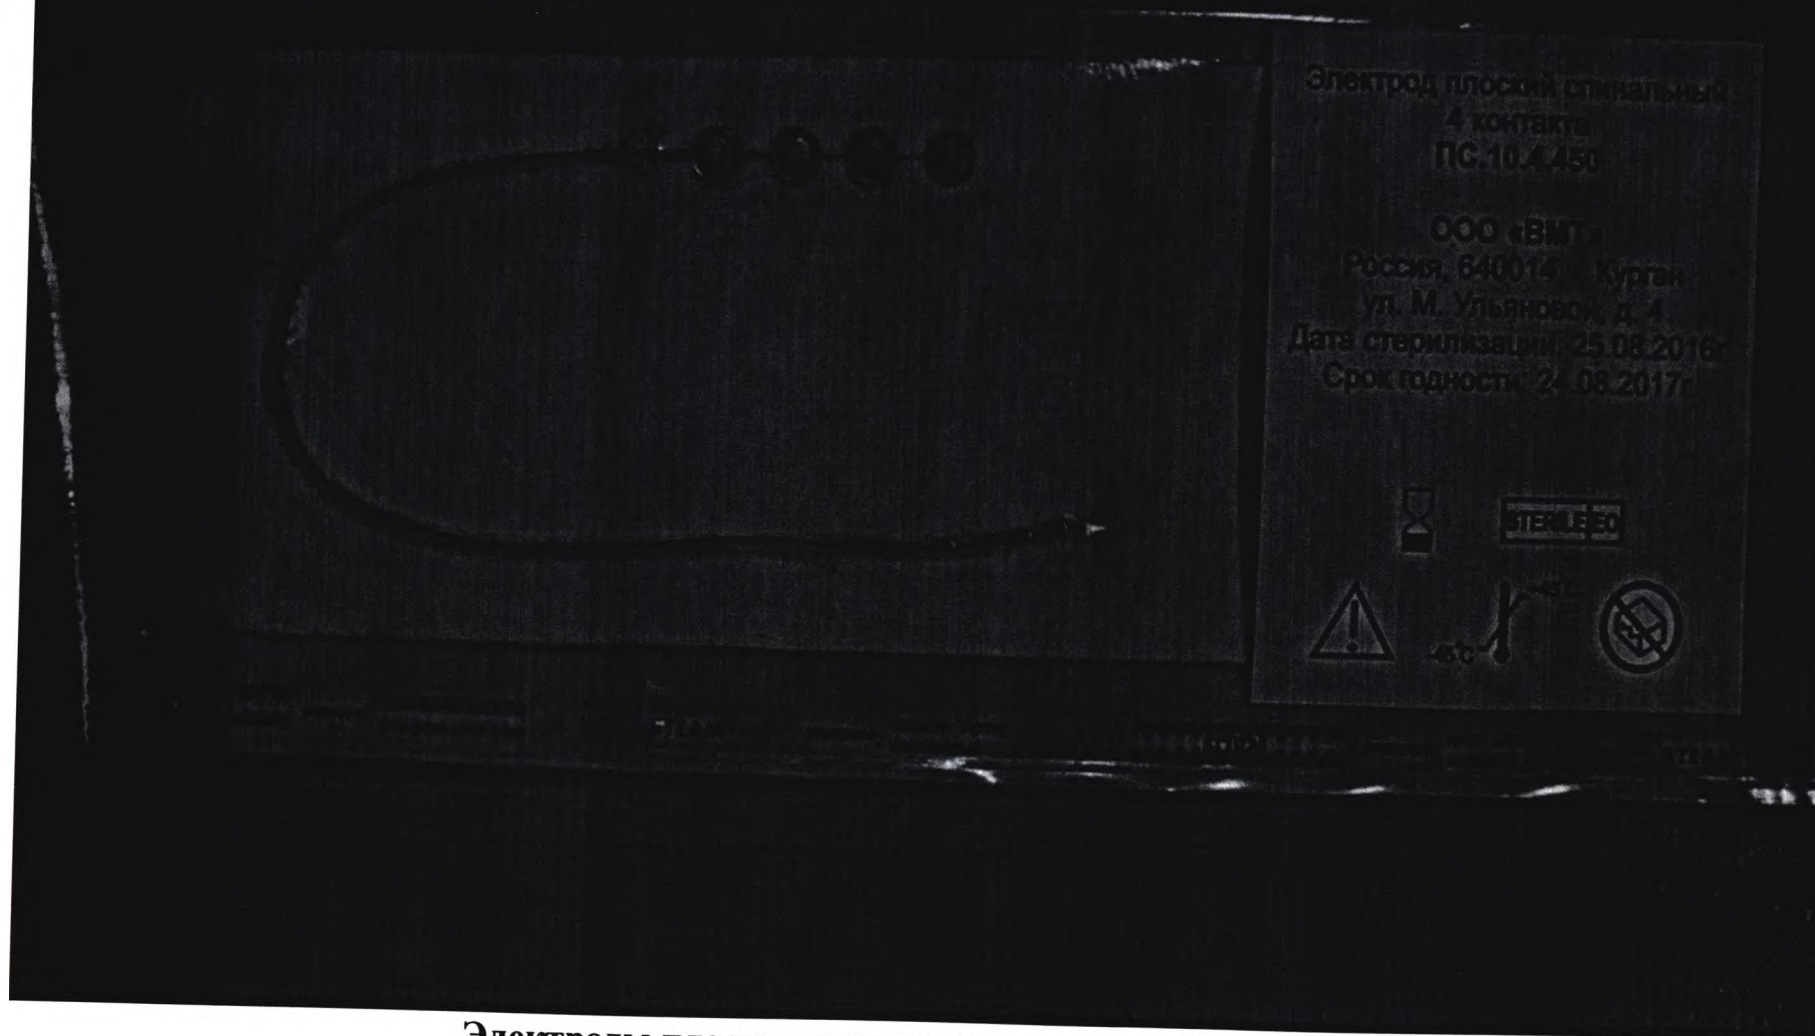


Электроды плоские спинальные, вариант 4 контакта

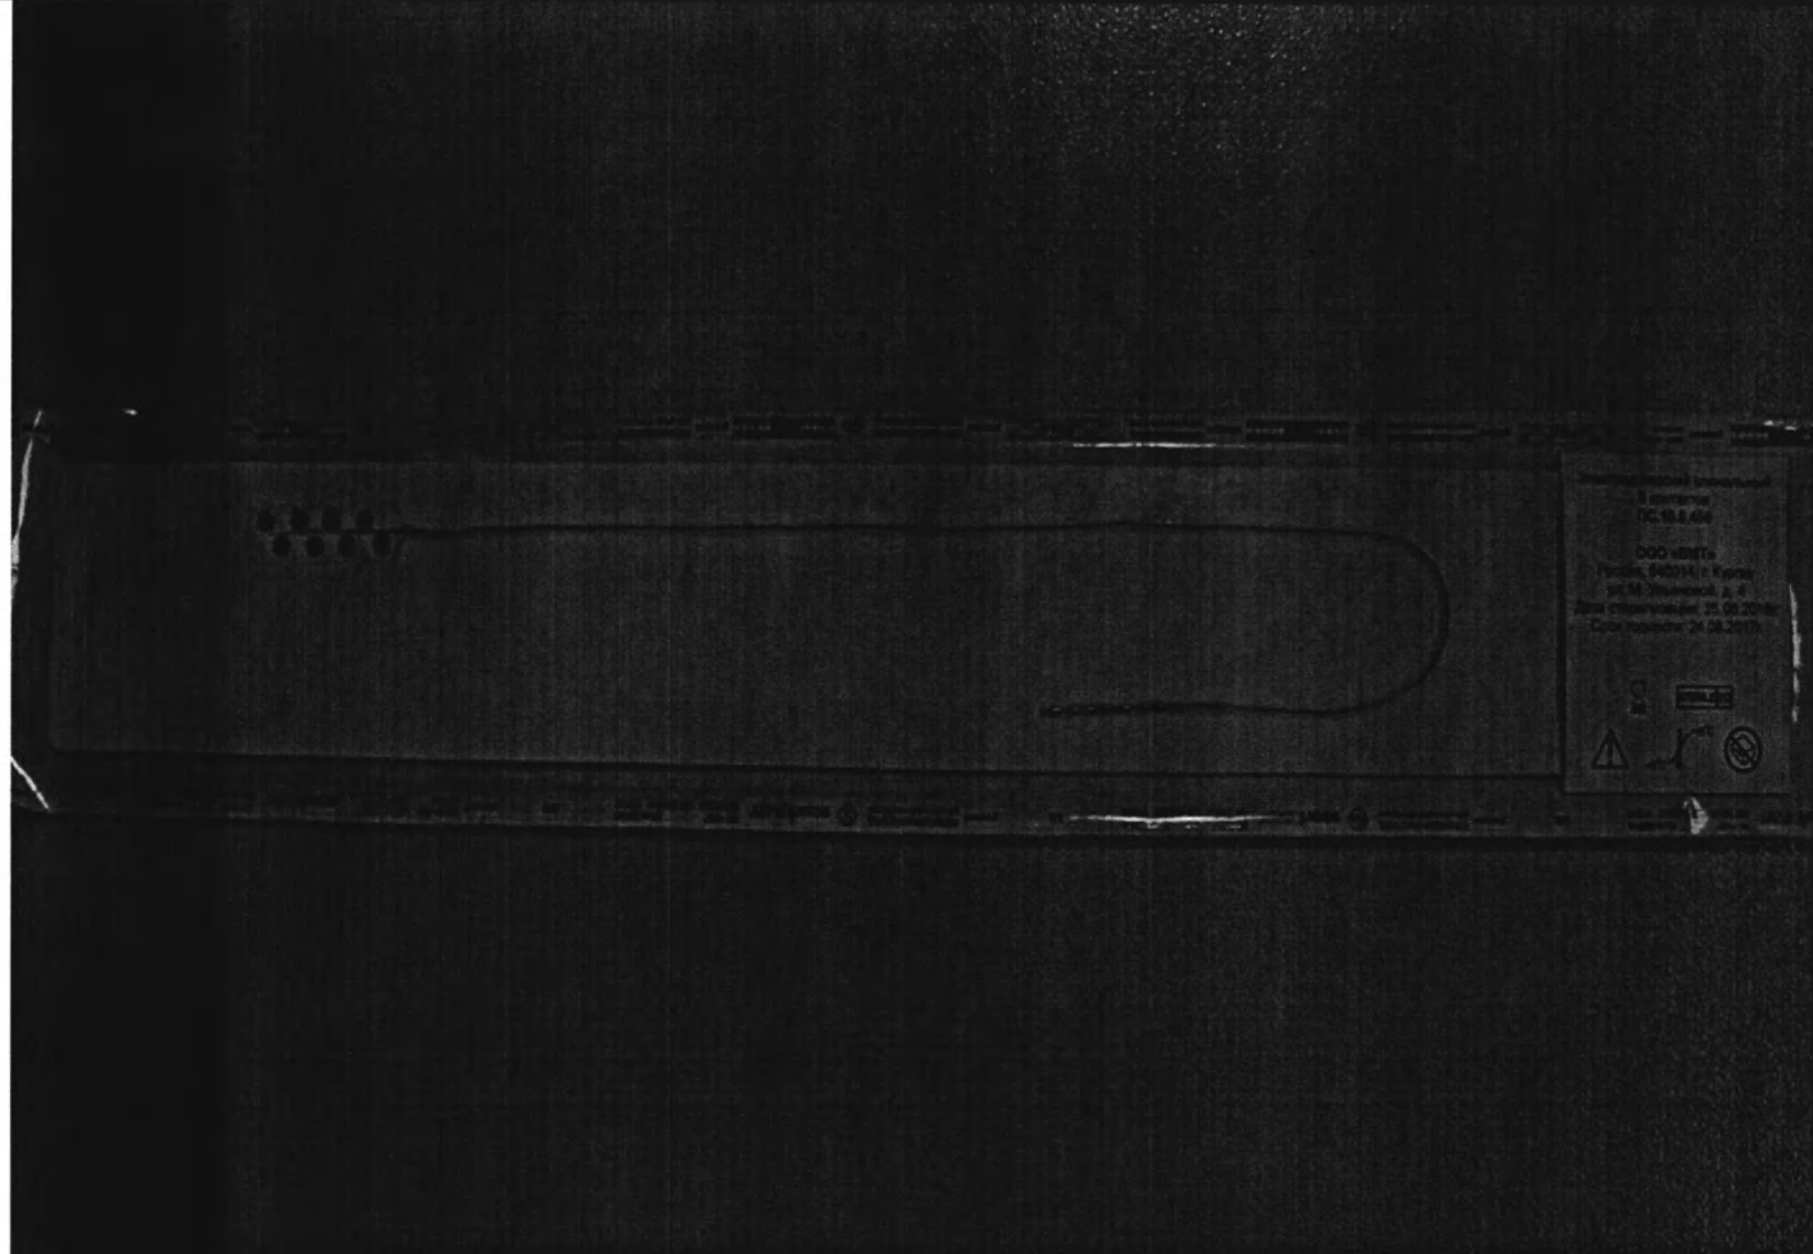


Электроды плоские спинальные, вариант 8 контактов

Электроды лепестковые, вариант 4 контакта

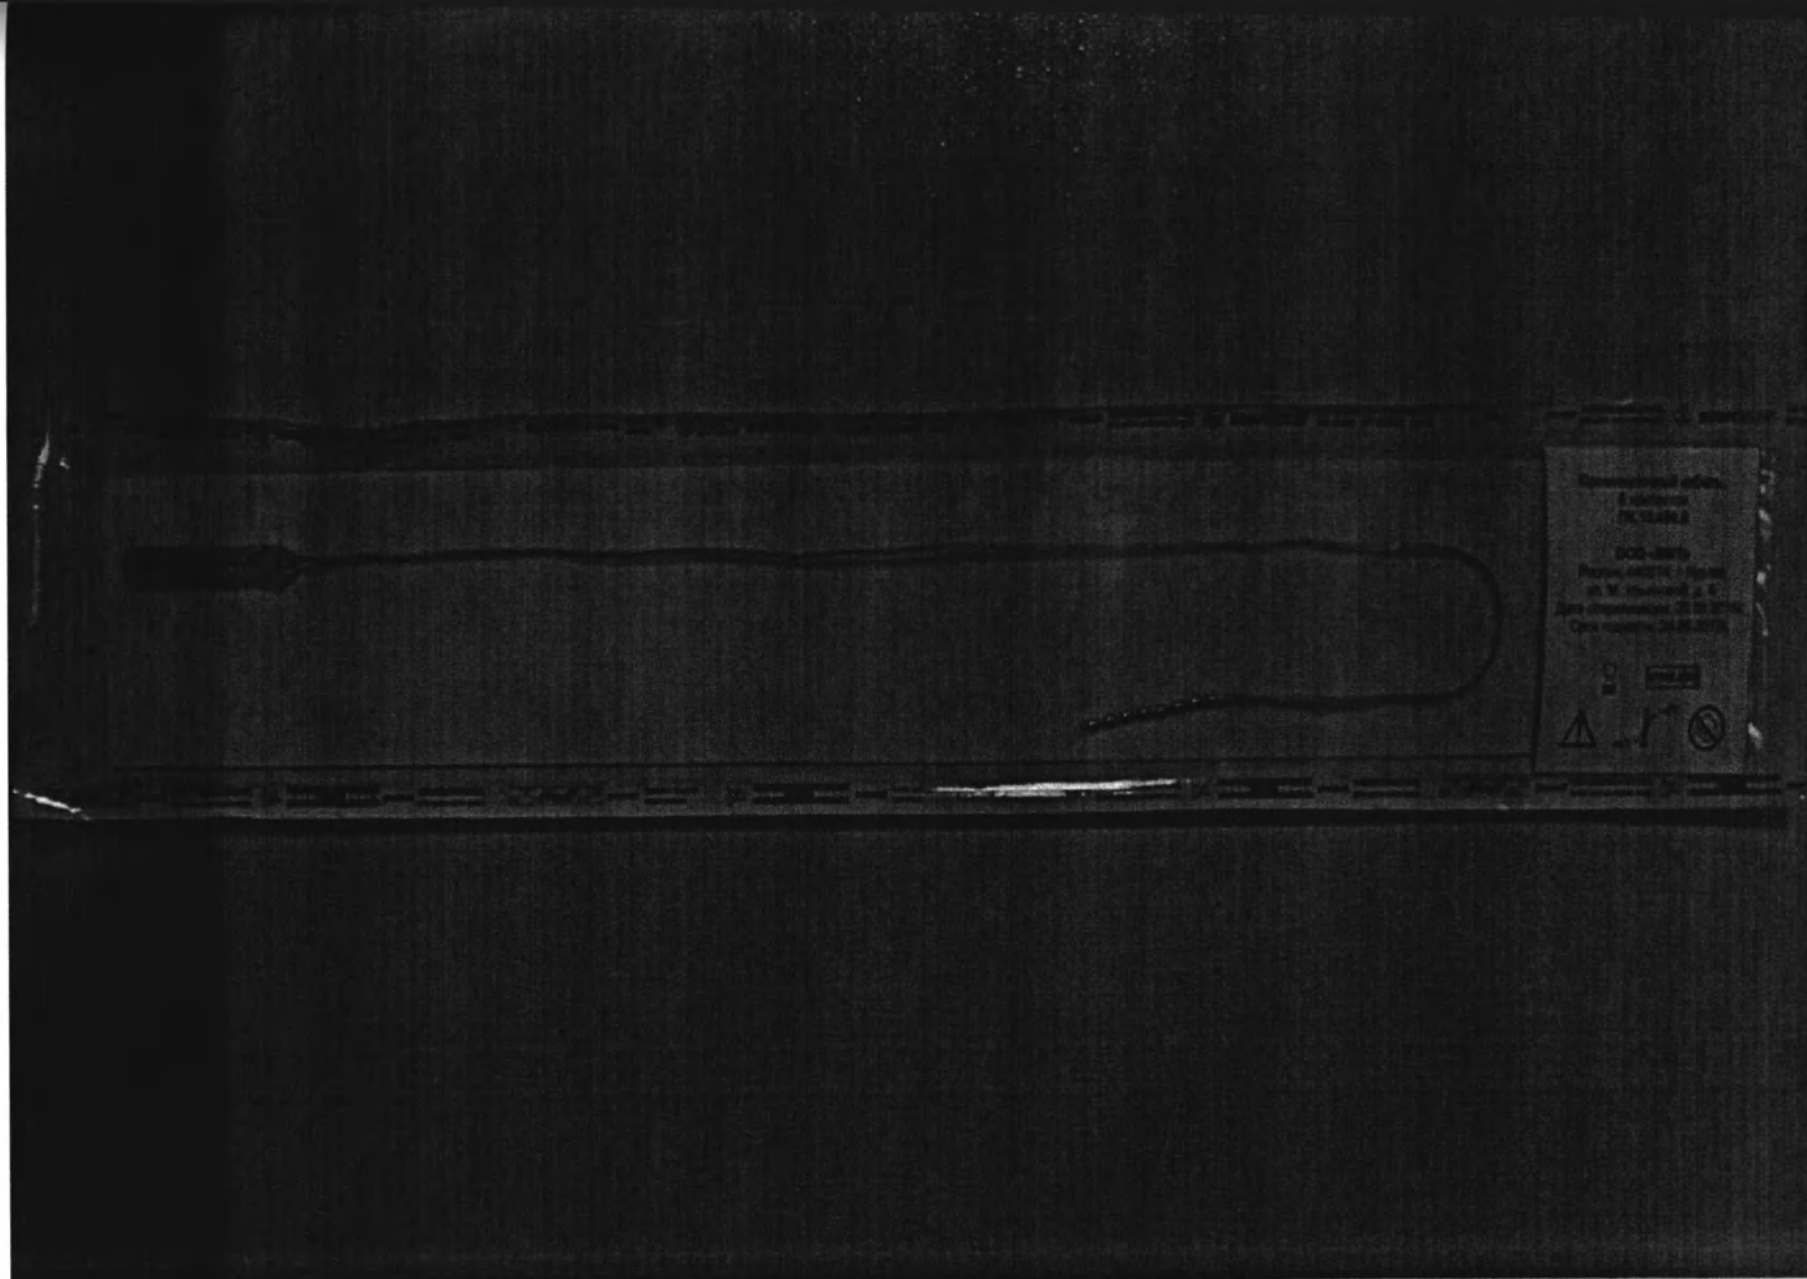


Промежуточный кабель, вариант 8 контактов

Якорь электрода

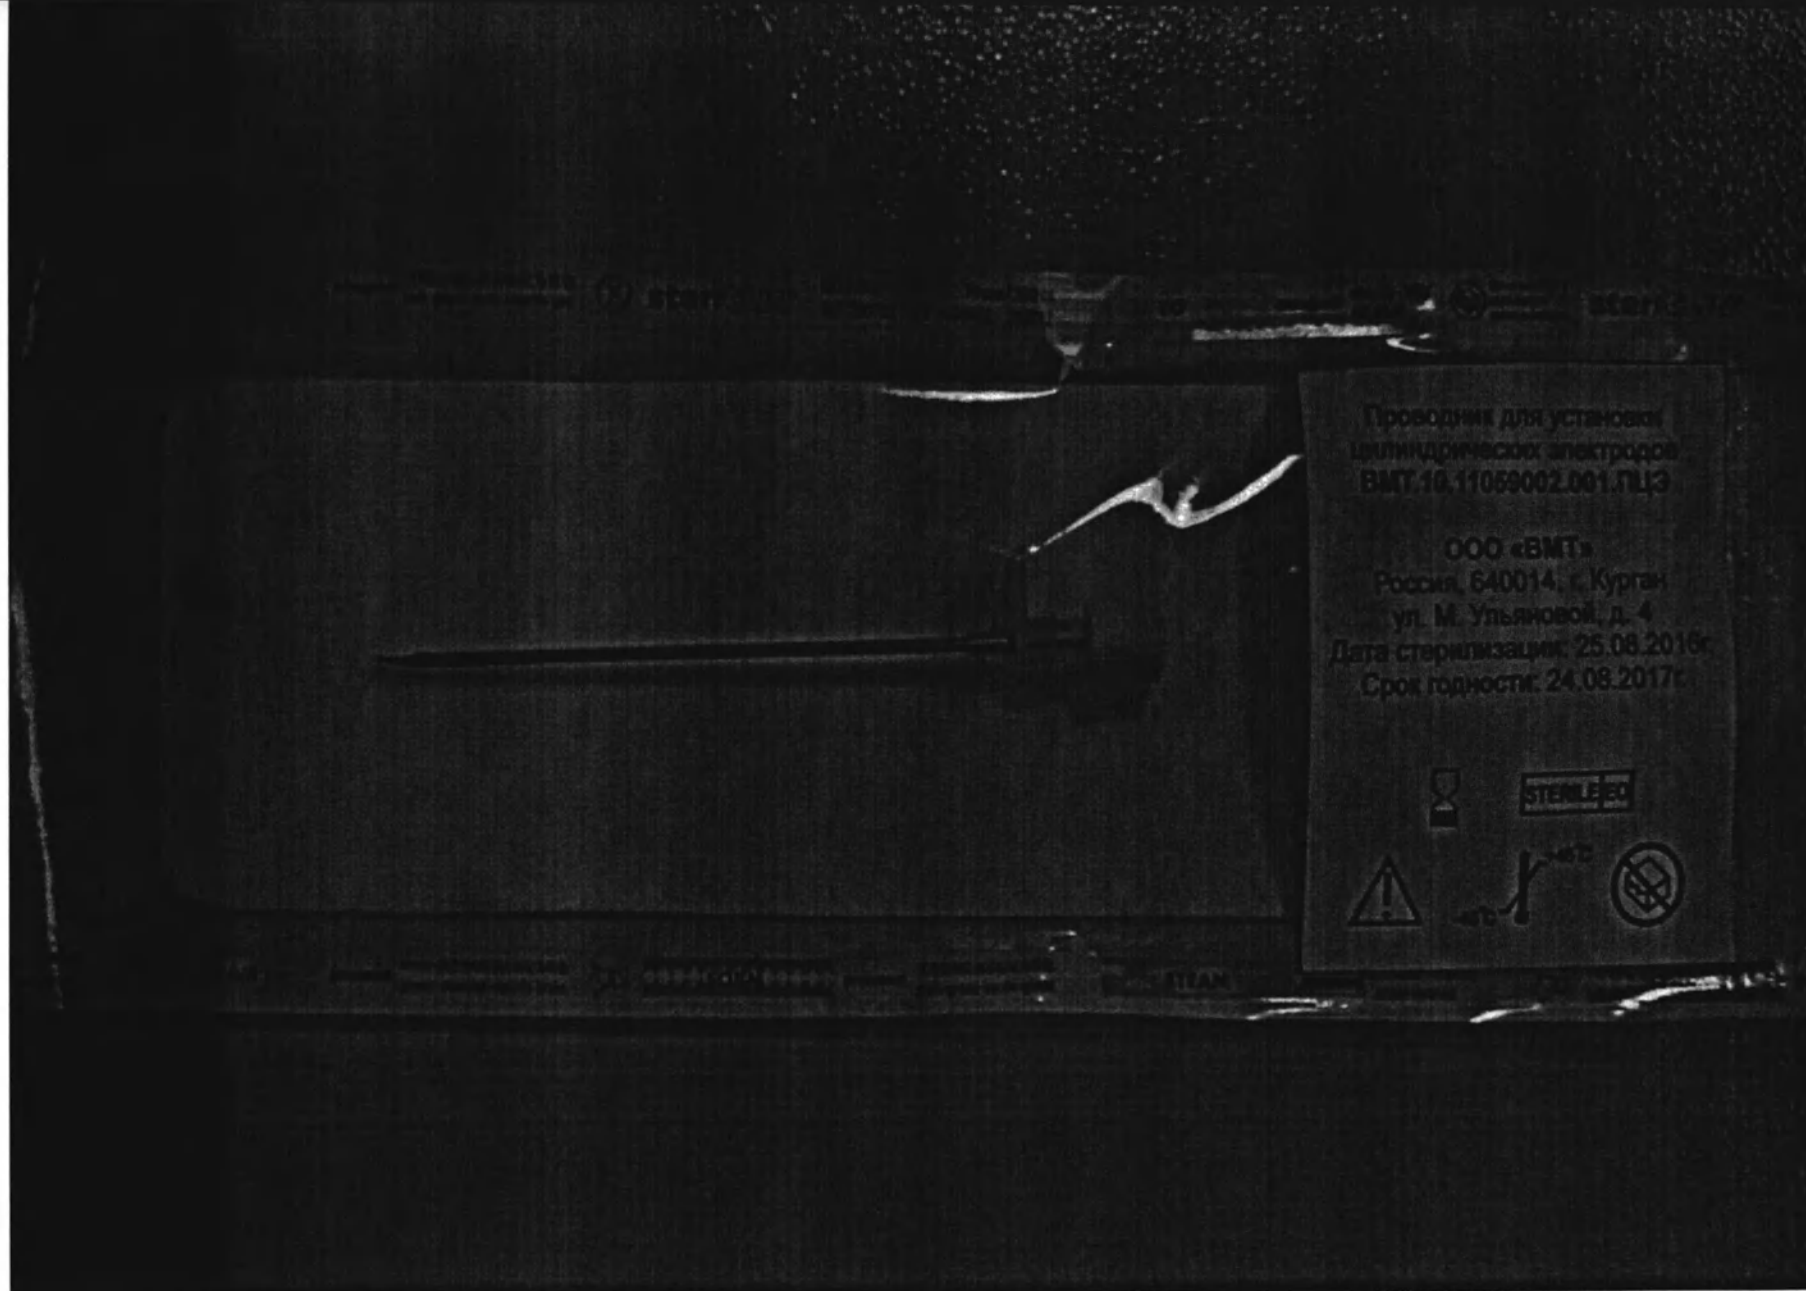


Инструменты:

Проводник для установки цилиндрических электродов

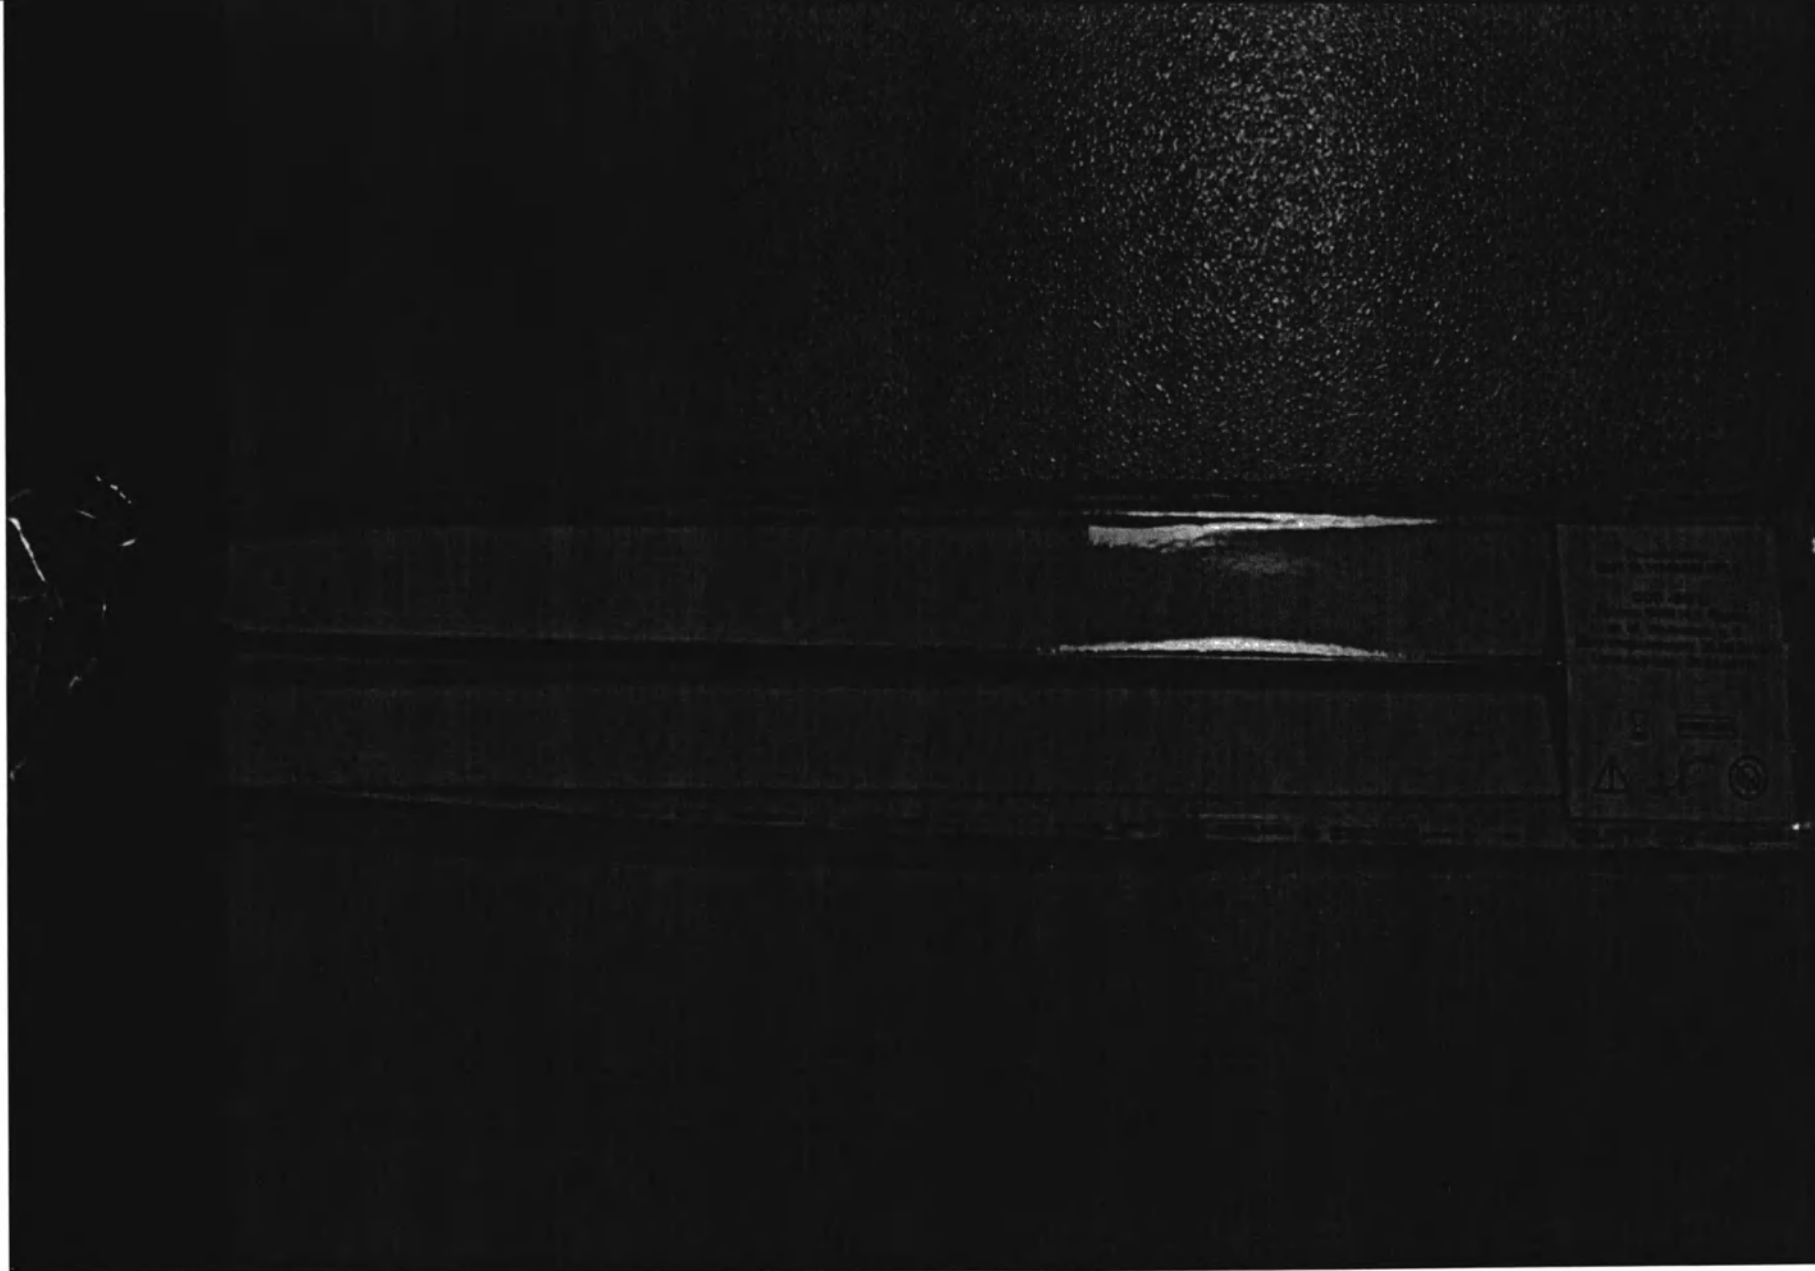

Туннелизатор



Отвертка динамометрическая

В документе пронумеровано
и прошито 9 листов

заместитель директора

ООО «ВМТ»


Белов И. А.

