

Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), в вариантах исполнения»



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 100 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 100 тестов




Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 100 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 100 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов

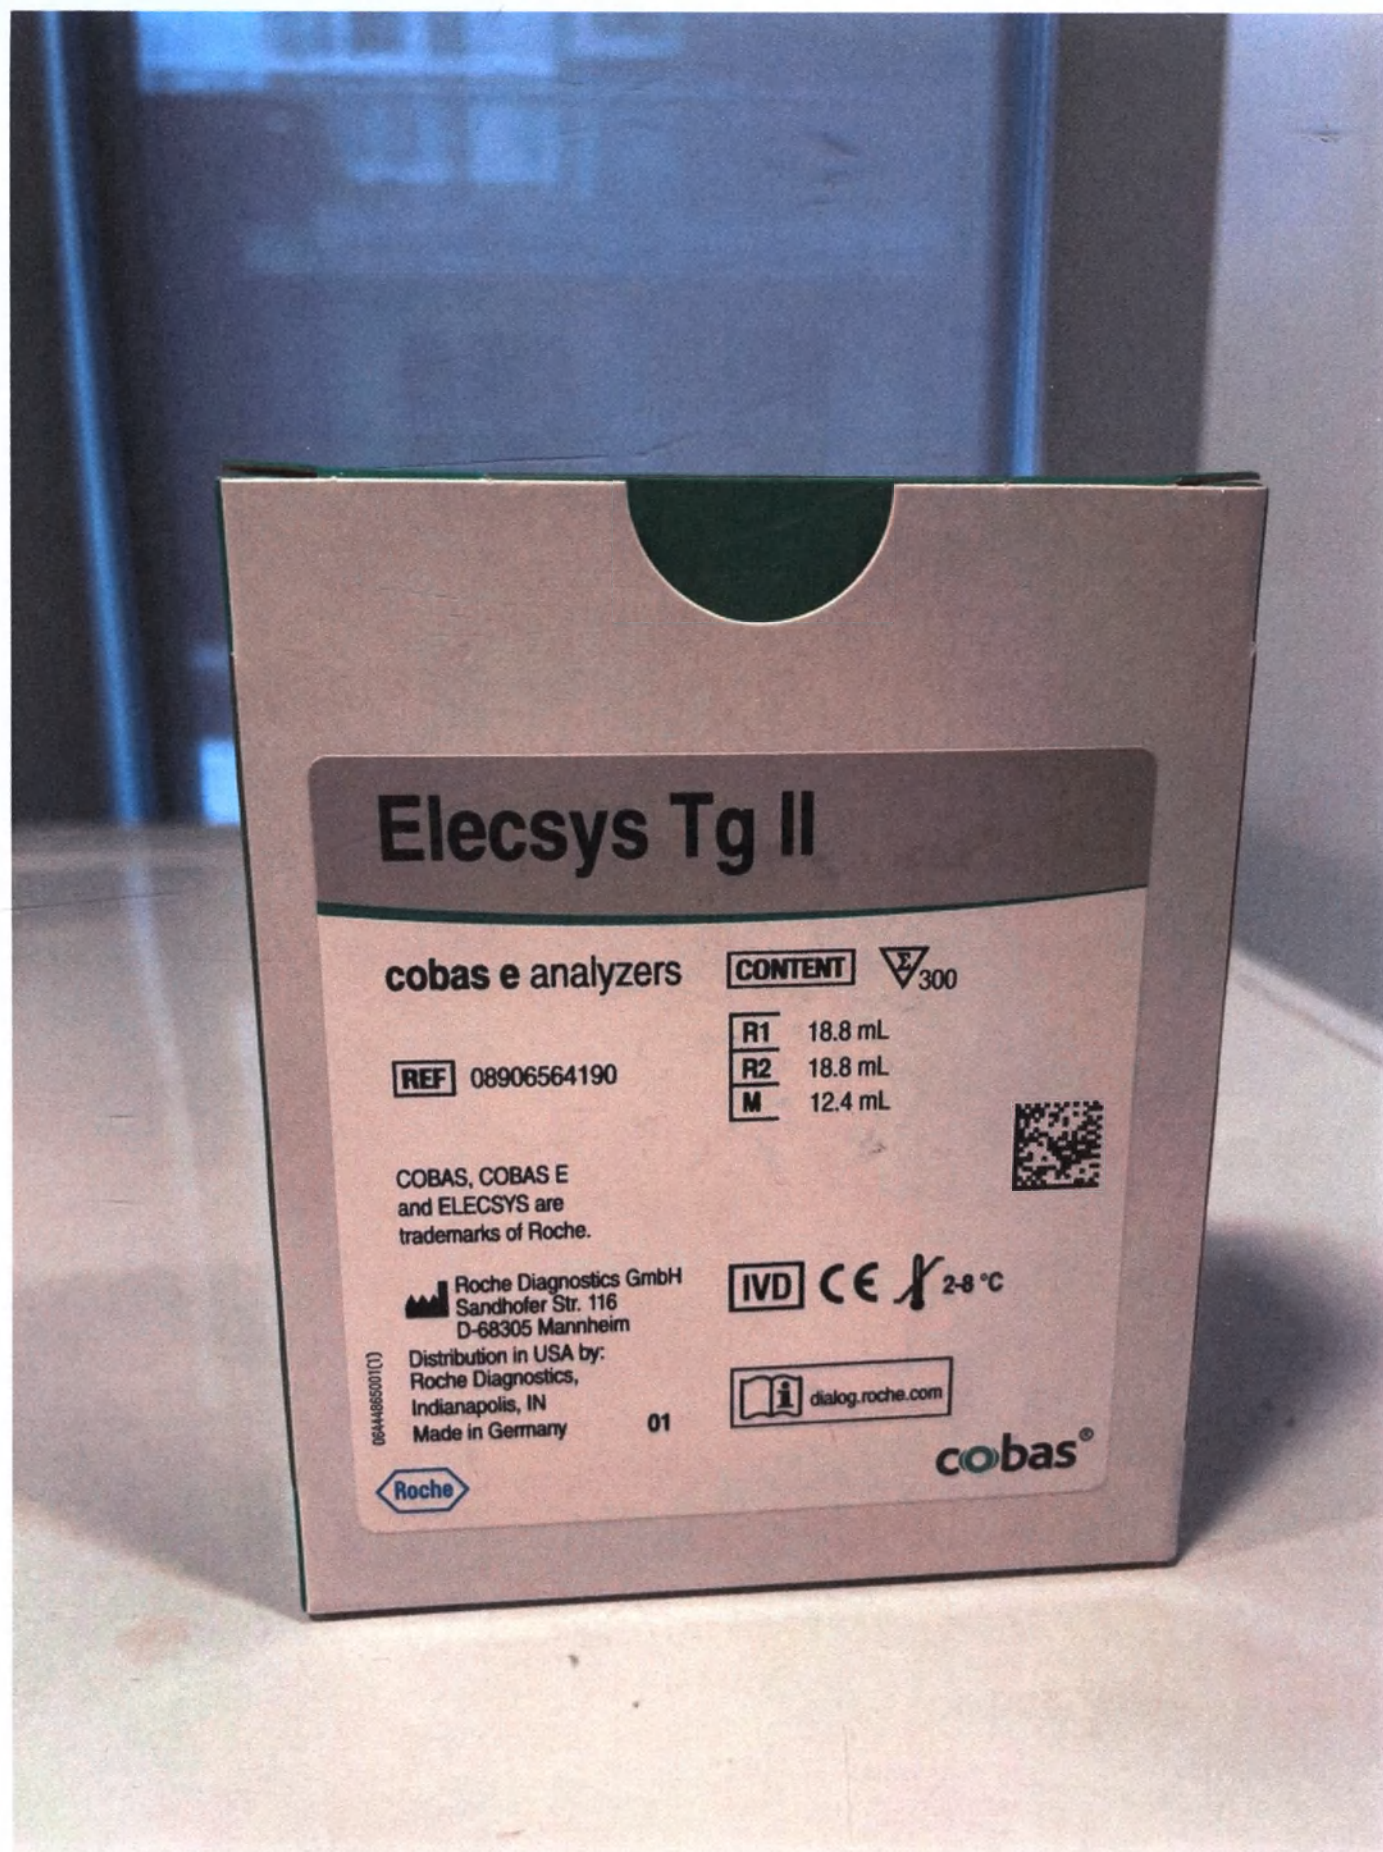

Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов

Elecsys Tg II

REF 08906564190

For USA: **CONTENT**

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Biotinylated monoclonal anti-Tg antibody (mouse) 1 mg/L
- R2** Monoclonal anti-Tg antibodies (mouse) labeled with ruthenium complex 3.1 mg/L




Rx only

01



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов

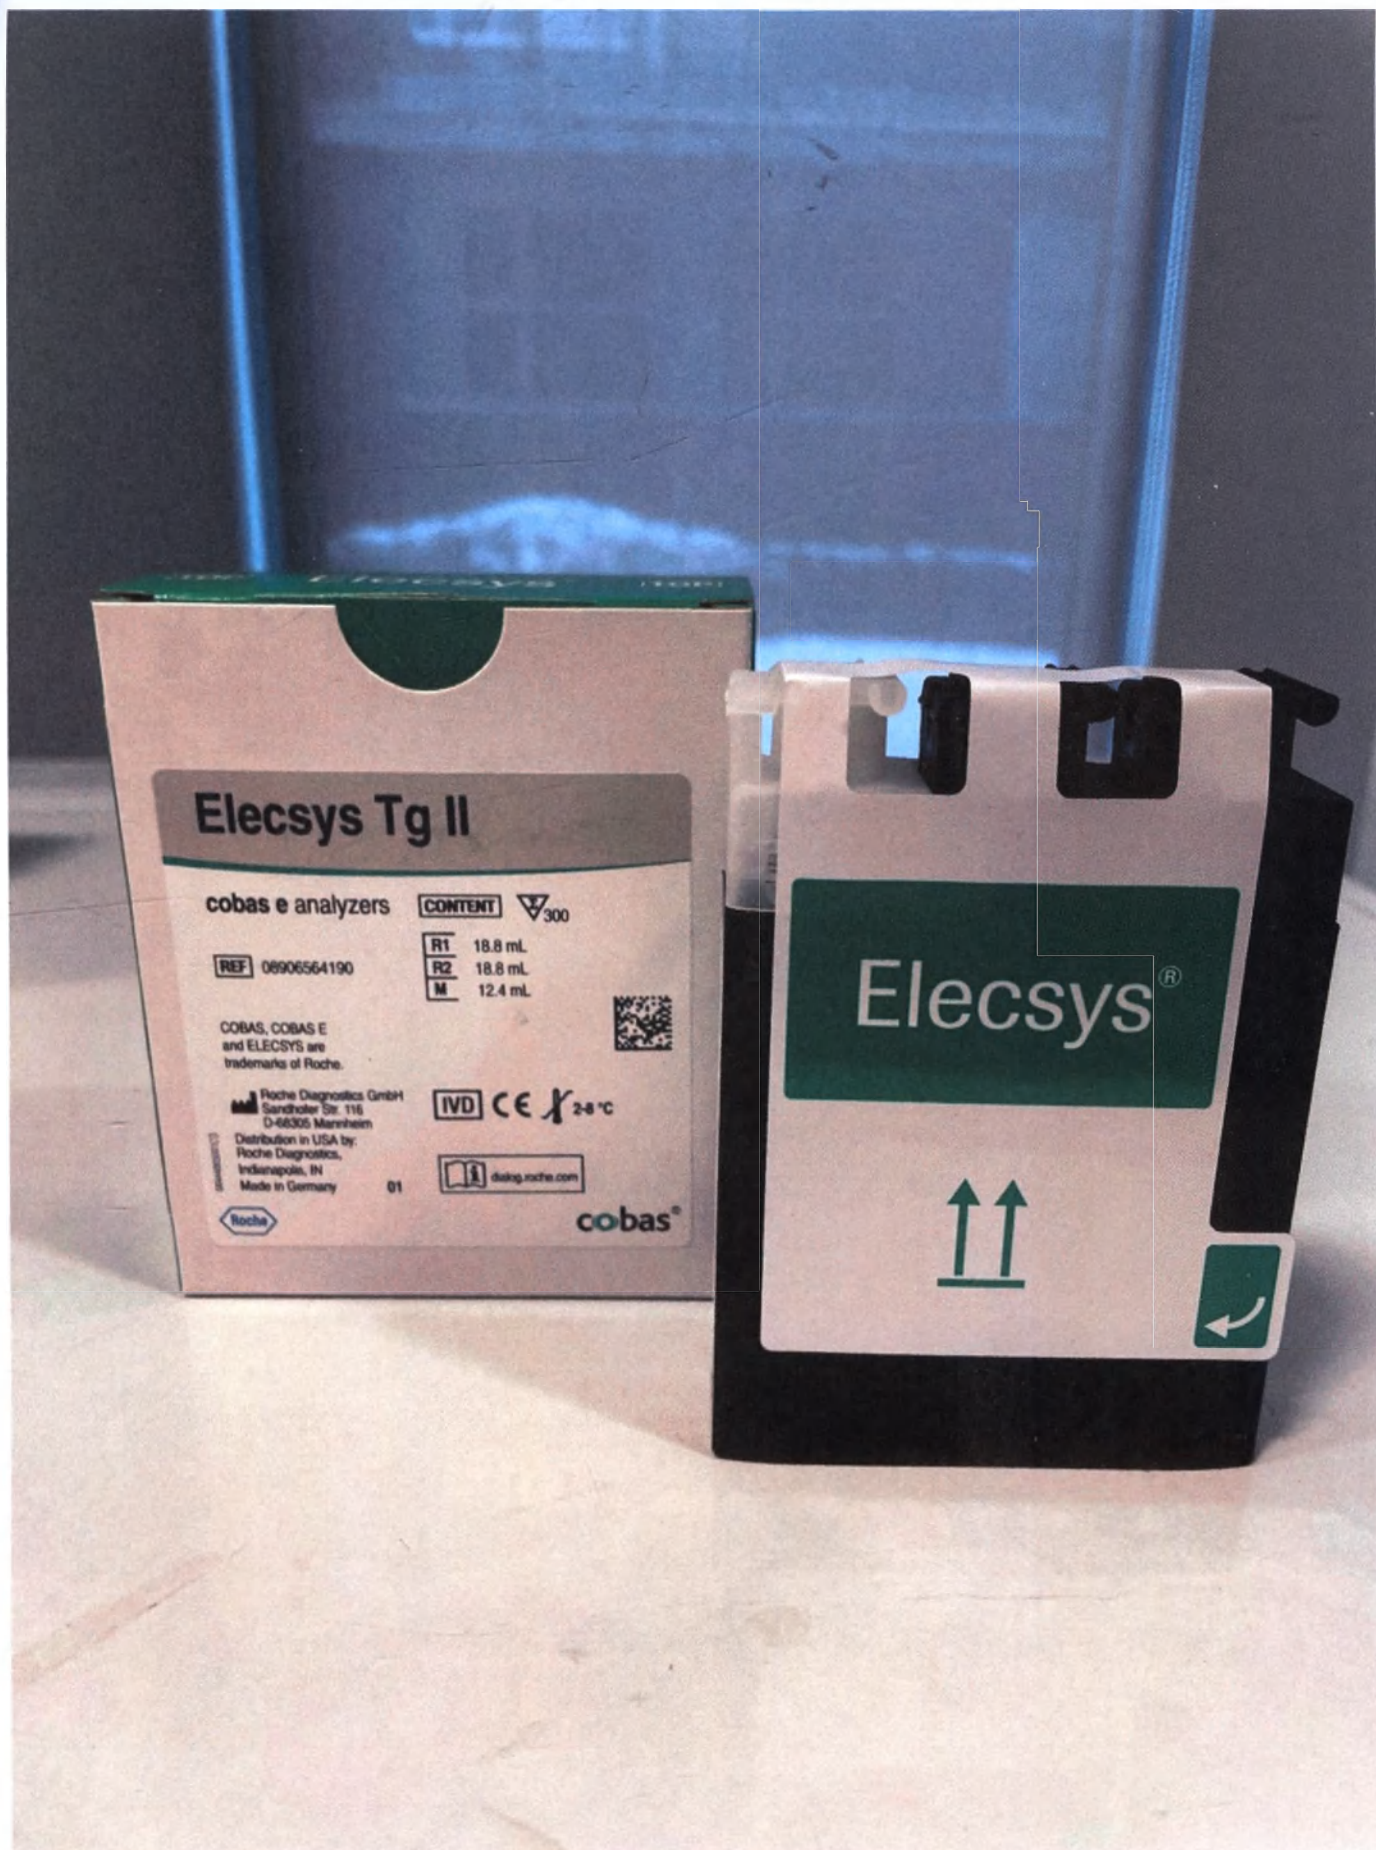

Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов

Реагенты в кассете для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers/TG 2), вариант исполнения на 300 тестов

Регистрационное удостоверение № _____ 97

Срок годности см. на упаковке

Гельература хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Дианостикус ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Издание предназначено только для диагностики *in vitro*
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Дианостикус Рус» (ООО «Рох Дианостикус Рус»), 107031, Москва, Трудовая площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-69, факс: +7 495 219-62-64. E-mail: moscow_tecservice_diagnostic@roche.com

Кат. номер 05904564190

Всего предусмотрено,
проектировано и
скреплено печатью



Вручен
по доверенности
от 04.02.2021