



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "ТТГ-Люминит"
 серия I

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
 2021 г.

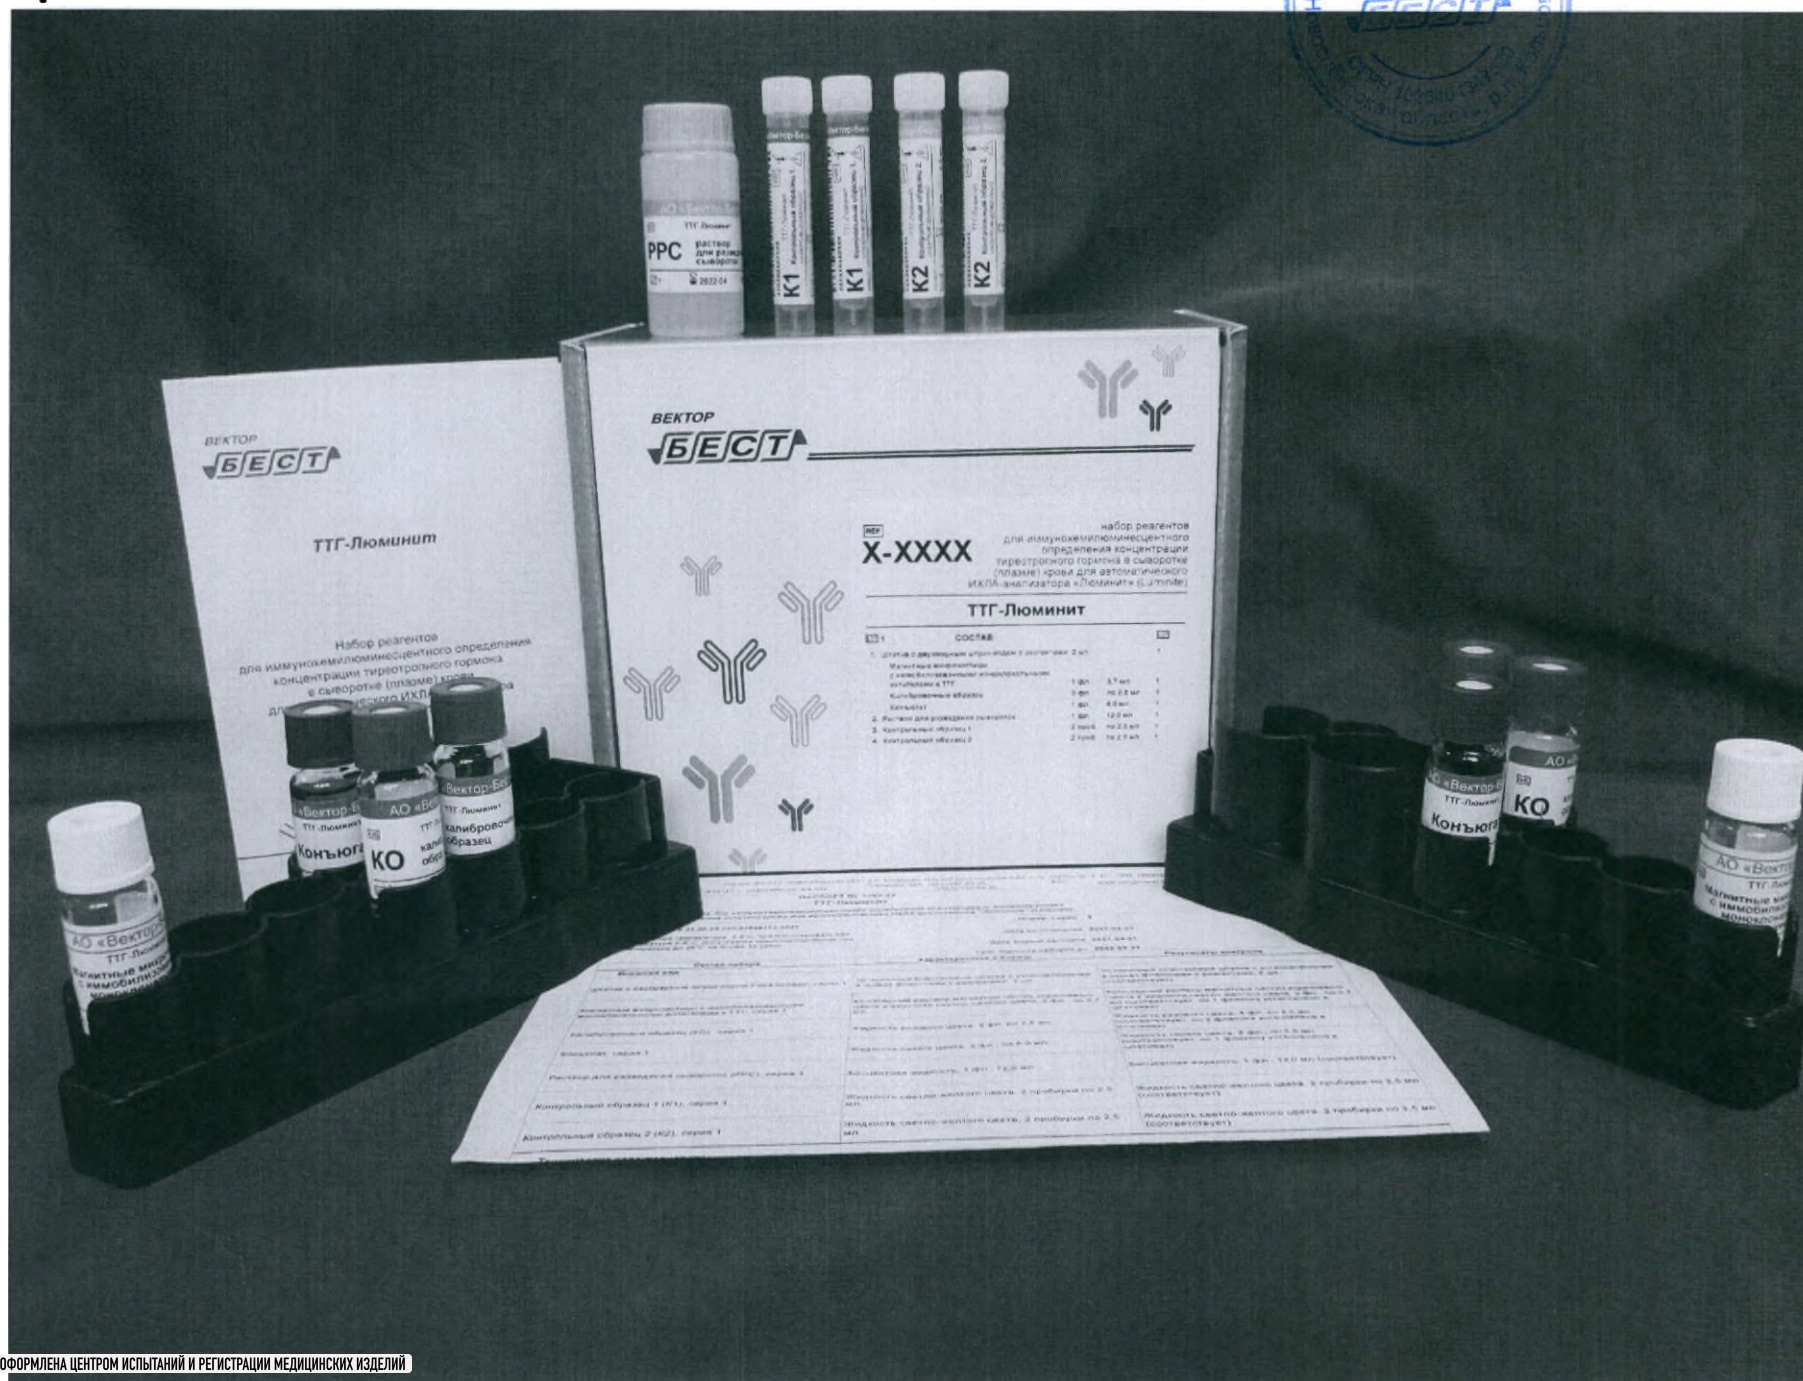

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Люминит" № 1
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусайнов
"22" 04 2021 г.

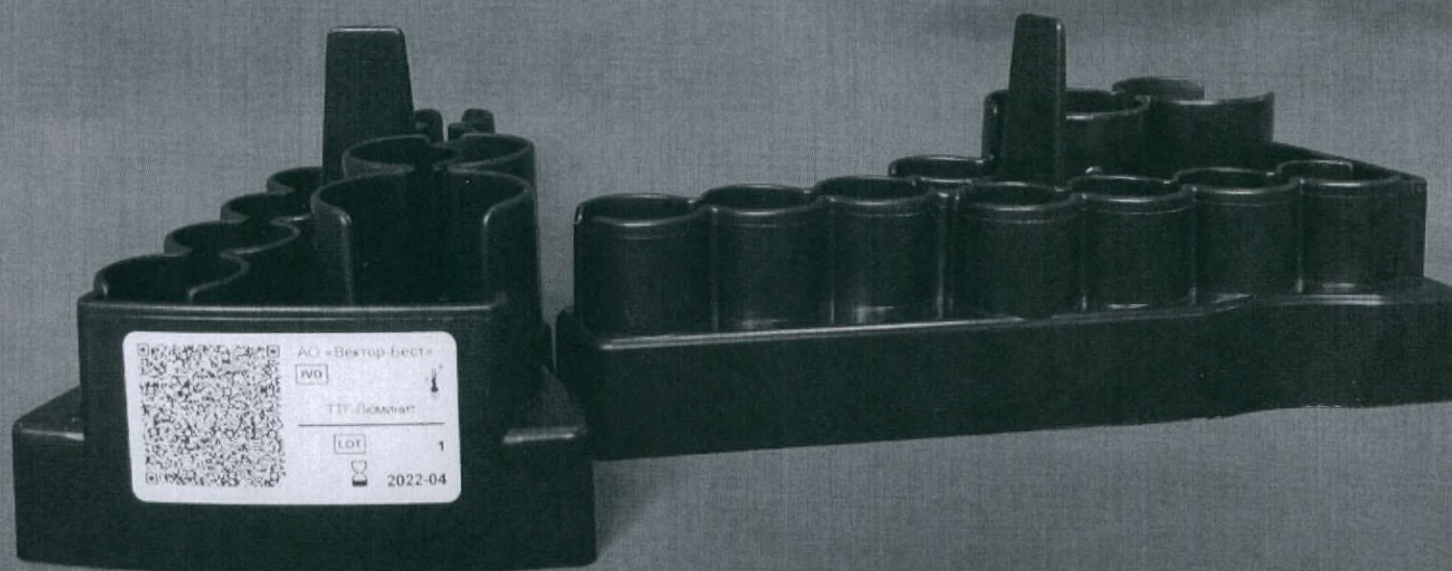

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“22” 04 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“22” 04/ 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 4
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“22” 04 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“22” 04 2021 г.

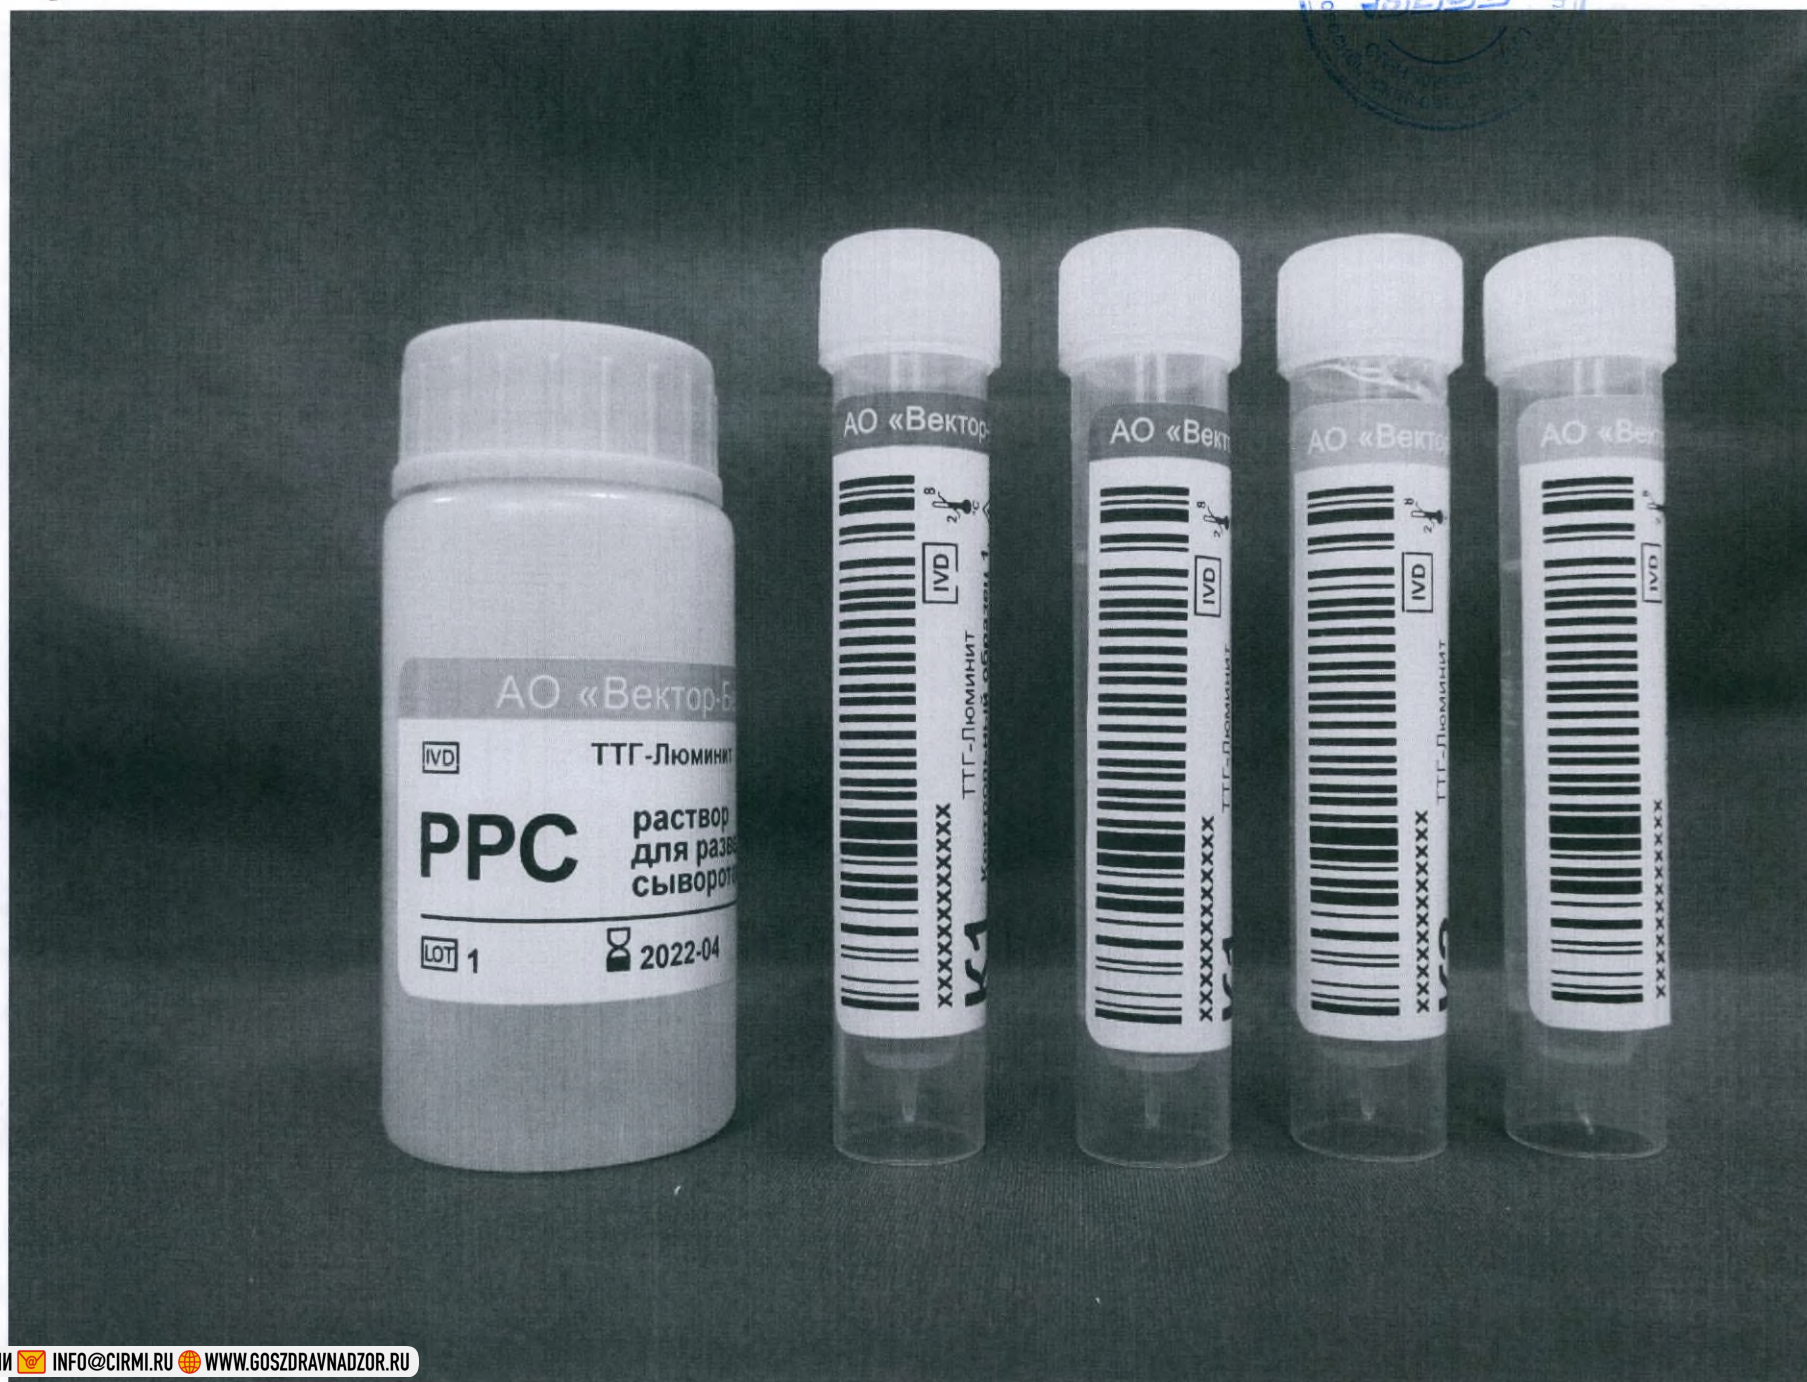

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Люминит" № 6
серия 1




Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусайнов
"28" 04 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 7
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 04 2021 г.

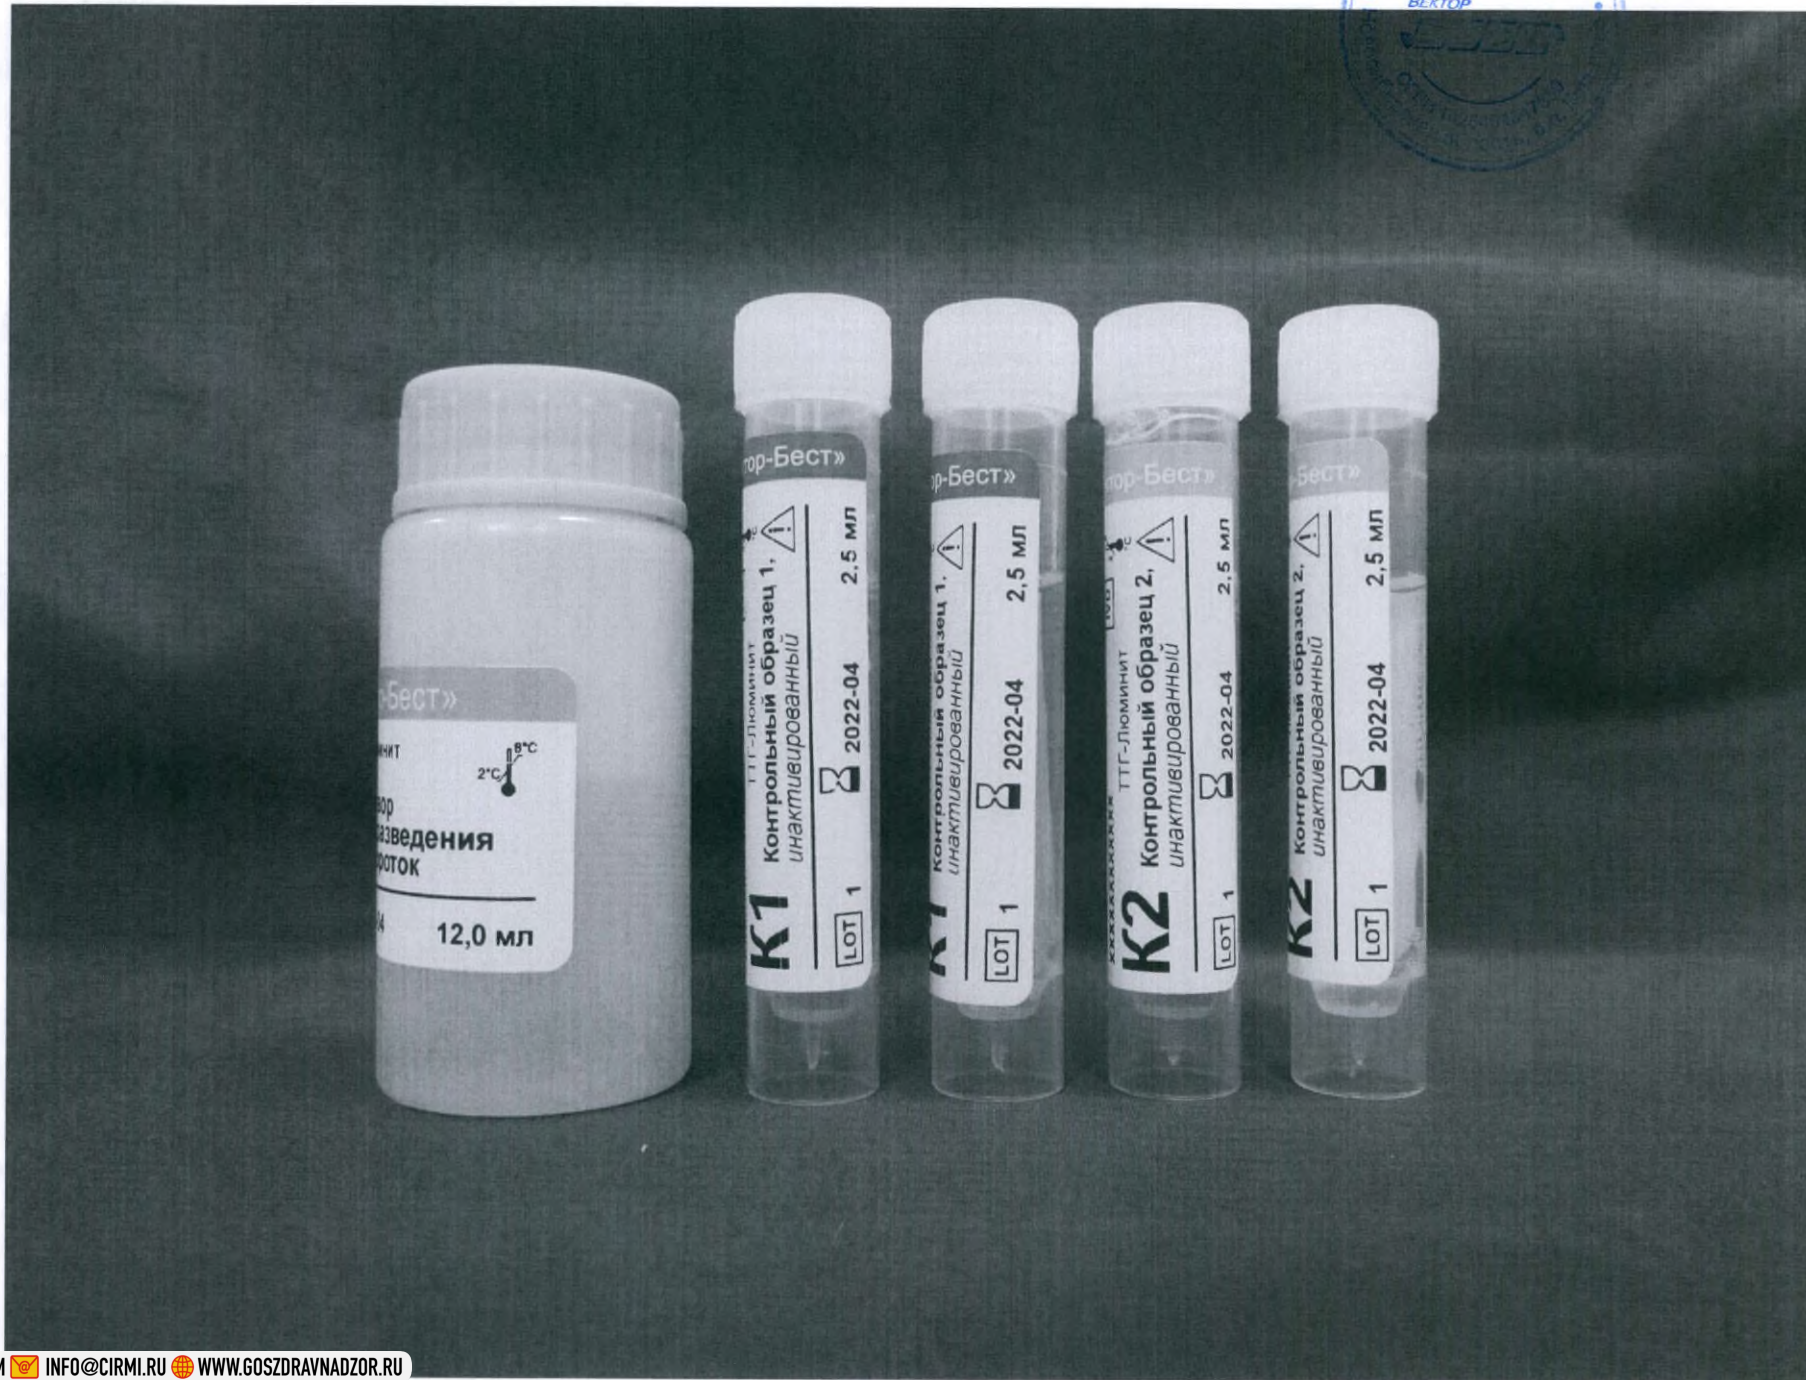

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 04 2021 г.



ВЕКТОР

БЕСТ



REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
определения концентрации
тиреотропного гормона в сыворотке
(плазме) крови для автоматического
ИХЛА-анализатора «Люминит» (Luminite)

ТТГ-Люминит


LOT 1

СОСТАВ:

LOT

1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.			1
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ	1 фл.	3,7 мл	1
Калибровочный образец	2 фл.	по 2,5 мл	1
Конъюгат	1 фл.	6,0 мл	1
2. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	1
3. Контрольный образец 1	2 проб.	по 2,5 мл	1
4. Контрольный образец 2	2 проб.	по 2,5 мл	1

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“12” 04 2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF **X-XXXX**

Σ
108

LOT

1

ТУ 21.20.23-142-23548172-2021

РУ №



2021-04-21



2022-04-21

ТТГ-Люминит

IVD





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“22” 04/ 2021 г.

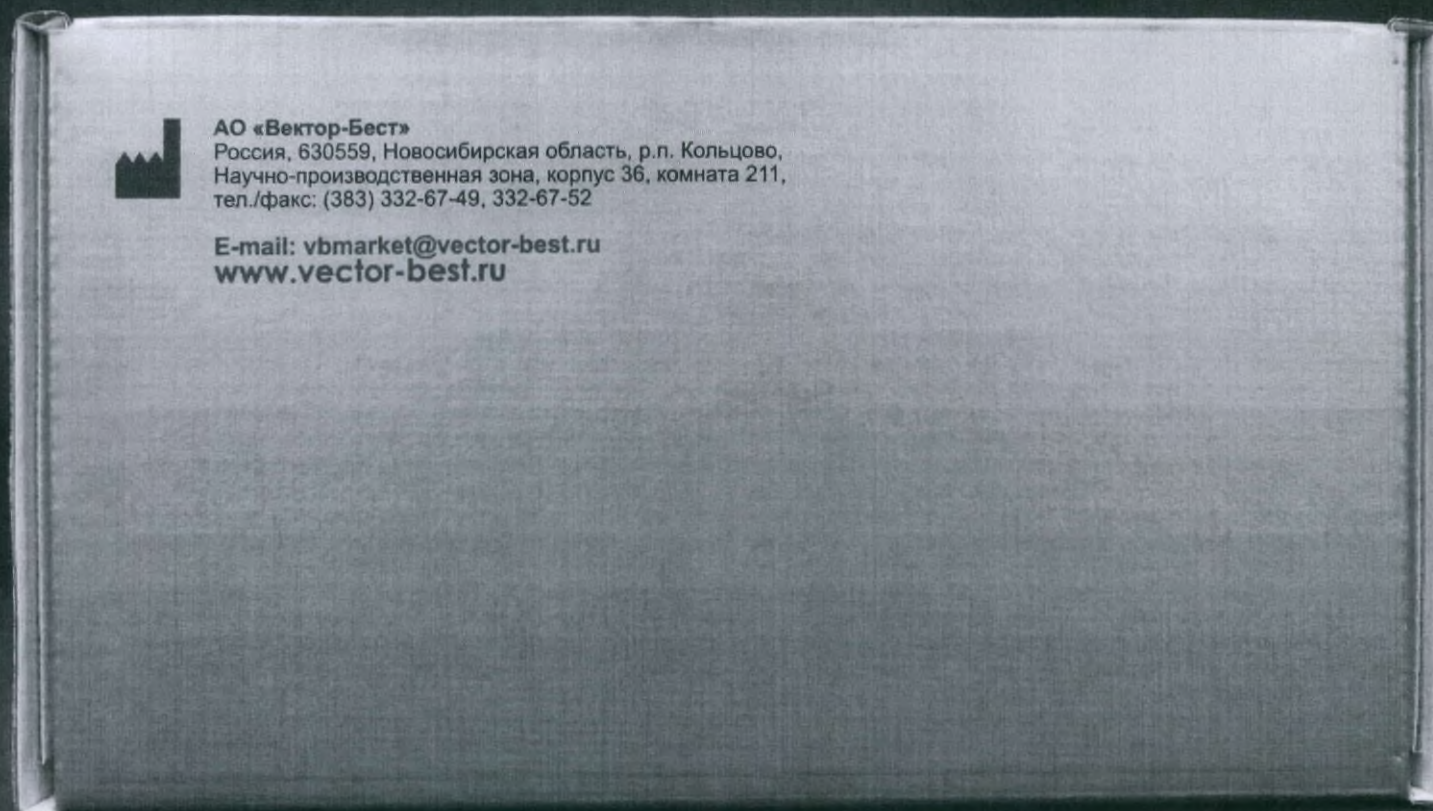


 АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “ТТГ-Люминит”
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “22” 04 2021 г.

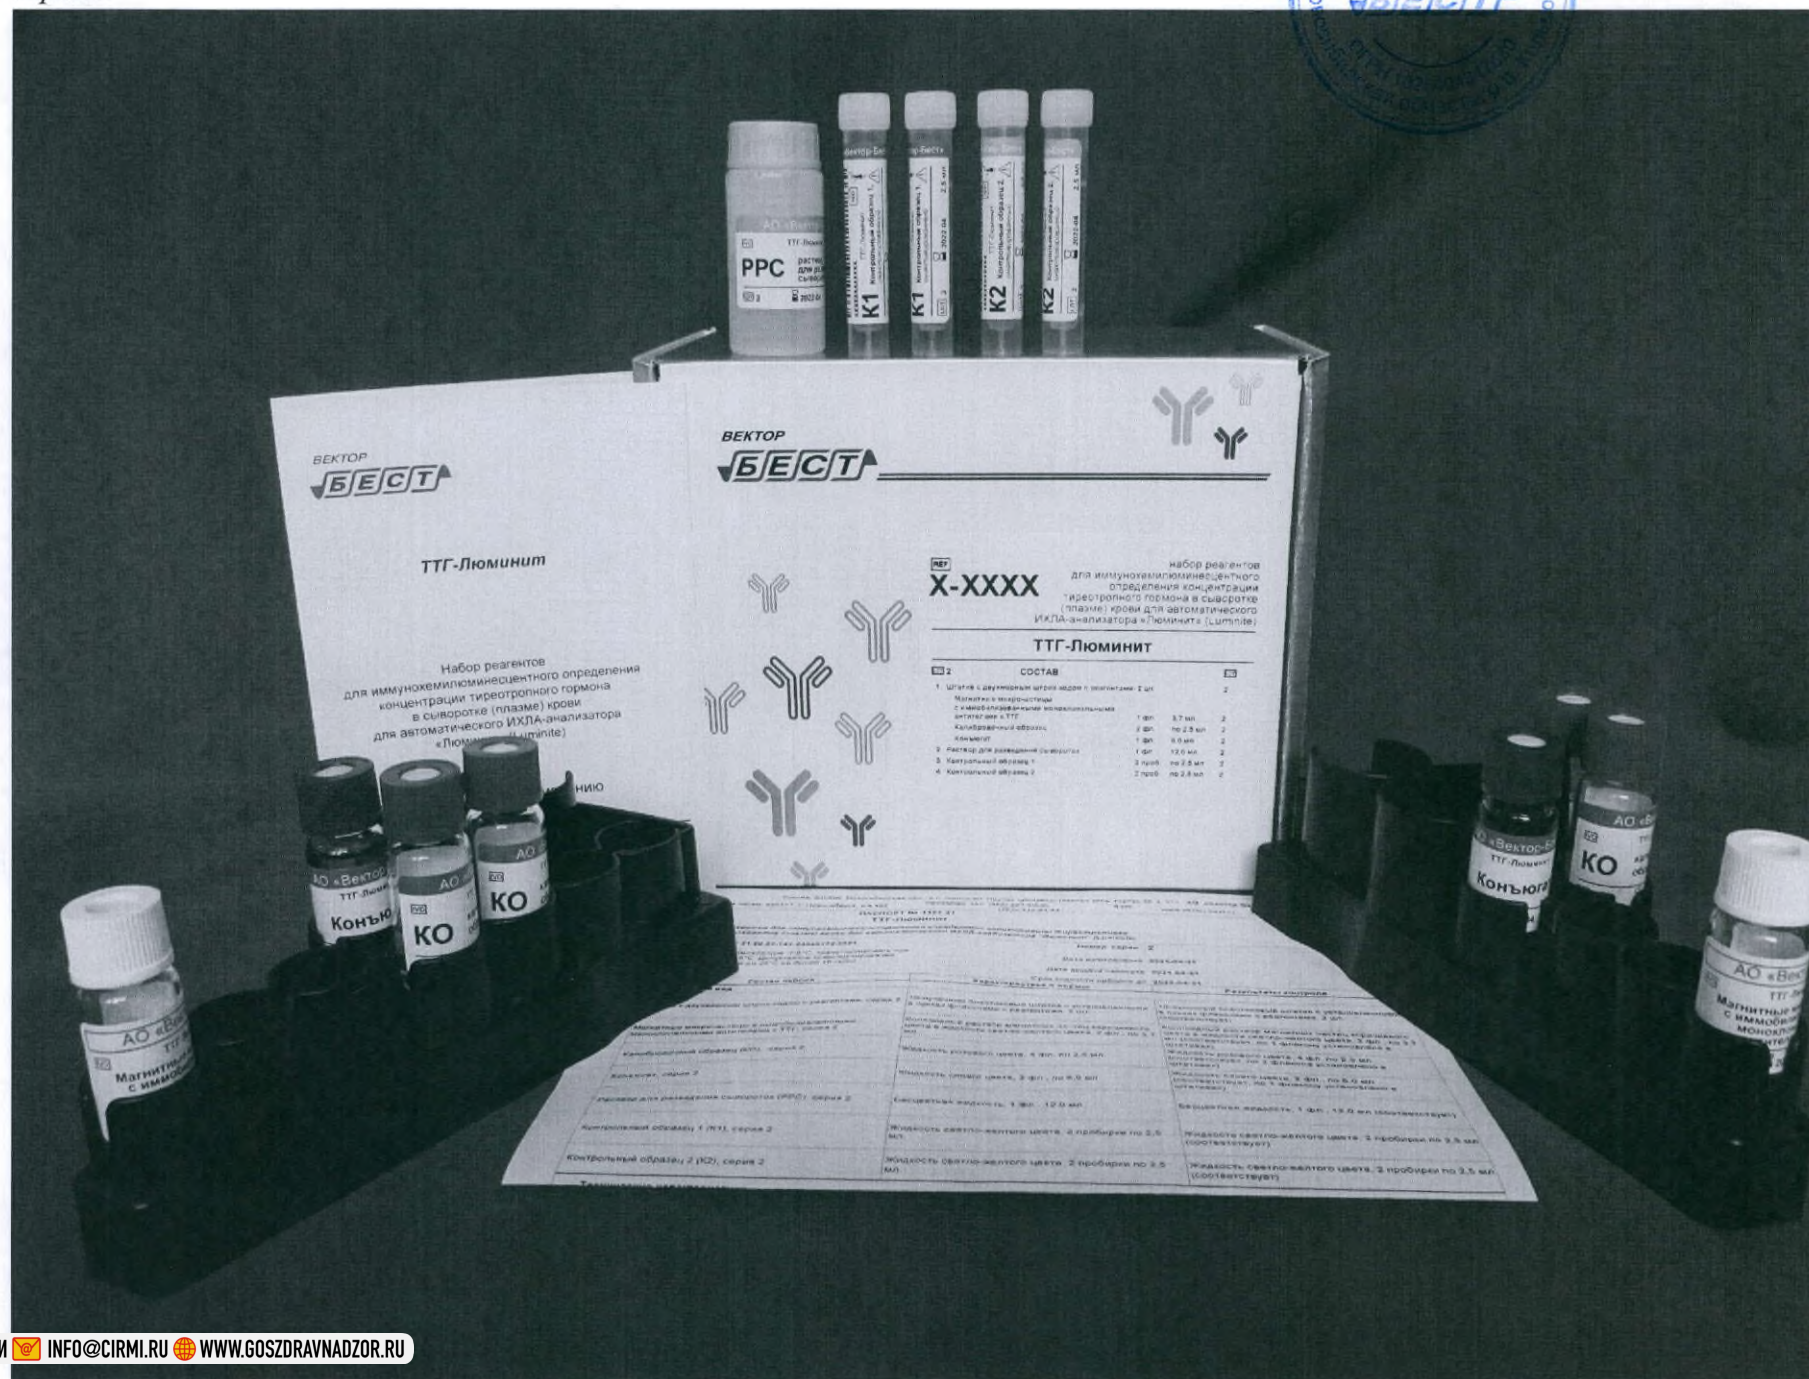

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“22” 04/ 2021 г.

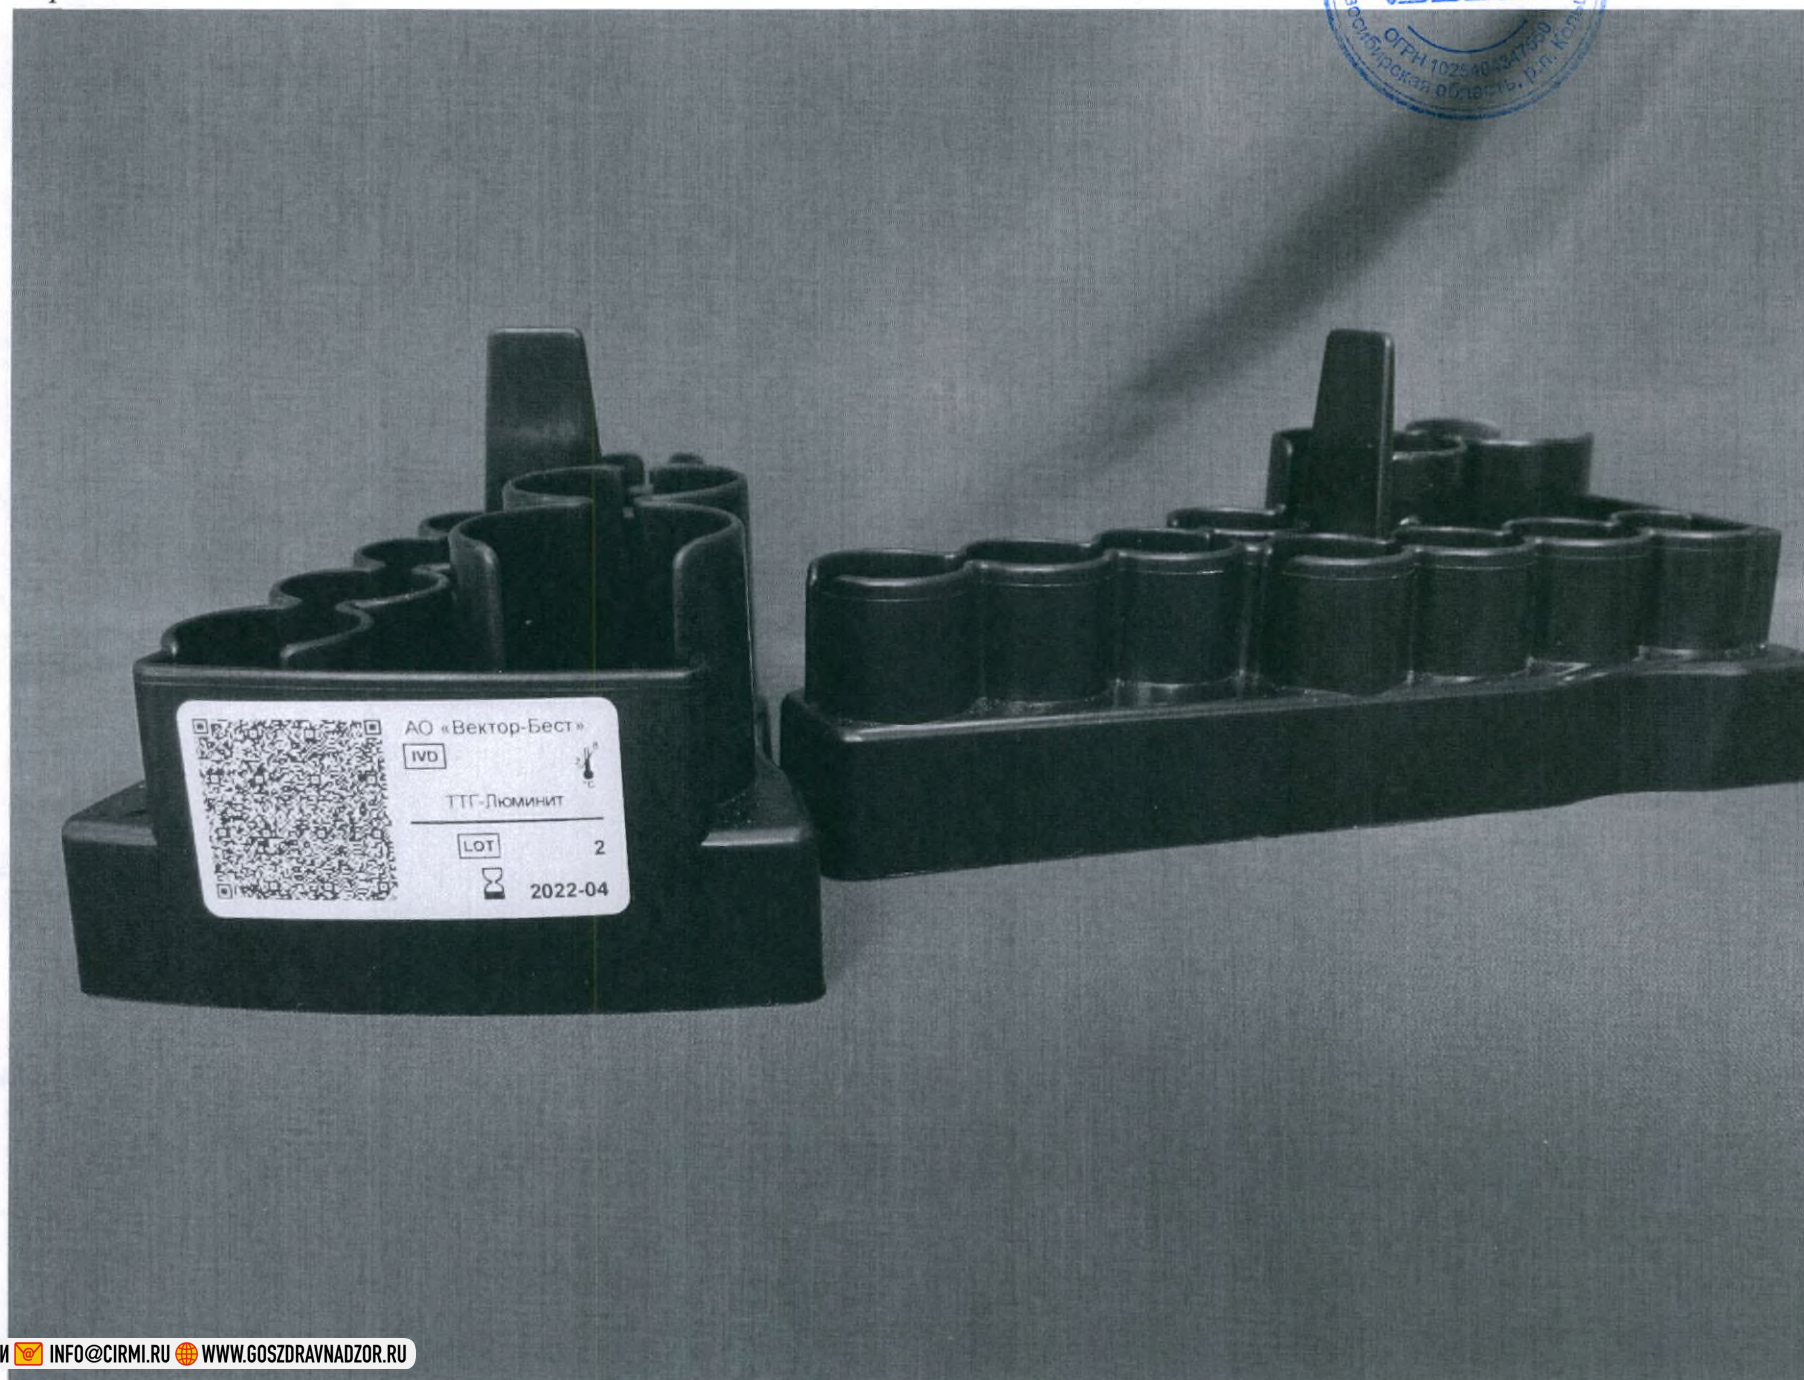

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
22.04.2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 3
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов




“22” 04 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 4
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“22” 04 2021 г.

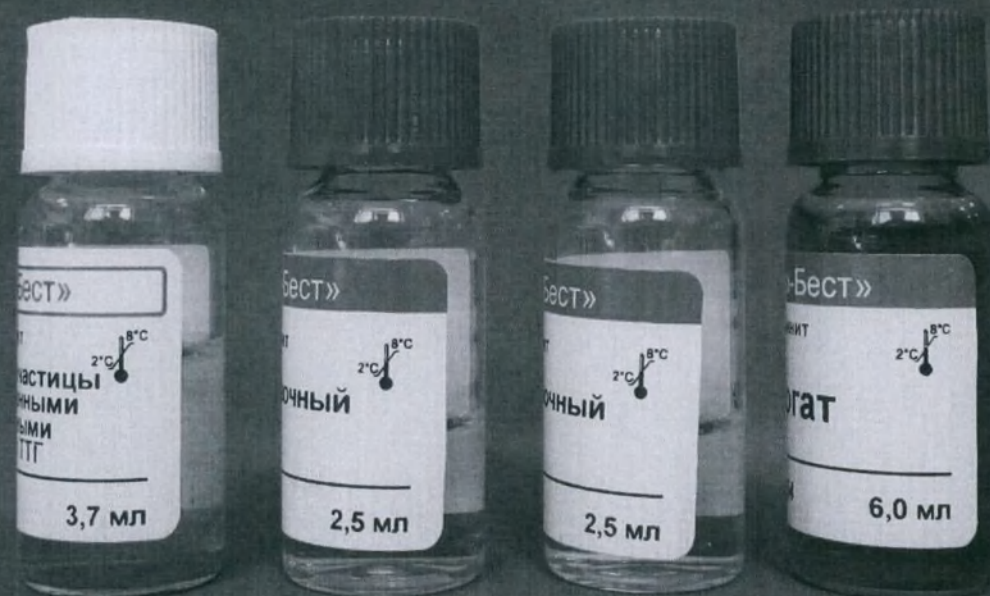

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“22” 04 2021 г.

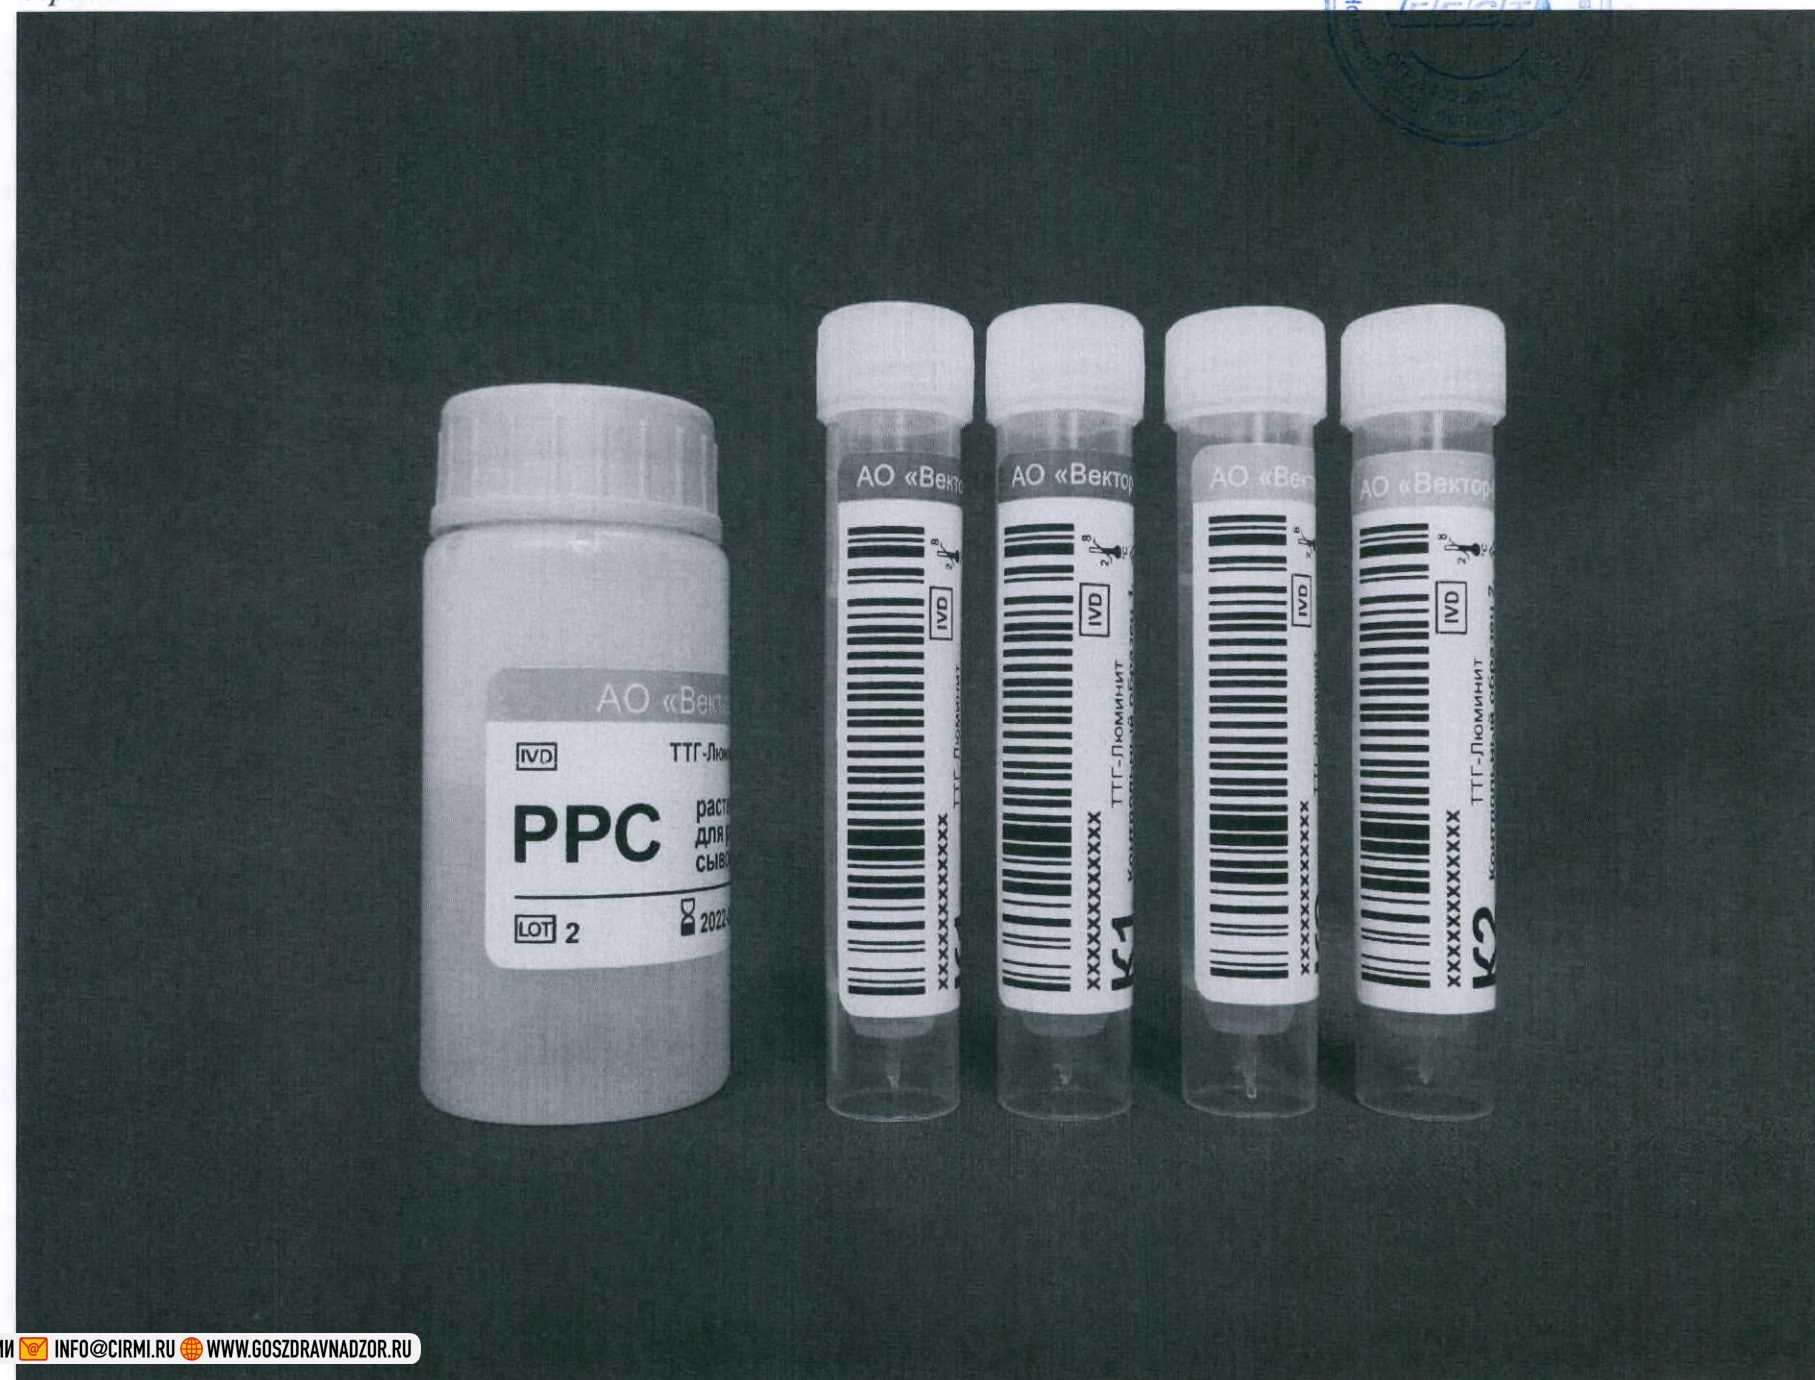


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«ТТГ-Люминит» № 6
серия 2



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусанов
11.04.2021 г.

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Люминит" № 7
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
22.04.2021 г.

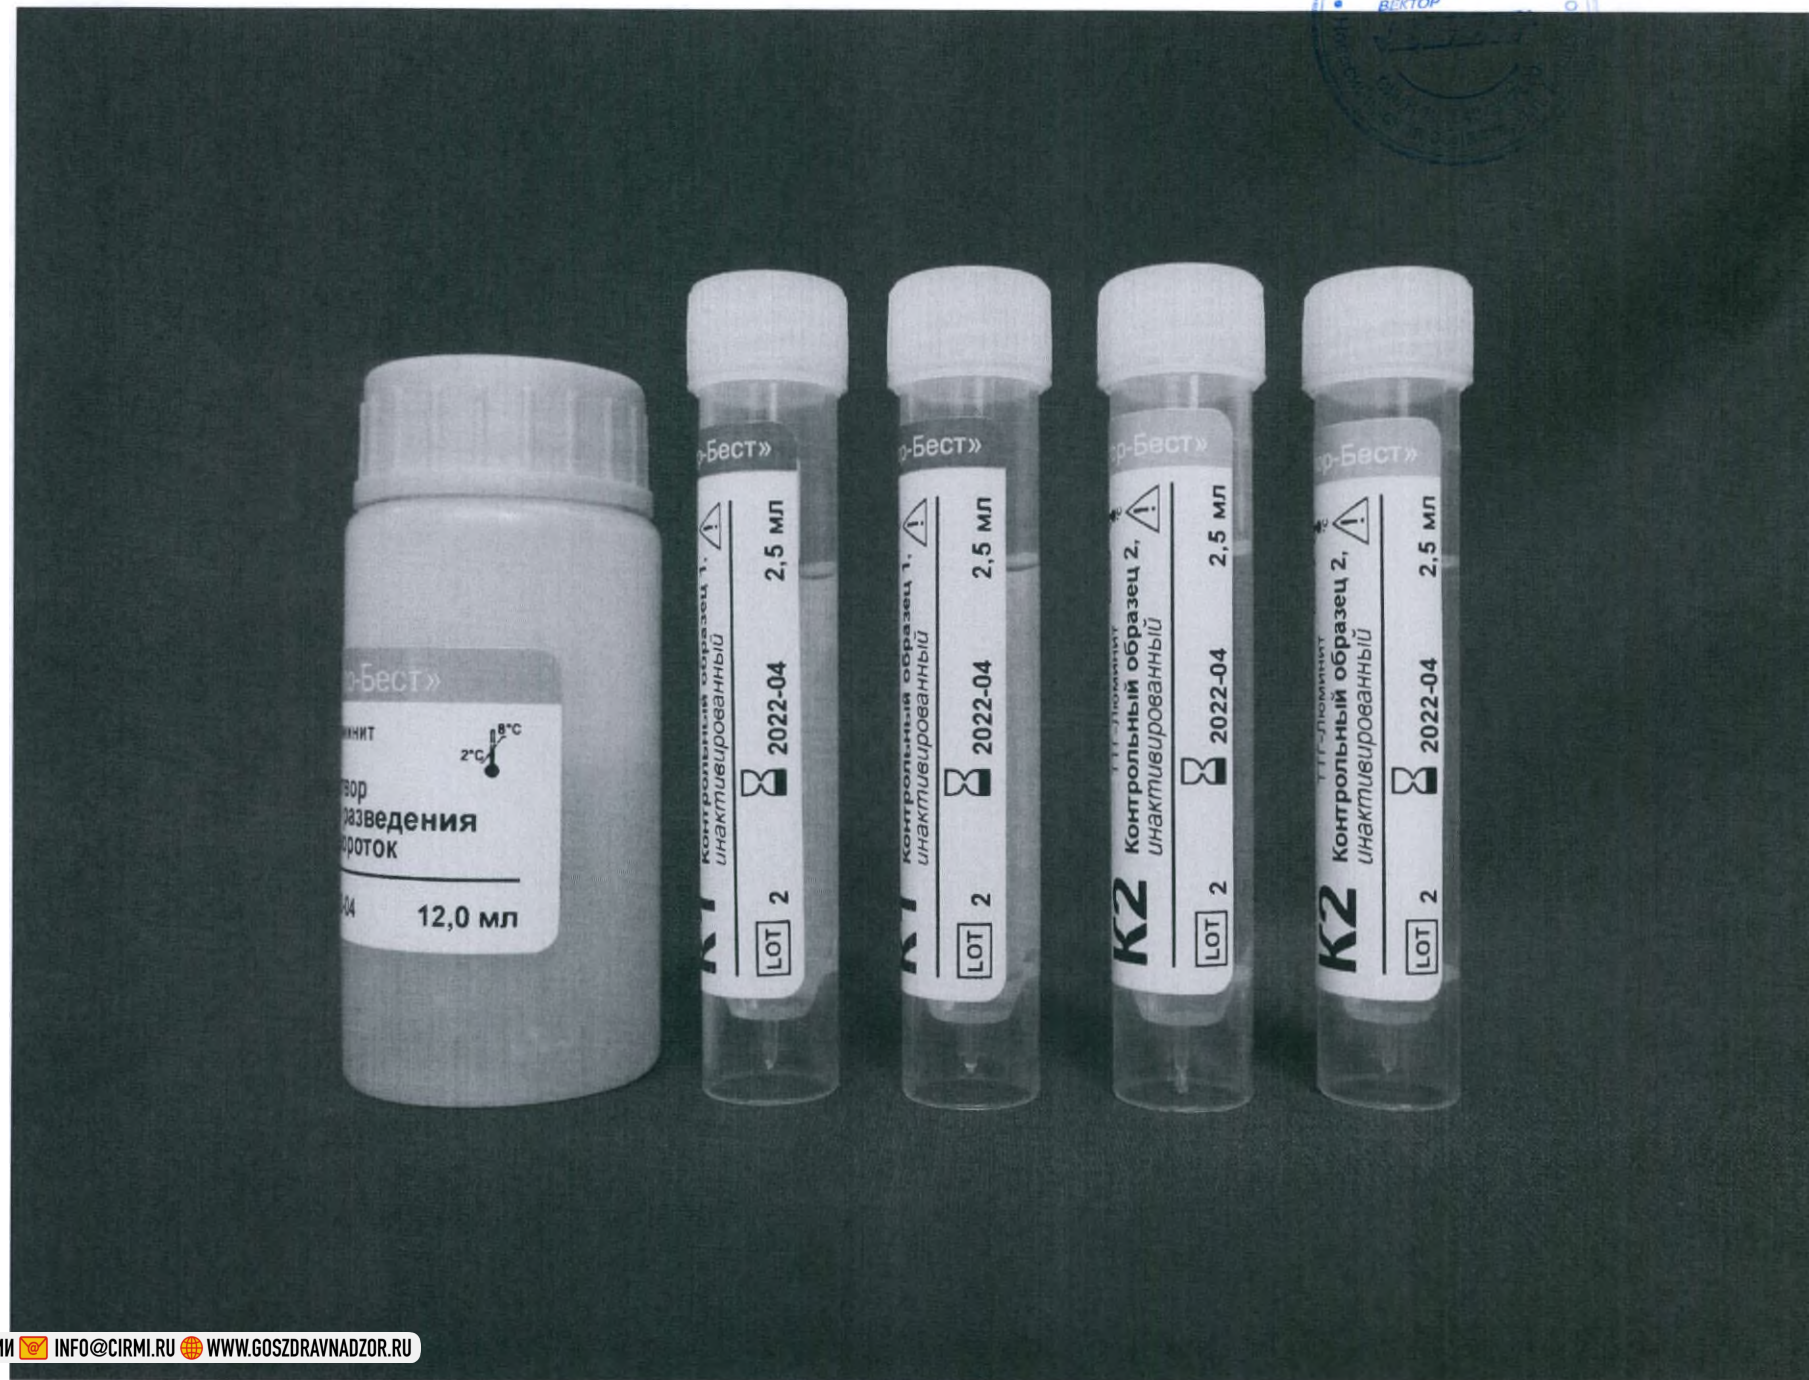

ВЕКТОР
БЕСТ



REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
определения концентрации
тиреотропного гормона в сыворотке
(плазме) крови для автоматического
ИХЛА-анализатора «Люминит» (Luminite)

ТТГ-Люминит

LOT 2

СОСТАВ:


LOT

1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.			2
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ	1 фл.	3,7 мл	2
Калибровочный образец	2 фл.	по 2,5 мл	2
Конъюгат	1 фл.	6,0 мл	2
2. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	2
3. Контрольный образец 1	2 проб.	по 2,5 мл	2
4. Контрольный образец 2	2 проб.	по 2,5 мл	2


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ТТГ-Люминит" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов

"22" 04 2021 г.

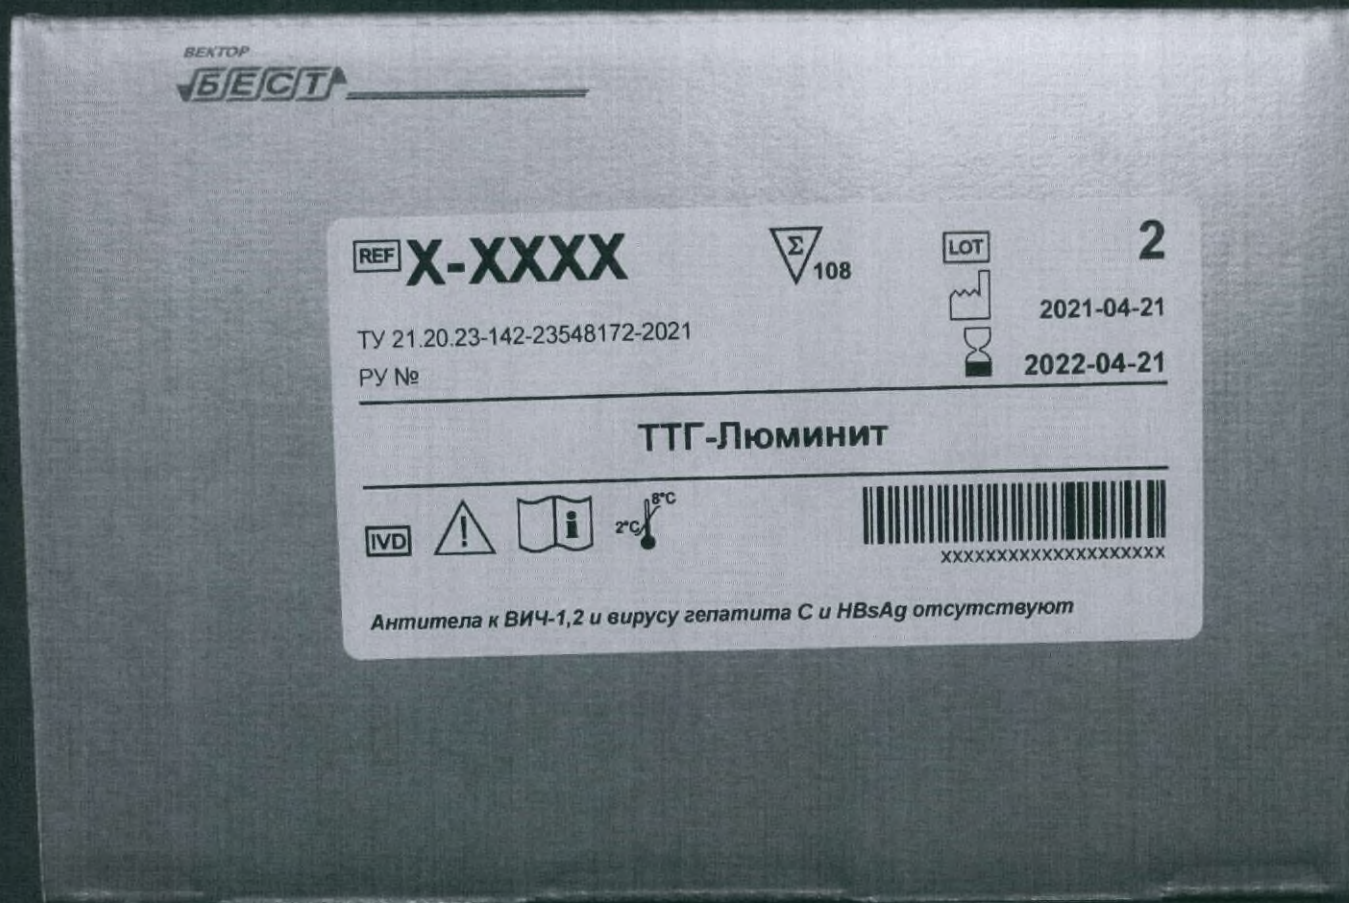

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Люминит” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“22” 04 2021 г.

