


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РАДИАТЕХ»





 Косьяненко С.В.

20 22 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ИНГАЛЯТОР ДЛЯ ДЫХАНИЯ
ПОДОГРЕТОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСЬЮ
ТЕРМОГЕЛИКС ПРО
по ТУ 32.50.21-007-02353754-2021**

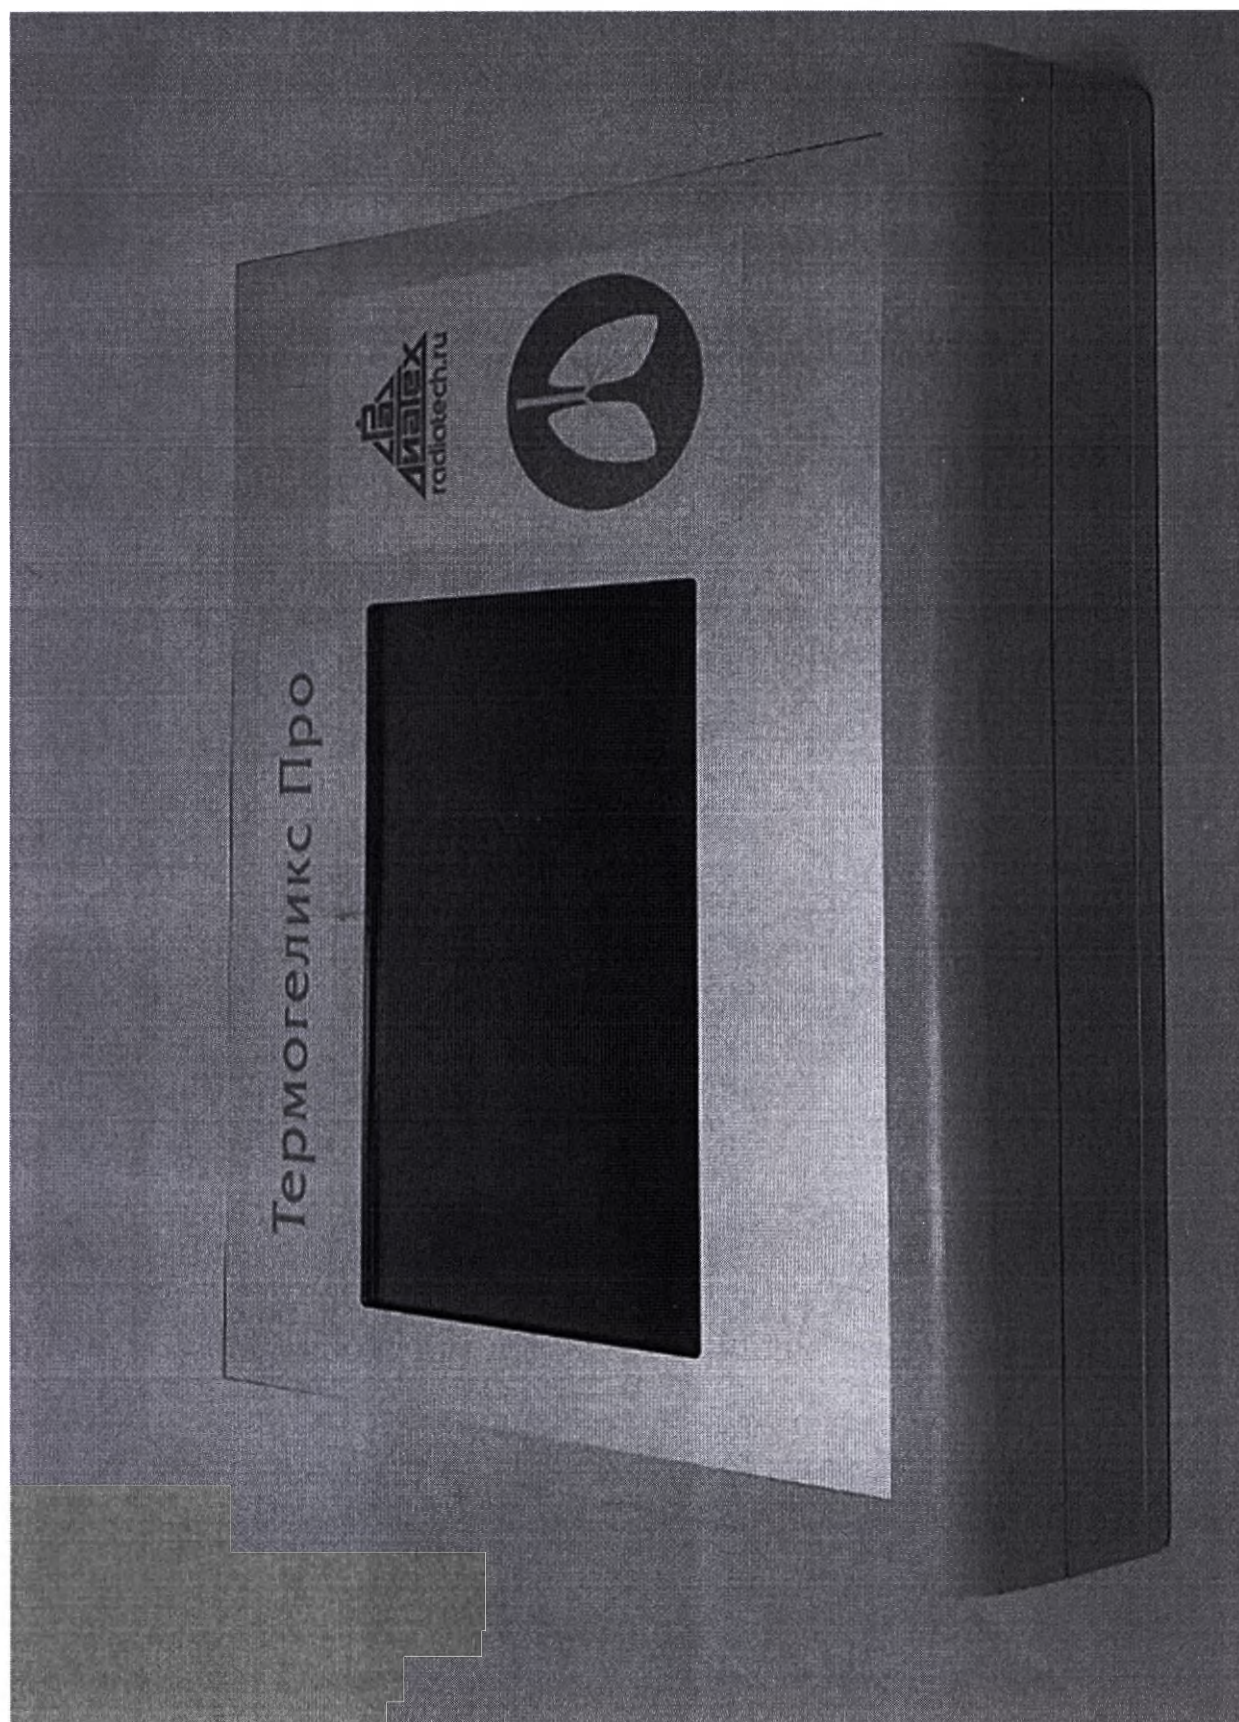

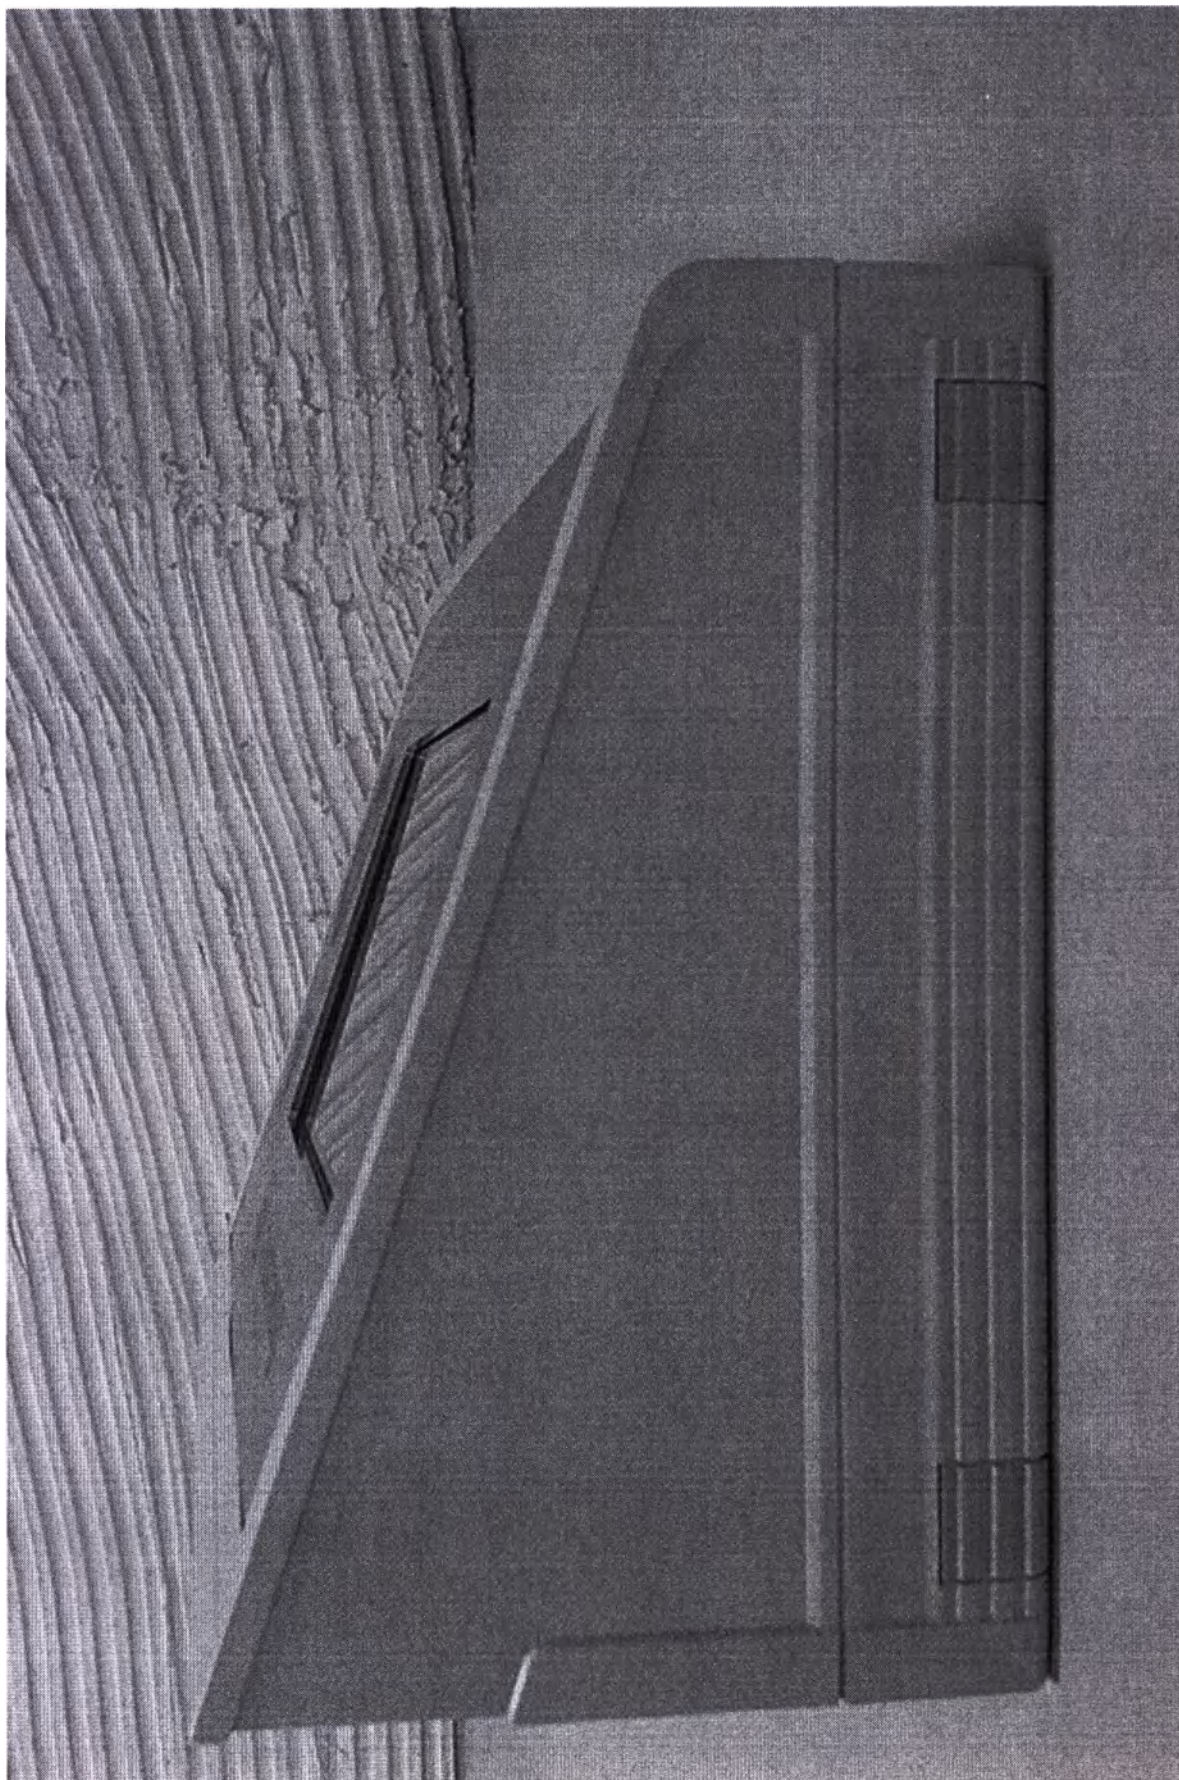


Внешний вид задней поверхности блока управления

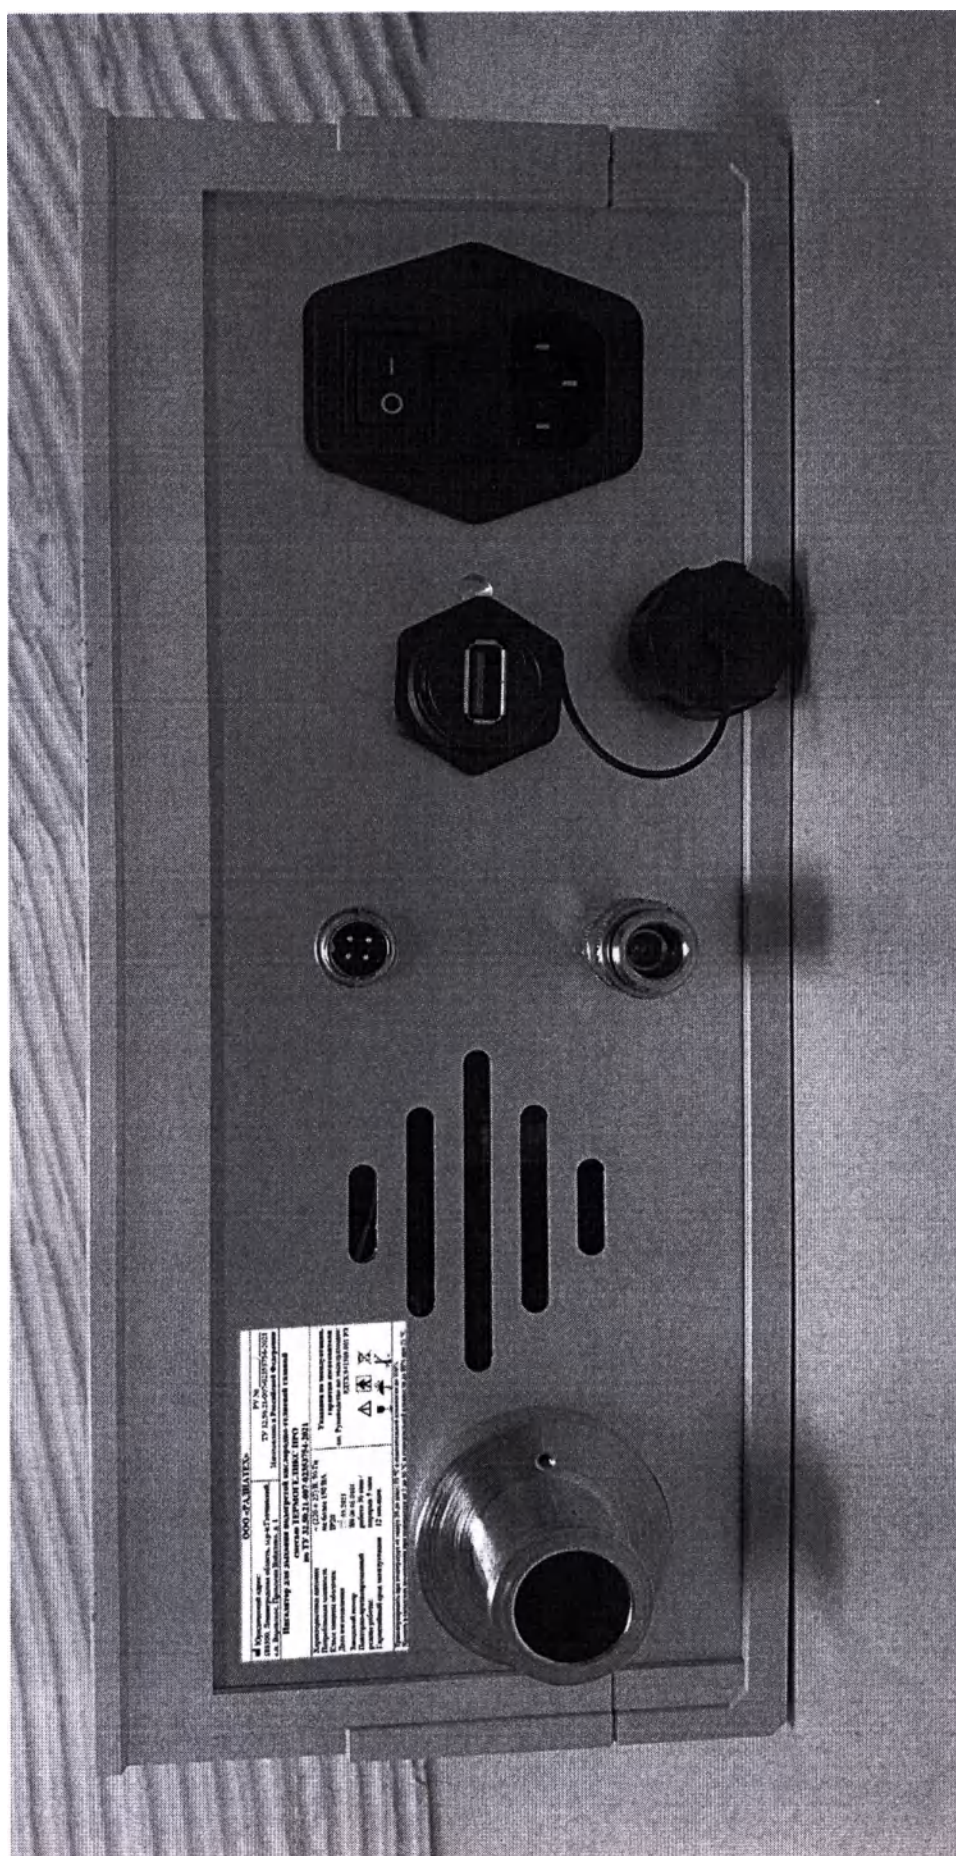


Внешний вид нагревательного элемента




Внешний вид кислородной трубки высокого давления в комплекте с соединителями

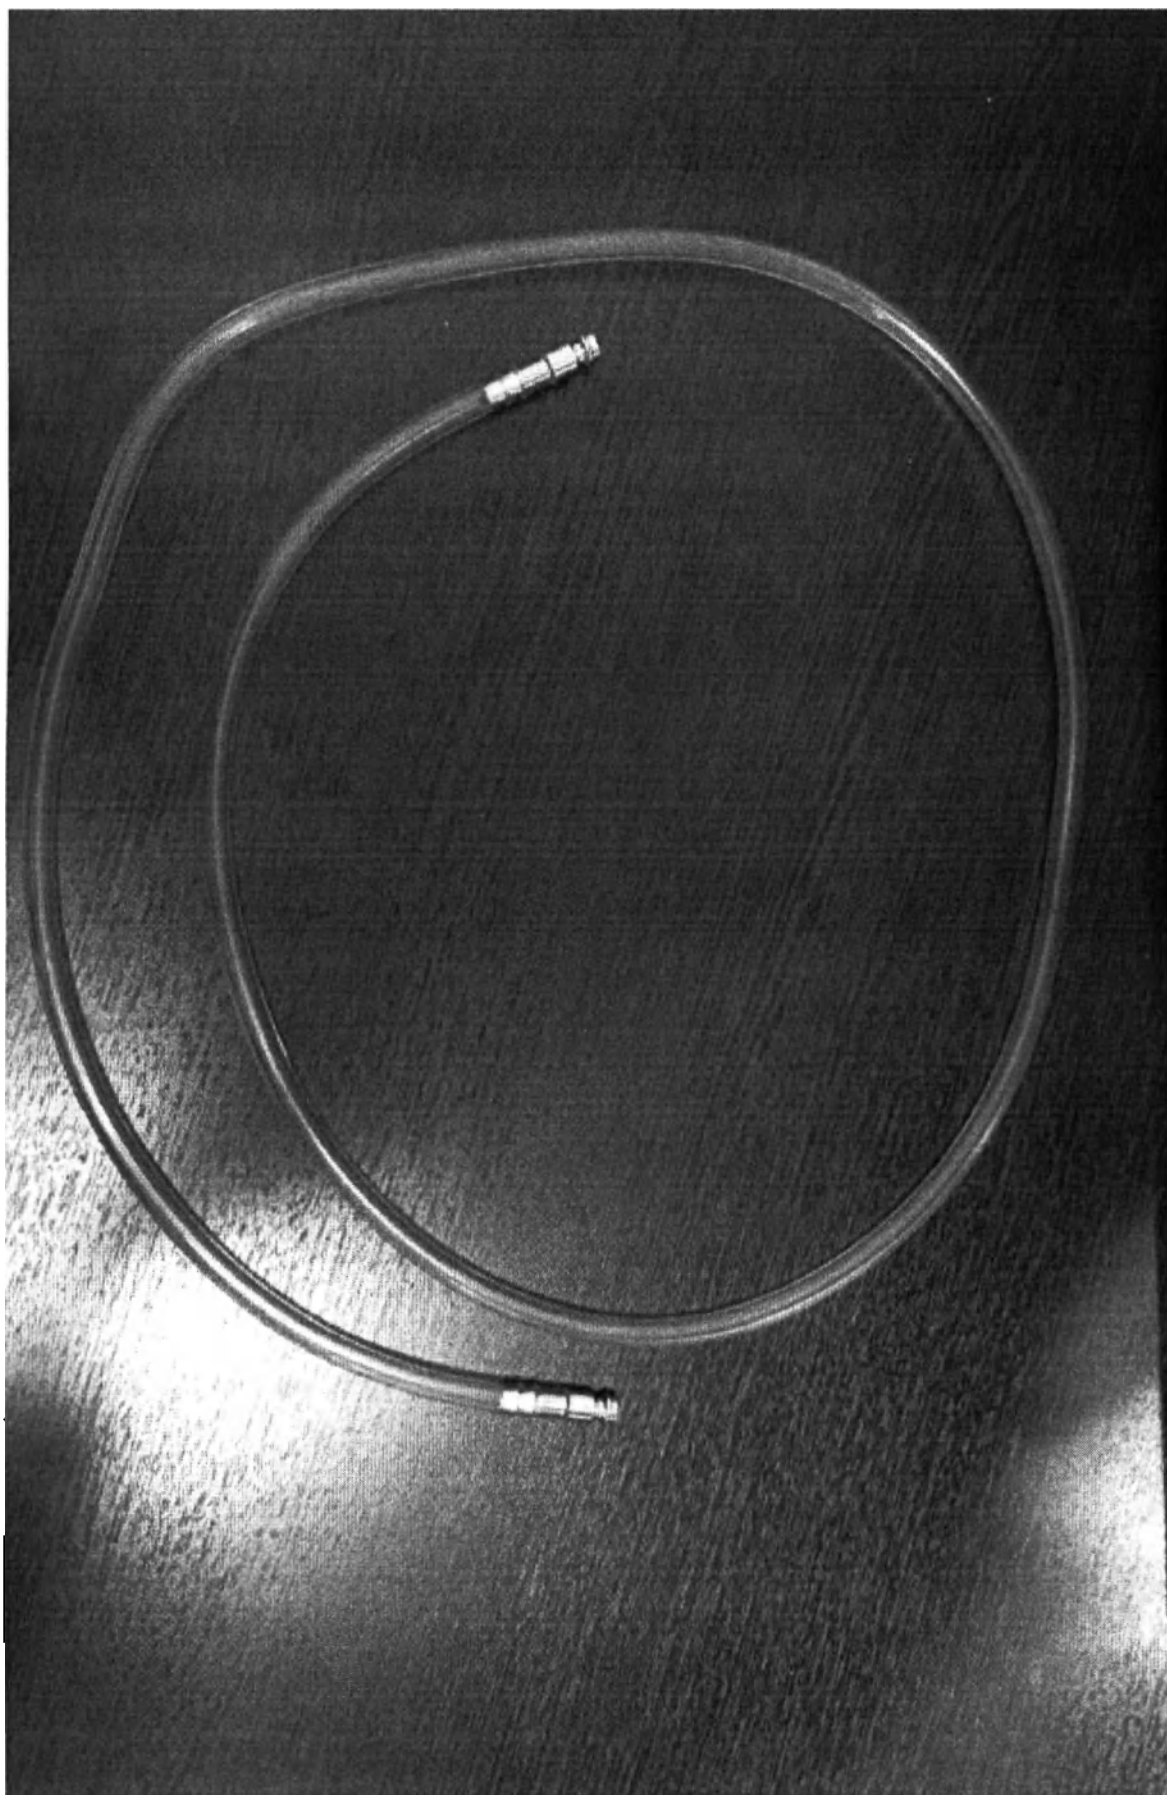

Небулайзер с кабелем питания

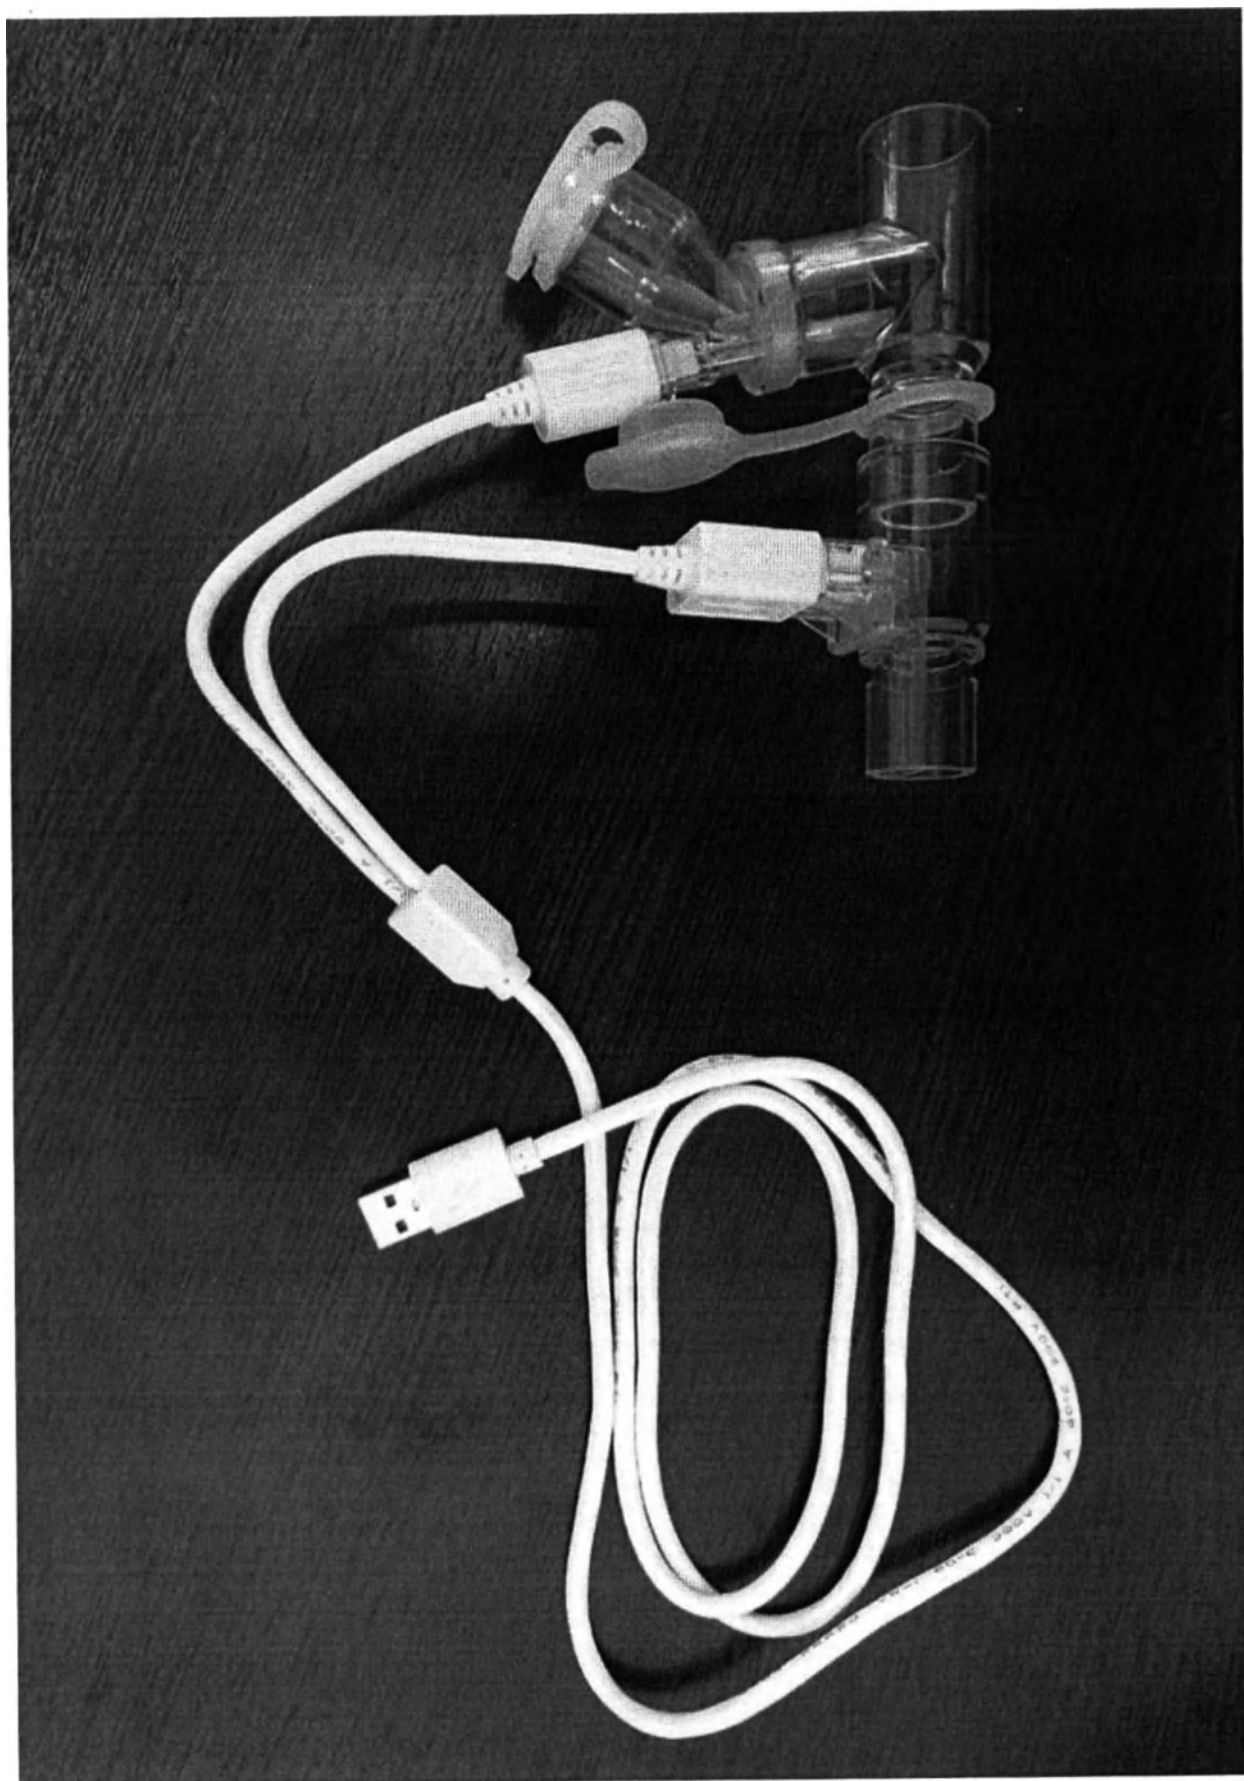


Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, для аэрозольной и кислородной терапии: Анестезиологическая маска, размером 4: Quadralite, EcoMask II, экономичные анестезиологические лицевые маска, маска лицевая анатомическая, производства «Интерсерджиал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551

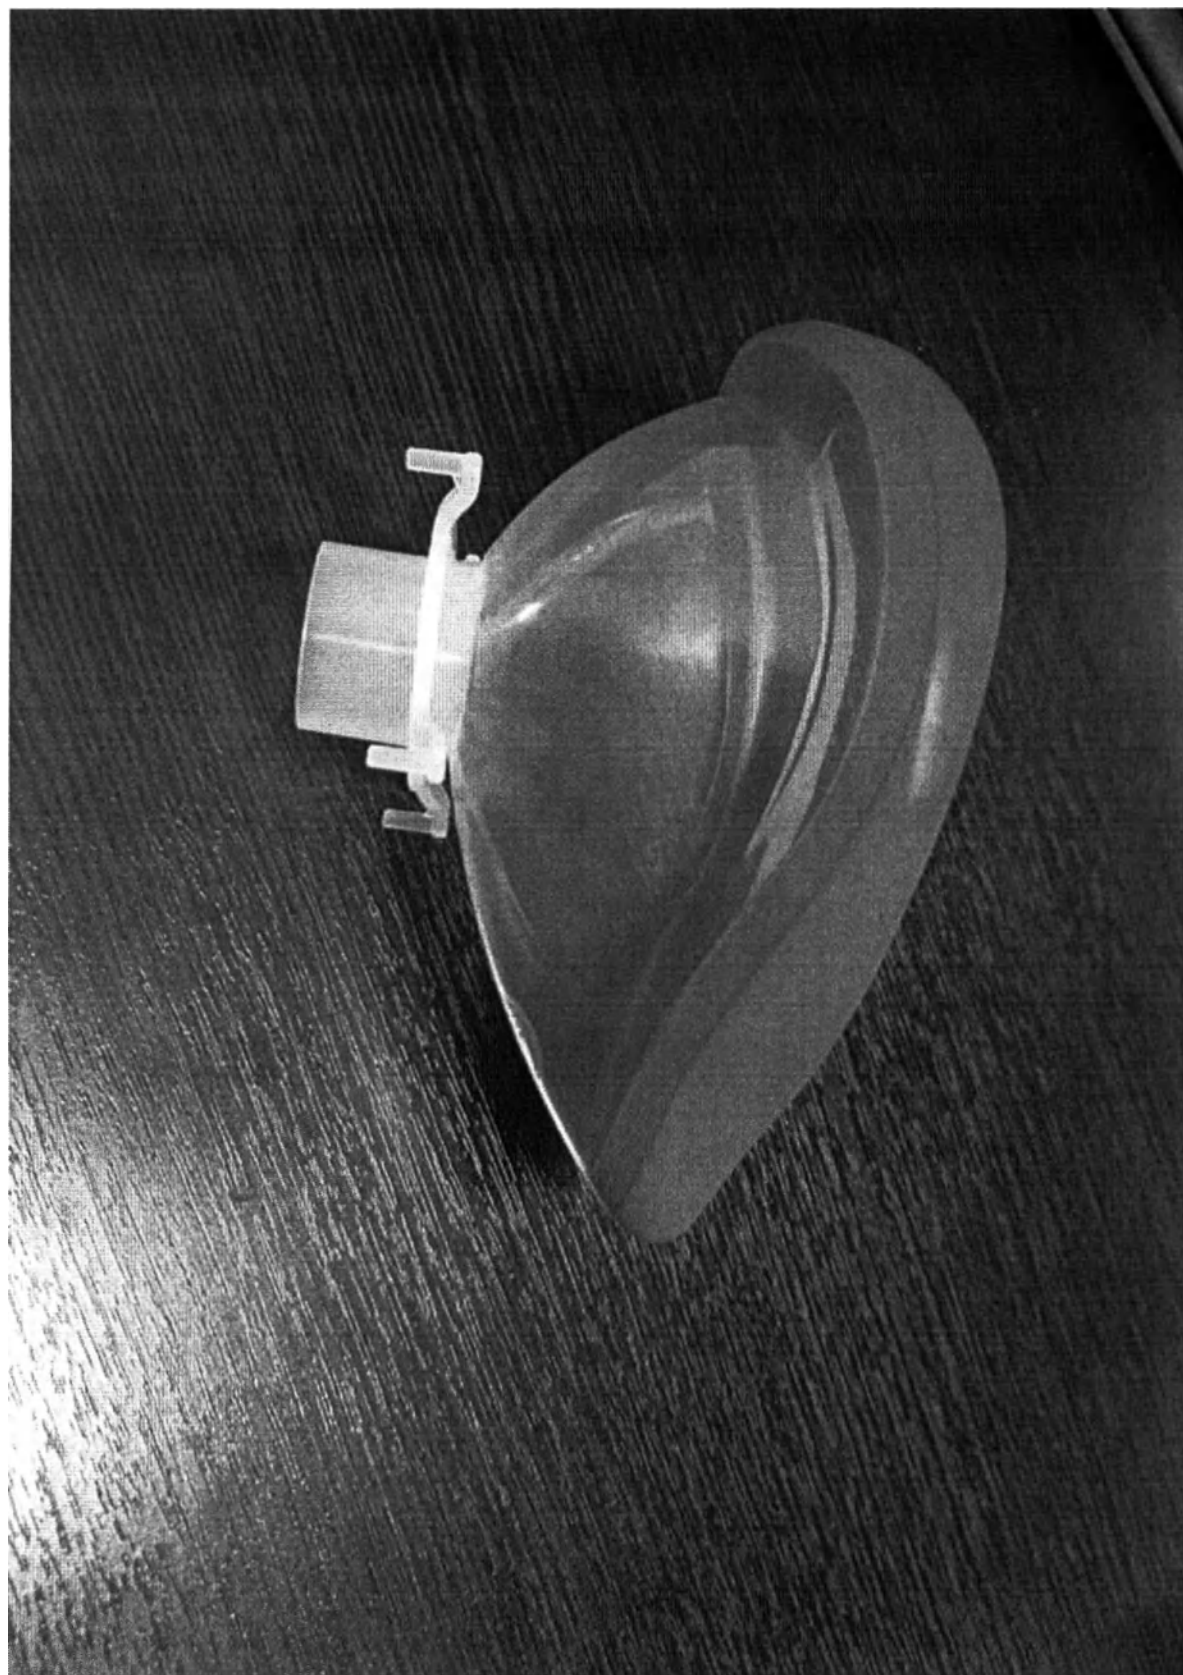

Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, для аэрозольной и кислородной терапии: Маска для вентиляции лёгких размер M/L (средний/большой): маска для CPAP производства «Интерсерджикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551




**Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, для
аэрозольной и кислородной терапии: Дыхательный шланг в комплекте с соединителями
или без: шланги для дыхательных контуров производства «Интерсерджикал Лтд.»,
Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551**

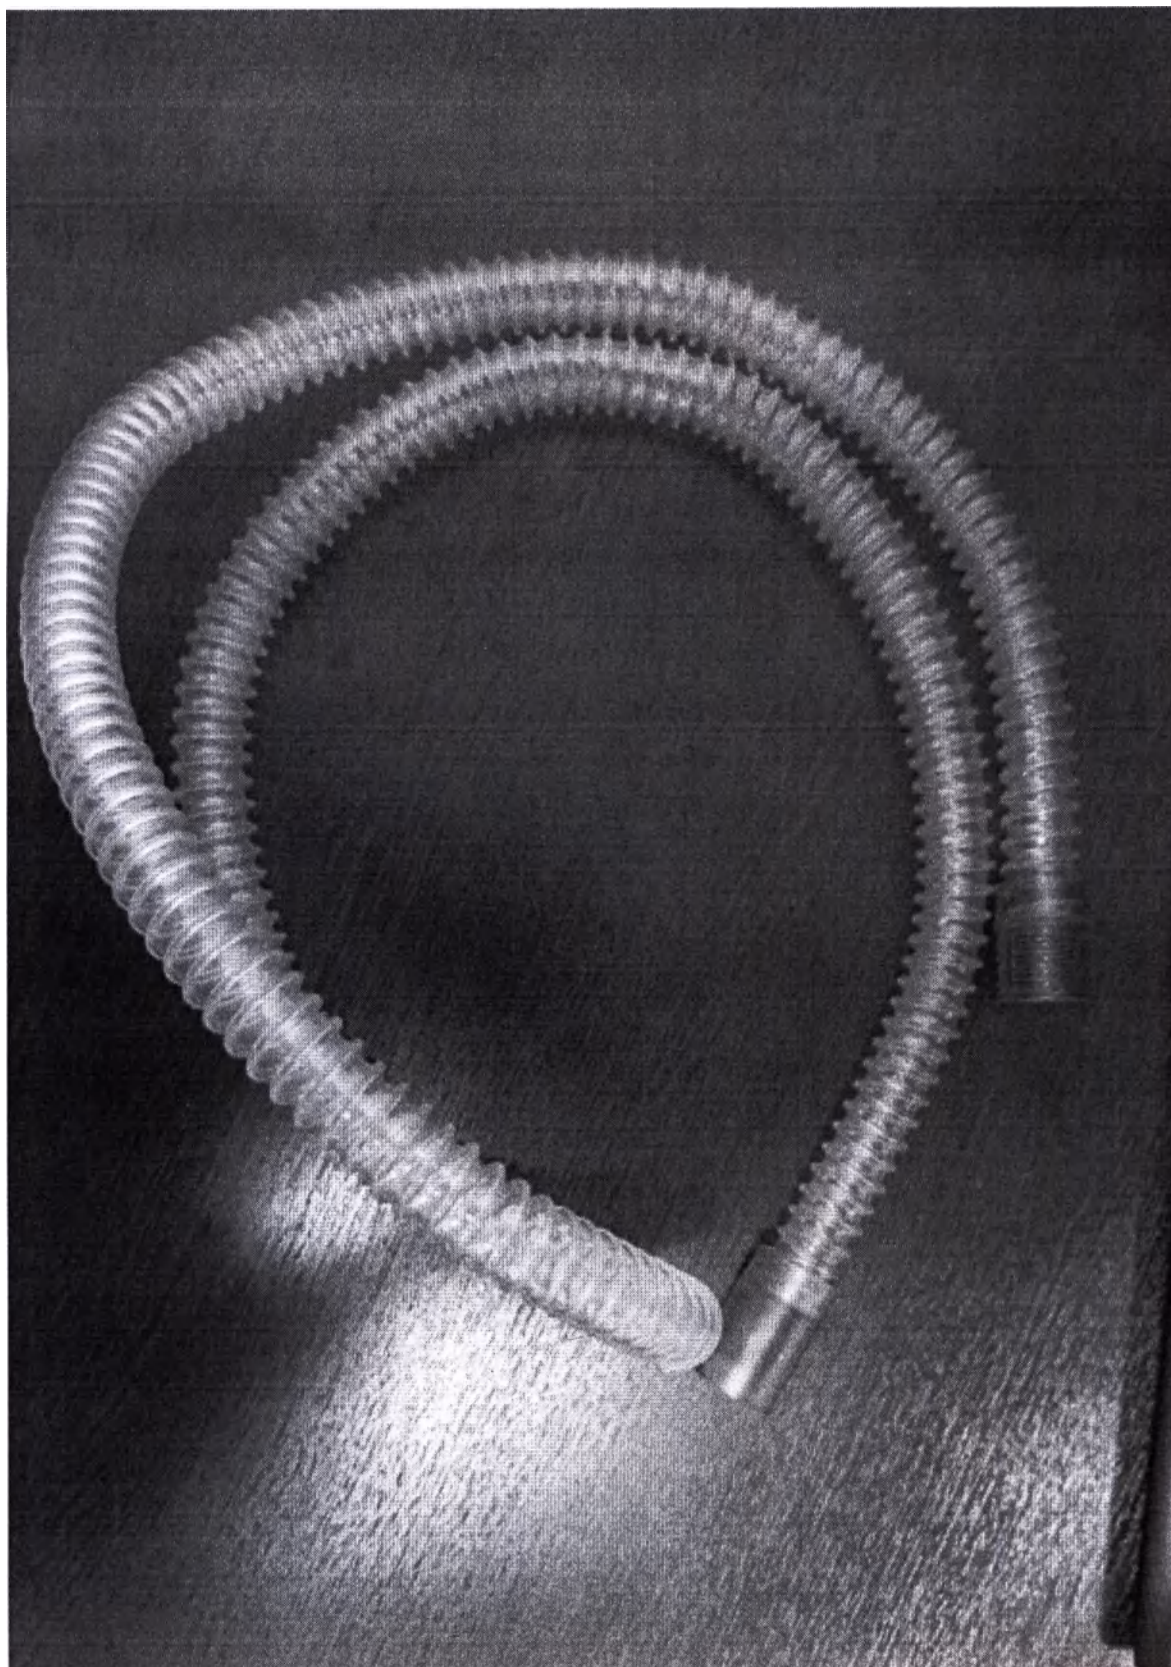

Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, для аэрозольной и кислородной терапии: Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры для пациентов, для дыхательных контуров, для аппаратов, производства «Интерсерджикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551



Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, для аэрозольной и кислородной терапии: Соединитель Т-образный, производства «Интерсерджикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551

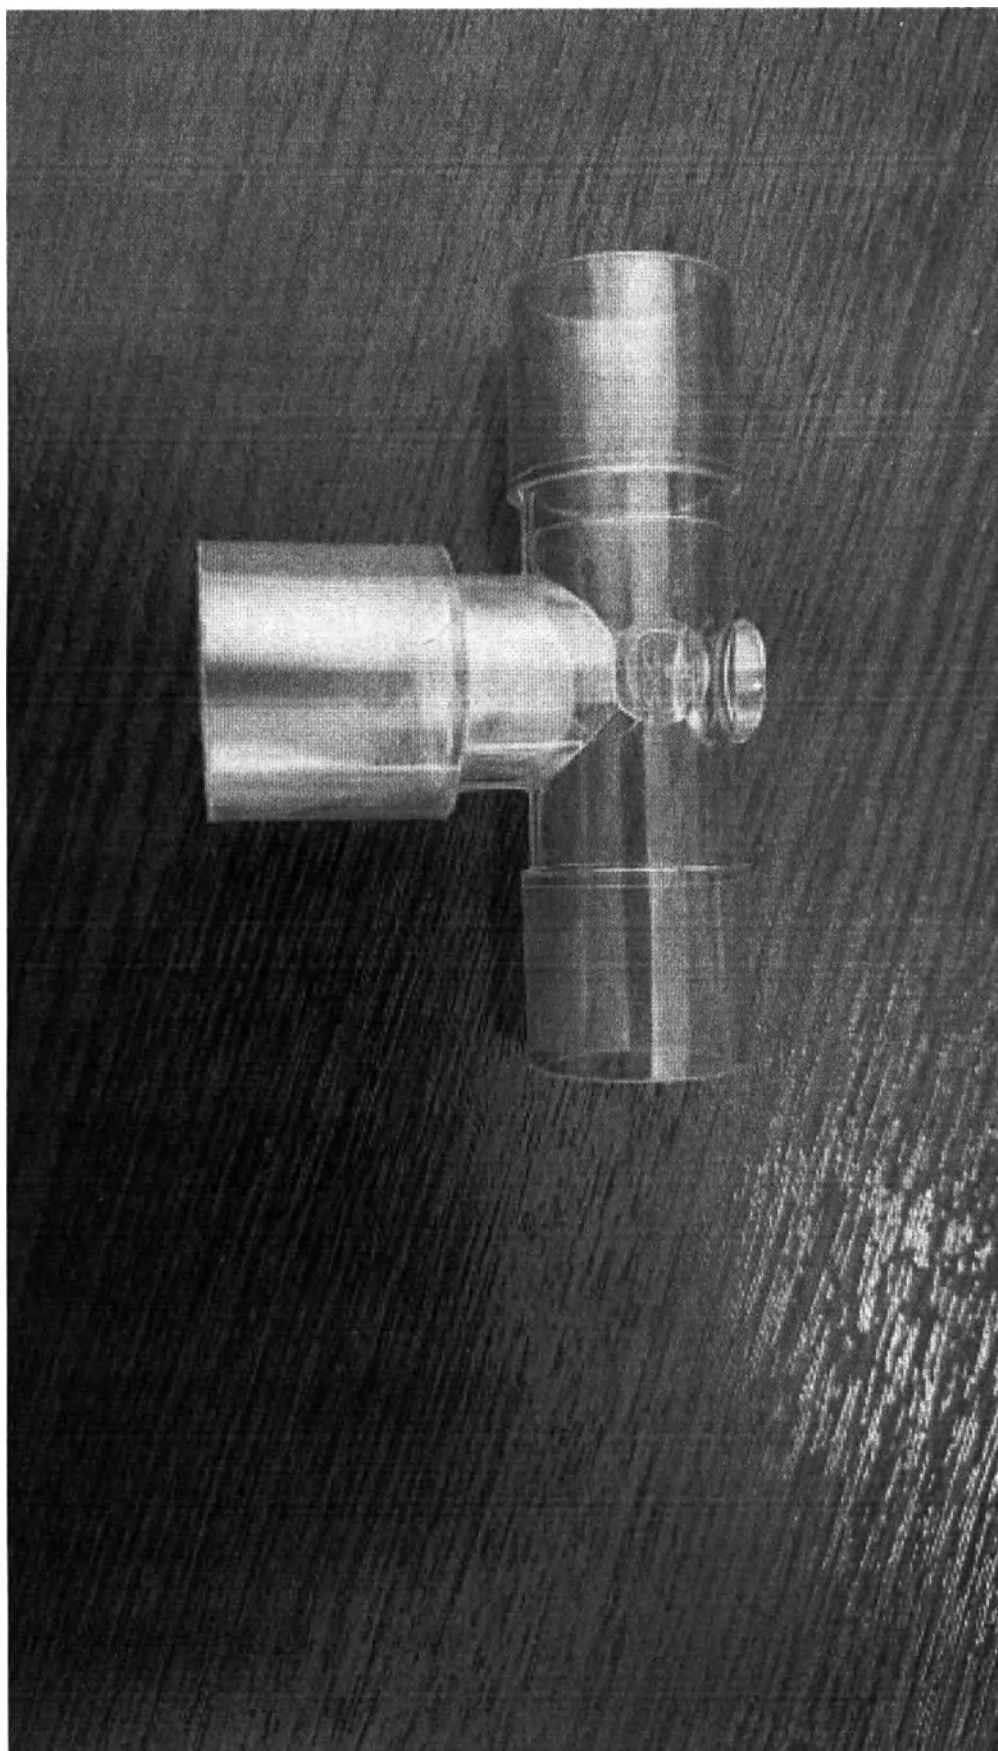

Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, для аэрозольной и кислородной терапии: Дыхательные клапаны: нереверсивный клапан производства «Интерсерджикал Лтд.», Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551



Съемный шнур питания сетевой



Шаблон маркировки

ООО «РАДИАТЕХ»		
 Юридический адрес: 188300, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Веревское, Промзона Вайялово, д. 1		РУ № _____ / _____ ТУ 32.50.21-007-02353754-2021 Изготовлено в Российской Федерации
Ингалятор для дыхания подогретой кислородно-гелиевой газовой смесью ТЕРМОГЕЛИКС ПРО по ТУ 32.50.21-007-02353754-2021		
Характеристики питания Потребляемая мощность Класс защиты оболочек Дата изготовления Заводской номер Повторно-кратковременный режим работы: Гарантийный срок эксплуатации	~ (220 ± 22) В, 50 Гц не более 150 ВА IP20  ММ.ГГГГ  06.01.XXXX работа 30 мин / перерыв 5 мин 12 месяцев	Указания по эксплуатации, гарантия изготовителя: см. Руководство по эксплуатации: РДТХ.941589.001 РЭ      
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в складских помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.		

Маркировка на изделии

ООО «РАДИАТЕХ»		
 Юридический адрес: 188300, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Веревское, Промзона Вайялово, д. 1		РУ № _____ / _____ ТУ 32.50.21-007-02353754-2021 Изготовлено в Российской Федерации
Ингалятор для дыхания подогретой кислородно-гелиевой газовой смесью ТЕРМОГЕЛИКС ПРО по ТУ 32.50.21-007-02353754-2021		
Характеристики питания Потребляемая мощность Класс защиты оболочек Дата изготовления Заводской номер Повторно-кратковременный режим работы: Гарантийный срок эксплуатации	~ (220 ± 22) В, 50 Гц не более 150 ВА IP20  03.2021  06.01.0101 работа 30 мин / перерыв 5 мин 12 месяцев	Указания по эксплуатации, гарантия изготовителя: см. Руководство по эксплуатации: РДТХ.941589.001 РЭ      
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в складских помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.		

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 15 (пятнадцать) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «РАДИАТЕХ»

Косьяненко С.В.
« 24 » июля 20 22 г.

