

# Фотографические изображения медицинского изделия


***Катетер SoundStar 3D для ультразвуковой диагностики в вариантах исполнения:***

- Катетер SoundStar 3D для ультразвуковой диагностики***
- Катетер SoundStar eco для ультразвуковой диагностики.***

Производитель

**Biosense Webster Inc.**

**33 Technology Drive Irvine, California 92618,  
USA**

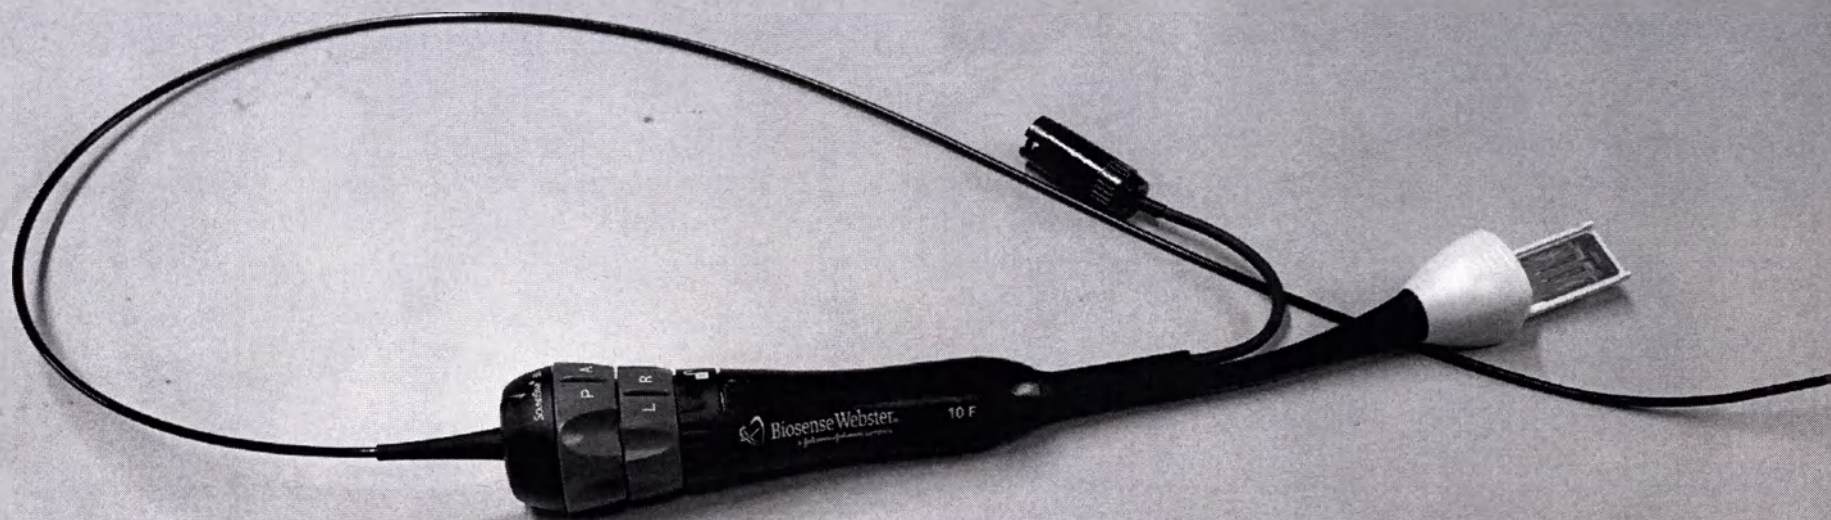



Contents dry shortly unless package is opened or damaged.  
Store in a cool, dry place.

CAUTION: Federal law (U.S.A.) restricts the sale and use of this device to or on the order of a physician.

Read the enclosed instructions for use for proper information on precautions, warnings and adverse effects before using the device.



Manufactured for Himmstein-Vielhaber in Korea

Bioscience Resource Project, Inc.  
3333 Diamond Canyon Road  
Diamond Bar, California 91766 USA  
Tel: +1 909-858-0500  
Tel: +1 909-729-8810  
Fax: +1 909-458-2905  
[www.bioscienceproject.com](http://www.bioscienceproject.com)

[illegible]

## Катетер SoundStar 3D для ультразвуковой диагностики

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке


Производитель: "Биосенс Вебстер Инк.", США, Biosense Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar, California, 91765, USA. Сделано в Корее.


Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: ФСЗ 2011/09050 от 28.03.2011



- Катетер SoundStar eco для ультразвуковой диагностики.

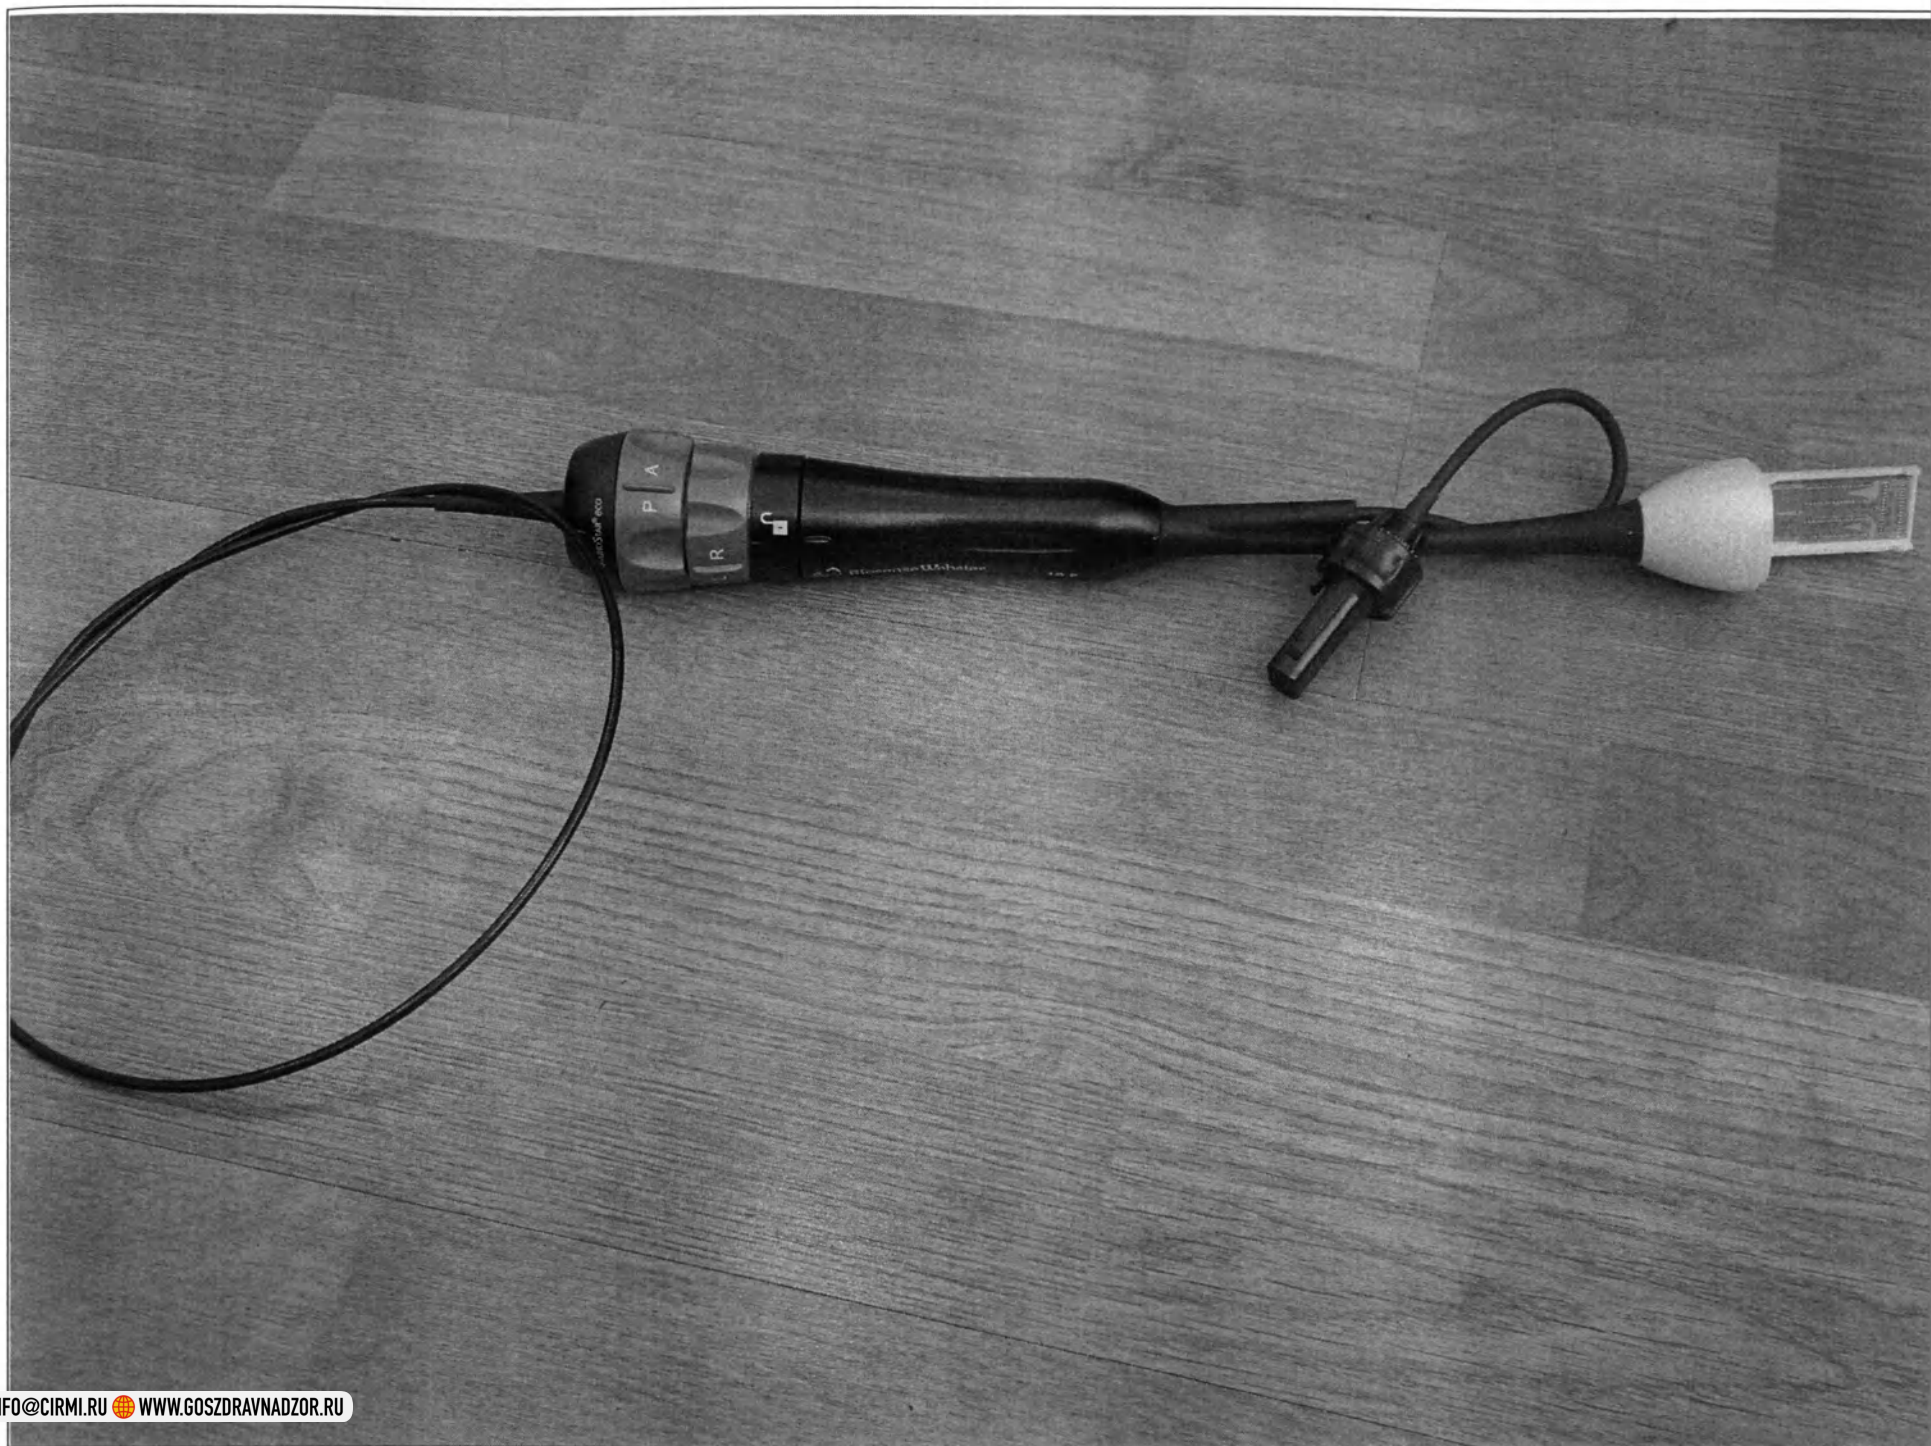

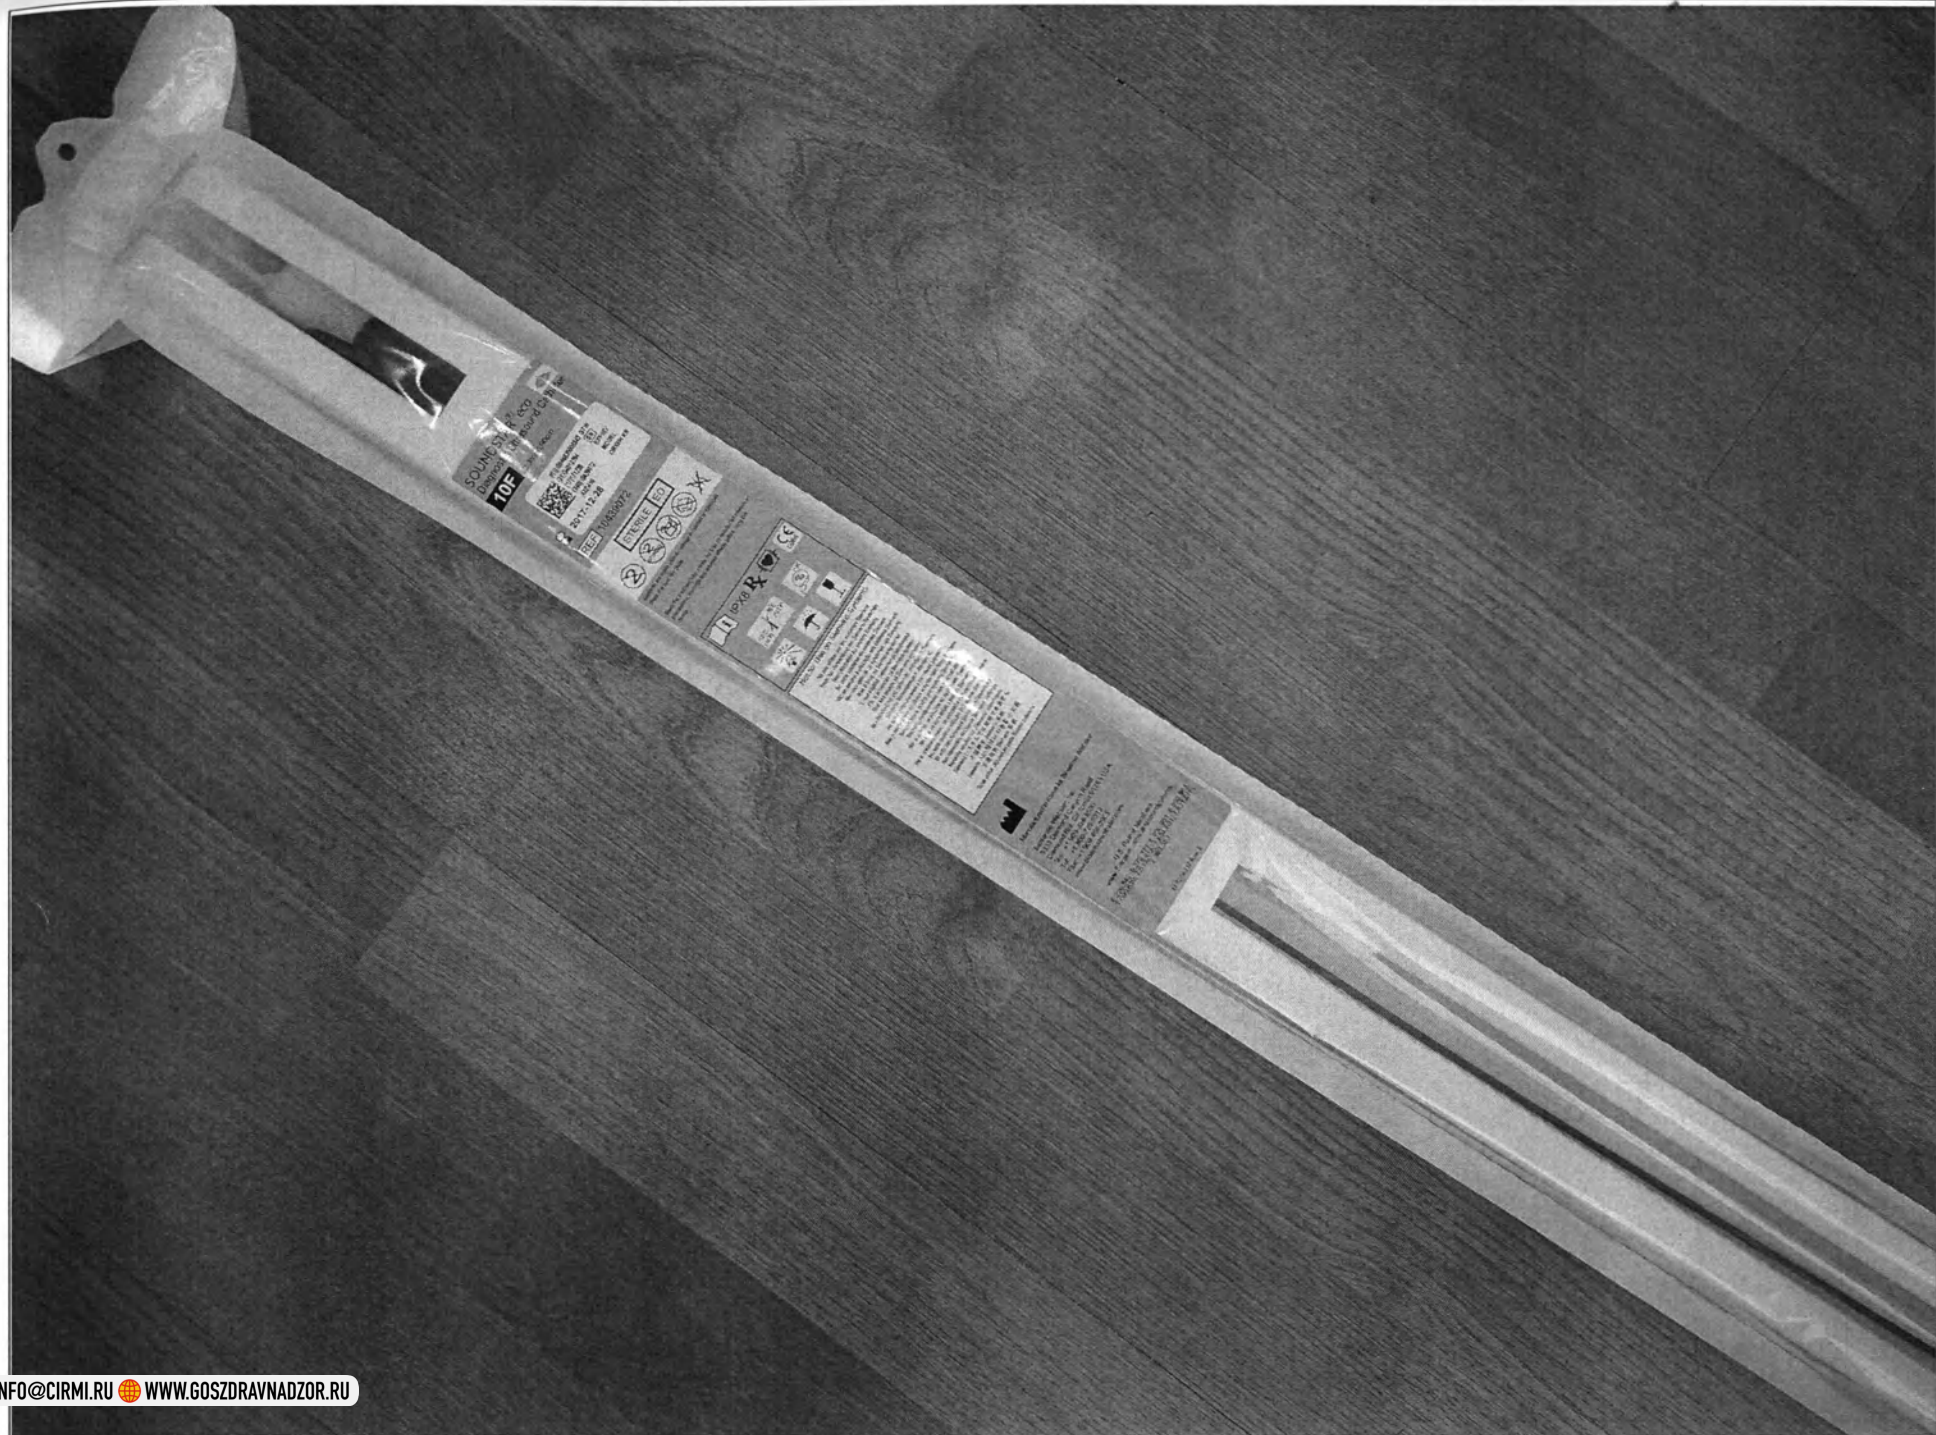

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Катетер SoundStar 3D для ультразвуковой диагностики в вариантах исполнения: Катетер SoundStar eco для ультразвуковой диагностики</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Область применения: для проведения внутрисердечного ультразвукового исследования                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Условия: Хранить в темном сухом месте при температуре от + 5° до 25°.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Не использовать после истечения срока годности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер и дата РУ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Внешний диаметр катетера:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Эффективная длина катетера: 90см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Срок годности: 1 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Количество штук в упаковке: 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  : "Байосенс Вебстер (США), Инк." Biosense Webster, Inc.,<br>33 Technology Drive, Irvine, CA 92618, USA (США)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Уполномоченный представитель производителя: ООО "Джонсон & Джонсон"<br>121614, г. Москва, ул. Крылатская 17/2<br>Телефон: +7(495) 580-7777, факс: 8 (495) 580 78 78                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  /  /  : см. упаковку<br> | <br>  |



ПРОШИТО И  
СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ  
7.1