



Фотографические изображения

Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark

Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (общий вид)

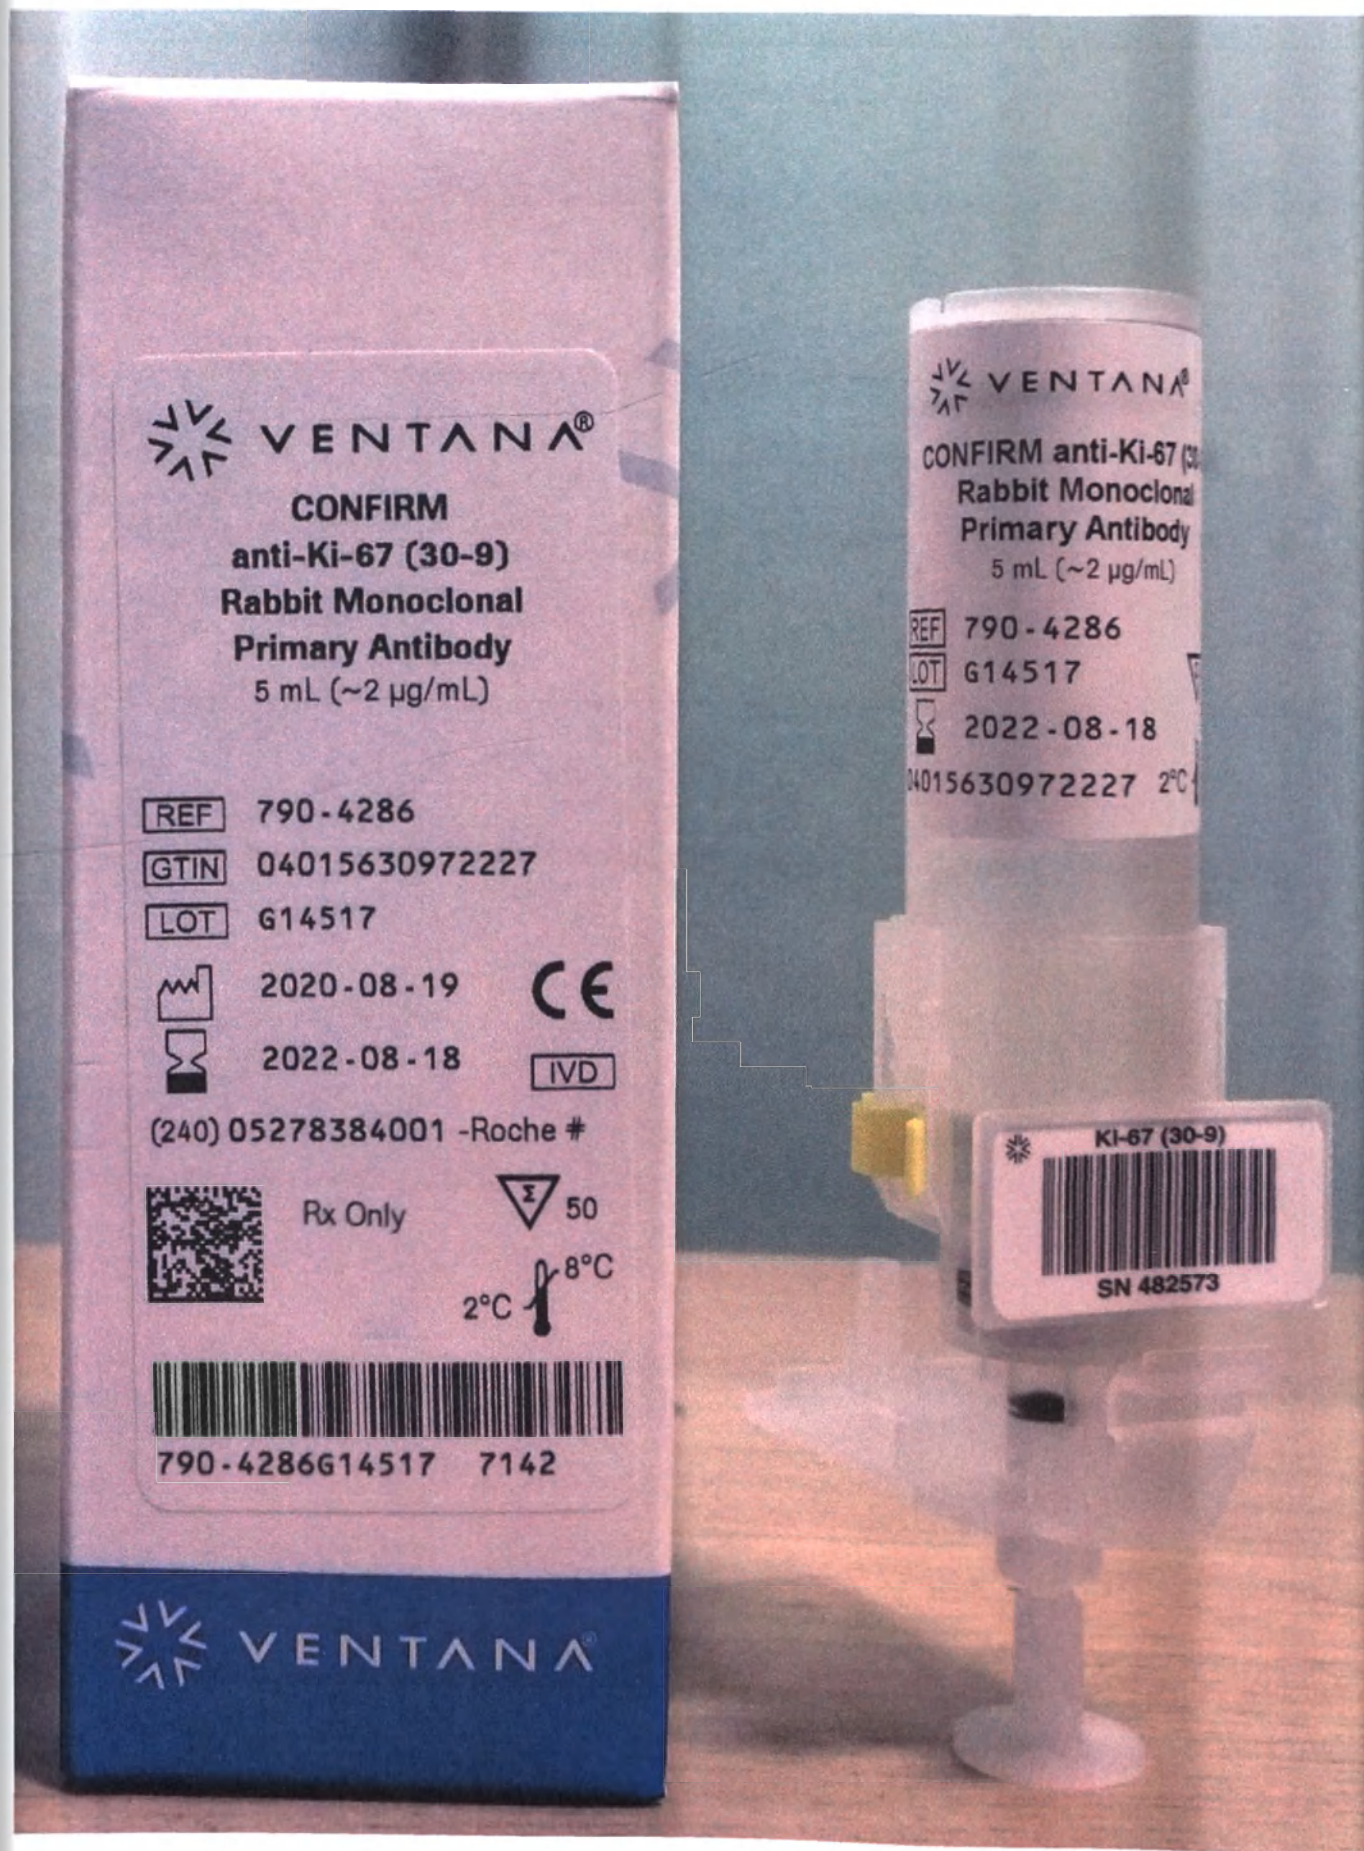

Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)

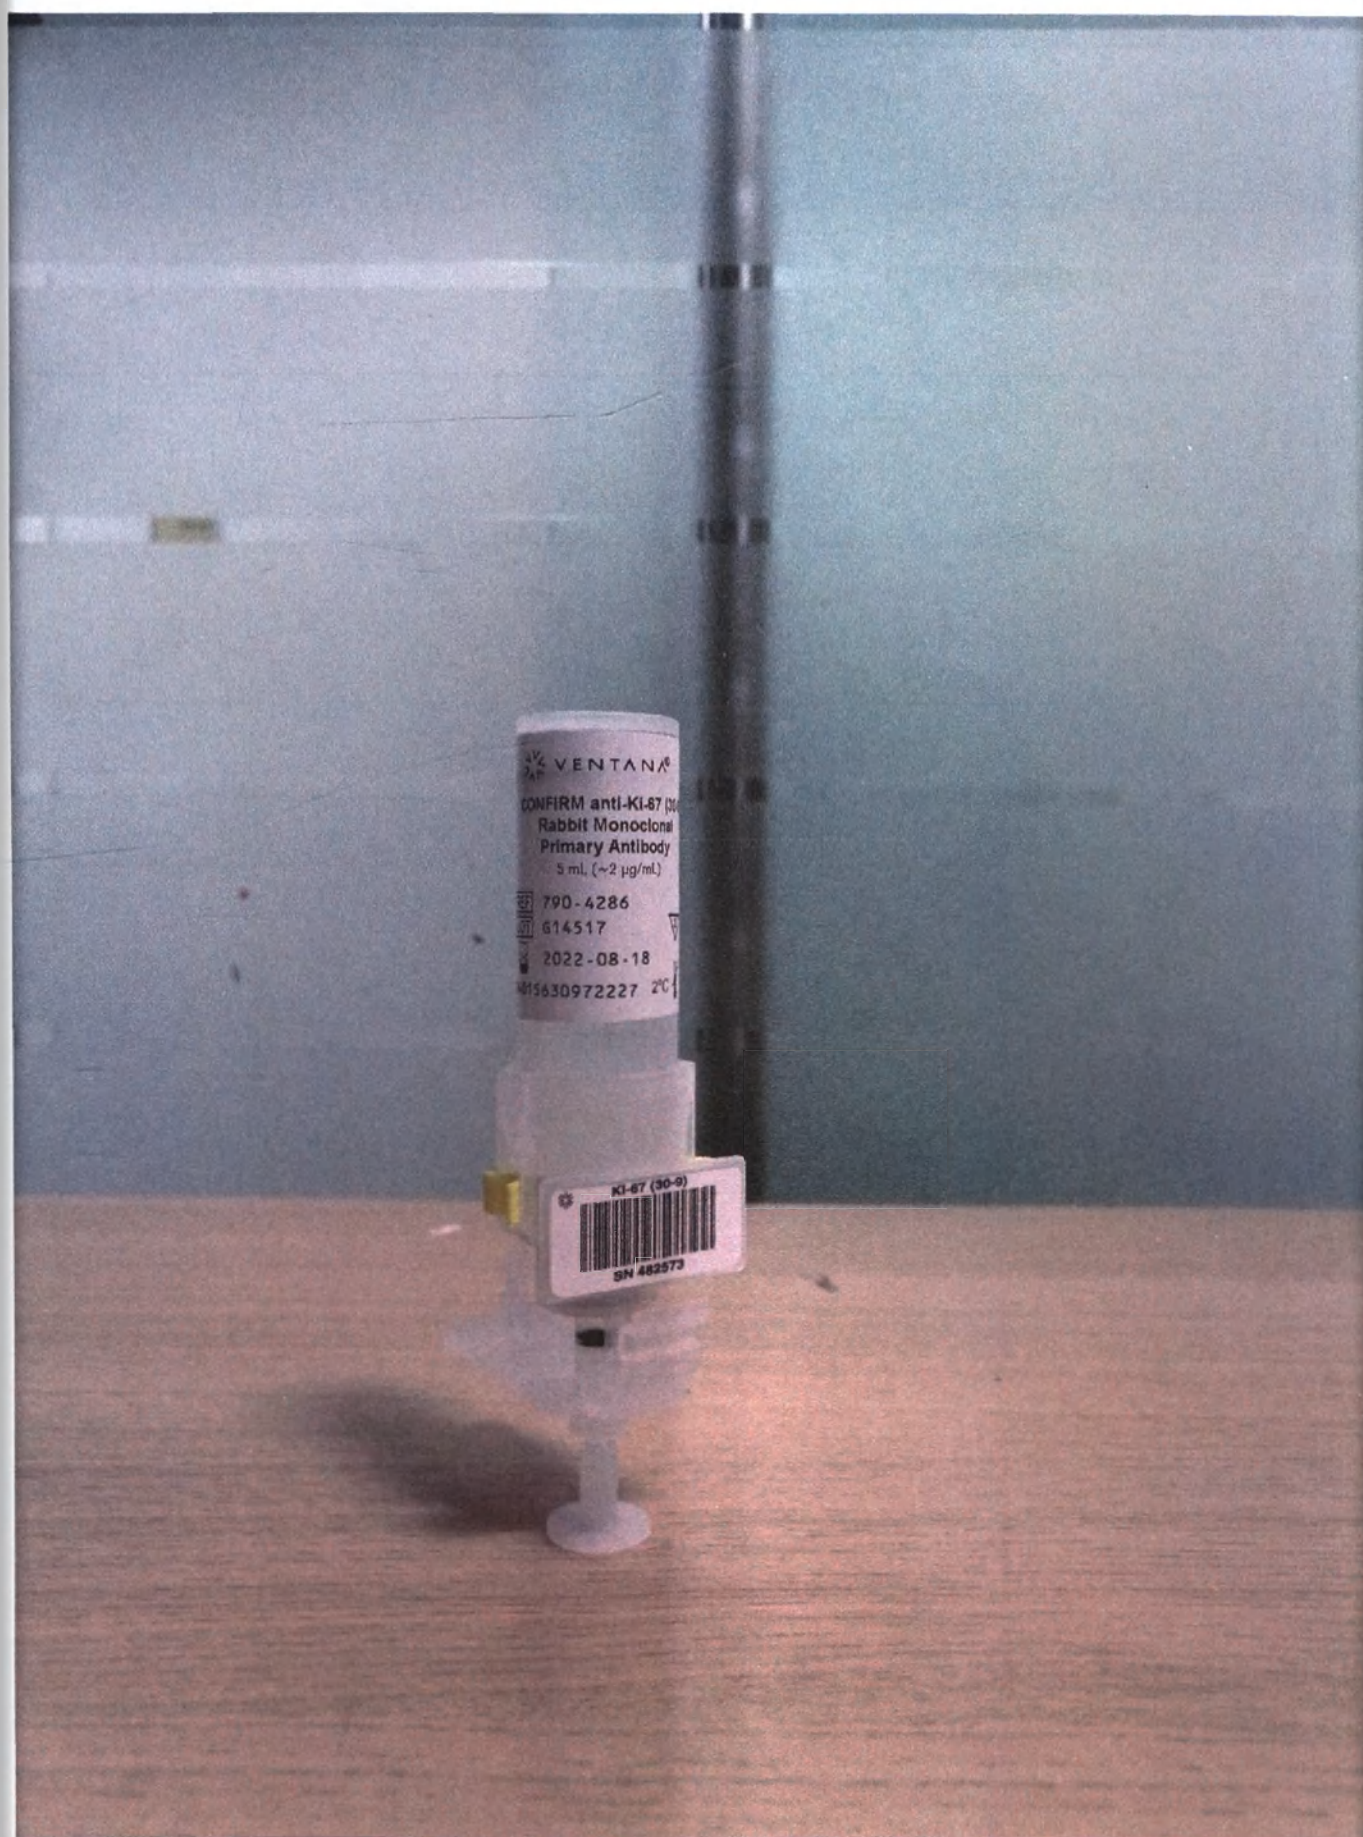

Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)



Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)



Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)




Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



VENTANA®

CONFIRM
anti-Ki-67 (30-9)
Rabbit Monoclonal
Primary Antibody
5 mL (~2 µg/mL)

REF


790-4286

GTIN

04015630972227

LOT

G14517



2020-08-19



2022-08-18

CE

IVD

(240) 05278384001 -Roche #



Rx Only



50

2°C  **8°C**



790-4286G14517 7142



VENTANA®

Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)

Первичное кроличье моноклональное антитело CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody для качественного иммуногистохимического обнаружения белка Ki-67 для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматической серии BenchMark.
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок годности см. на упаковке. Дату производства см. на упаковке.
Температура хранения см. на упаковке. Номер лота см. на упаковке.
Производитель: «Ventana Medical Systems, Inc.», 1910 East Innovation Park Drive, Tucson, AZ 85785 USA.
Настоящее предложение для диагностики in vitro.
Указанные в нем данные являются рекомендациями производителя.
Обязательно с ограниченной ответственностью «Раш Диагностика Рус» (ООО «Раш Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2. Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: rashdiag@rashdiag.ru, rashdiag.com
Карт номер 052276390001 (790-4288)



VENTANA

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
10 листа (ов)



по доверенности
от 04.02.2021

(Грашина Д. В.)