



Фотографические изображения

Набор для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark


Набор для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (общий вид)

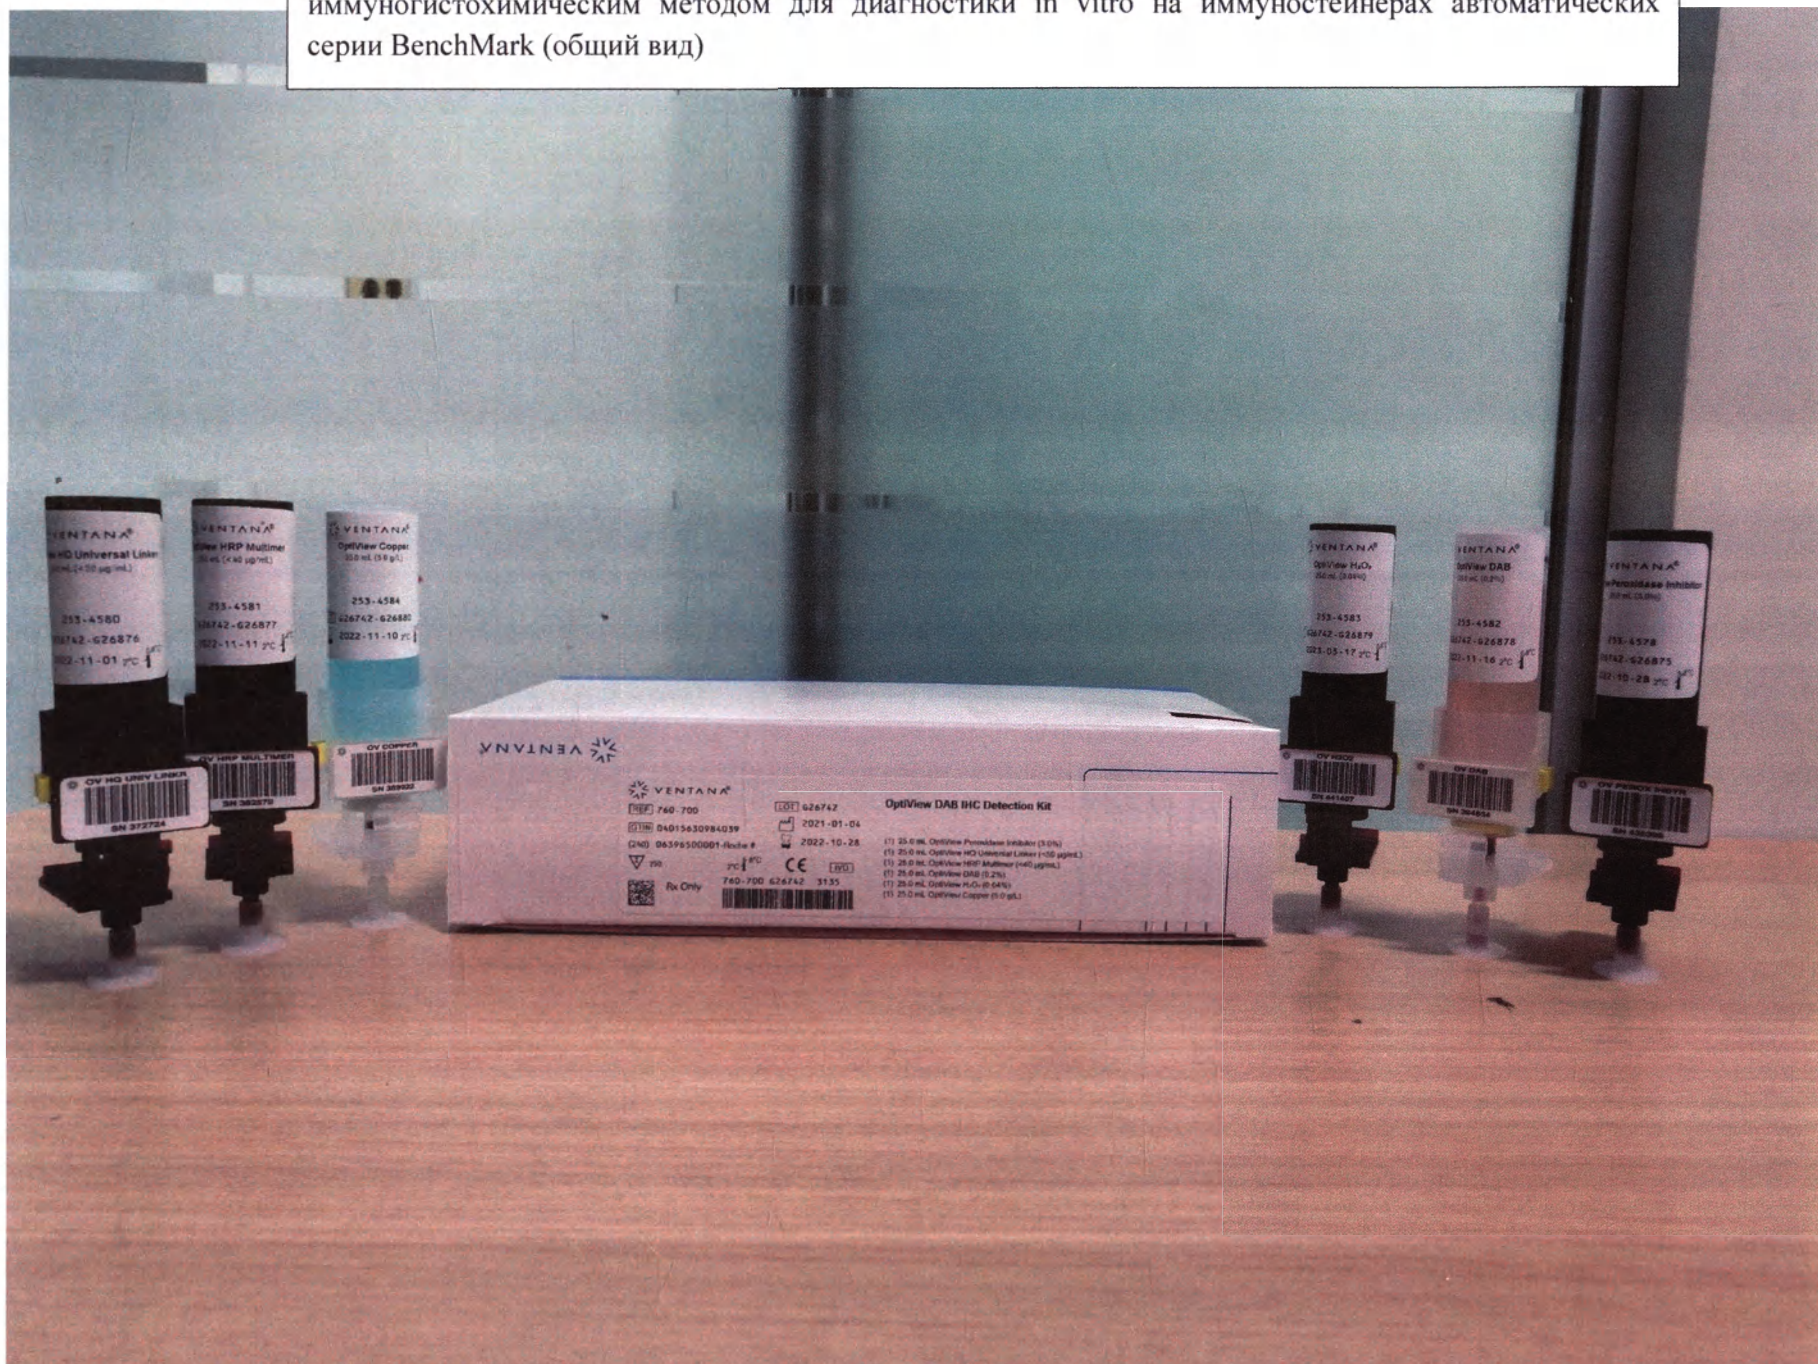

Реагент OptiView Peroxidase Inhibitor в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)

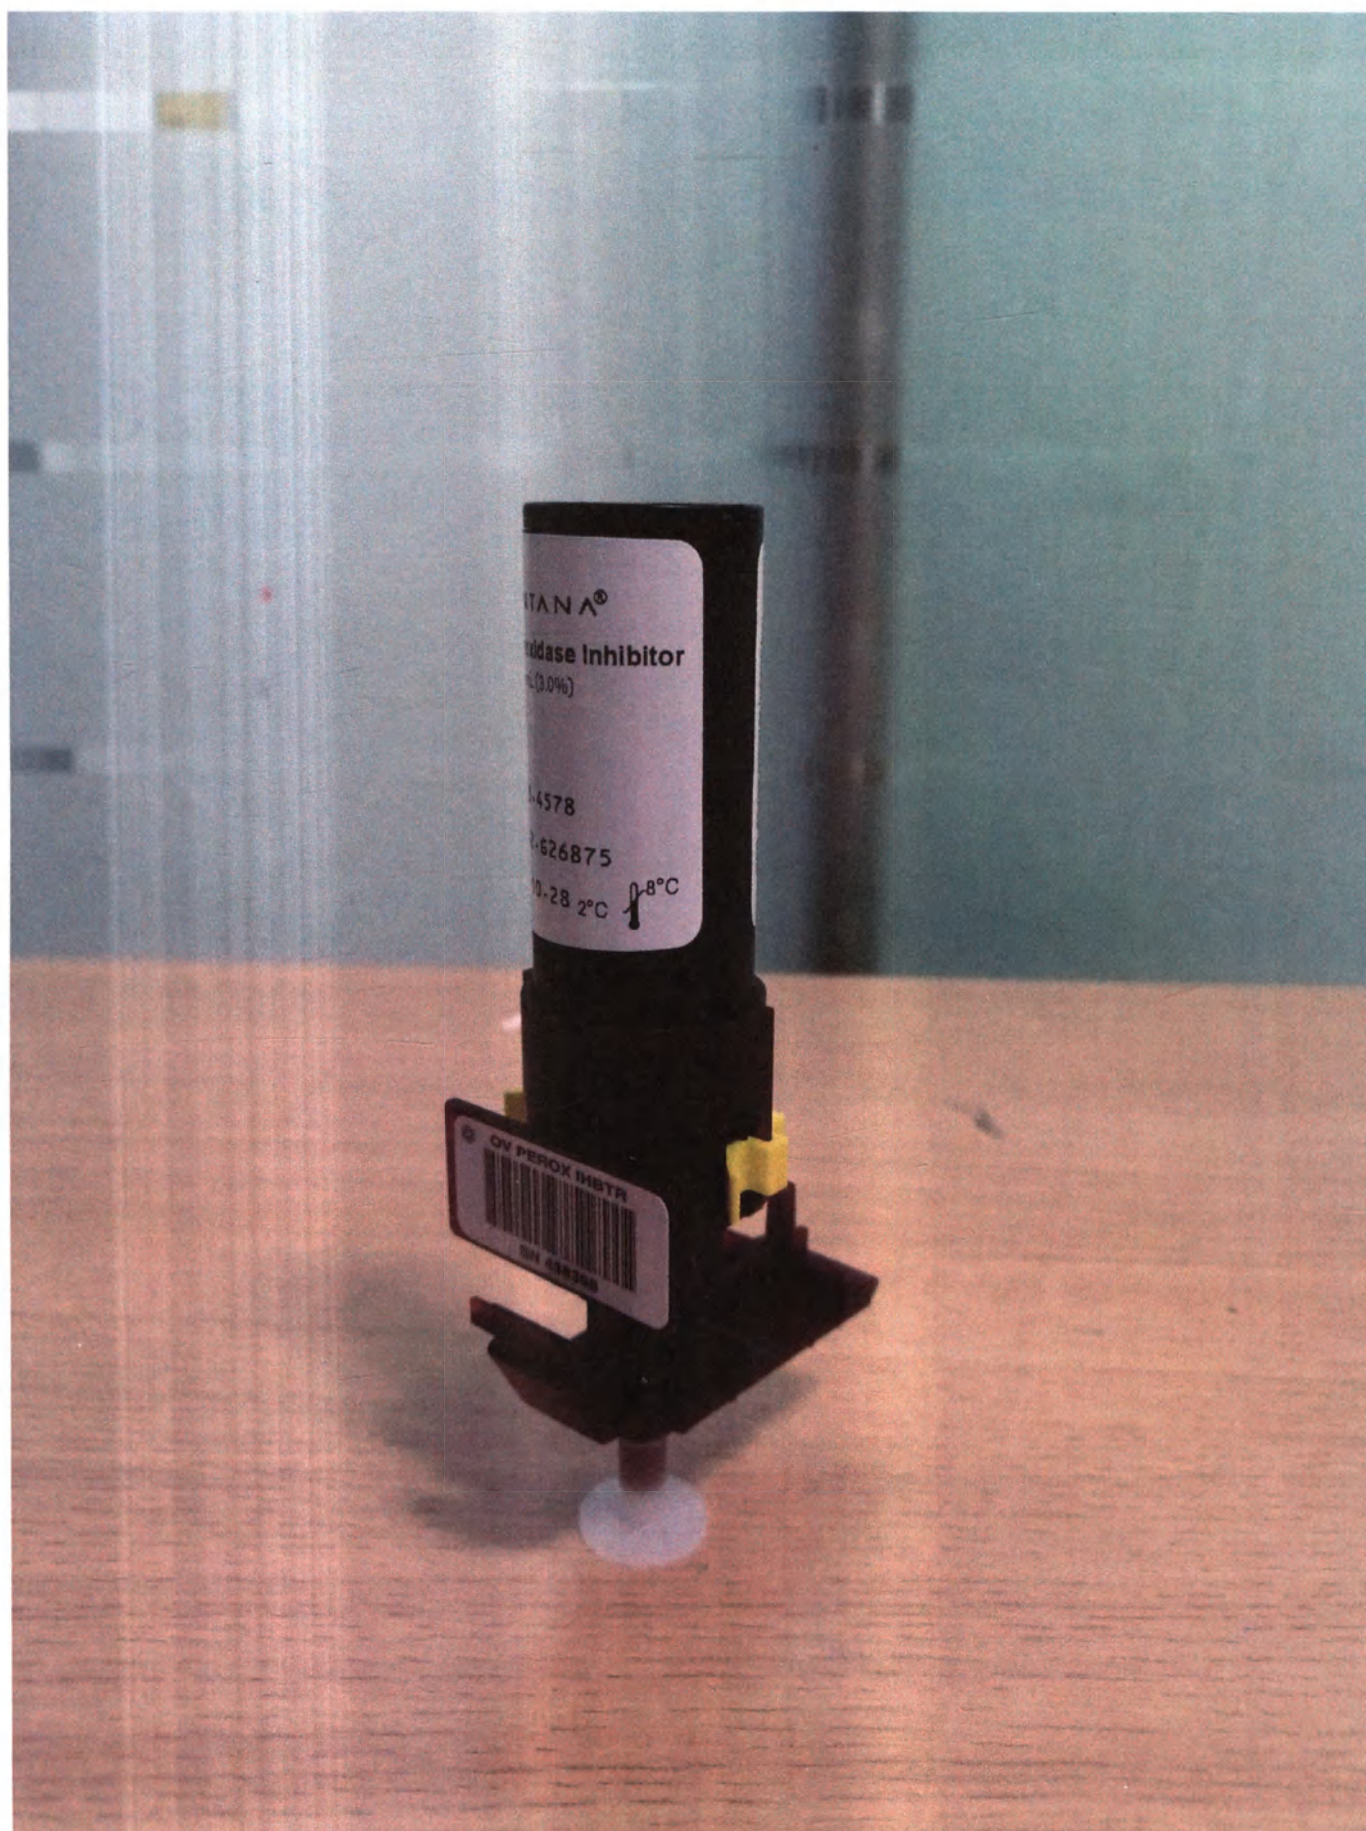

Реагент OptiView Peroxidase Inhibitor в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)

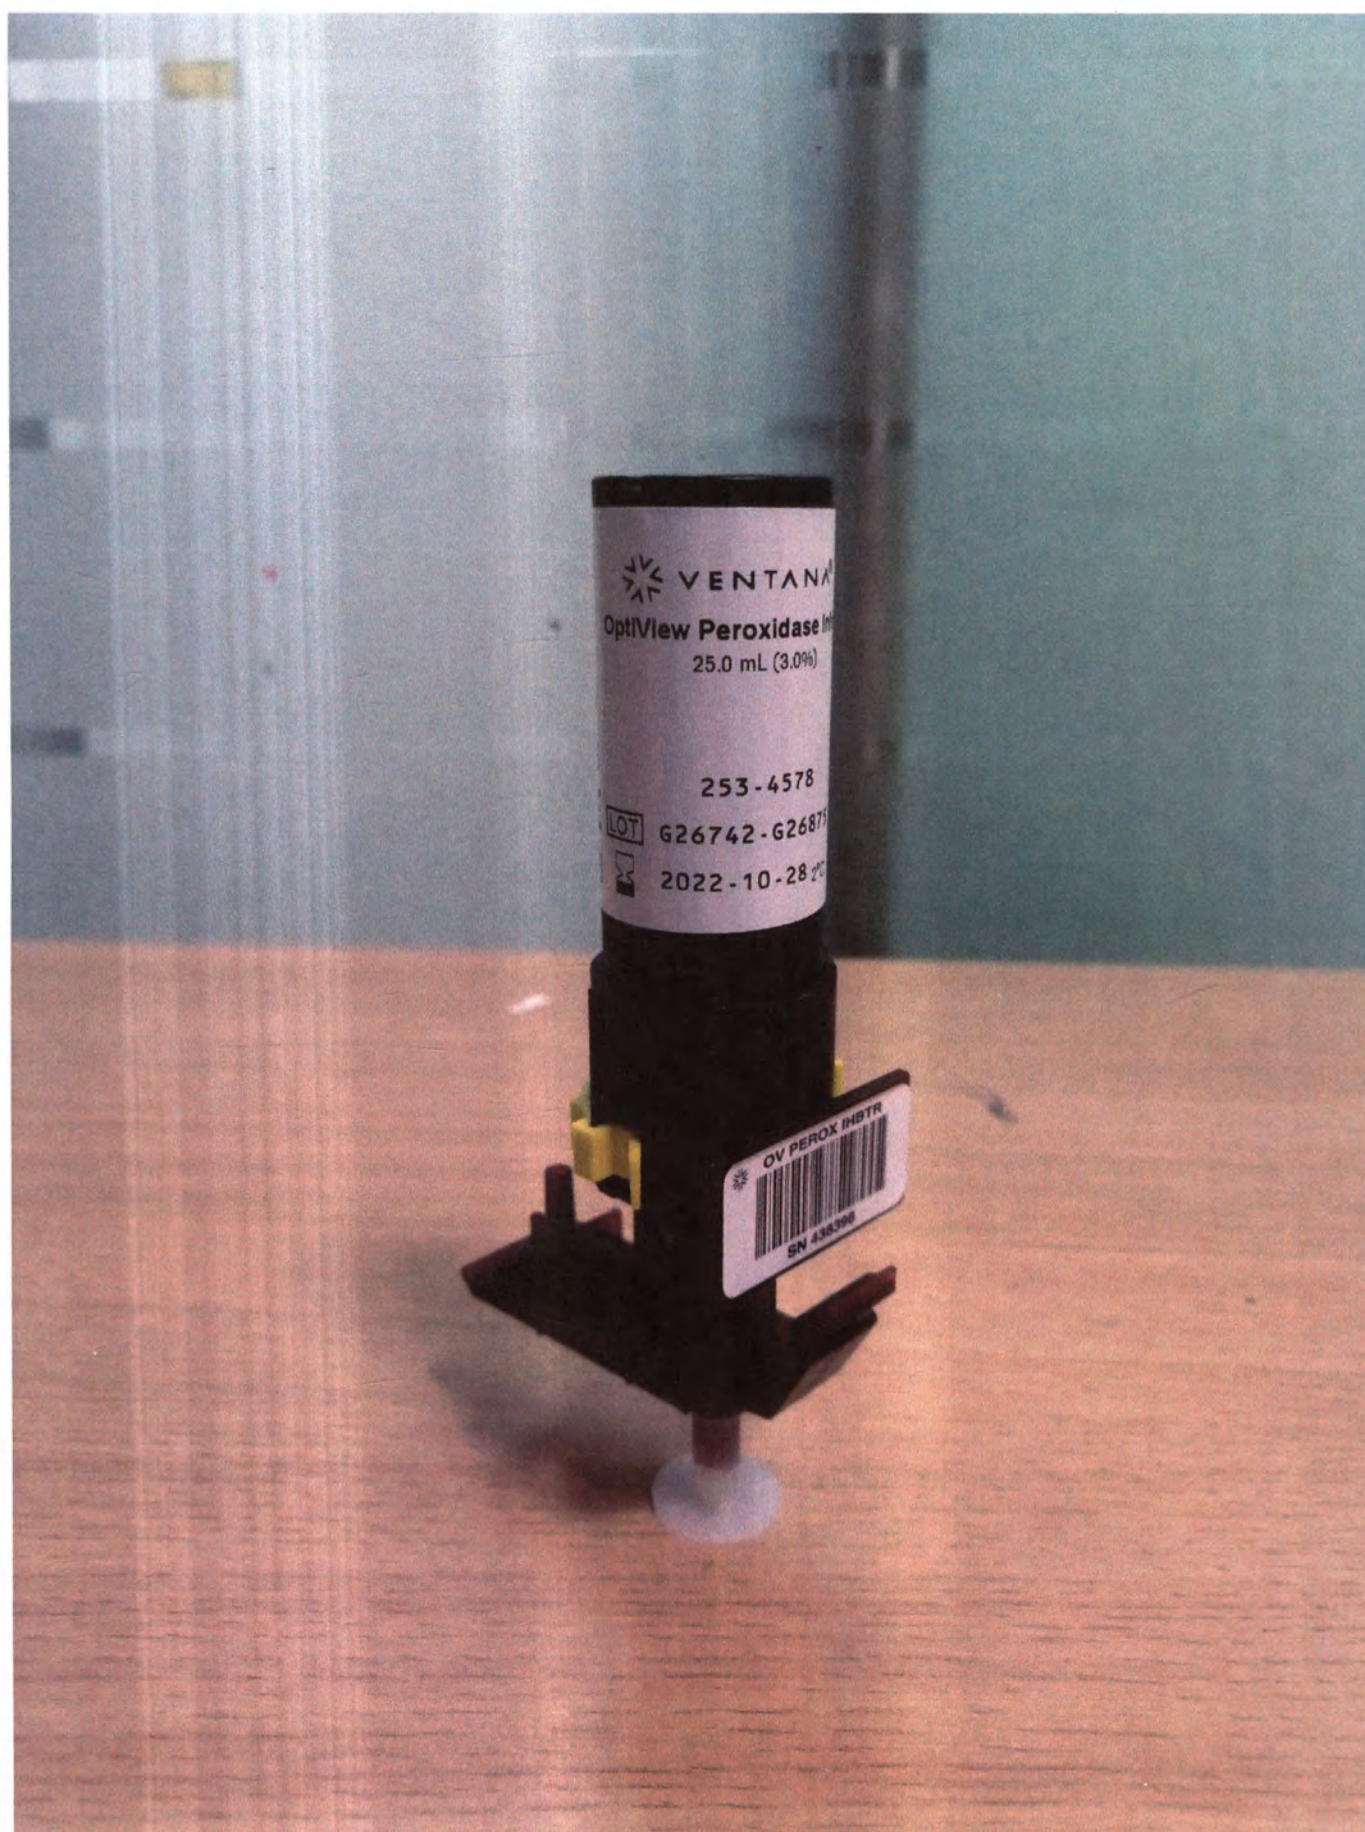


Реагент OptiView Peroxidase Inhibitor в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)



Реагент OptiView HQ Universal Linker в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.




Реагент OptiView HQ Universal Linker в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

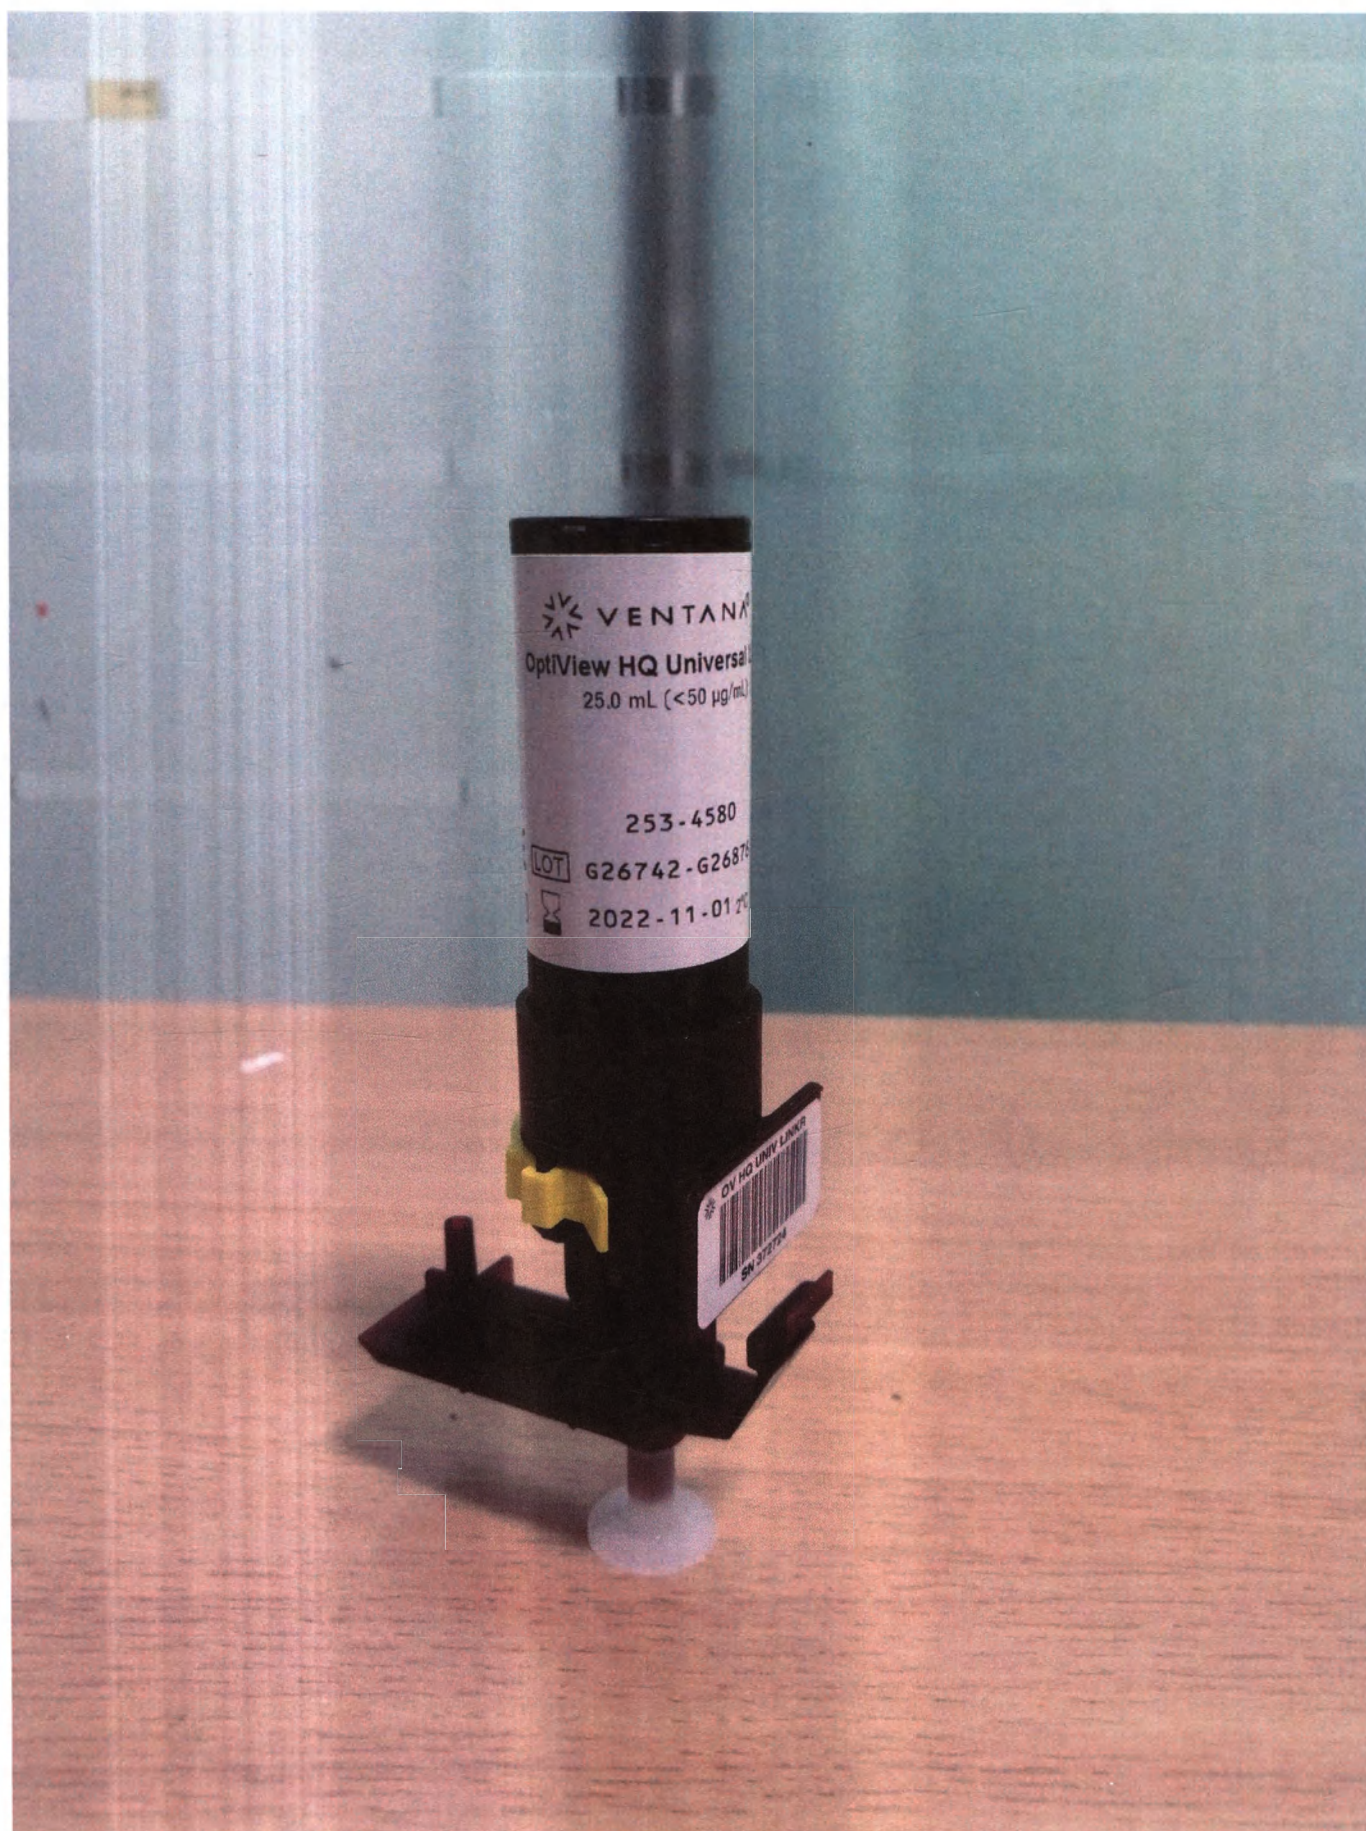


Реагент OptiView HQ Universal Linker в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.




Реагент OptiView HRP Multimer в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

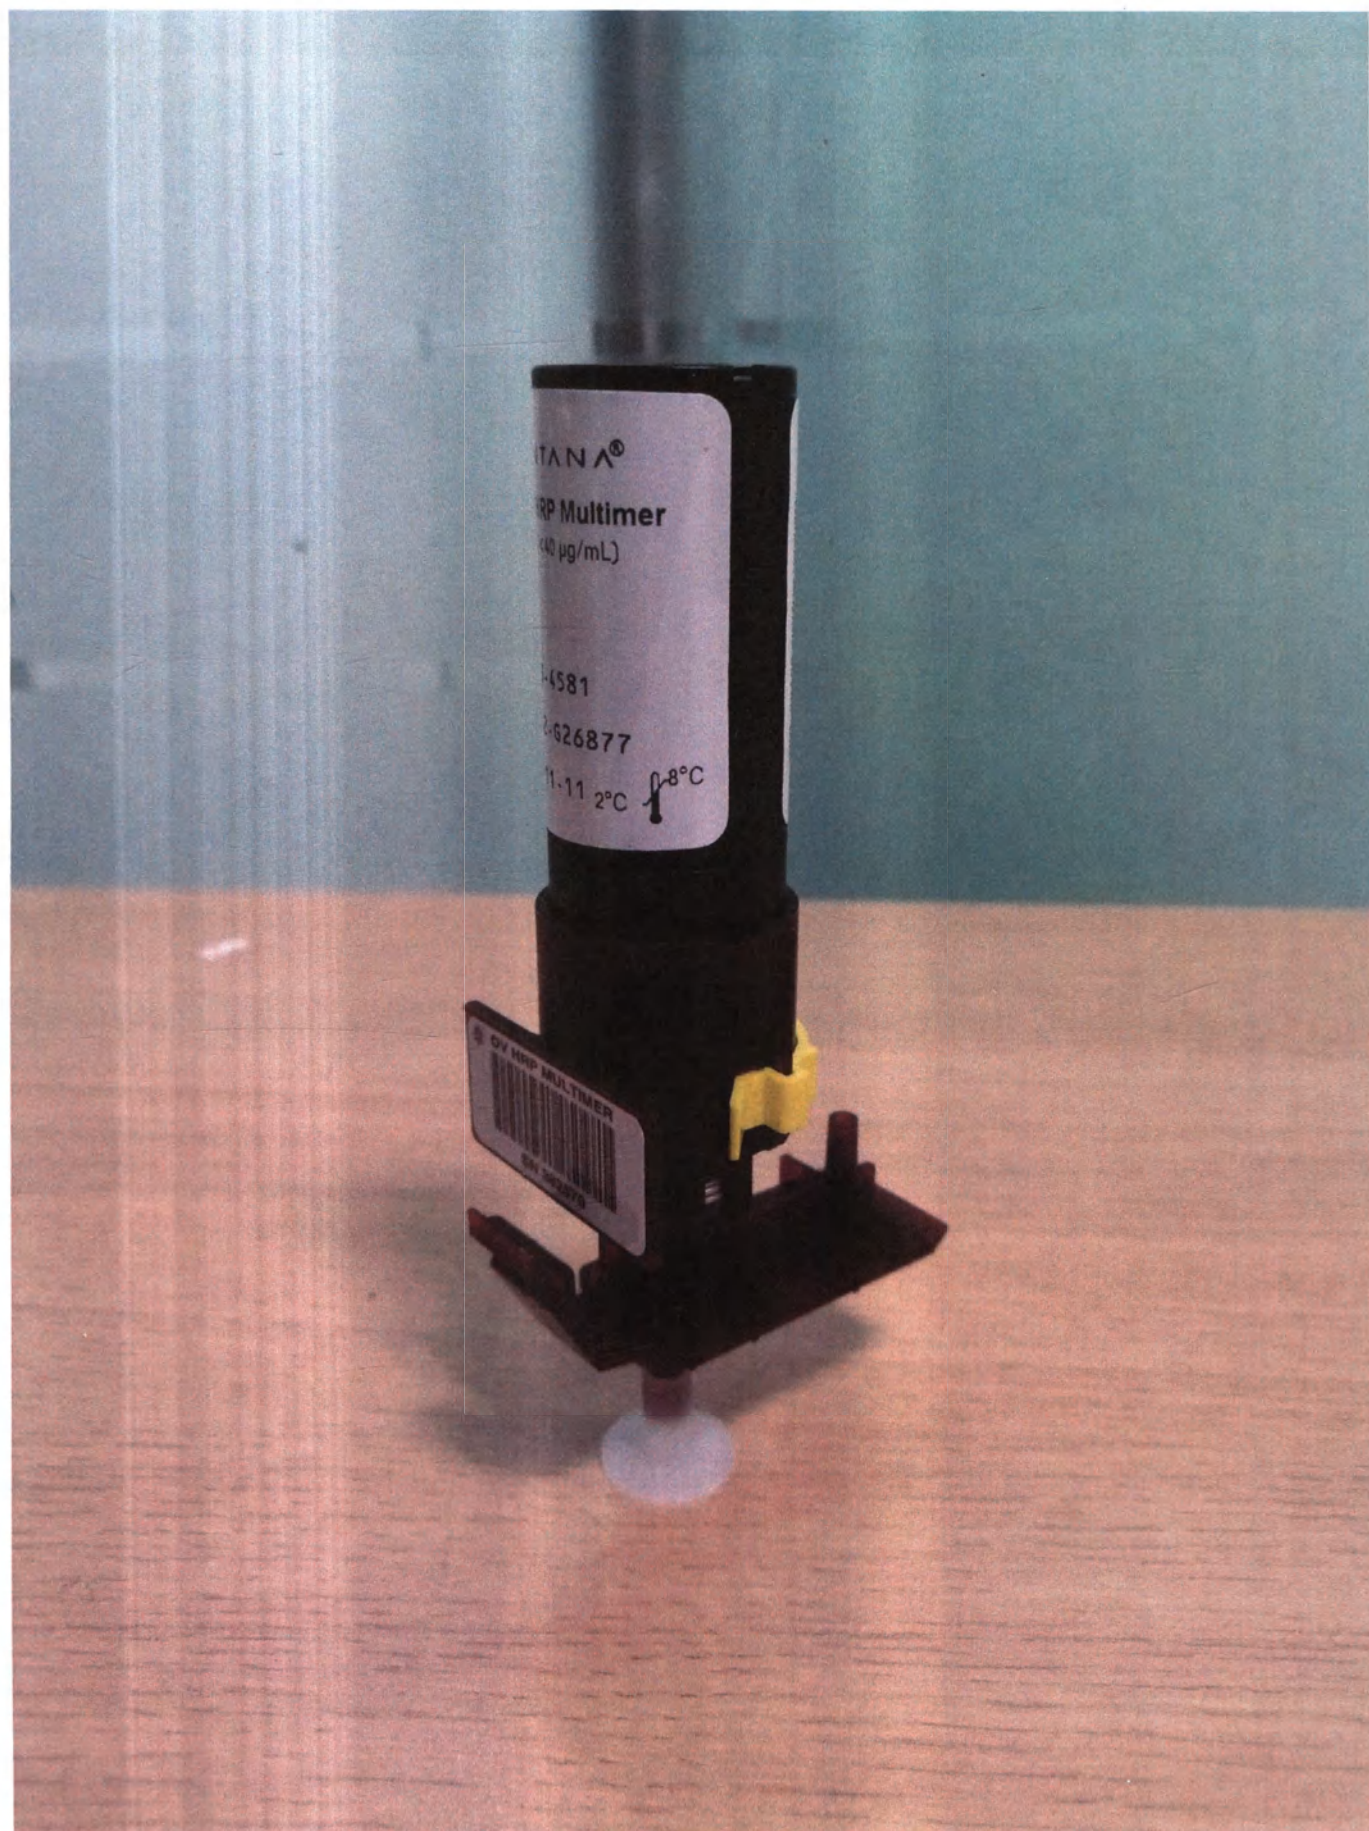


Реагент OptiView HRP Multimer в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

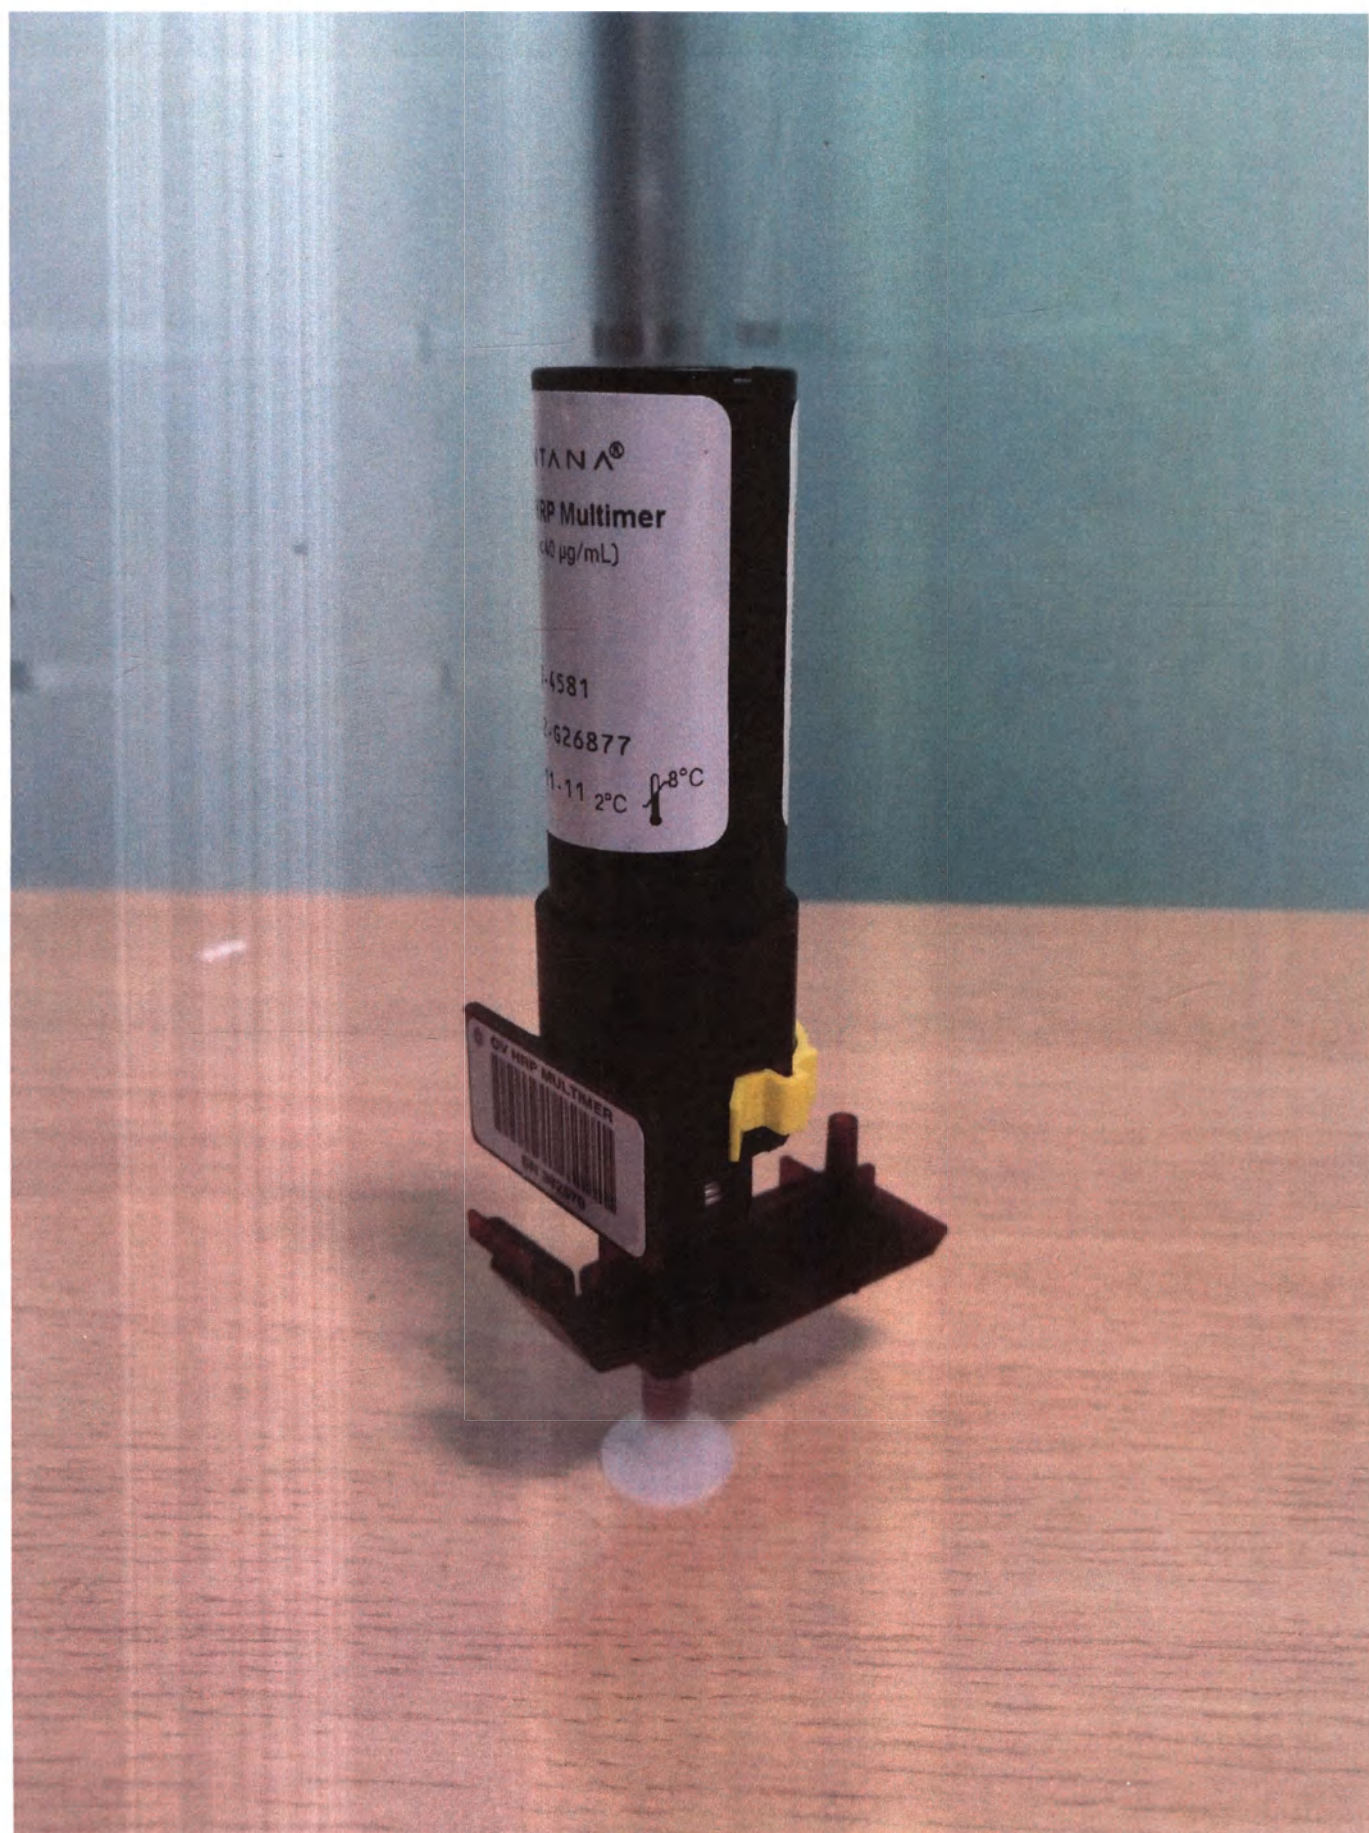


Реагент OptiView HRP Multimer в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

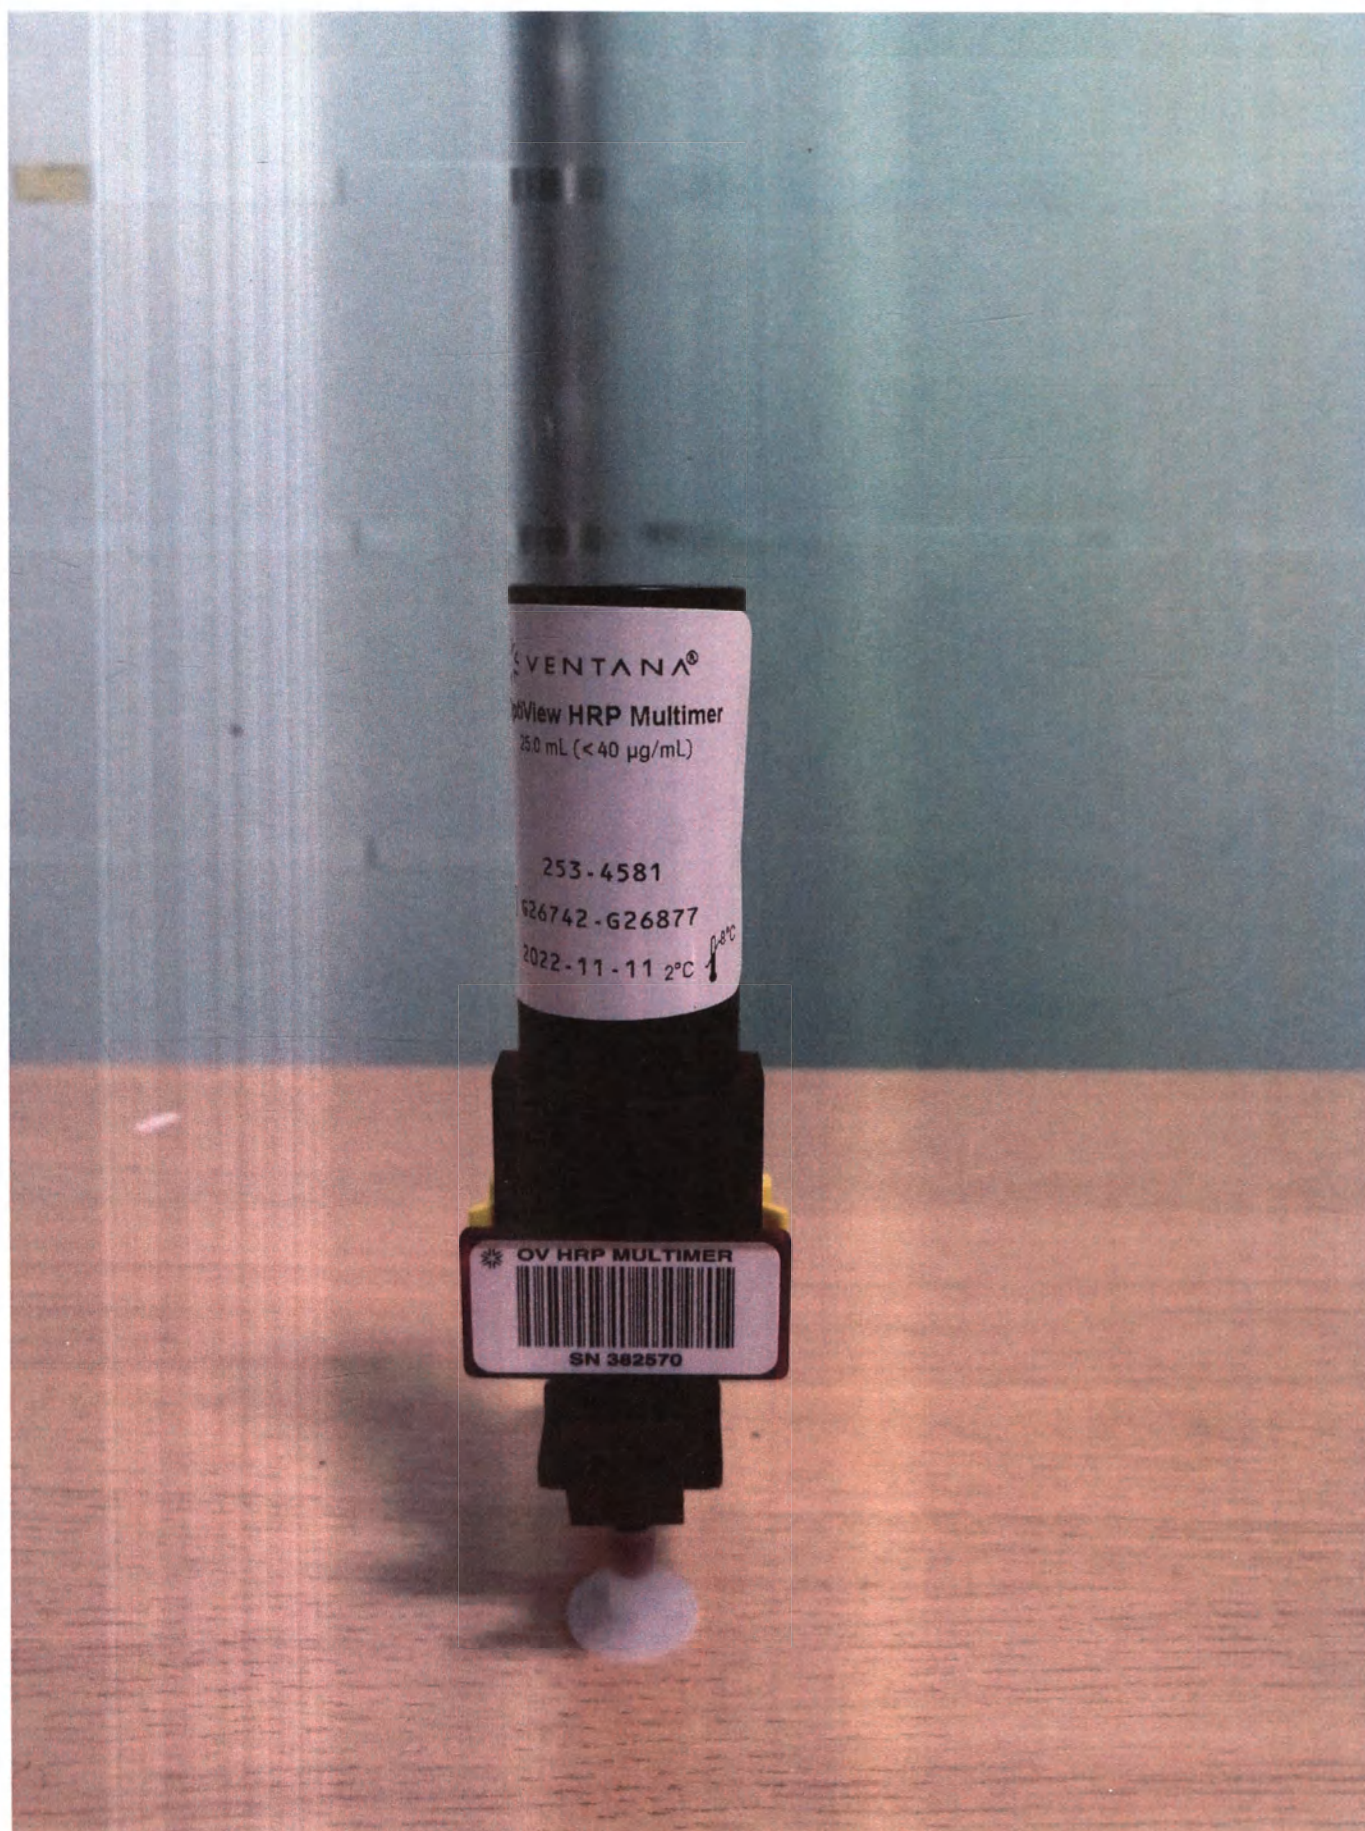

Реагент OptiView HRP Multimer в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

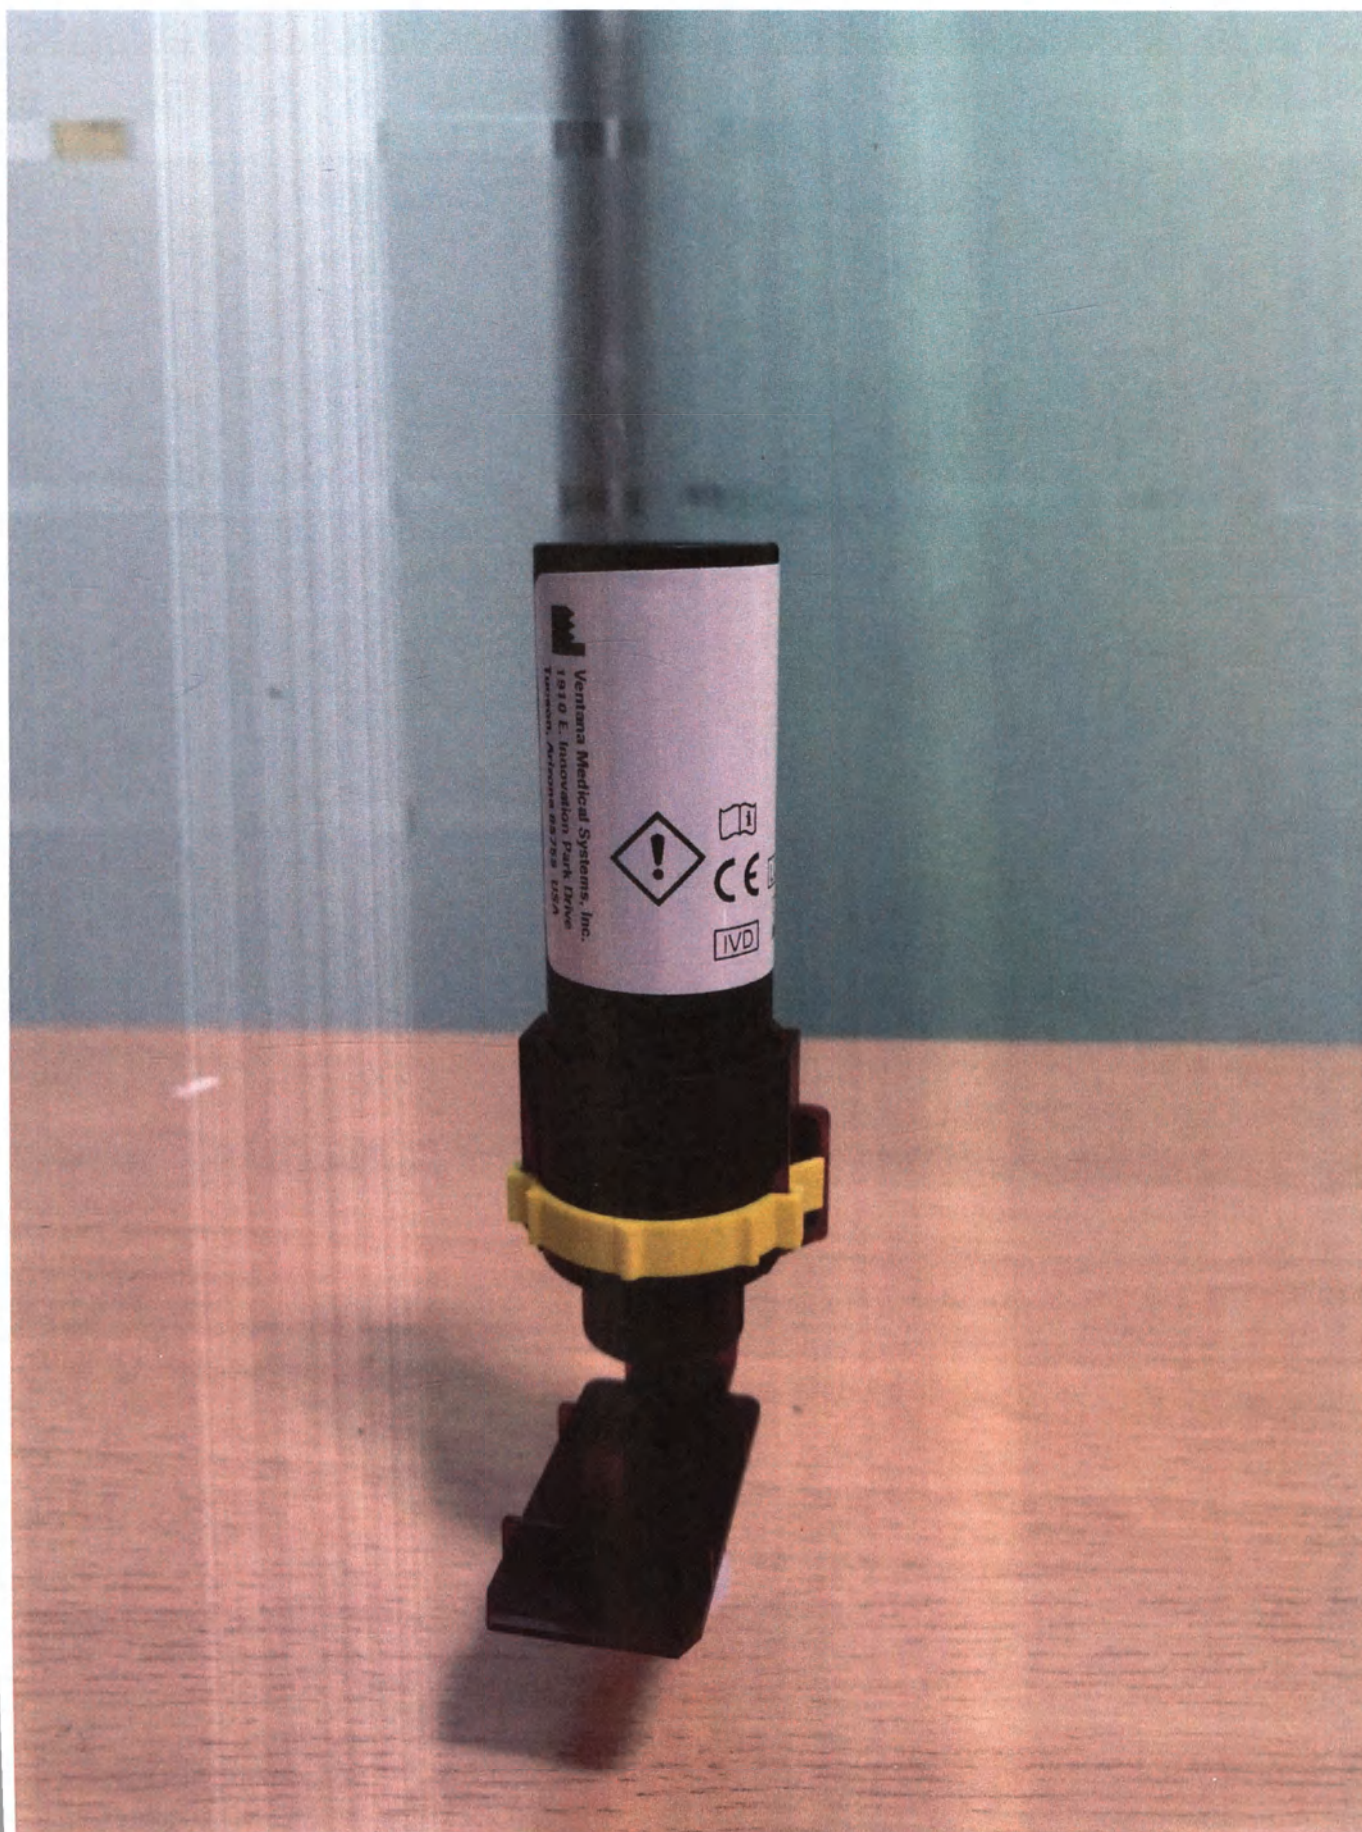


Реагент OptiView DAB в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

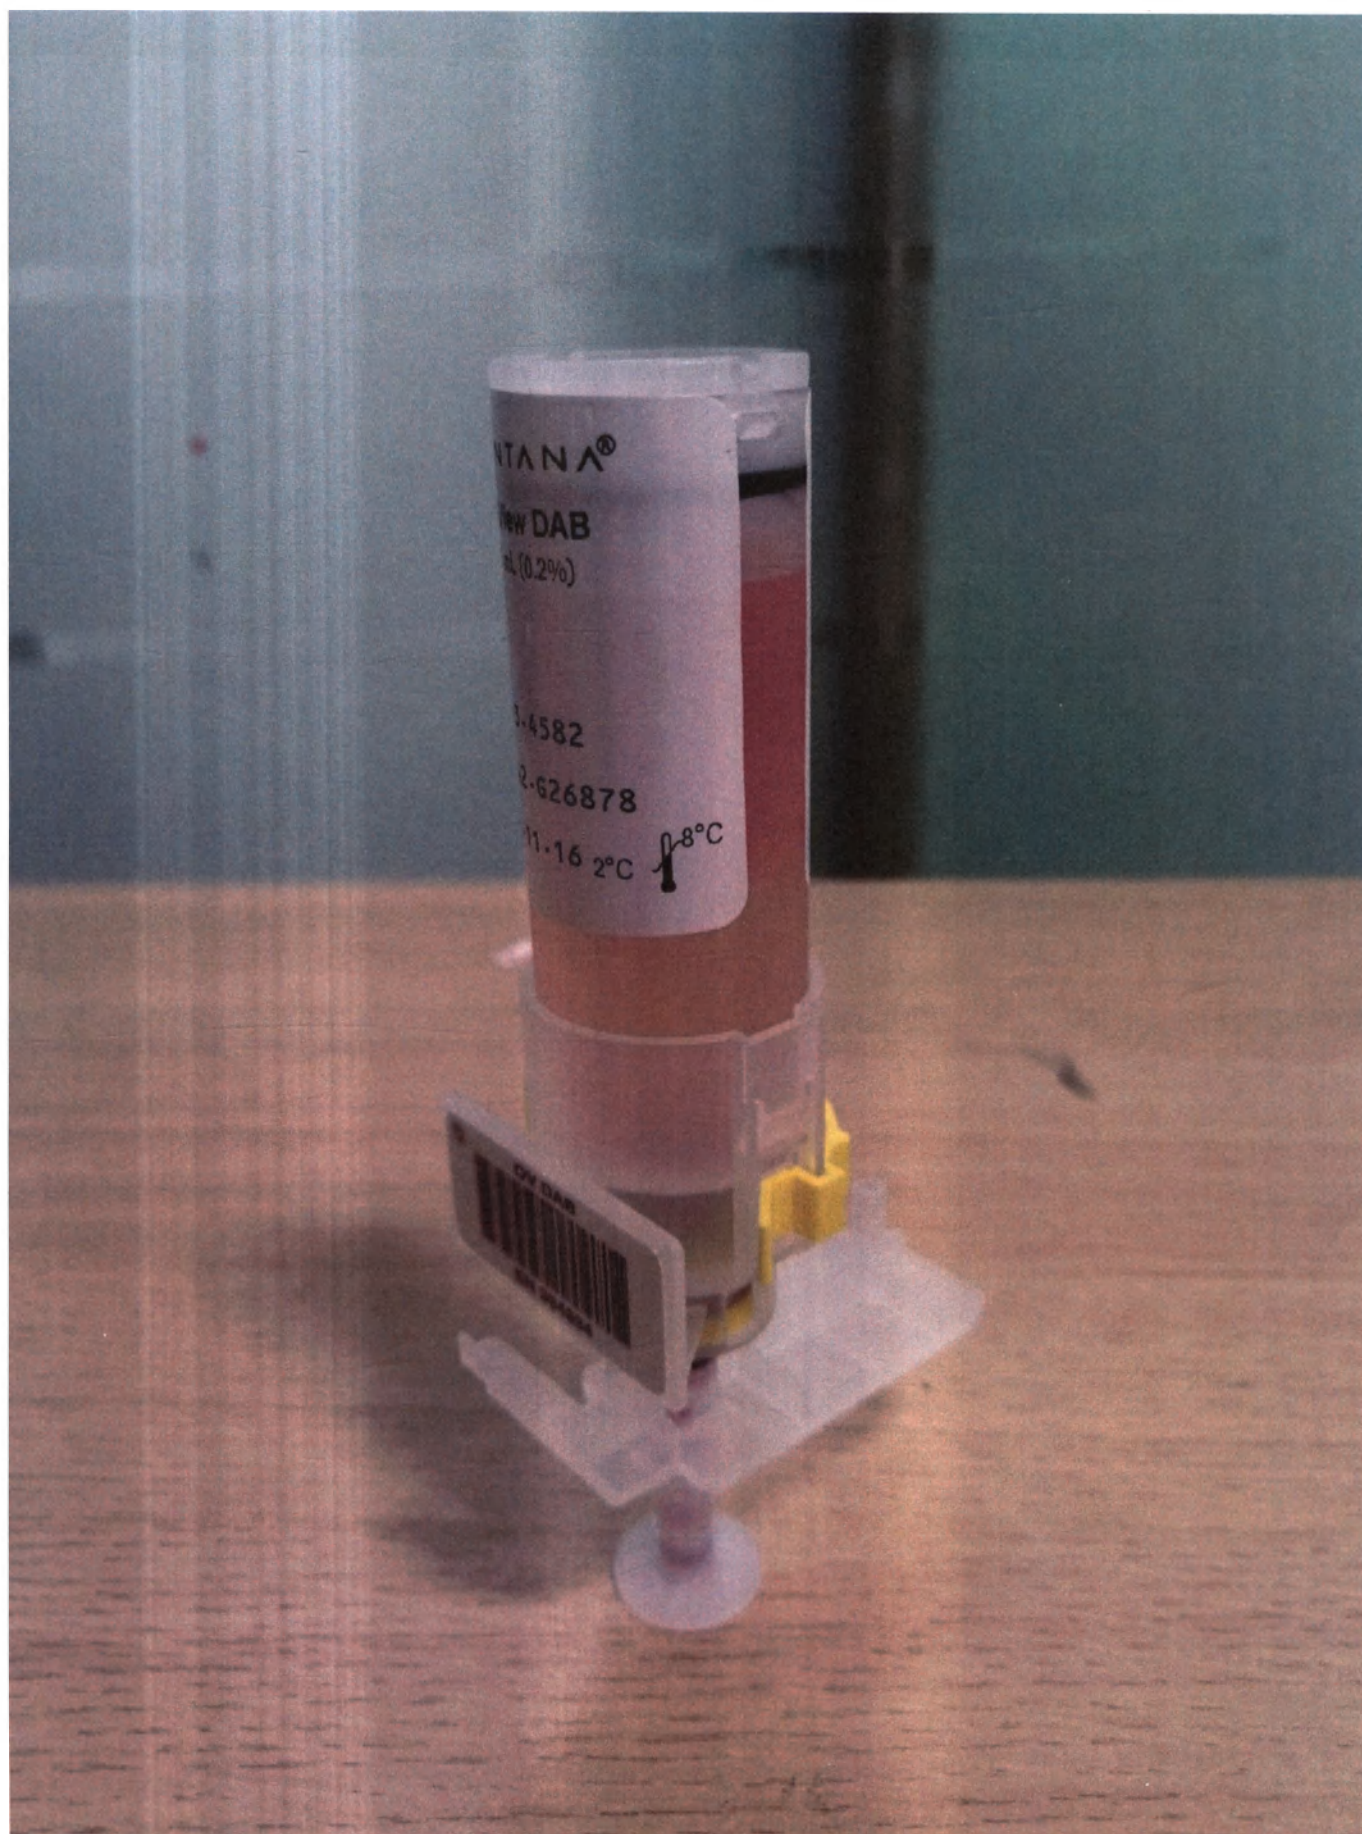

Реагент OptiView DAB в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.



Реагент OptiView DAB в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

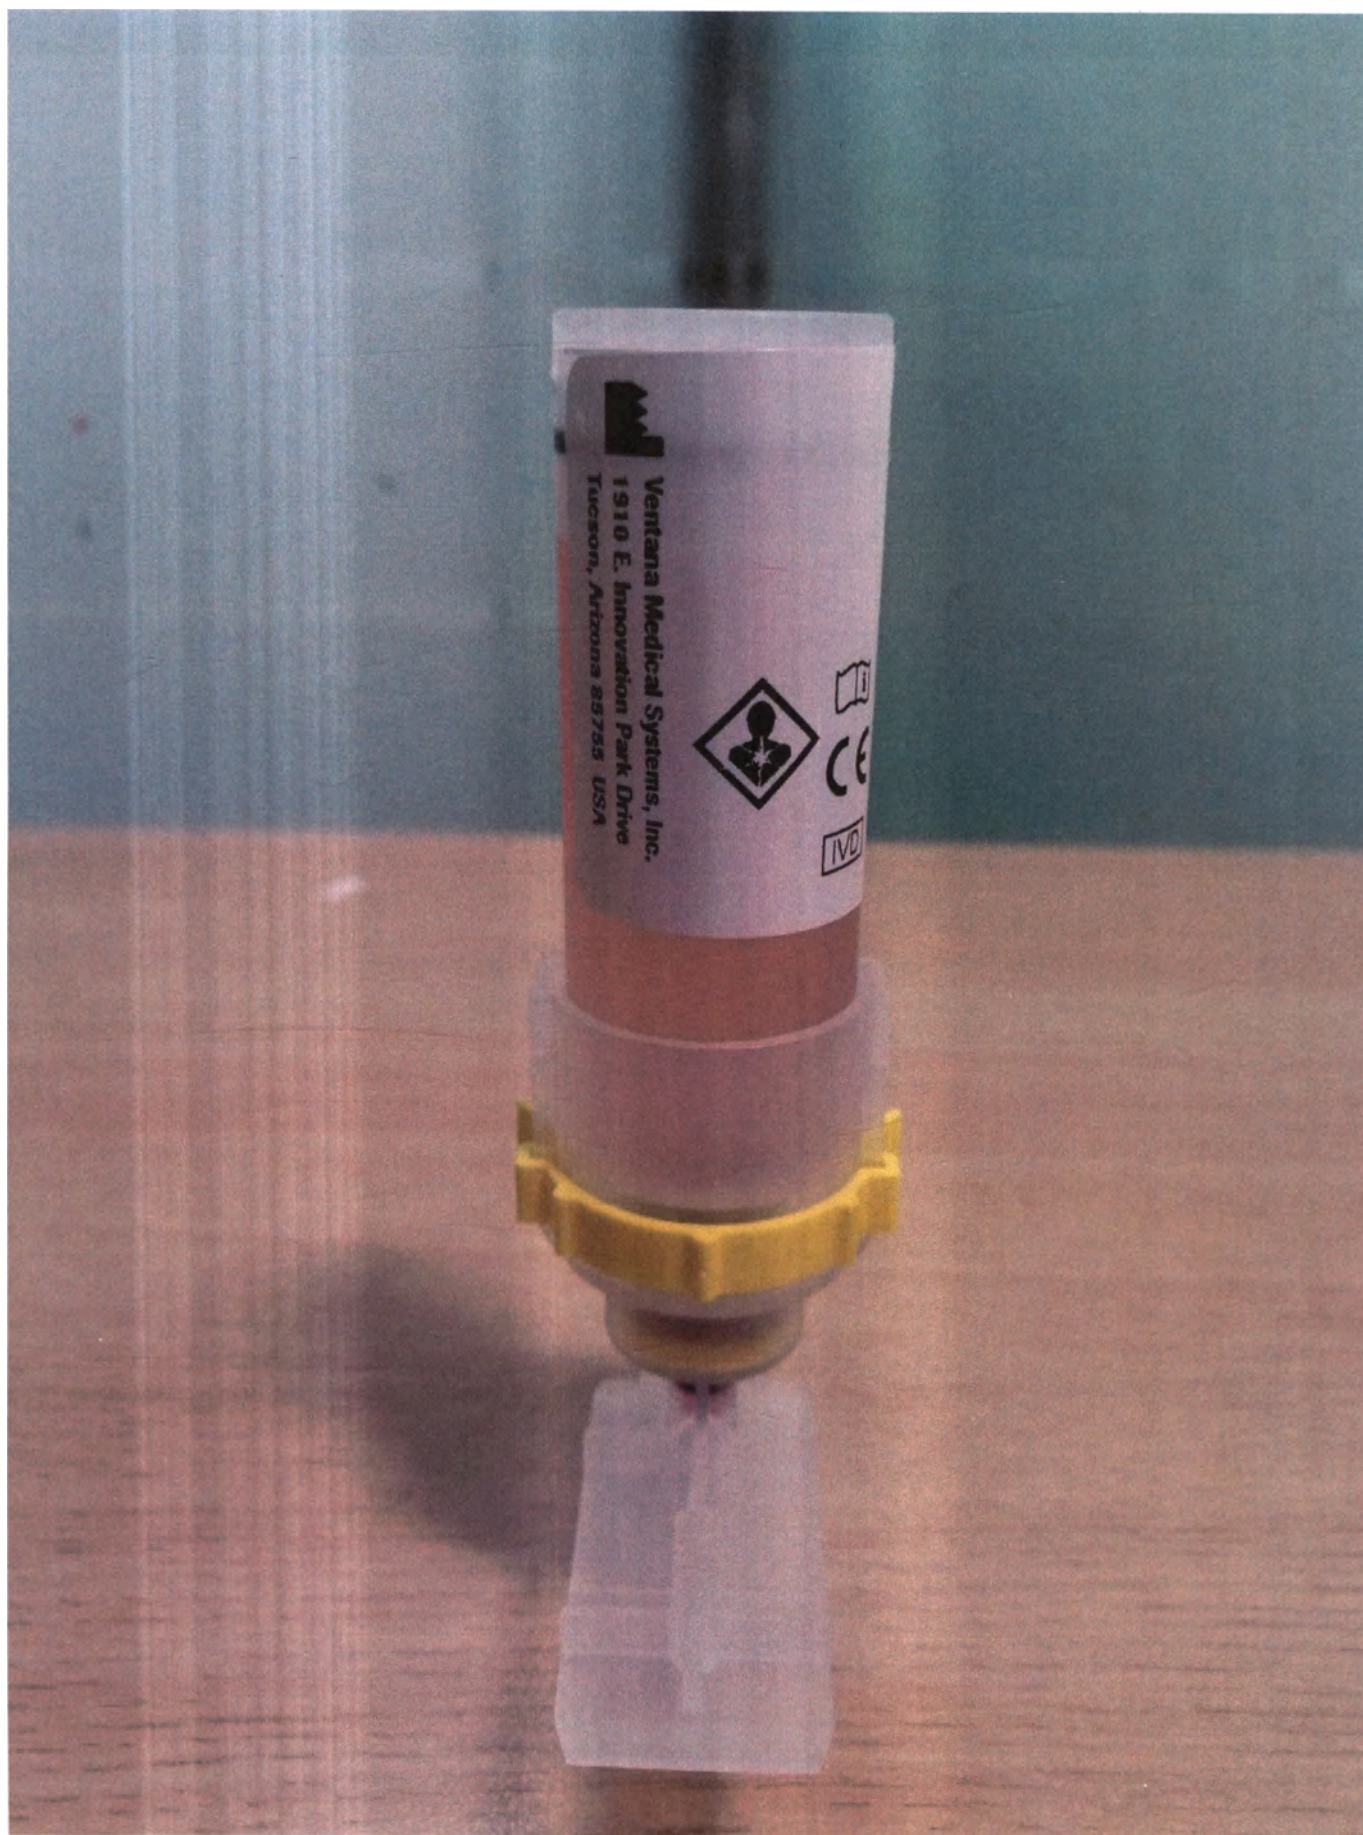

Реагент OptiView H₂O₂ в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.




Реагент OptiView H₂O₂ в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.




Реагент OptiView H₂O₂ в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.




Реагент OptiView H₂O₂ в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

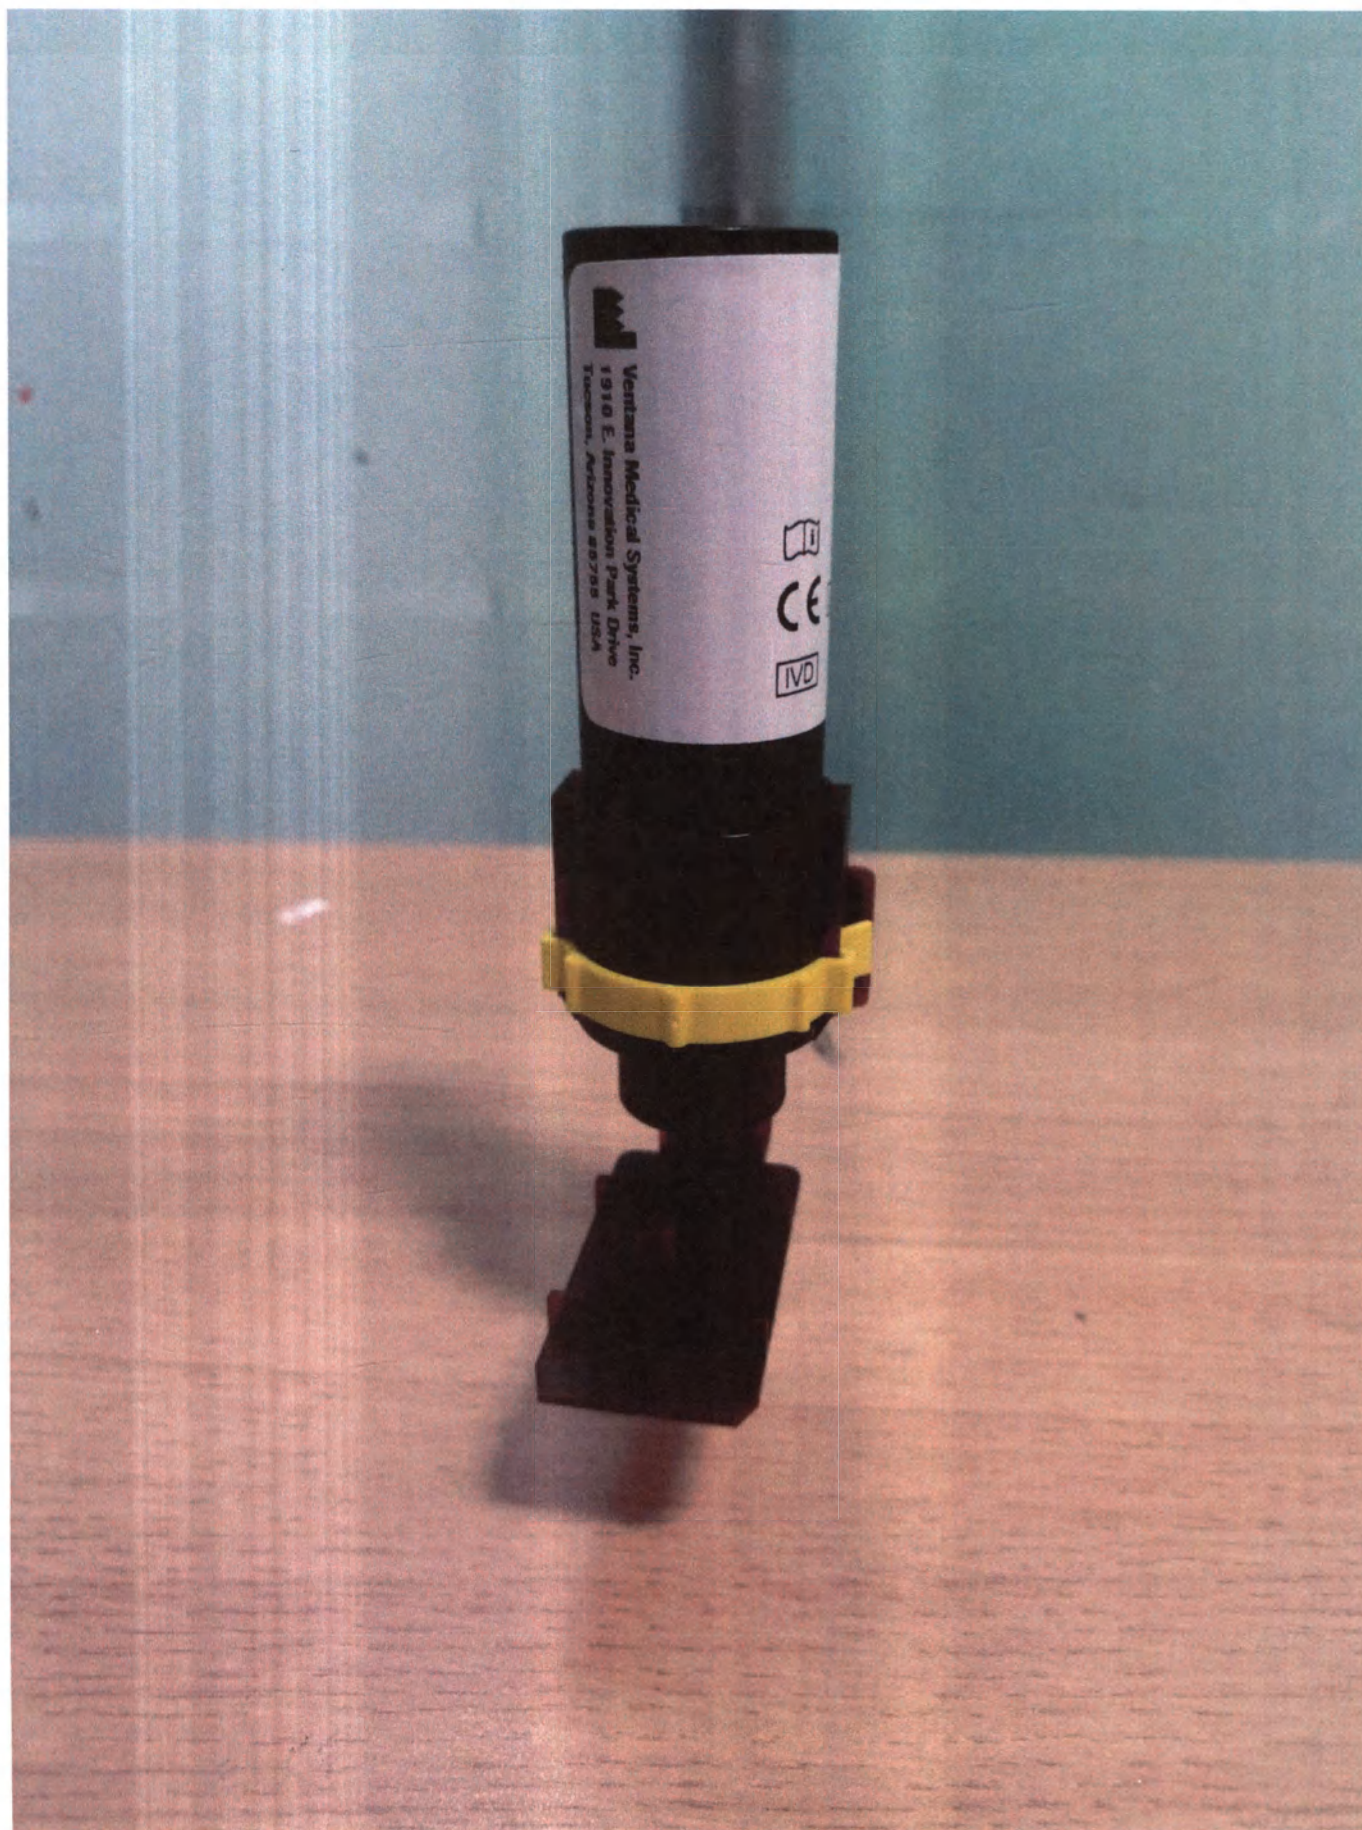

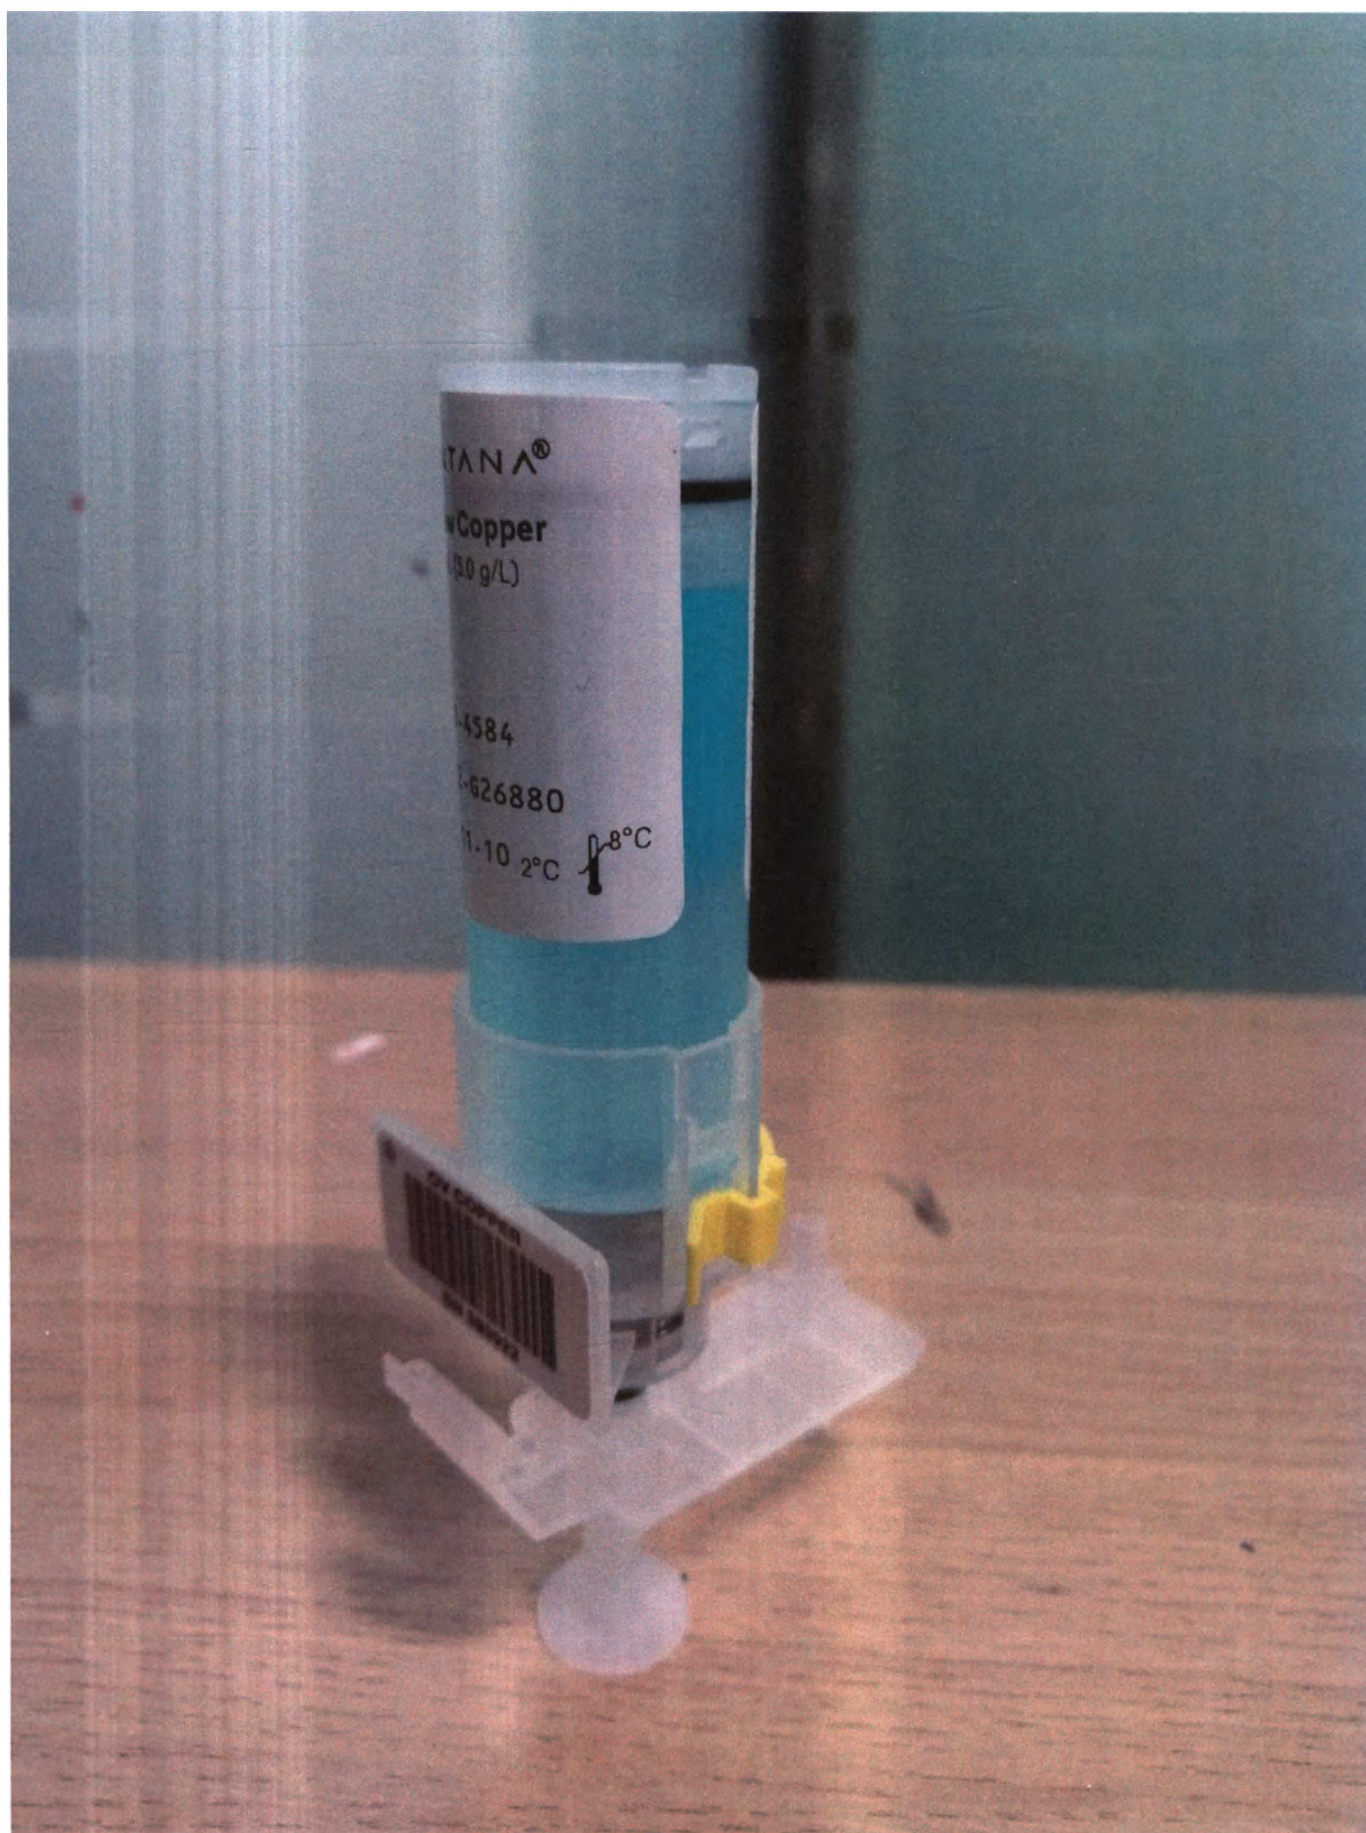

Реагент OptiView DAB Copper в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт

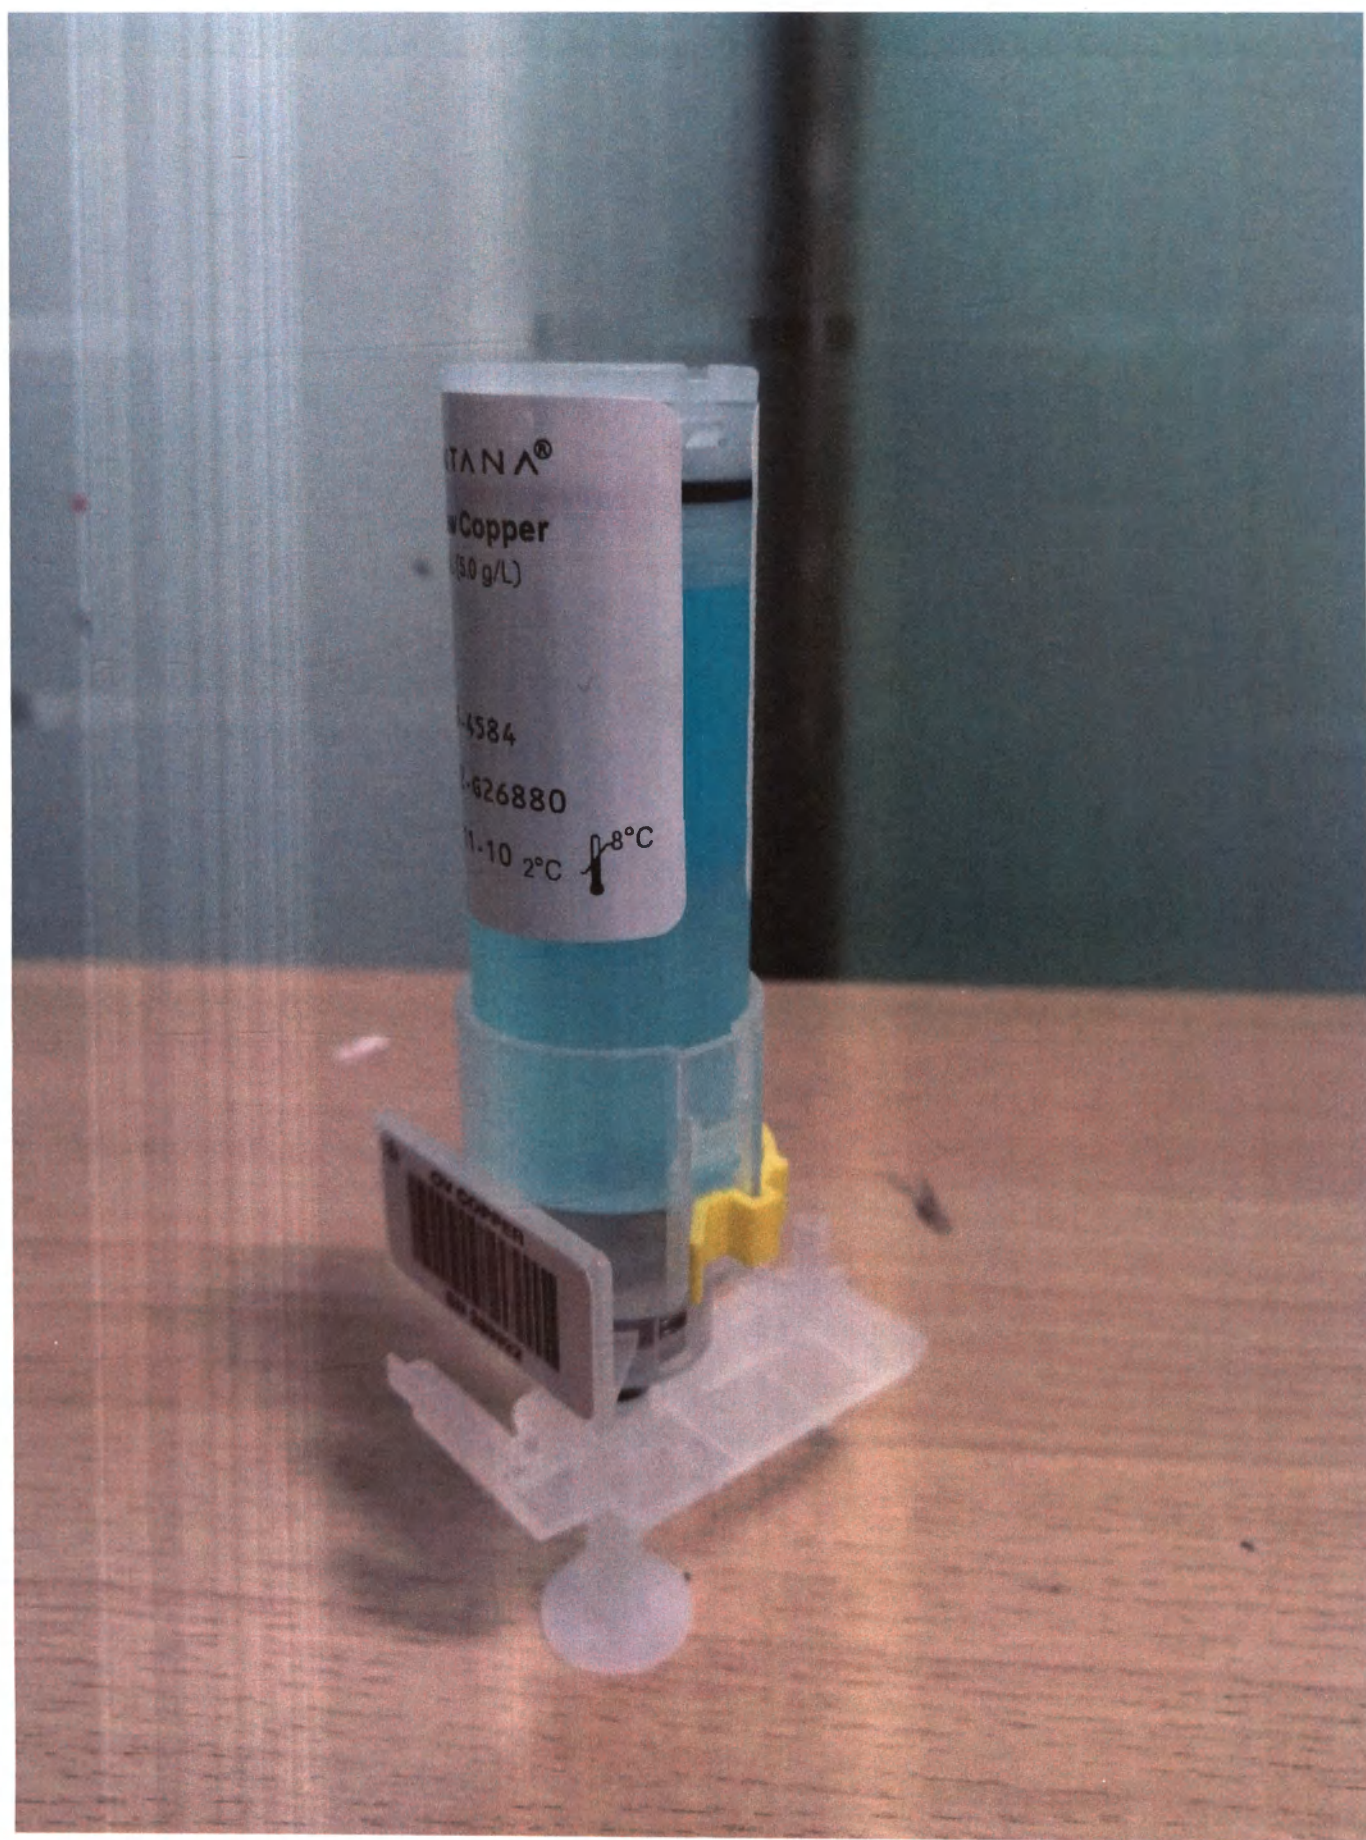

Реагент OptiView DAB Copper в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт



Реагент OptiView DAB Copper в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт



Набор для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Набор для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)

VENTANA

VENTANA®

REF 760-700

LOT 626742

GTIN 04015630984039

2021-01-04

(240) 06396500001-Roche #

2022-10-28

250

2°C - 8°C

CE

IVD



Rx Only

760-700 626742 3135



OptiView DAB IHC Detection Kit

- (1) 25.0 mL OptiView Peroxidase Inhibitor (3.0%)
- (1) 25.0 mL OptiView HQ Universal Linker (<50 µg/mL)
- (1) 25.0 mL OptiView HRP Multimer (<40 µg/mL)
- (1) 25.0 mL OptiView DAB (0.2%)
- (1) 25.0 mL OptiView H₂O₂ (0.04%)
- (1) 25.0 mL OptiView Copper (5.0 g/L)


Ventana Medical Systems, Inc.
1910 E. Innovation Park Drive
Tucson, Arizona 85755
USA
+1 520 887 2155
+1 800 227 2155 (USA)

 www.ventanamed.com

EC REP
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany

Made in USA



 VENTANA

Набор для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)

Набор для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark.

- Состав:
1. Реагент OptiView Peroxidase Inhibitor в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт;
 2. Реагент OptiView H2 Universal Linker в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт;
 3. Реагент OptiView HRP Multiplier в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт;
 4. Реагент OptiView DAB в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт;
 5. Реагент OptiView H2O в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт;
 6. Реагент OptiView Copper в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт;

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок годности см. на упаковке. Дату производства см. на упаковке.
Температура хранения см. на упаковке. Номер лота см. на упаковке.



Производитель: «Ventana Medical Systems, Inc.», 1910 East Innovation Park Drive, Tucson, AZ 85704 USA

Удостоверено для диагностики in vitro
Удостоверено в соответствии с приказом Минздрава России от 14.06.2017 № 245н «Об утверждении правил регистрации медицинских изделий, подлежащих обязательной регистрации в Росздравнадзоре» (Зарегистрировано в Едином государственном реестре медицинских изделий № 107031, Москва, Трудовая площадь, д.2 Тел: +7 495 228-88-99, факс: +7 495 228-82-64, E-mail: info@ventanamedical.com)

Код: 10000000000000000000 (710-799)

 VENTANA

по доверенности
от 04.02.2021

(Ермишин Д. В.)

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
24 листа (ов)

