


ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Инте-Рент»
Жукова М.В.
«1» августа 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


Нить ретракторная AtriaPak плетеная без
протилки нестерильная, различных размеров: 000,
00, 0, 1, 2, 3




1. Питьевая вода: Аппарат и система безпрерывно-периодическая, размер 000, первичная упаковка, 0,5 л, 0,5 л.

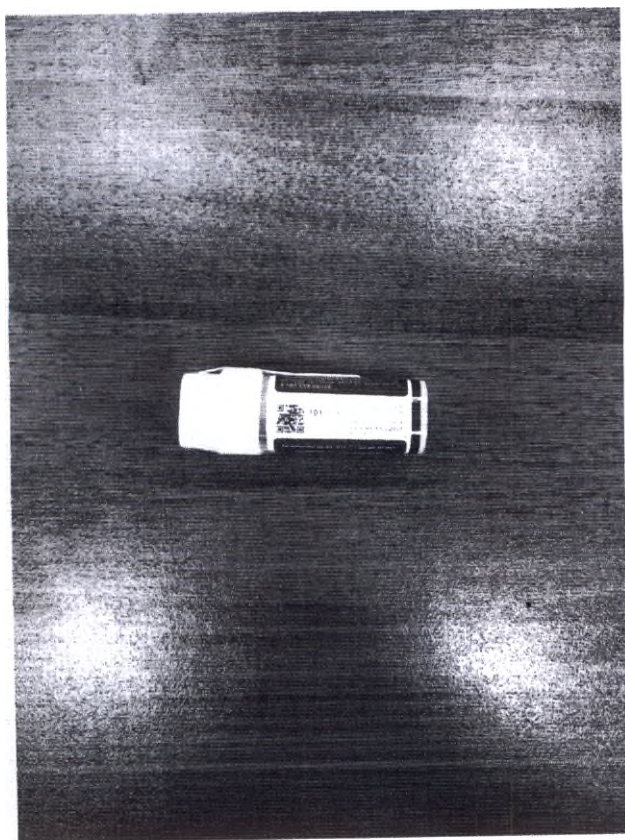


1. *Illegible text*

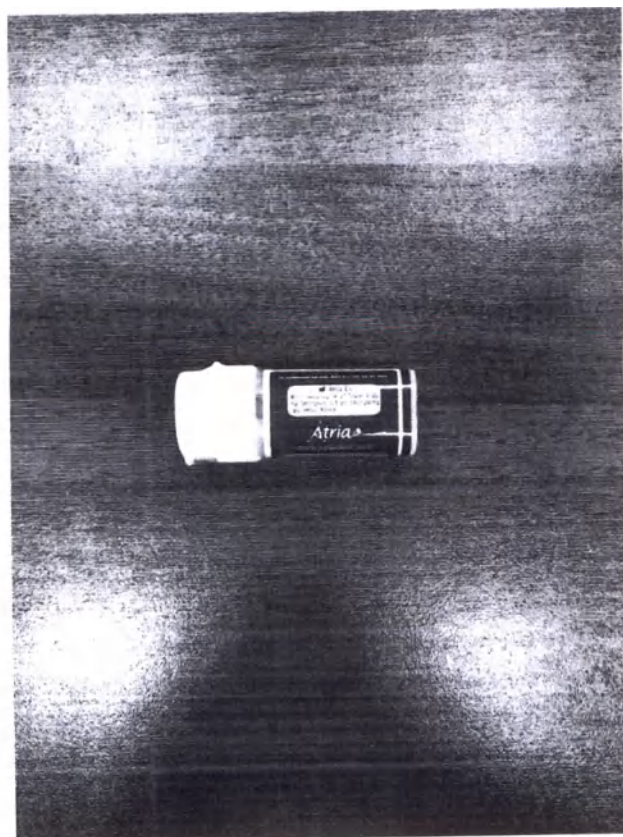


1. Источники информации: Ахмедов, И. С. и др. // Информационная система «ЭКО» / И. С. Ахмедов, И. В. Сидоров, И. В. Сидоров. — М.: 1998. — 100 с.

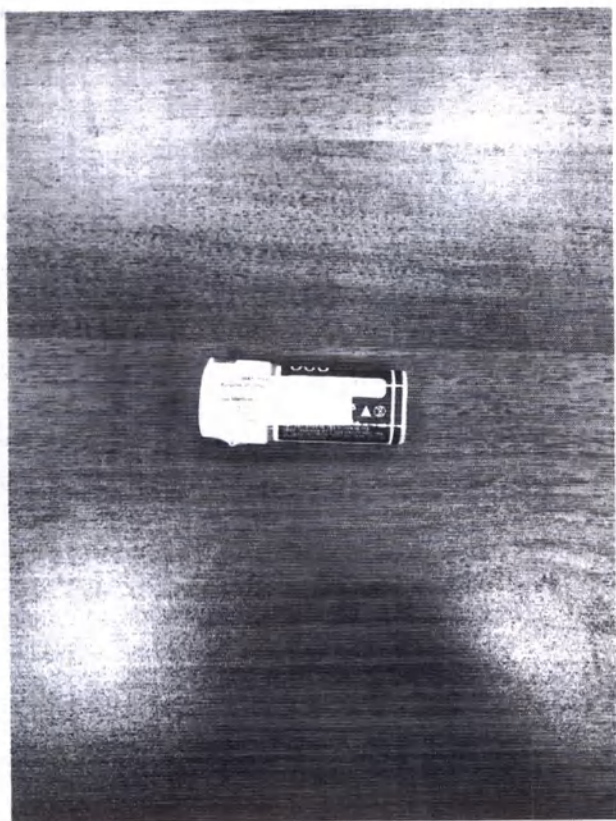

1. Питье-реставрация Atrial Pak 000 (ссылка на сайт) - средний размер 000 (средняя толщина 0,5 мм)

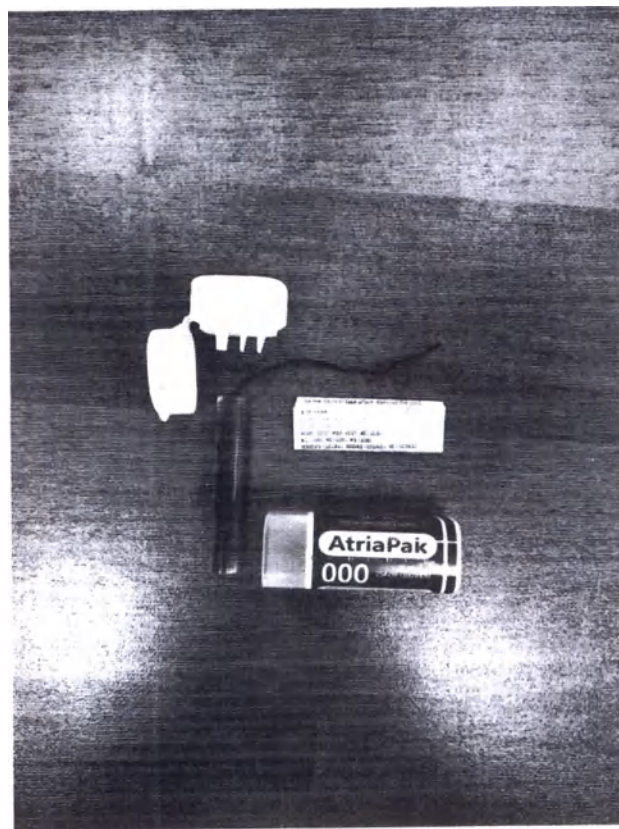

2. Питье-реставрация Atrial Pak 000 (ссылка на сайт) - средний размер 000 (средняя толщина 0,5 мм)

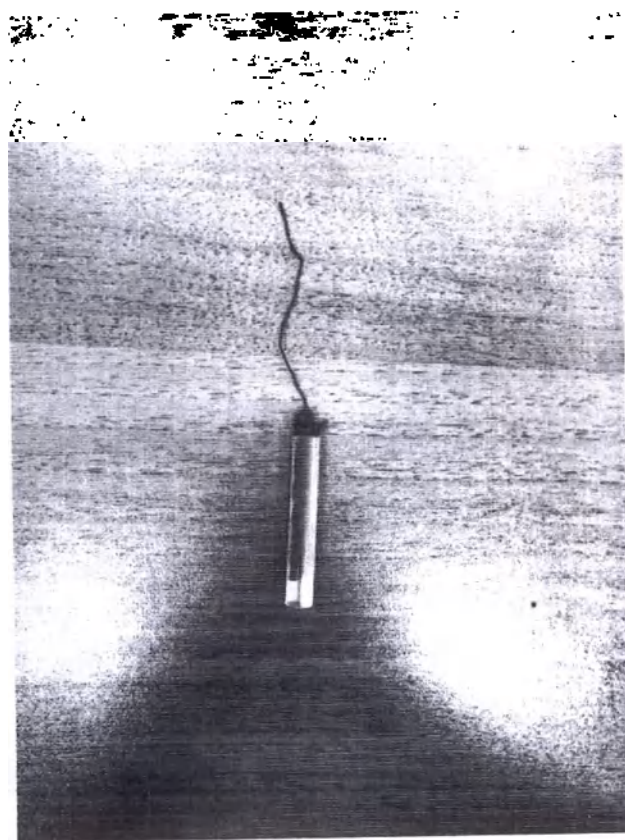


3. Питье-реставрация Atrial Pak 000 (ссылка на сайт) - средний размер 000 (средняя толщина 0,5 мм)



4. Питье-реставрация Atrial Pak 000 (ссылка на сайт) - средний размер 000 (средняя толщина 0,5 мм)



2. Питьевая вода AtriaPak и система фильтрации воды (вспомогательная система)

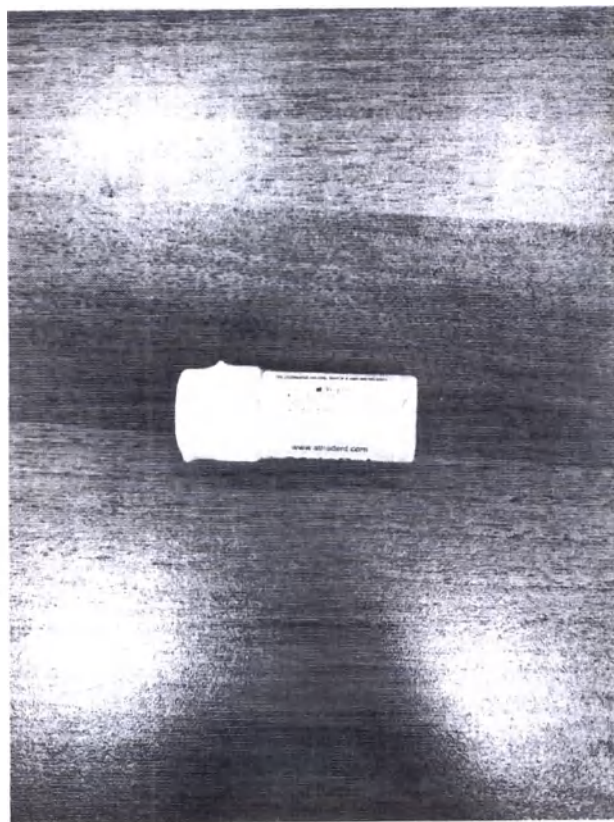

3. Питьевая вода AtriaPak и система фильтрации воды (вспомогательная система)



4. Питьевая вода AtriaPak и система фильтрации воды (вспомогательная система)




5. Питьевая вода AtriaPak и система фильтрации воды (вспомогательная система)




2. Питьевая retractable AtriaPak и система ее крепления к стропу, размер 00.




3. Питьевая retractable AtriaPak и система ее крепления к стропу, размер 0, первичная упаковка, вид сверху.

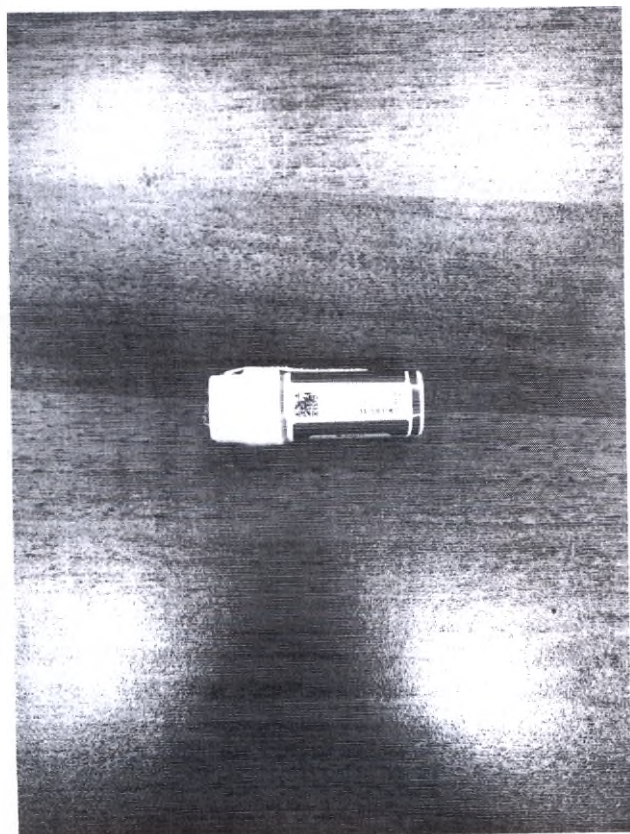

4. Питьевая retractable AtriaPak и система ее крепления к стропу, размер 0, первичная упаковка, вид сбоку.

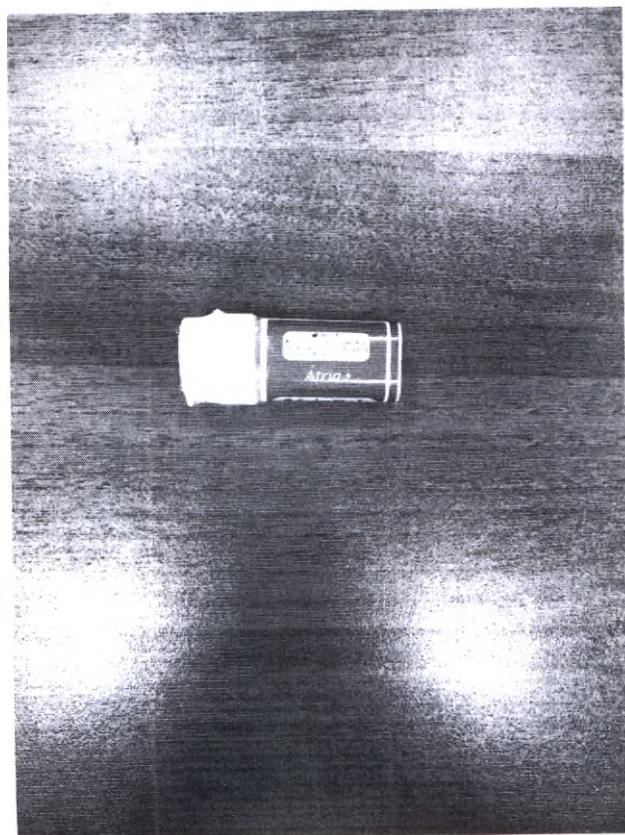


5. Питьевая retractable AtriaPak и система ее крепления к стропу, размер 0, первичная упаковка, вид сбоку.

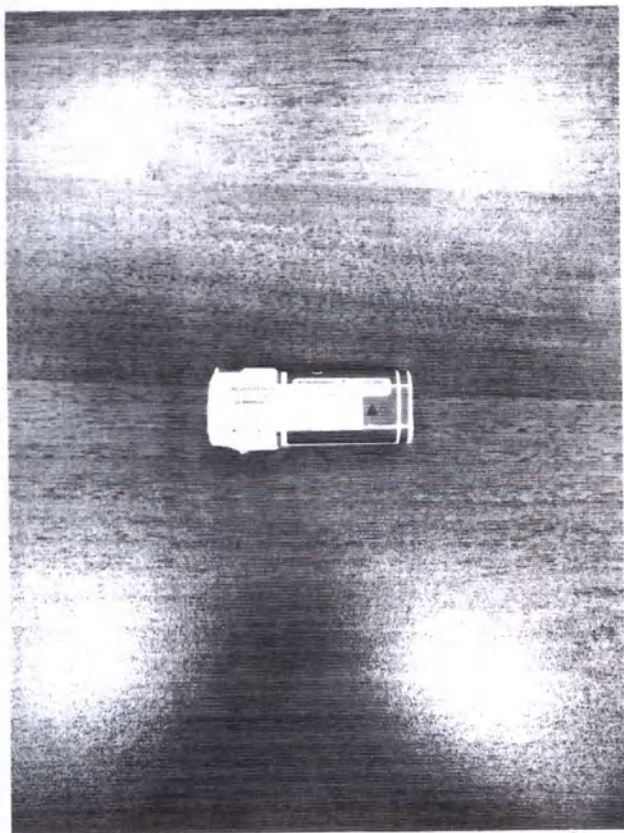

1. Питьевый пакет AtrialPak и его размеры (приведены для справки) - размер 0, герметичная упаковка, вид сверху







2. Питьевый пакет AtrialPak и его размеры (приведены для справки) - размер 0, донышко упаковки

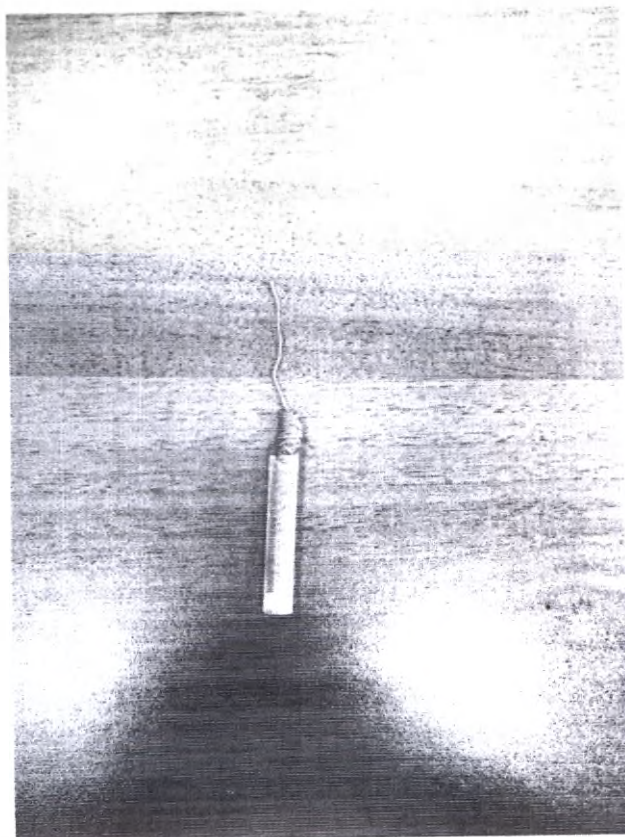


3. Питьевый пакет AtrialPak и его размеры (приведены для справки) - размер 1, герметичная упаковка, вид сверху




4. Питьевый пакет AtrialPak и его размеры (приведены для справки) - размер 1, герметичная упаковка, вид сверху

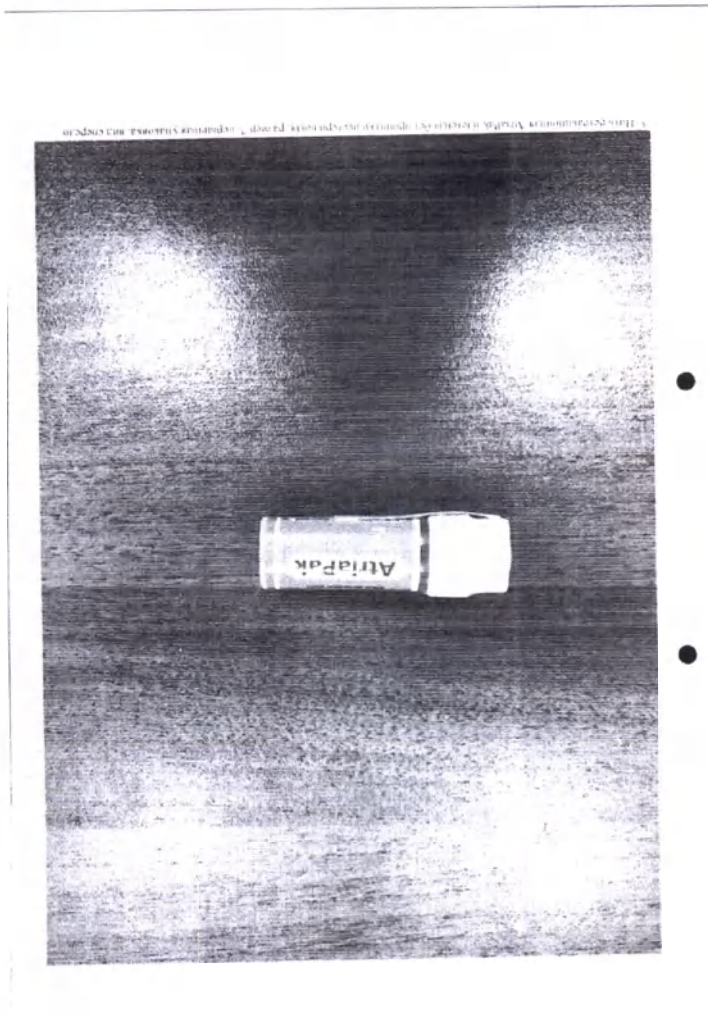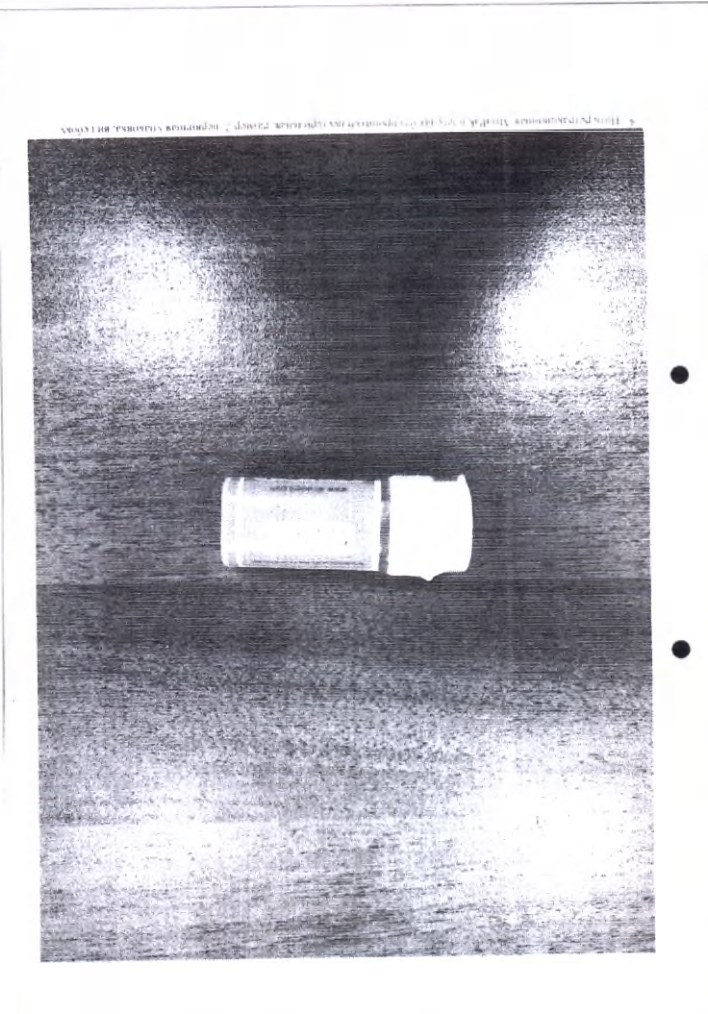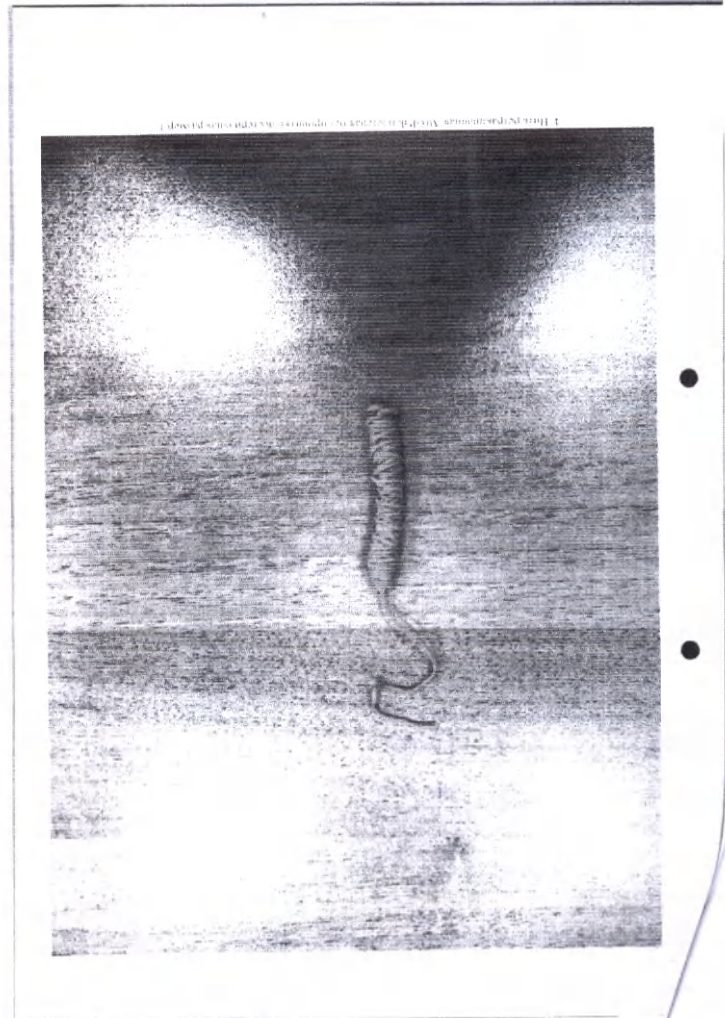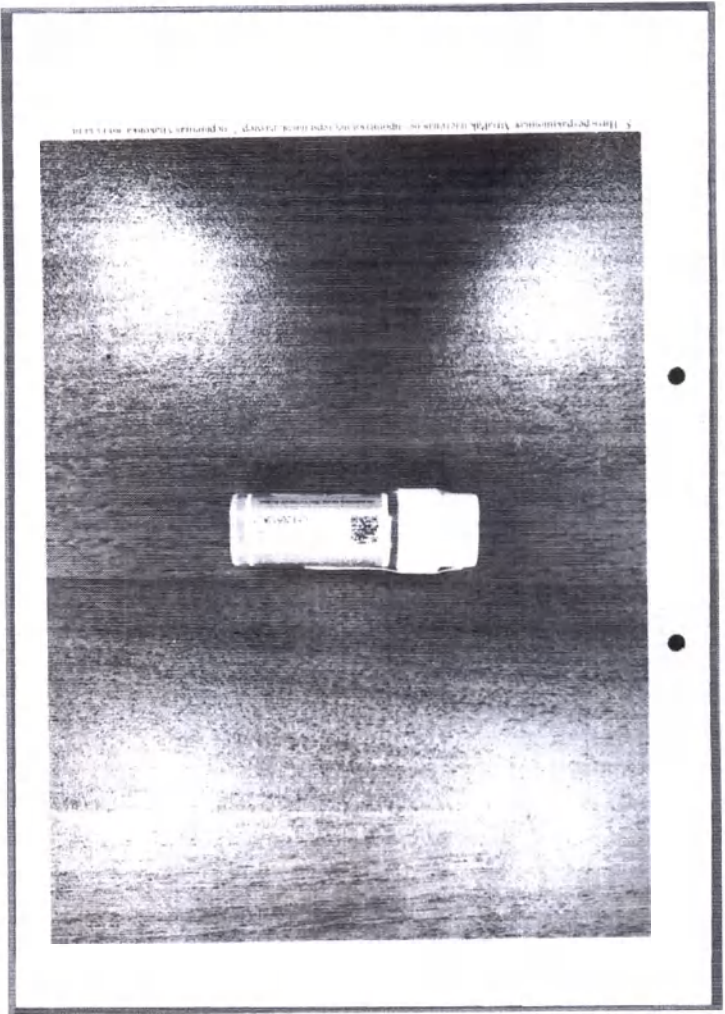

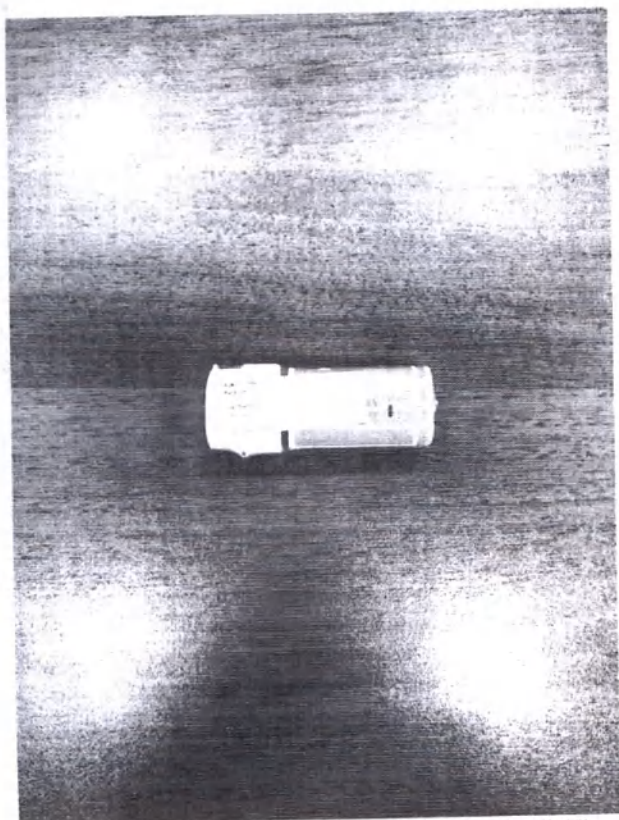


1. Питьевая вода AtrialPak и вода из-под крана (температура 20-25°C) в течение 2-х часов.

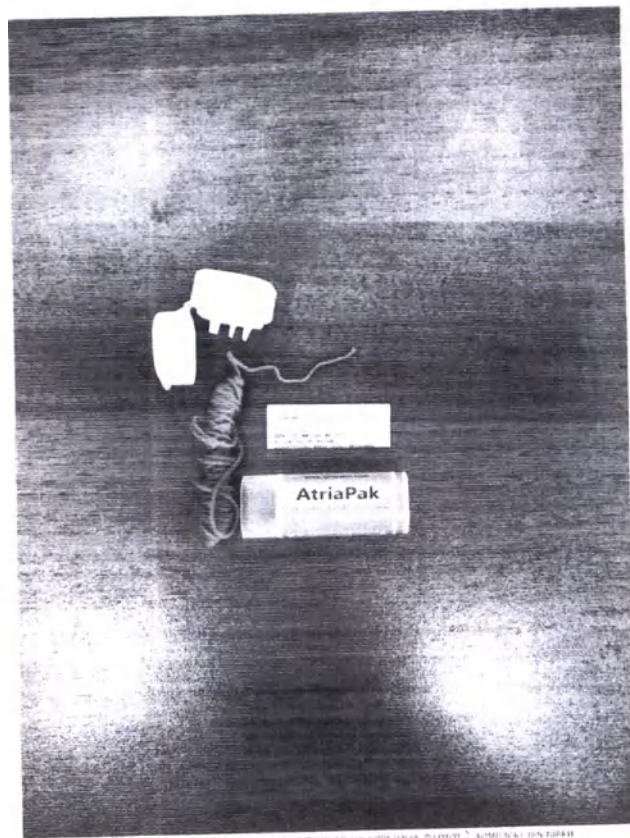


2. Питьевая вода AtrialPak и вода из-под крана (температура 20-25°C) в течение 2-х часов.




3. Питьевая вода AtrialPak и вода из-под крана (температура 20-25°C) в течение 2-х часов.

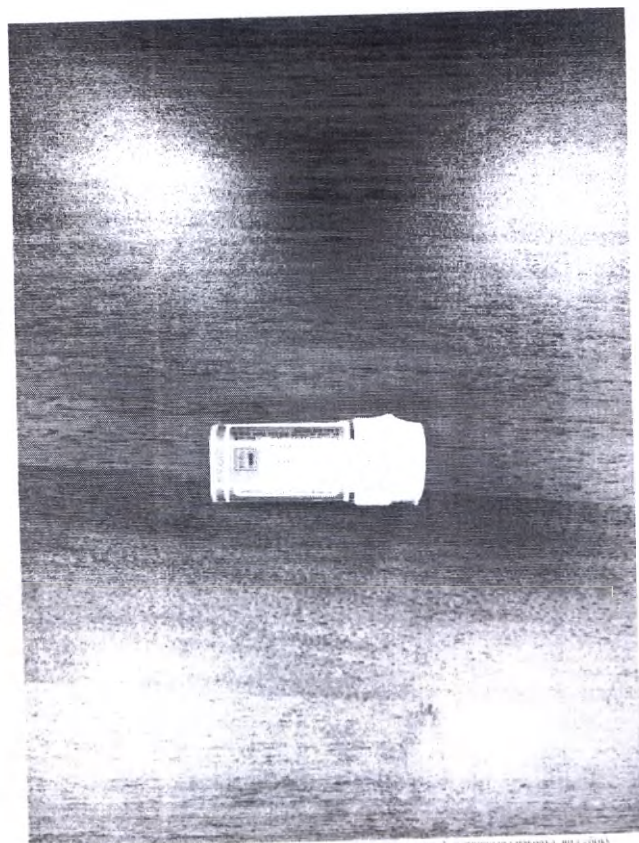

4. Питьевая вода AtrialPak и вода из-под крана (температура 20-25°C) в течение 2-х часов.

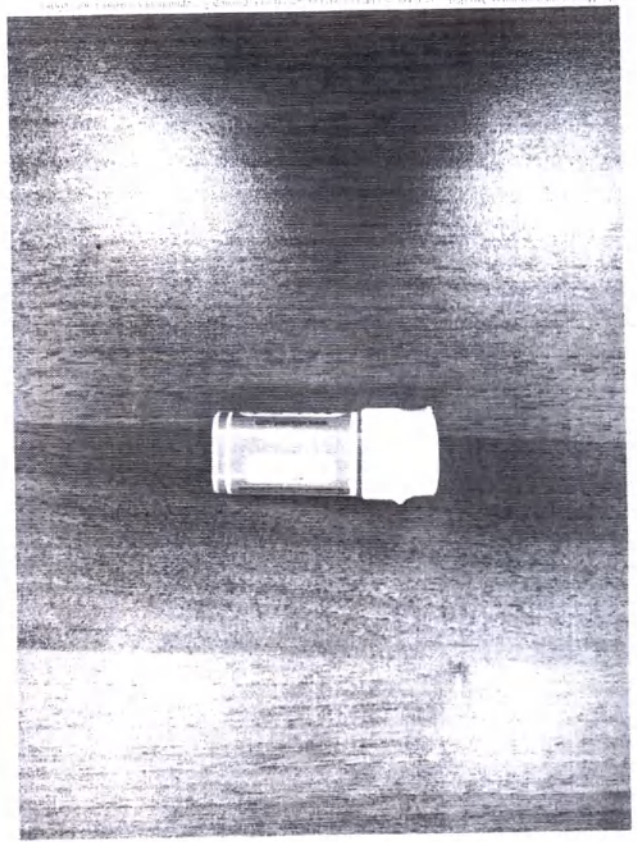


В. Фотография упаковки препарата Атриапак, полученная в ходе расследования.

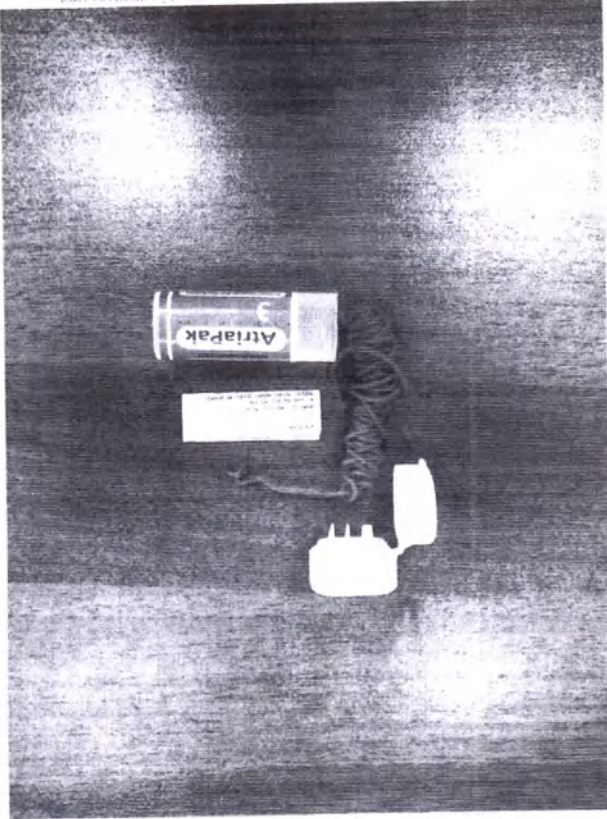

В. Фотография упаковки препарата Атриапак, полученная в ходе расследования.




В. Фотография упаковки препарата Атриапак, полученная в ходе расследования.

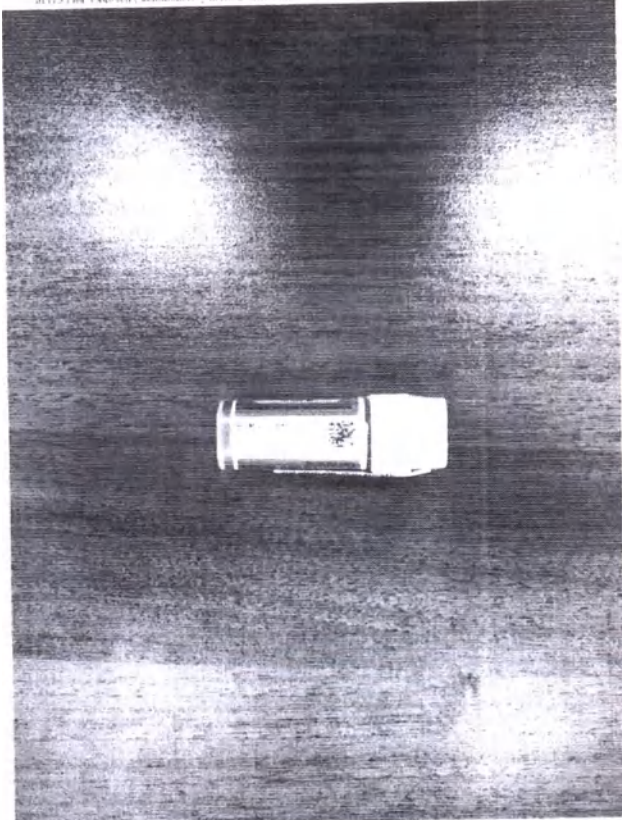

В. Фотография упаковки препарата Атриапак, полученная в ходе расследования.



Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
17.05.2017

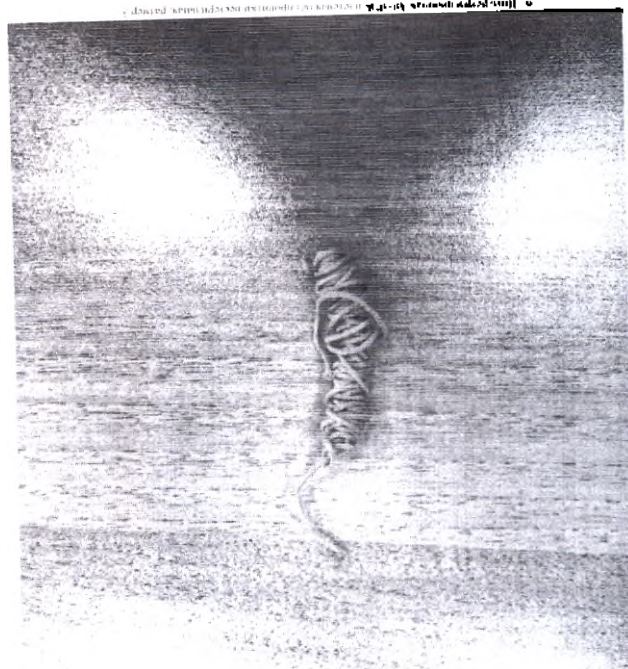

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
17.05.2017

Адрес: г. Минск, ул. Тельмана, д. 17
Телефон: +375 10 233-11-11

Служба: ...

Подпись: ...

Место происшествия: ...

Время: ...

Дата: ...

Инициалы: ...

Подпись: ...

Место происшествия: ...

Время: ...

Дата: ...

Инициалы: ...