

Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
«ООО «Сименс Здоровоохранение»

Чигринец Е.А.
2023 г.



«Раствор промывающий 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Probe Wash 3 (Atellica IM PW3))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

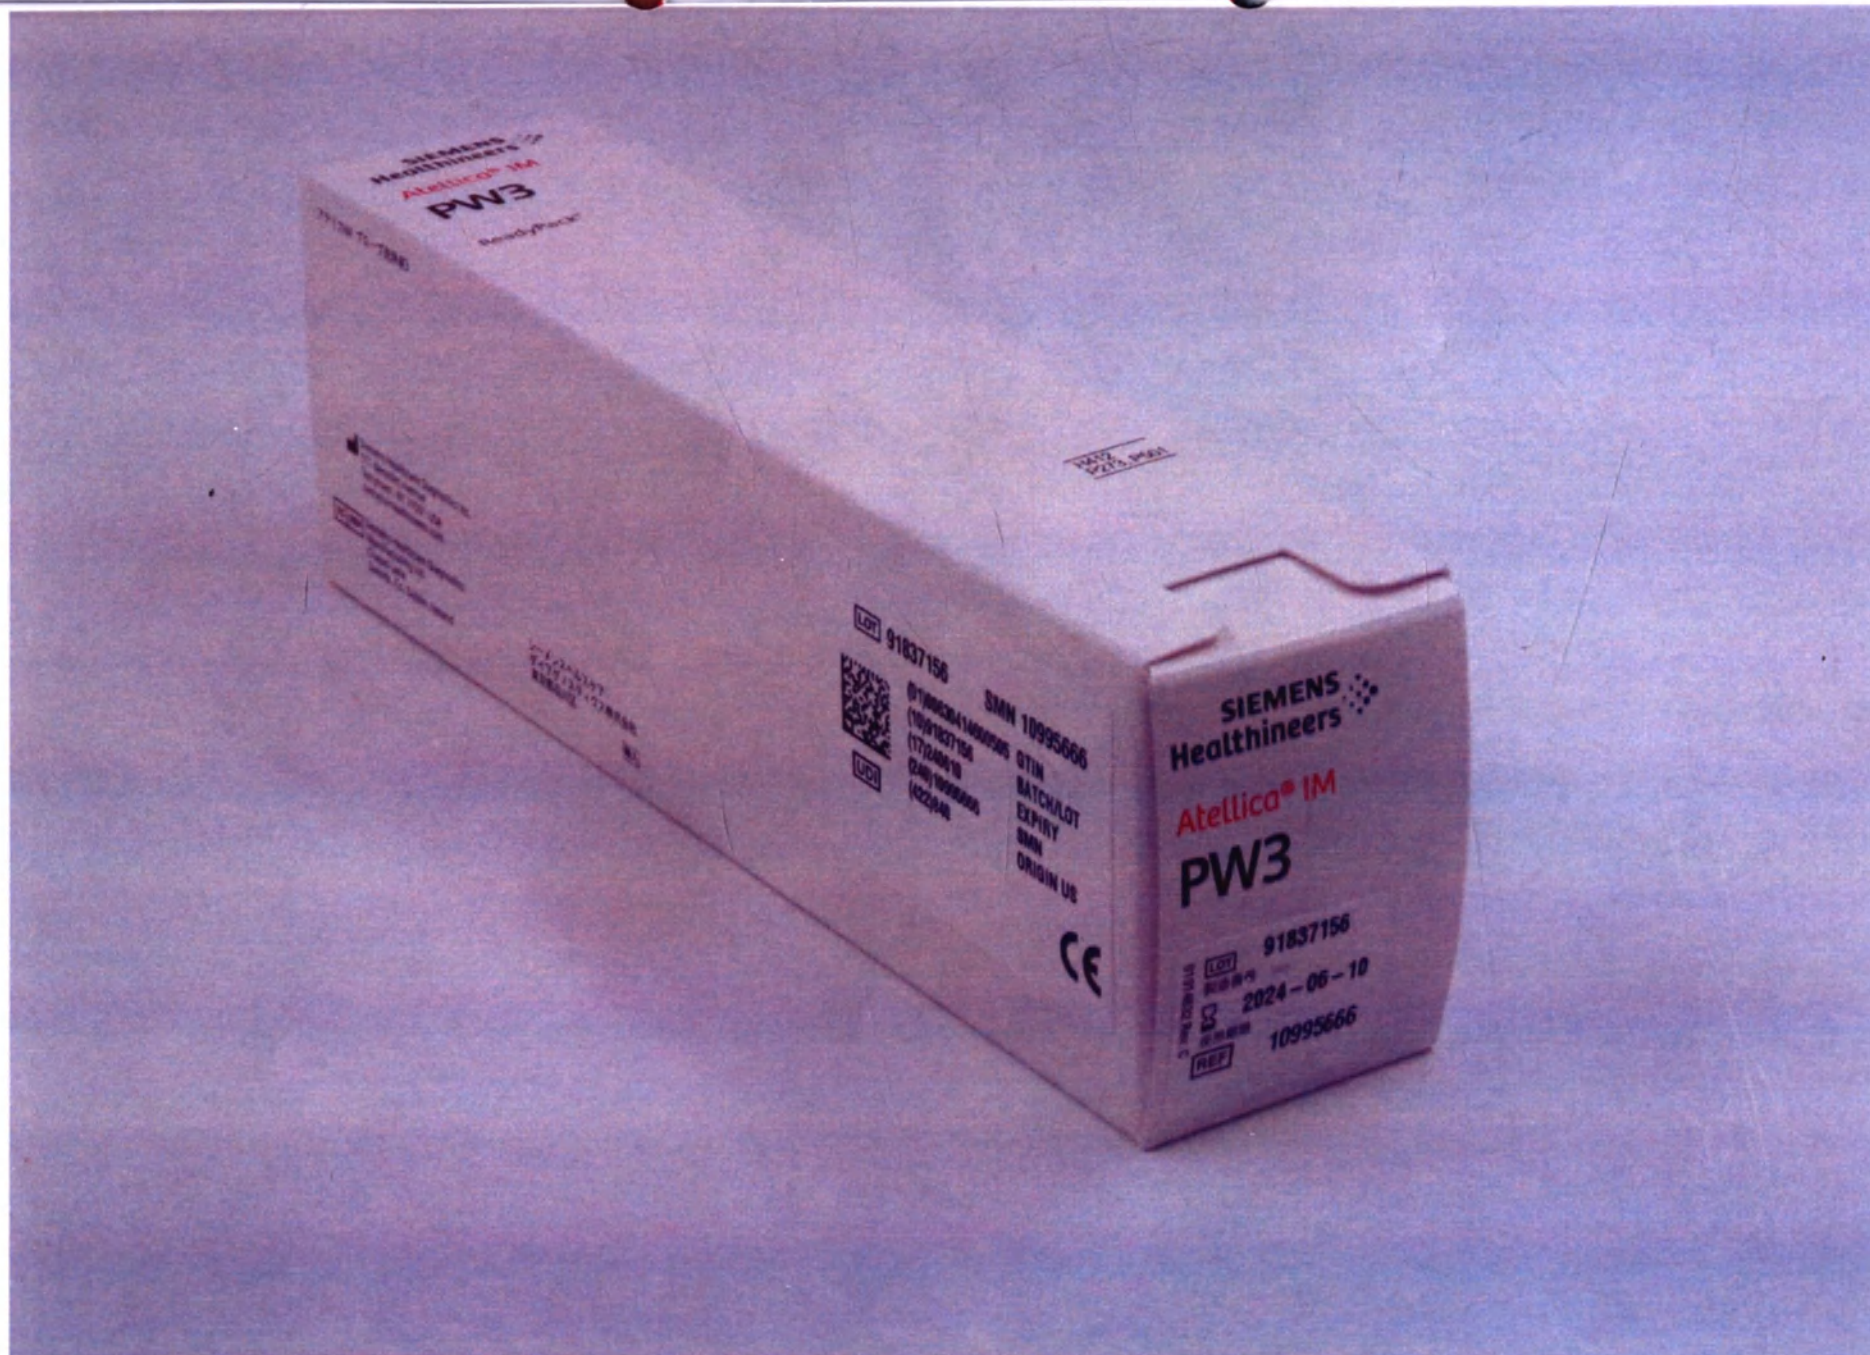


Рисунок 1. Раствор промывающий 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Probe Wash 3 (Atellica IM PW3)), в составе: 1. Раствор

アテリカIM プローブ洗浄液3

 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA
siemens-healthineers.com

EC REP Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社
東京都品川区

輸入

LOT 91837156

SMN 10995666



UDI

(01)00630414600505 GTIN

(10)91837156

(17)240610

(240)10995666

(422)840

BATCH/LOT

EXPIRY

SMN

ORIGIN US



Рисунок 2. Раствор промывающий 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Probe Wash 3 (Atellica IM PW3)), в составе: 1. Раствор

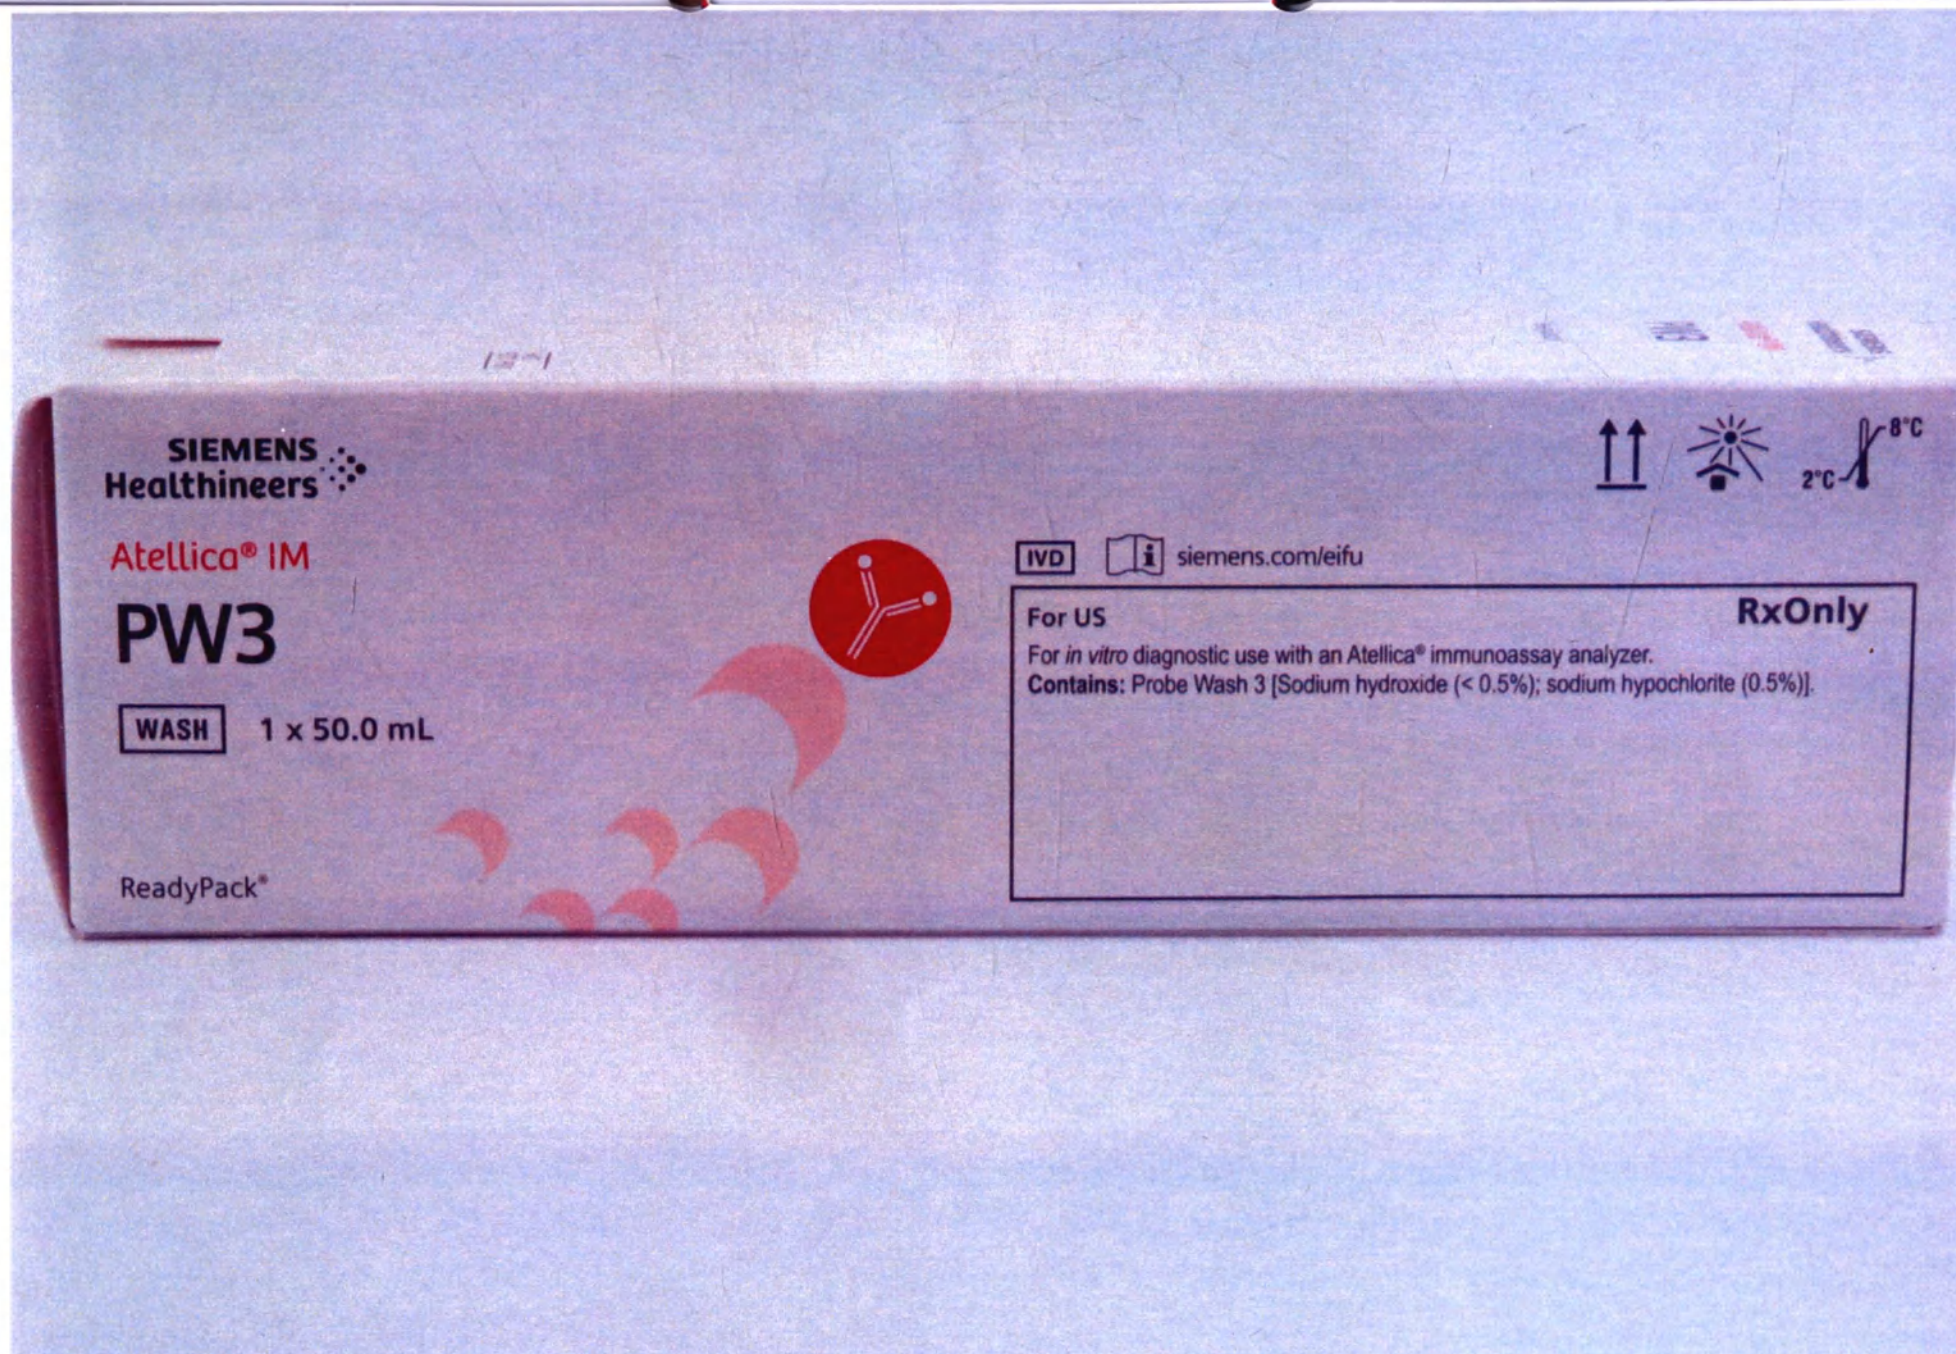


Рисунок 3. Раствор промывающий 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Probe Wash 3 (Atellica IM PW3)), в составе: 1. Раствор

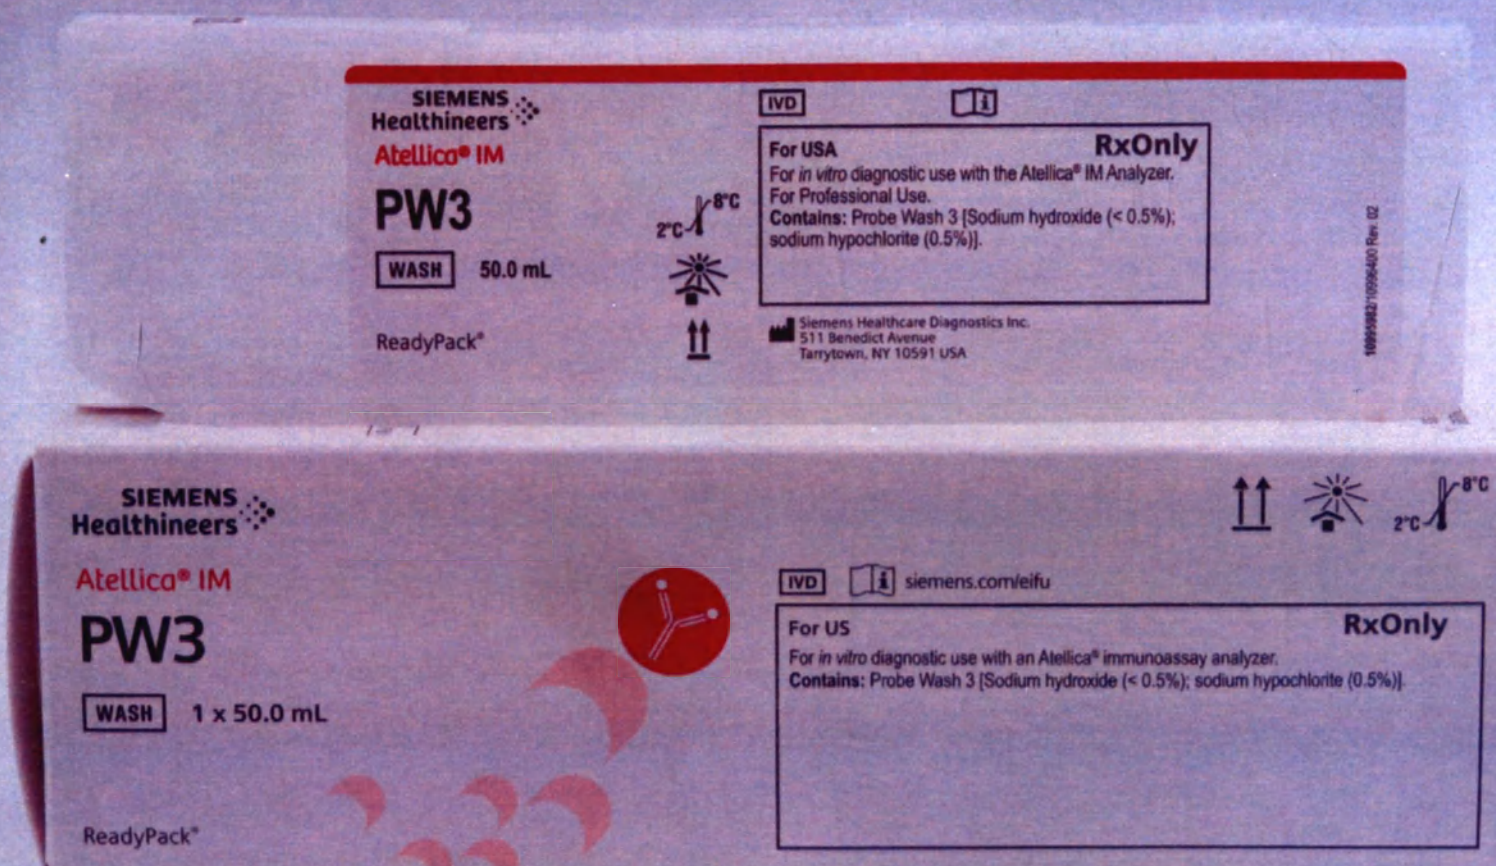


Рисунок 4. Раствор промывающий 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Probe Wash 3 (Atellica IM PW3)), в составе: 1. Раствор

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

PW3

WASH

50.0 mL

ReadyPack®

2°C 8°C



IVD



For USA

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use with the Atellica® IM Analyzer.
For Professional Use.

Contains: Probe Wash 3 [Sodium hydroxide (< 0.5%);
sodium hypochlorite (0.5%)].



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA

10995982/10996400 Rev. 02

SIEMENS



Рисунок 5. Раствор промывающий 3 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Probe Wash 3 (Atellica IM PW3)), в составе: 1. Раствор

10995666

Раствор промывающий 3 для анализаторов
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Probe
Wash 3 (Atellica IM PW3))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2021/15625 от 21.10.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 6. Макет маркировки для Российской Федерации, который будет наноситься на внешнюю упаковку медицинского изделия «Раствор промывающий 3 для



Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

