

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «РОТАНА»

В.Г. Фирсов



«30» августа 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Набор реагентов для количественного определения D-димера (D-dimer) иммунофлуоресцентным методом»

Производитель/разработчик: Getein Biotech, Inc. / Гетеин Биотек, Инк.



Юридический адрес: No. 9 Bofu Road, Luche District, 211505, Nanjing, China.



Внешняя упаковка медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения D-димера (D-dimer) иммунофлуоресцентным методом»

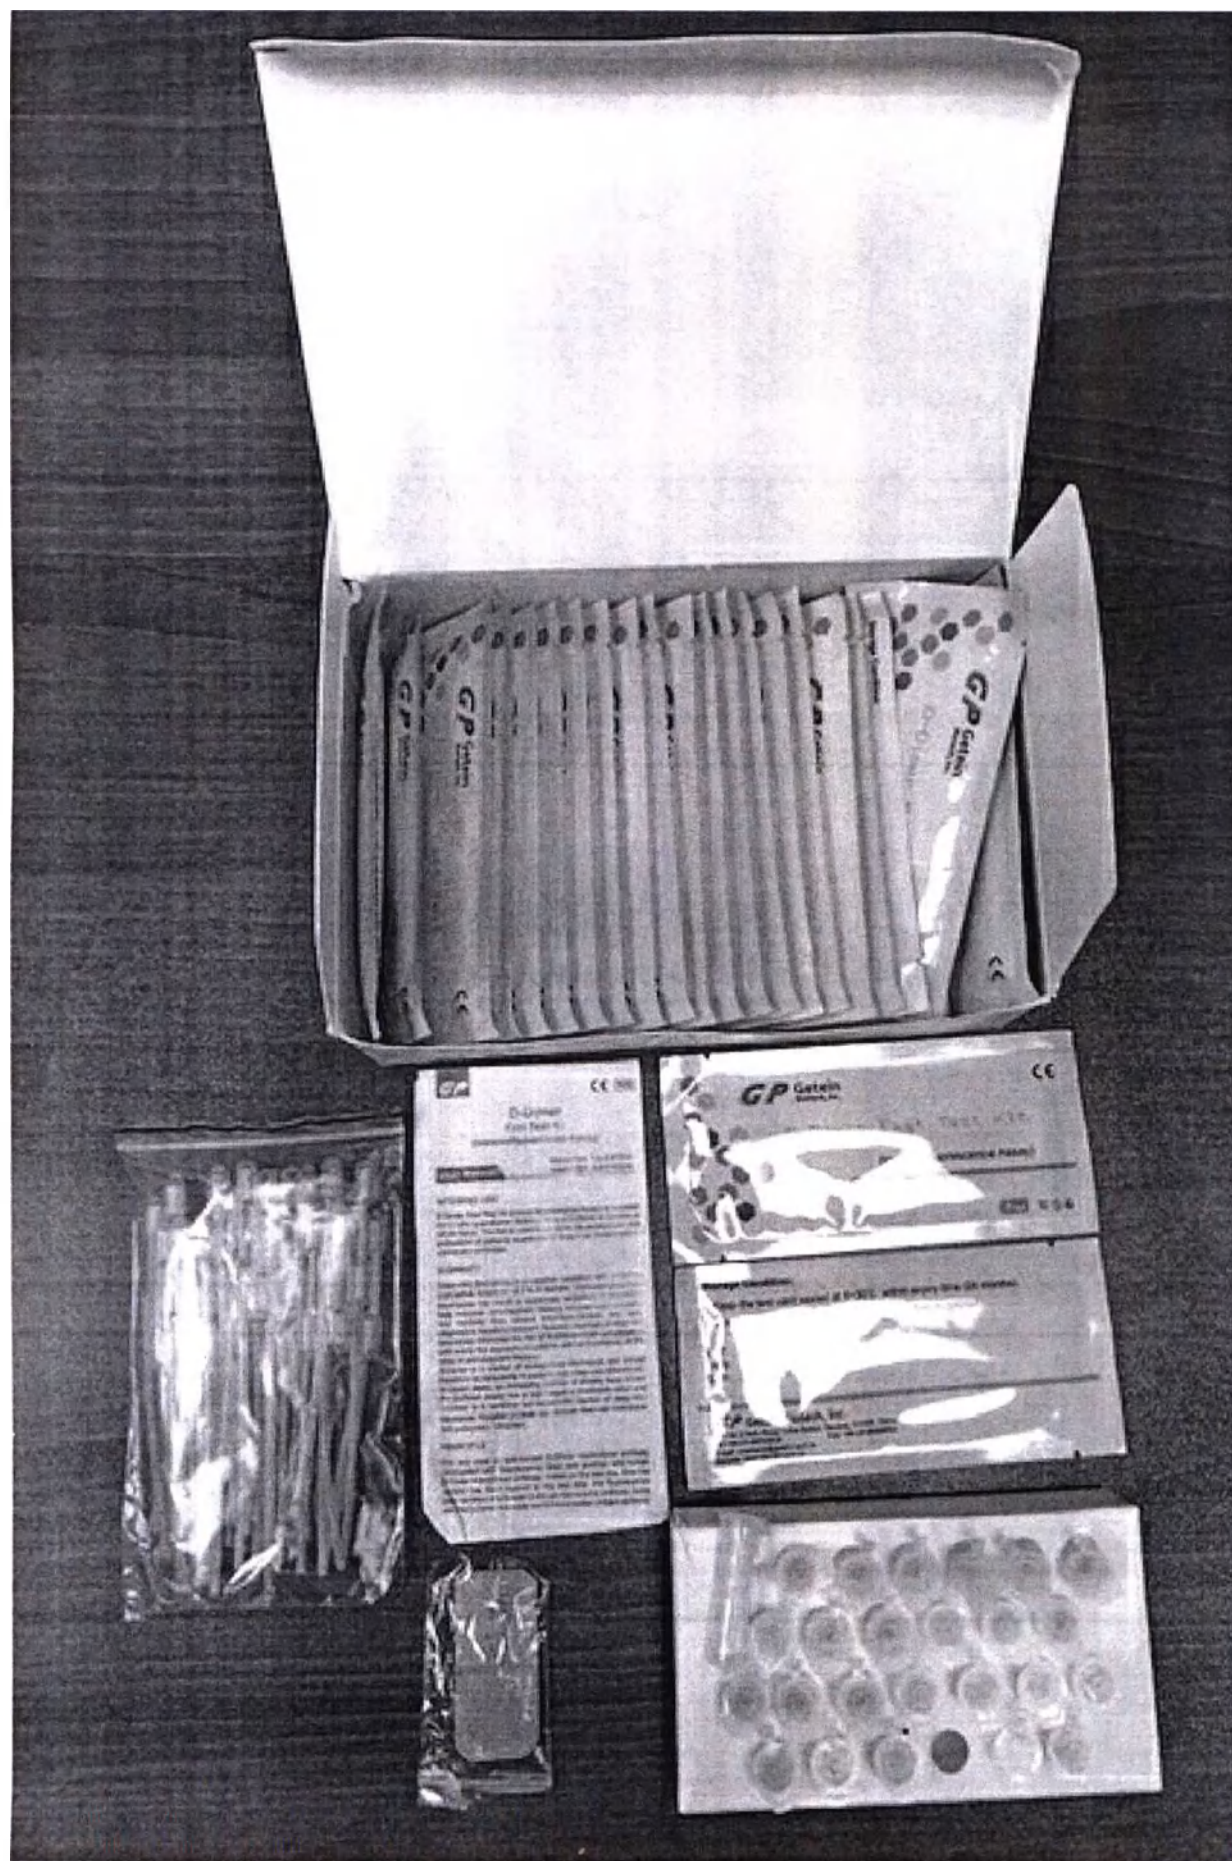

Содержимое упаковки и комплектация медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения D-димера (D-dimer)

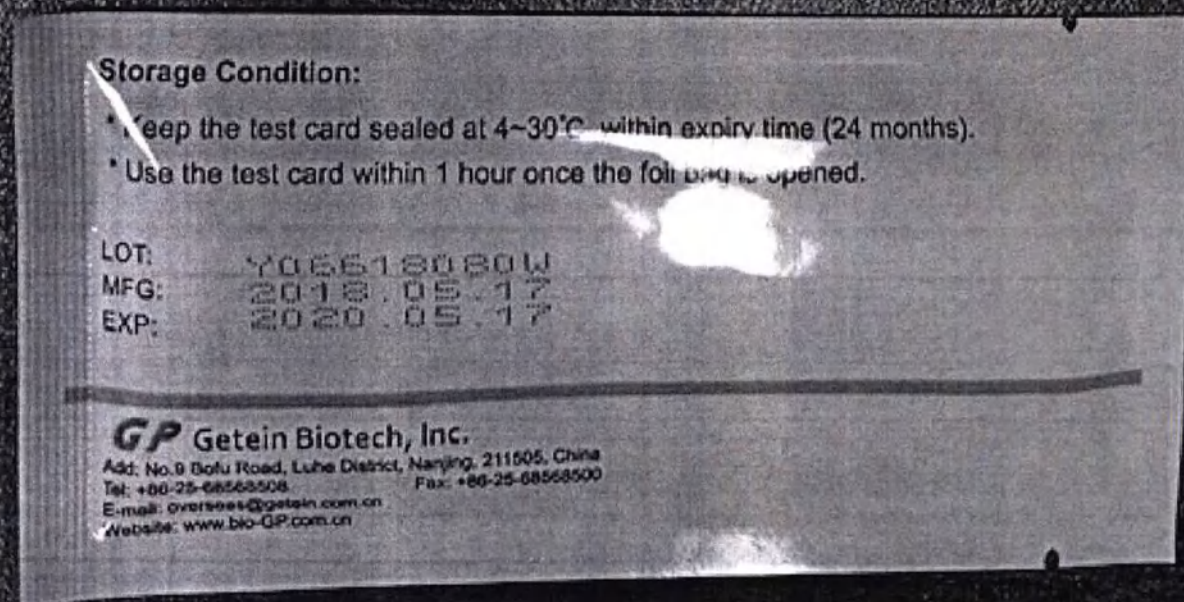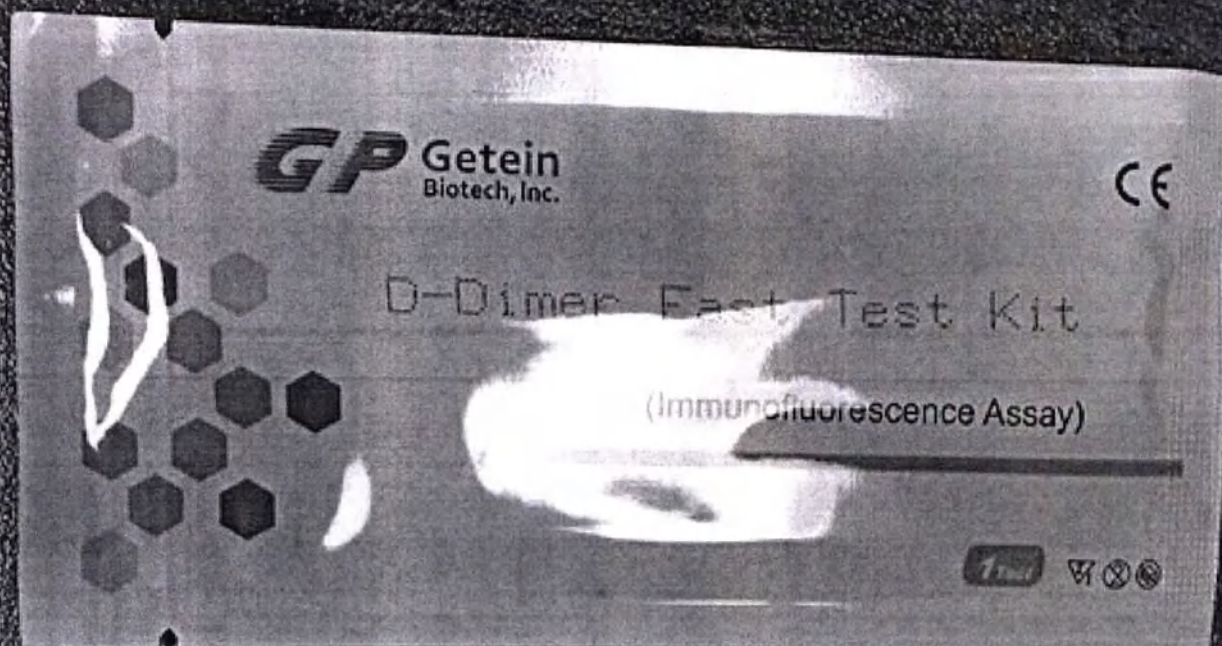

Storage Condition:


- * Keep the test card sealed at 4~30°C within expiry time (24 months).
- * Use the test card within 1 hour once the foil bag is opened.

LOT: Y06618080W
MFG: 2018.05.17
EXP: 2020.05.17


Getein Biotech, Inc.

Add: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China
Tel: +86-25-68565508 Fax: +86-25-68565500
E-mail: overseas@getein.com.cn
Website: www.bio-GP.com.cn

**Индивидуальная упаковка медицинского изделия Тест-кассеты для
количественного определения D-димера (D-dimer) иммунофлуоресцентным
методом**

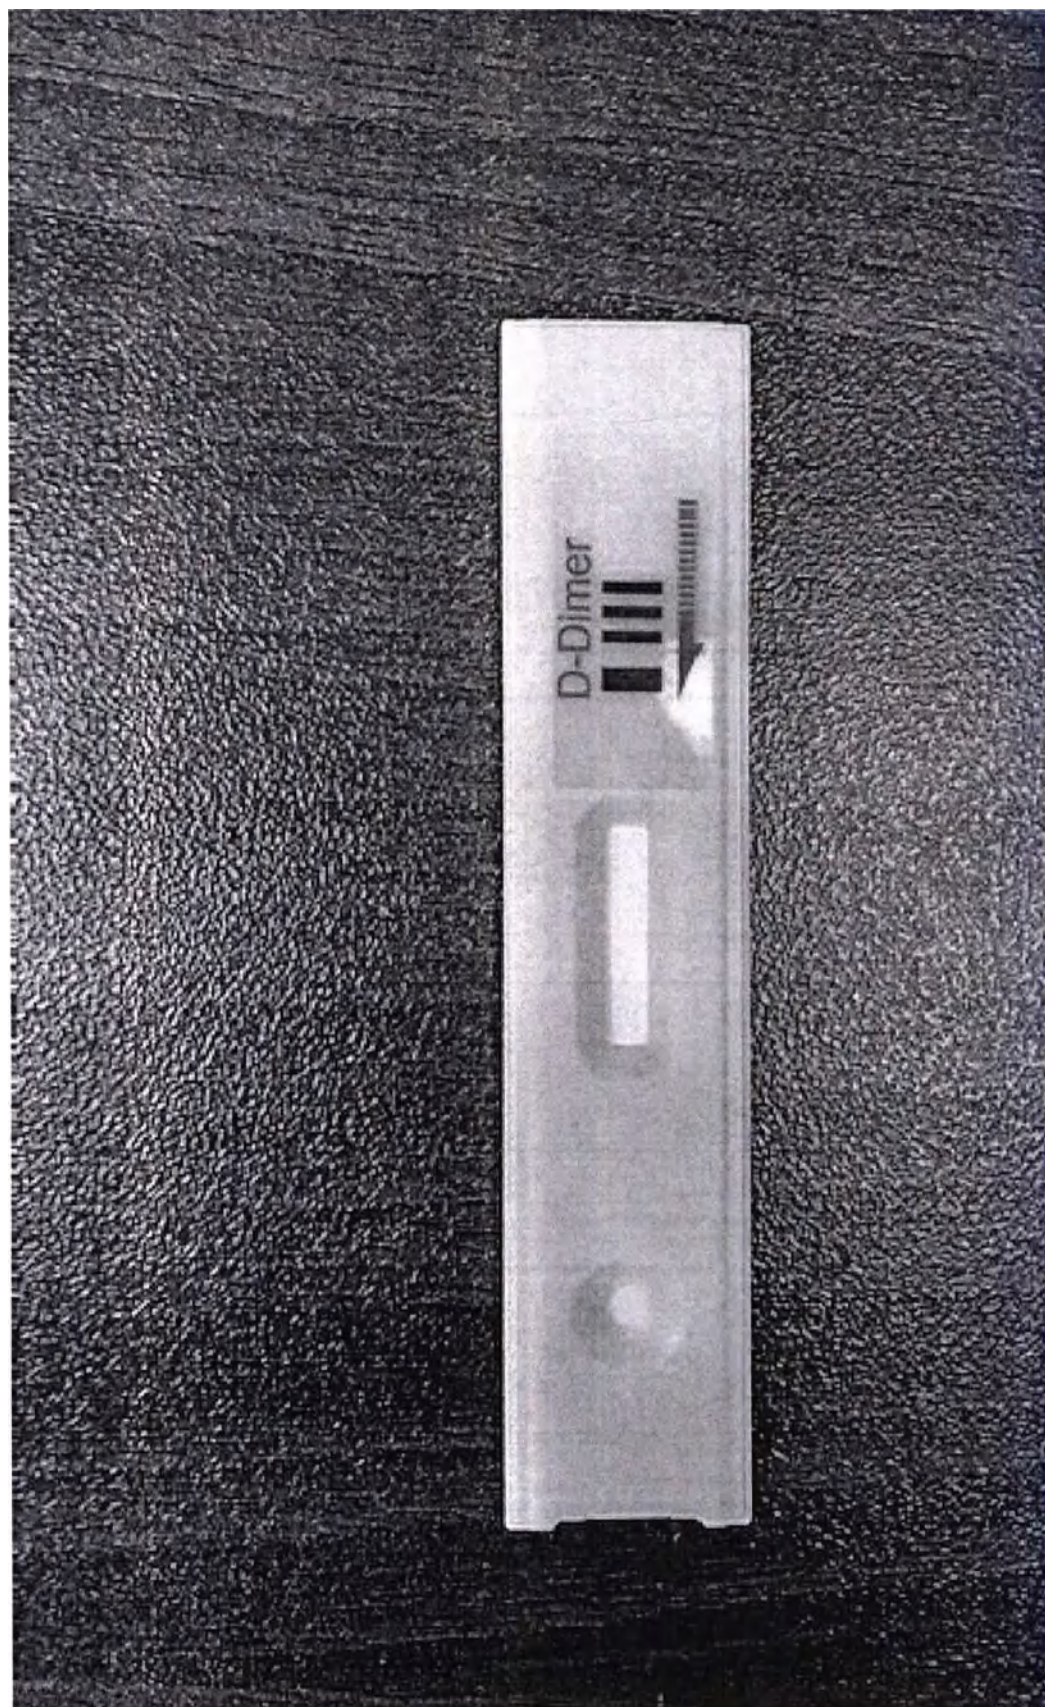

**Тест-кассета для количественного определения D-димера (D-dimer)
иммунофлуоресцентным методом**

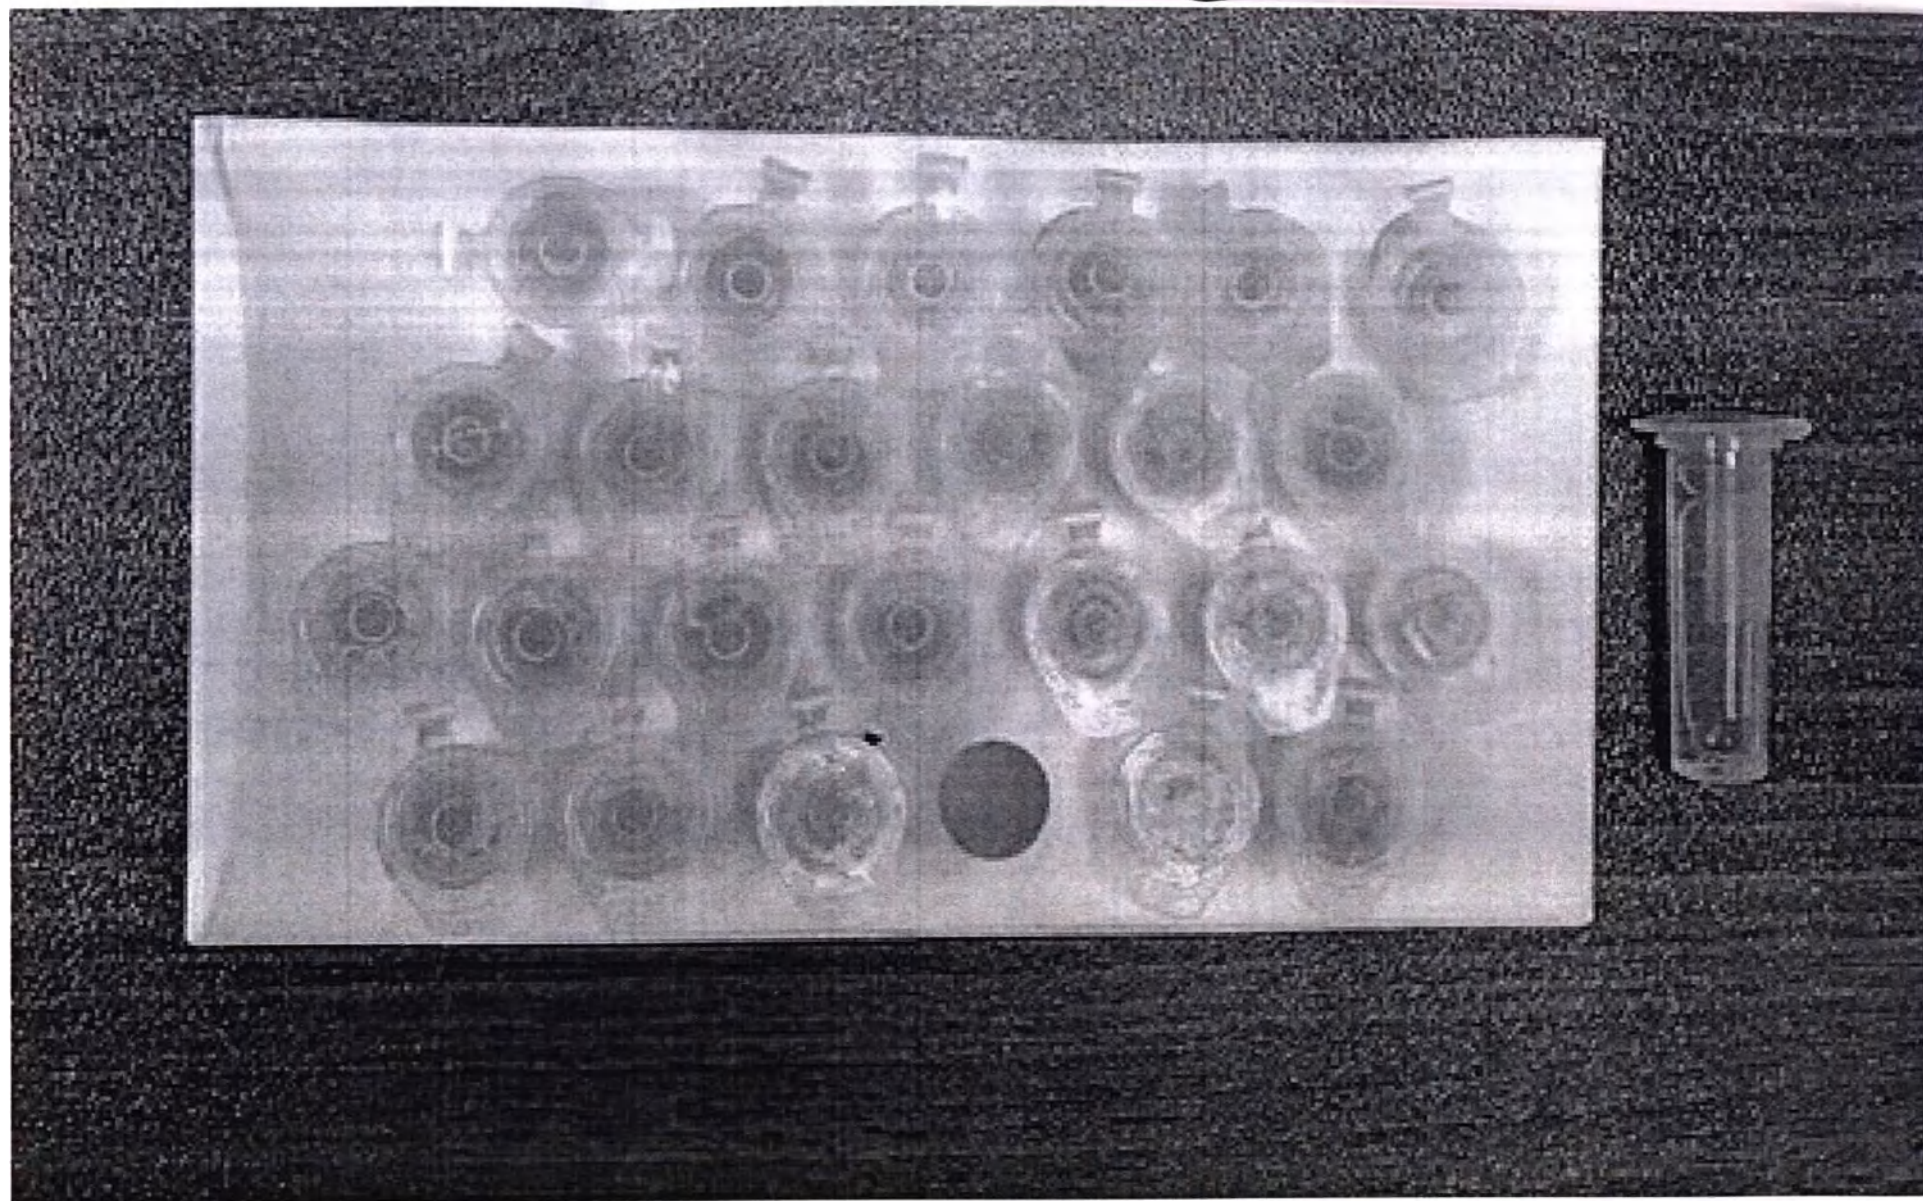

Разбавитель образца



SD-карта

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 лист об

Генеральный директор
ООО «Ротана»

« 31 » августа 2021 г.

В.Г. Фирсов

