


**Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор для размораживания ооцитов и эмбрионов после витрификации, в
вариантах исполнения»**

производства компании
РЕПРОЛАЙФ, Инк., Япония (REPROLIFE, Inc.)

Набор для размораживания ооцитов и эмбрионов после витрификации, в вариантах исполнения (Набор «102» для размораживания ооцитов и эмбрионов после витрификации), в составе: 1. Раствор размораживающий TS, 1.8 мл;
2. Раствор разбавляющий DS, 0.5 мл;
3. Раствор промывающий WS, 1.0 мл;
4. Планшет для размораживания;
5. Инструкция по применению.




Ознакомьтесь с Инструкцией по применению

Состав растворов: см. инструкцию по применению. Не содержит лекарственных средств. Нетоксично, не содержит цитотоксичных и генотоксичных компонентов.

Для профессионального использования в специализированной лаборатории ЭКО.

Набор предназначен для размораживания ооцитов и эмбрионов пациента с целью возобновления жизнедеятельности клеток человека после витрификации (замораживания) в процессе применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

01.08.2020 26.07.2021 LOT JCHAD243WKN REF WK0102



Стерильно. Не использовать повторно. Не использовать после даты истечения срока годности. Не использовать при повреждении упаковки. Условия утилизации: см. инструкцию по применению.

РЕПРОЛАЙФ, Инк., Япония (REPROLIFE, Inc.) 2-5-3-9F Синдзюку, Синдзюку-ку Токио, 160-0022, Япония (2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022, Japan)
e-mail: info@reprolife.jp

Уполномоченный Представитель Производителя в Российской Федерации: ООО «Интерген», Российская Федерация, 117186, Москва, ул. Нагорная, д. 4А, Тел. (495) 724-38-62, т/факс (499) 969-83-38 e-mail: info@intergen.ru

Регистрационное удостоверение: ****/**** от *****

1. Вариант исполнения I. - Набор «102» для размораживания ооцитов и эмбрионов после витрификации
Маркировка на русском языке, обратная сторона вторичной упаковки




2. Вариант исполнения I. - Набор «102» для размораживания ооцитов и эмбрионов после витрификации
Оригинальная маркировка на английском языке, лицевая сторона вторичной упаковки



3. Вариант исполнения I. - Набор «102»,

Вскрытый, в составе: 1. Раствор размораживающий TS, 1.8 мл; 2. Раствор разбавляющий DS, 0.5 мл; 3. Раствор промывающий WS, 1.0 мл; 4. Планшет для размораживания; 5. Инструкция по применению.

Страница 4 из 11

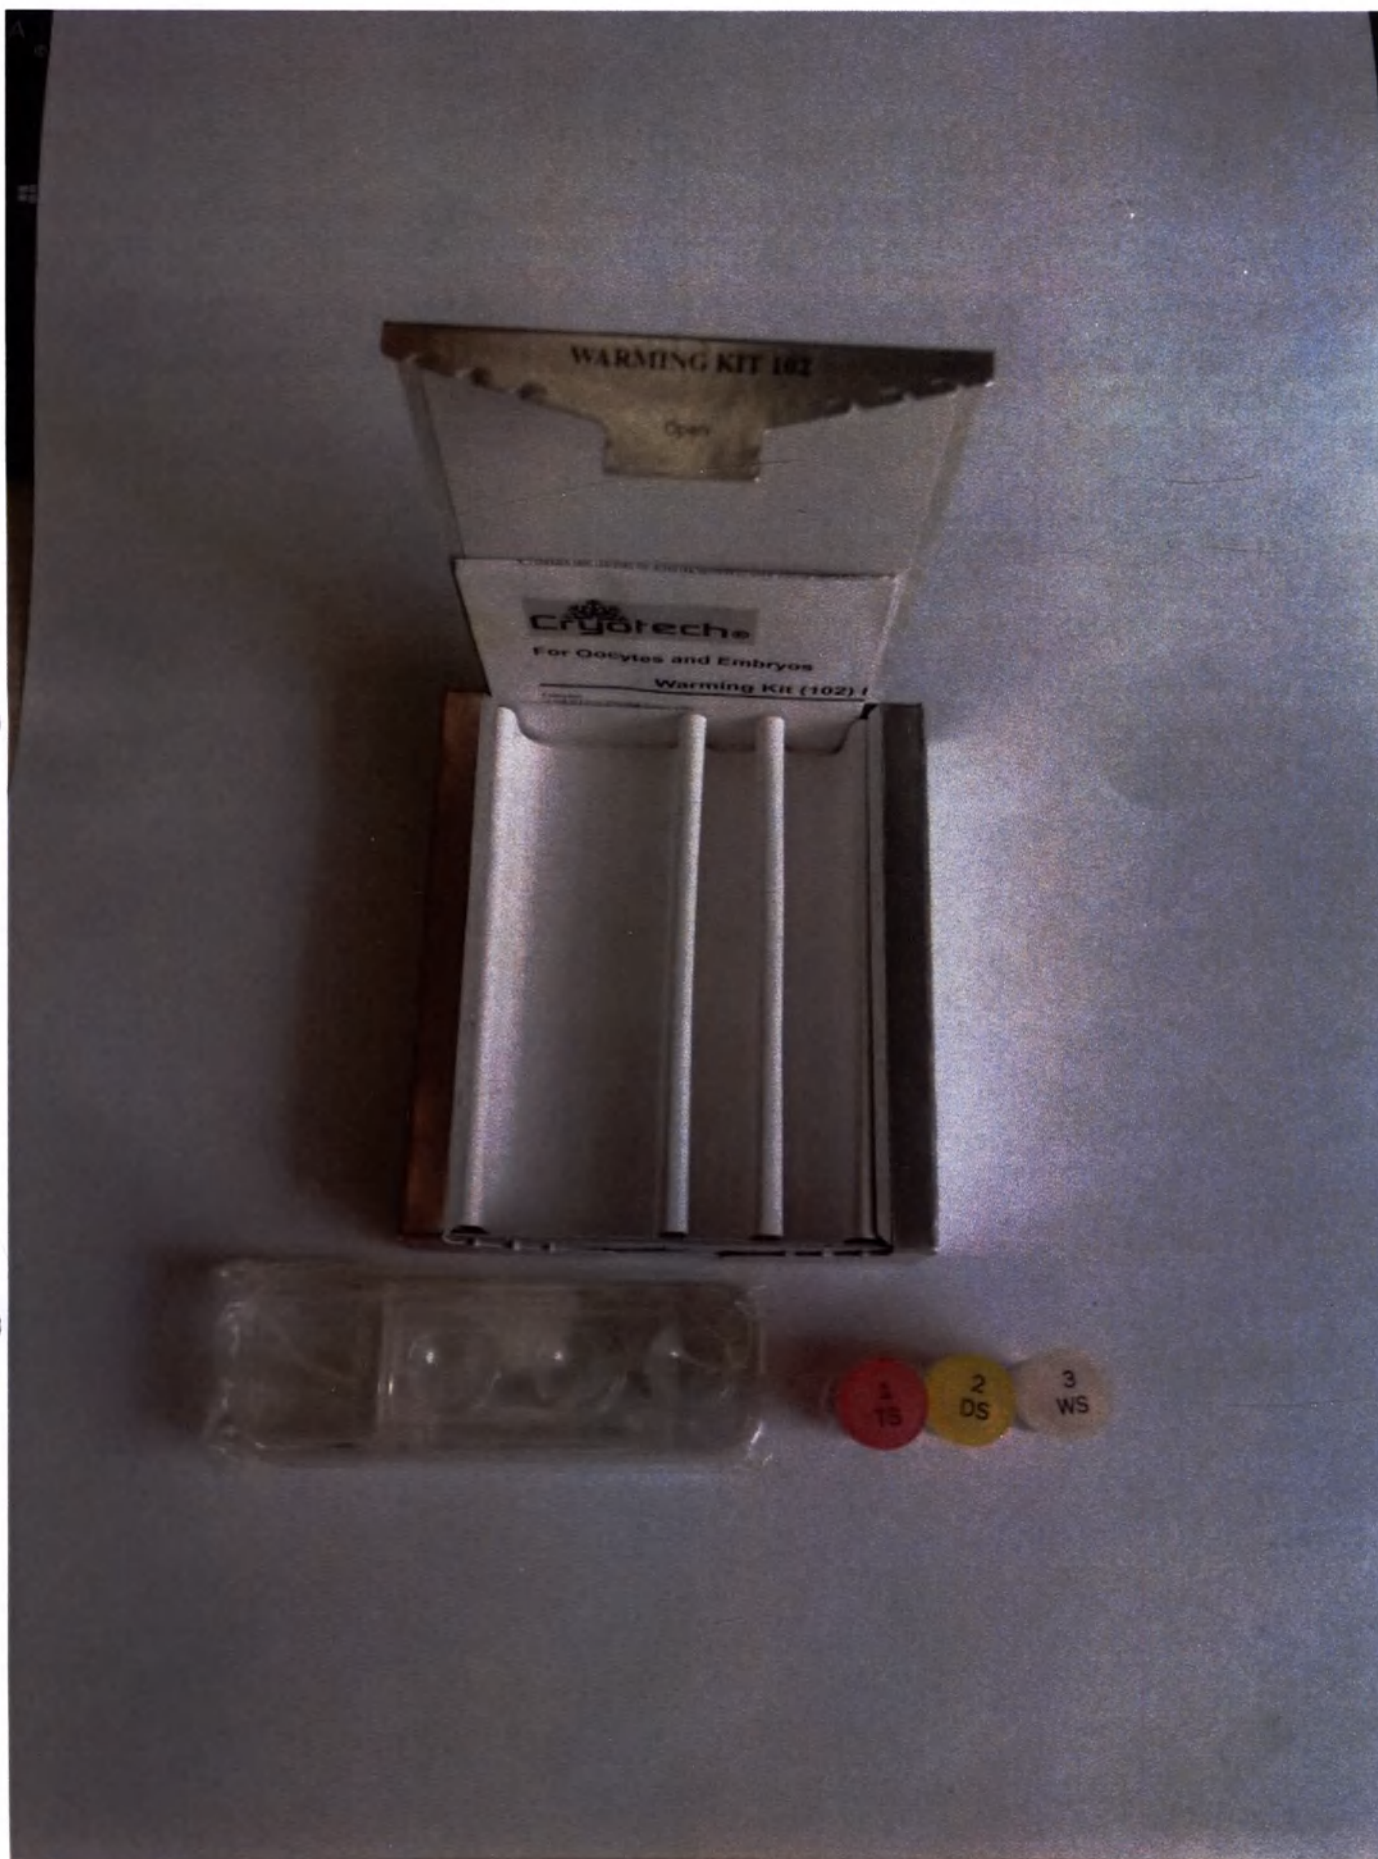

4. Вариант исполнения I. - Набор «102»,


Вскрытый, в составе: 1. Раствор размораживающий TS, 1.8 мл; 2. Раствор разбавляющий DS, 0.5 мл; 3. Раствор промывающий WS, 1.0 мл; 4. Планшет для размораживания; 5. Инструкция по применению.

Страница 5 из 11




5. Вариант исполнения I. - Набор «102»,

Компоненты Набора: 1. Раствор размораживающий TS, 1.8 мл; 2. Раствор разбавляющий DS, 0.5 мл; 3. Раствор промывающий WS, 1.0 мл; 4. Планшет для размораживания (вскрытый)

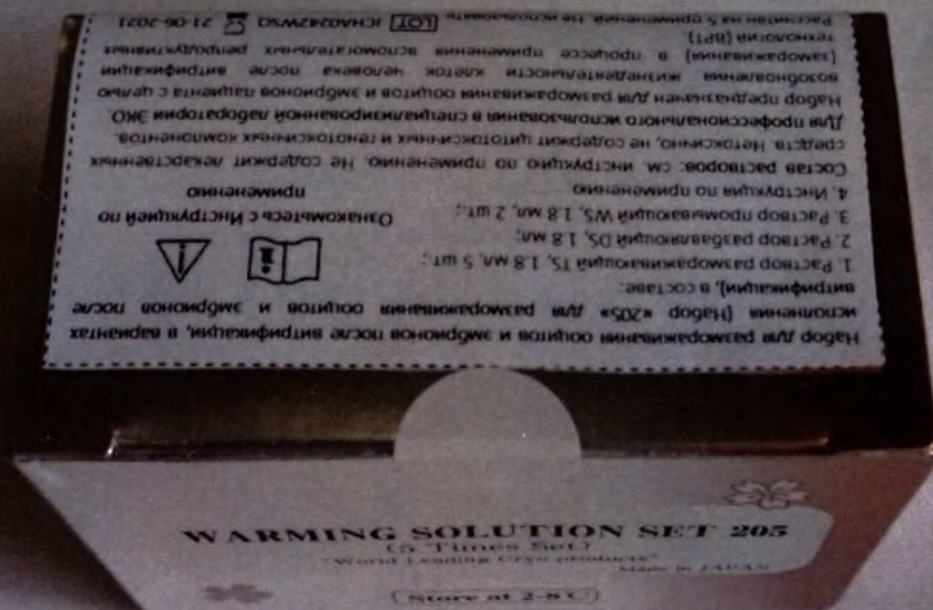

7. Вариант исполнения II. - Набор «205» для размораживания ооцитов и эмбрионов после витрификации
Оригинальная маркировка на английском языке, лицевая сторона вторичной упаковки

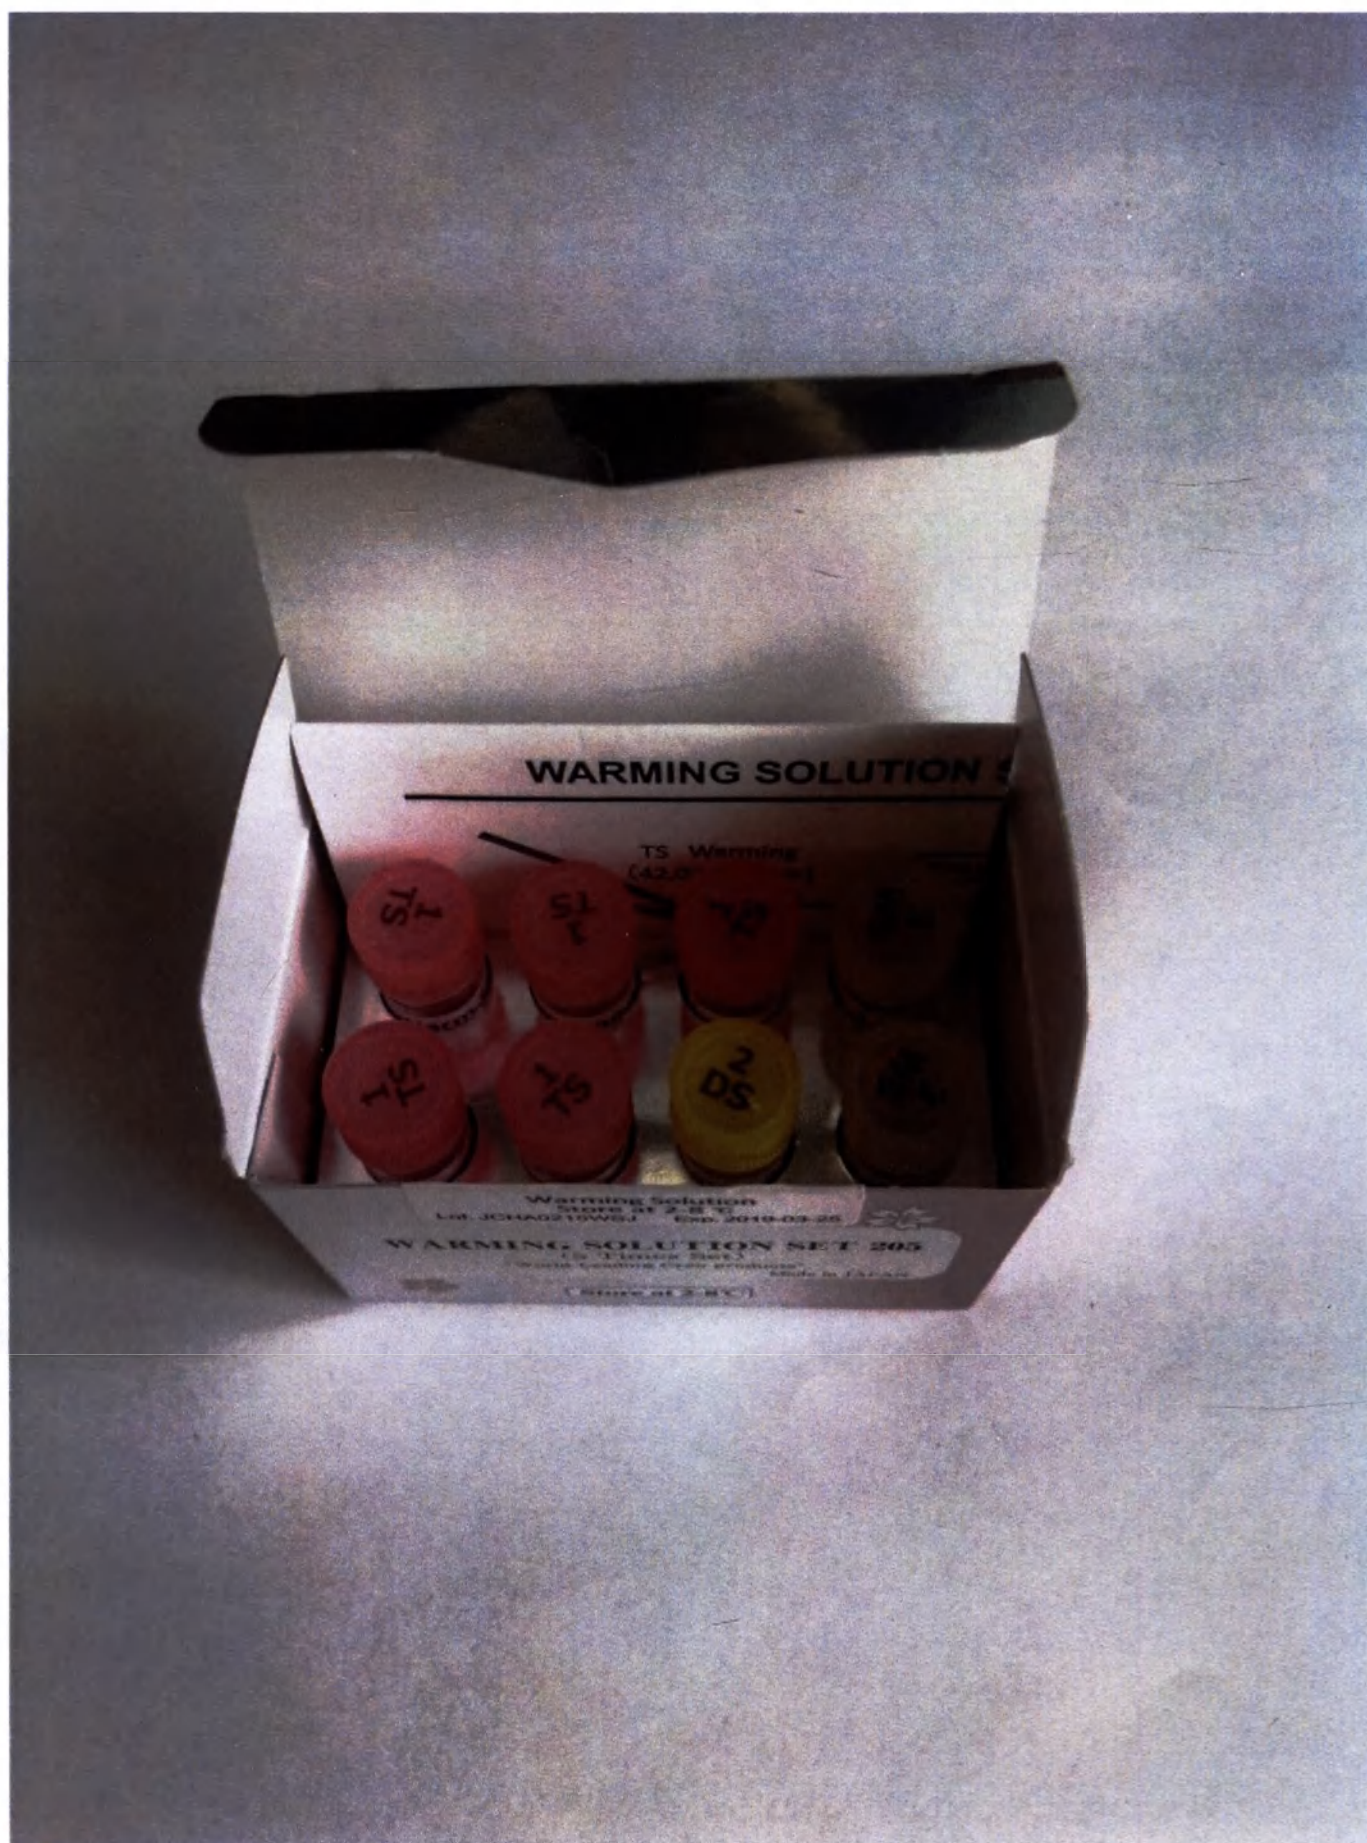


8. Вариант исполнения II. - Набор «205»,
Вскрытый, в составе: 1. Раствор размораживающий TS, 1.8 мл, 5 шт.; 2. Раствор разбавляющий DS, 1.8 мл; 3. Раствор промывающий WS, 1.8 мл, 2 шт.; 4. Инструкция по применению.



9. Вариант исполнения II. - Набор «205»,

Вскрытый, в составе: 1. Раствор размораживающий TS, 1.8 мл, 5 шт.; 2. Раствор разбавляющий DS, 1.8 мл; 3. Раствор промывающий WS, 1.8 мл, 2 шт.; 4. Инструкция по применению.

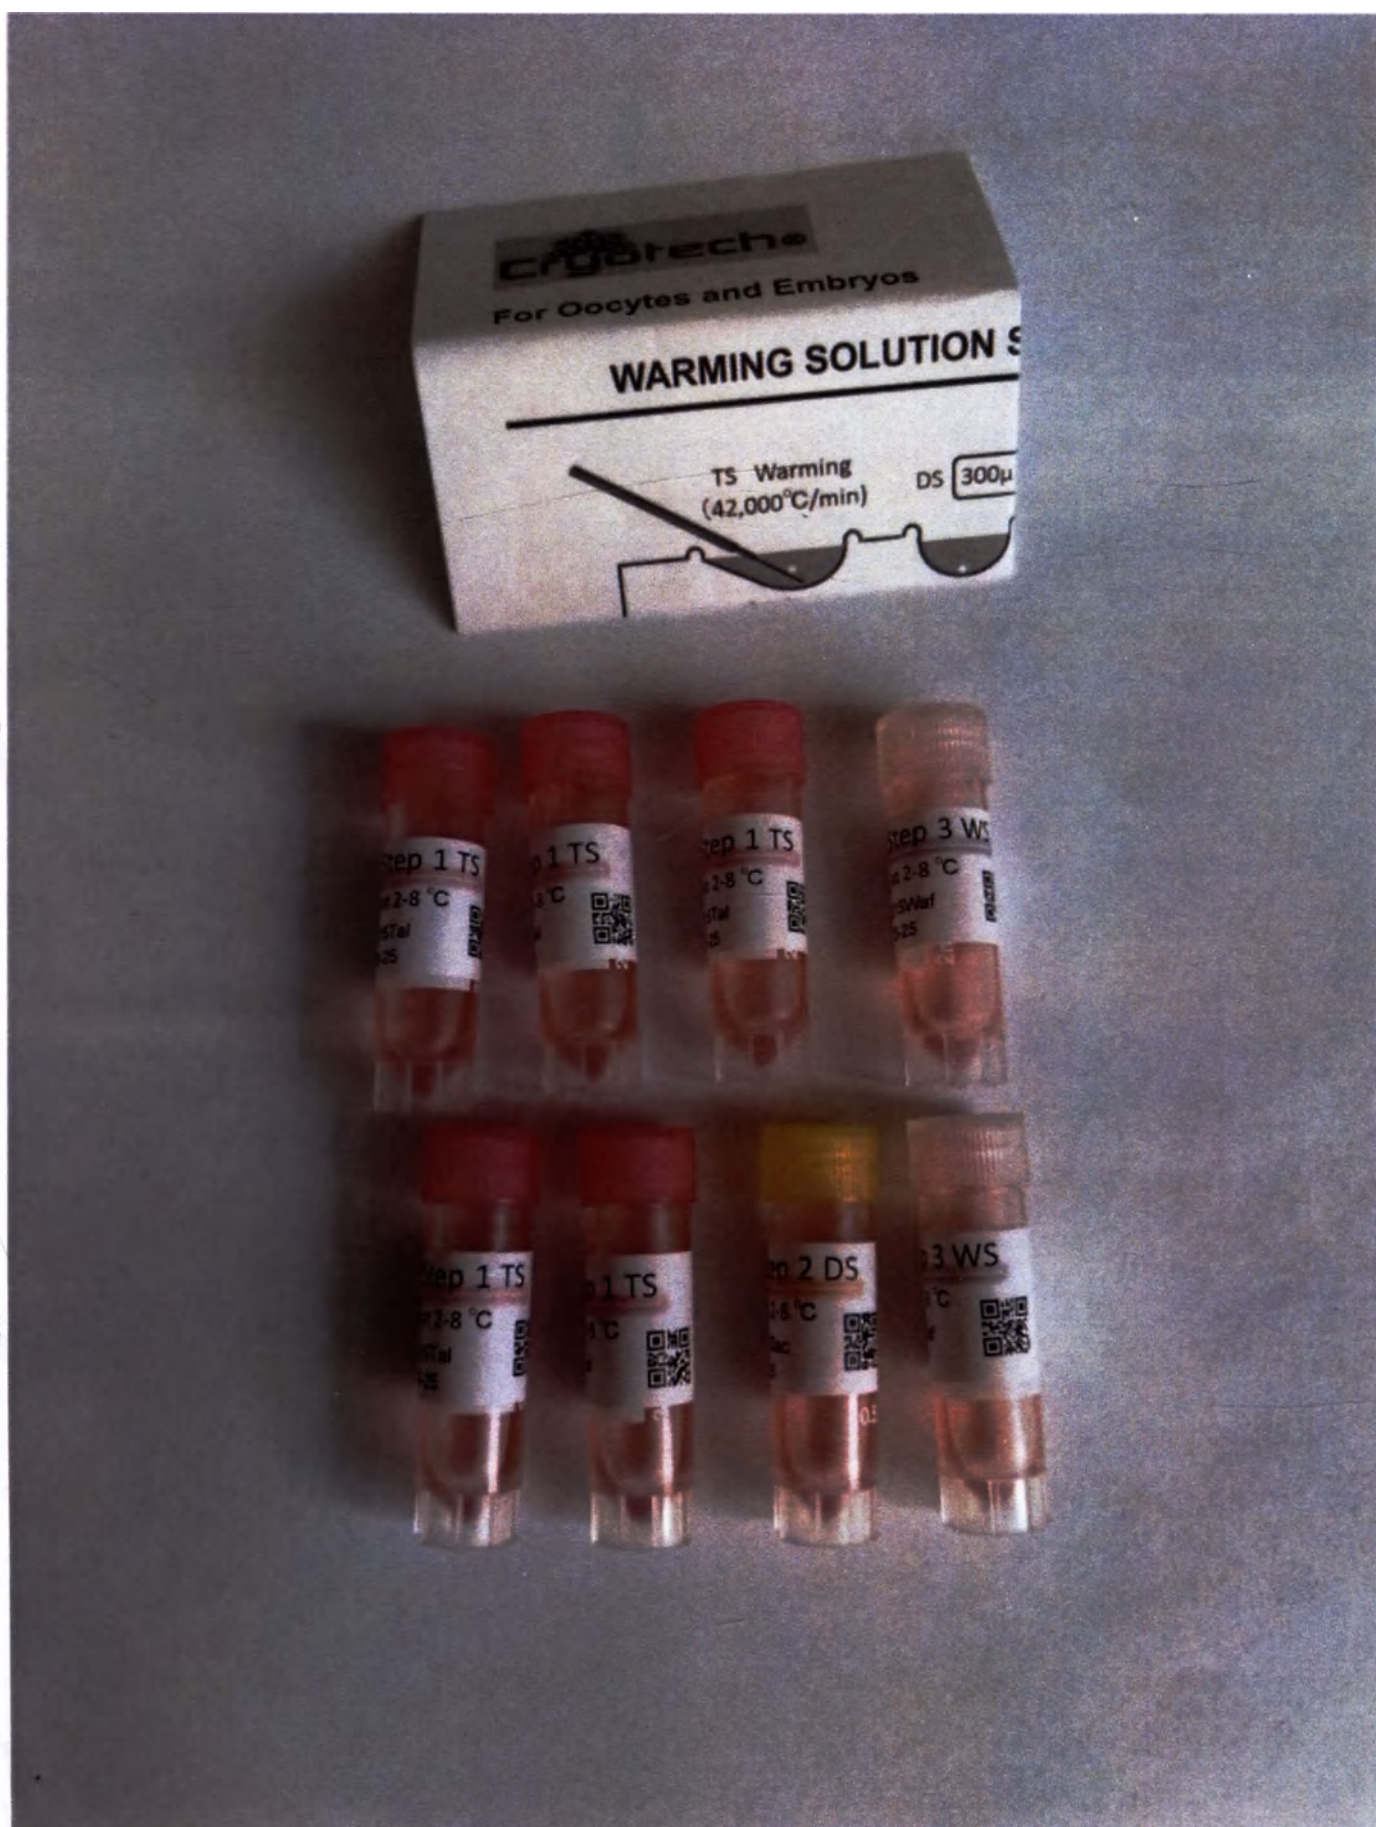

10. Вариант исполнения II. - Набор «205»,

Компоненты Набора: 1. Раствор размораживающий TS, 1.8 мл, 5 шт.; 2. Раствор разбавляющий DS, 1.8 мл; 3. Раствор промывающий WS, 1.8 мл, 2 шт.; 4. Инструкция по применению.

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 11 листа(ов).

Генеральный директор ООО «Интерген»
Тотра М.Н.



(подпись)
«02» сентября 2021 года М.П.