


Forte Medical Service
«Форте Медикал Сервис»

Россия, 119571, Москва, Вернадского
пр-кт, дом 123, стр.2, комната 9,
Тел/факс: +79036611020,
E-mail: ftmedical@ya.ru



ООО «Форте Медикал Сервис»
Генеральный директор
Бурмистрова Н. В.


М.П.
(Подпись)

" 6 " 09 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**Аппарат физиотерапевтический
для сухого гидромассажа
AQUATIZER QZ-240SG**


2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аппарат физиотерапевтический для сухого гидромассажа AQUATIZER QZ-240SG в составе:

1. Блок основной (ванна) - 1 шт.
2. Подушка – не более 3 шт. (при необходимости).
3. Покрывало хлопчатобумажное – не более 3 шт. (при необходимости).
4. Простынь – не более 3 шт. (при необходимости).
5. Утяжелитель для ног - 1 шт. (при необходимости).
6. Козырек светозащитный – не более 3 шт. (при необходимости).
7. Подушка для рук – не более 3 шт. (при необходимости).
8. Чехол для ног надувной (для фиксации каждой ступни) – не более 3 шт. (при необходимости).
9. Подставка для ног - 1 шт.
10. Фильтр радиатора – не более 3 шт. (при необходимости).
11. Кабель питания - 1 шт.
12. Шланг для наполнения ванны – 2 шт.
13. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Аппарат физиотерапевтический для сухого гидромассажа AQUATIZER QZ-240SG в составе:

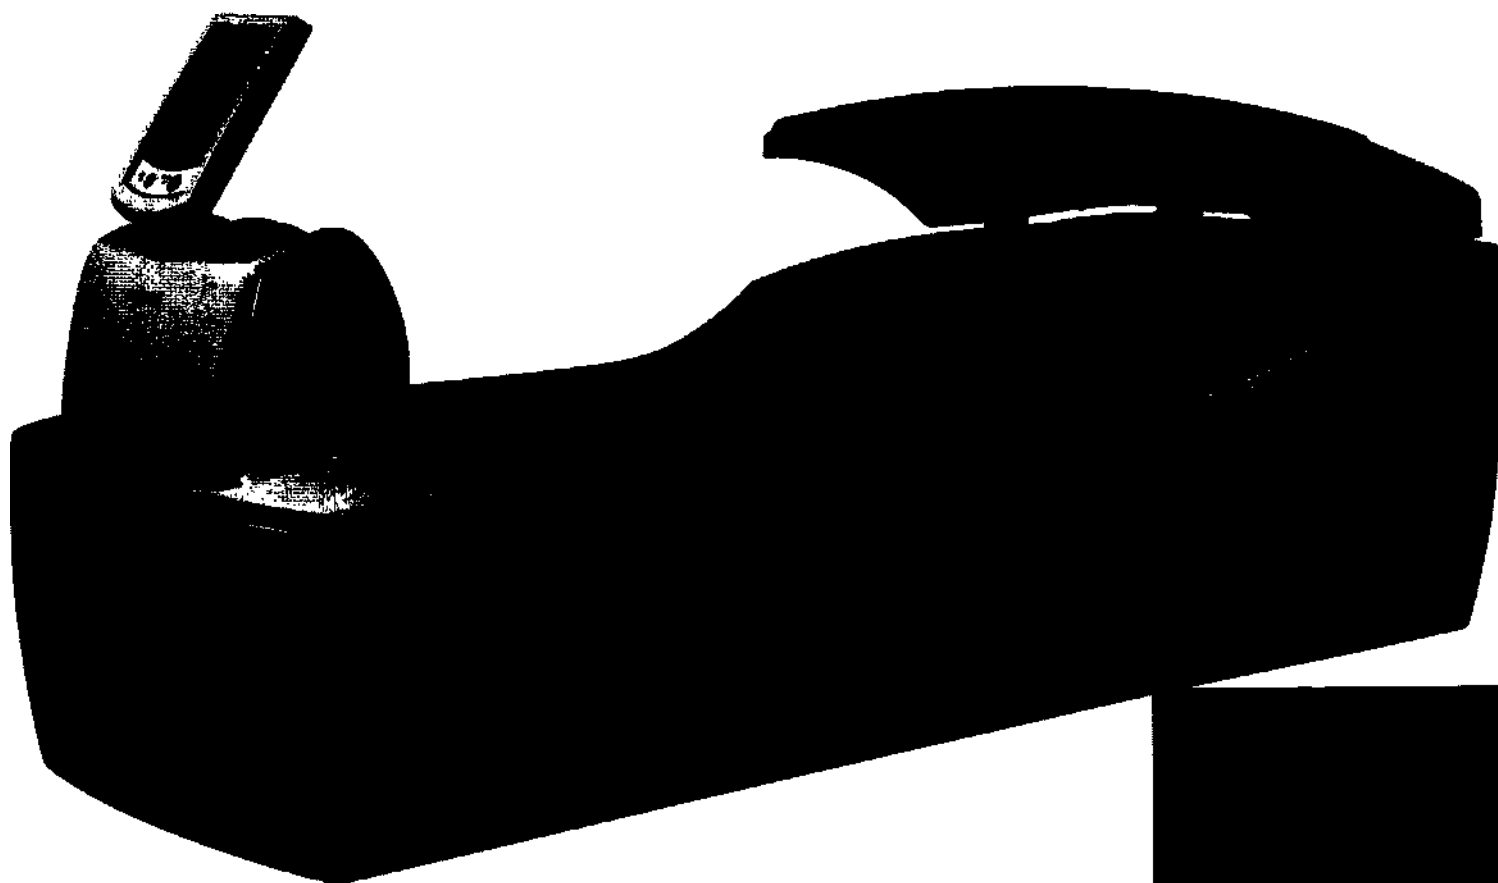


1. Блок основной (ванна).






3.Покрывало хлопчатобумажное.

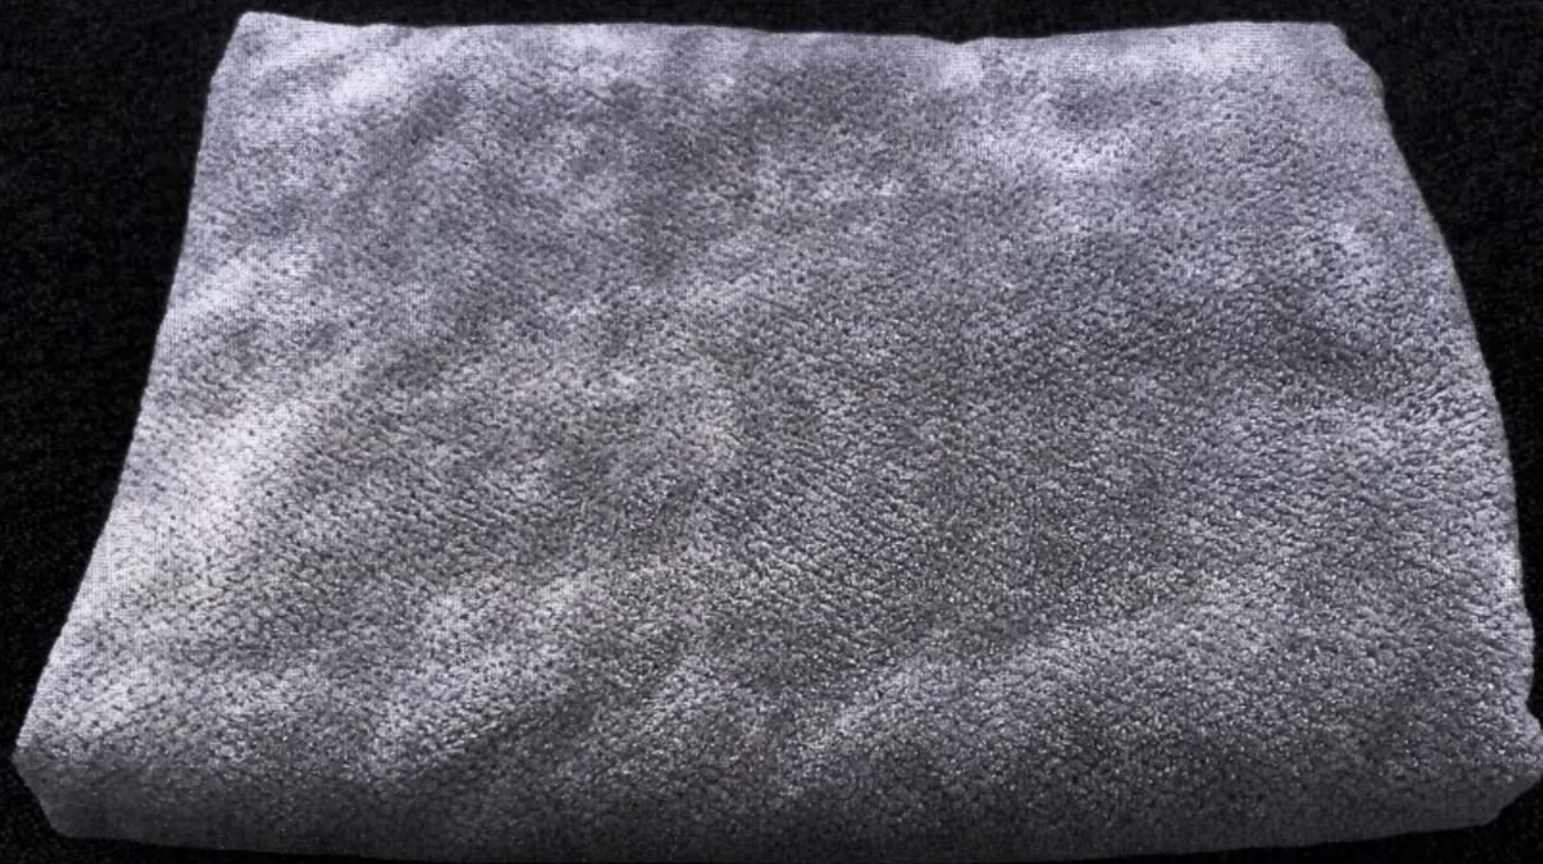

VCV6439




VCV6900

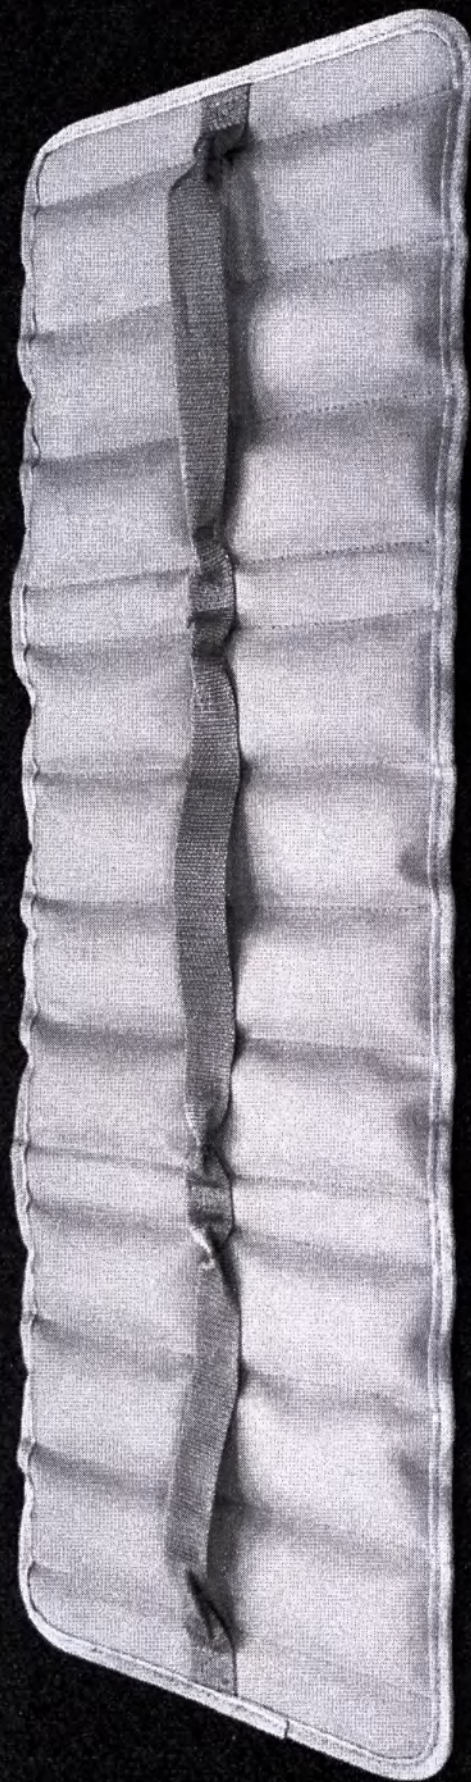


КОМ6406

6.Козырек светозащитный.

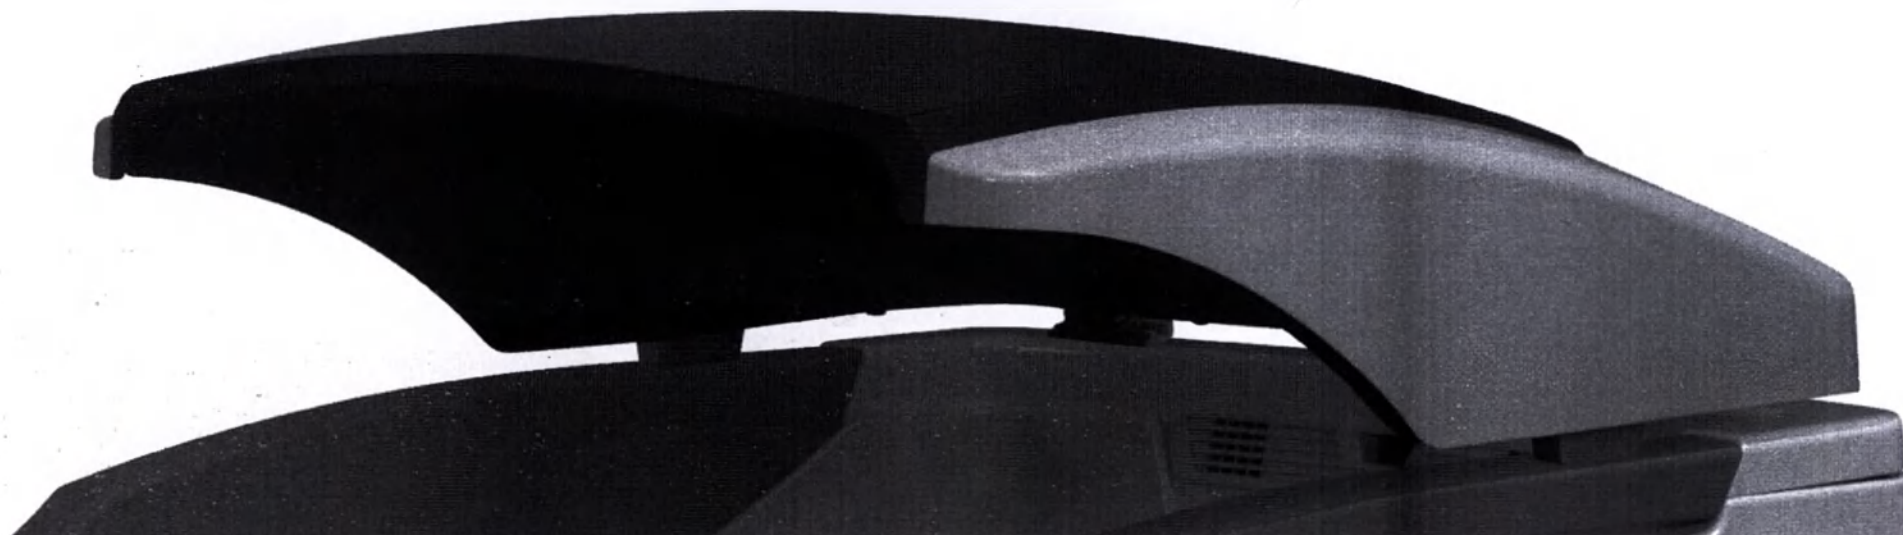

7.Подушка для рук.

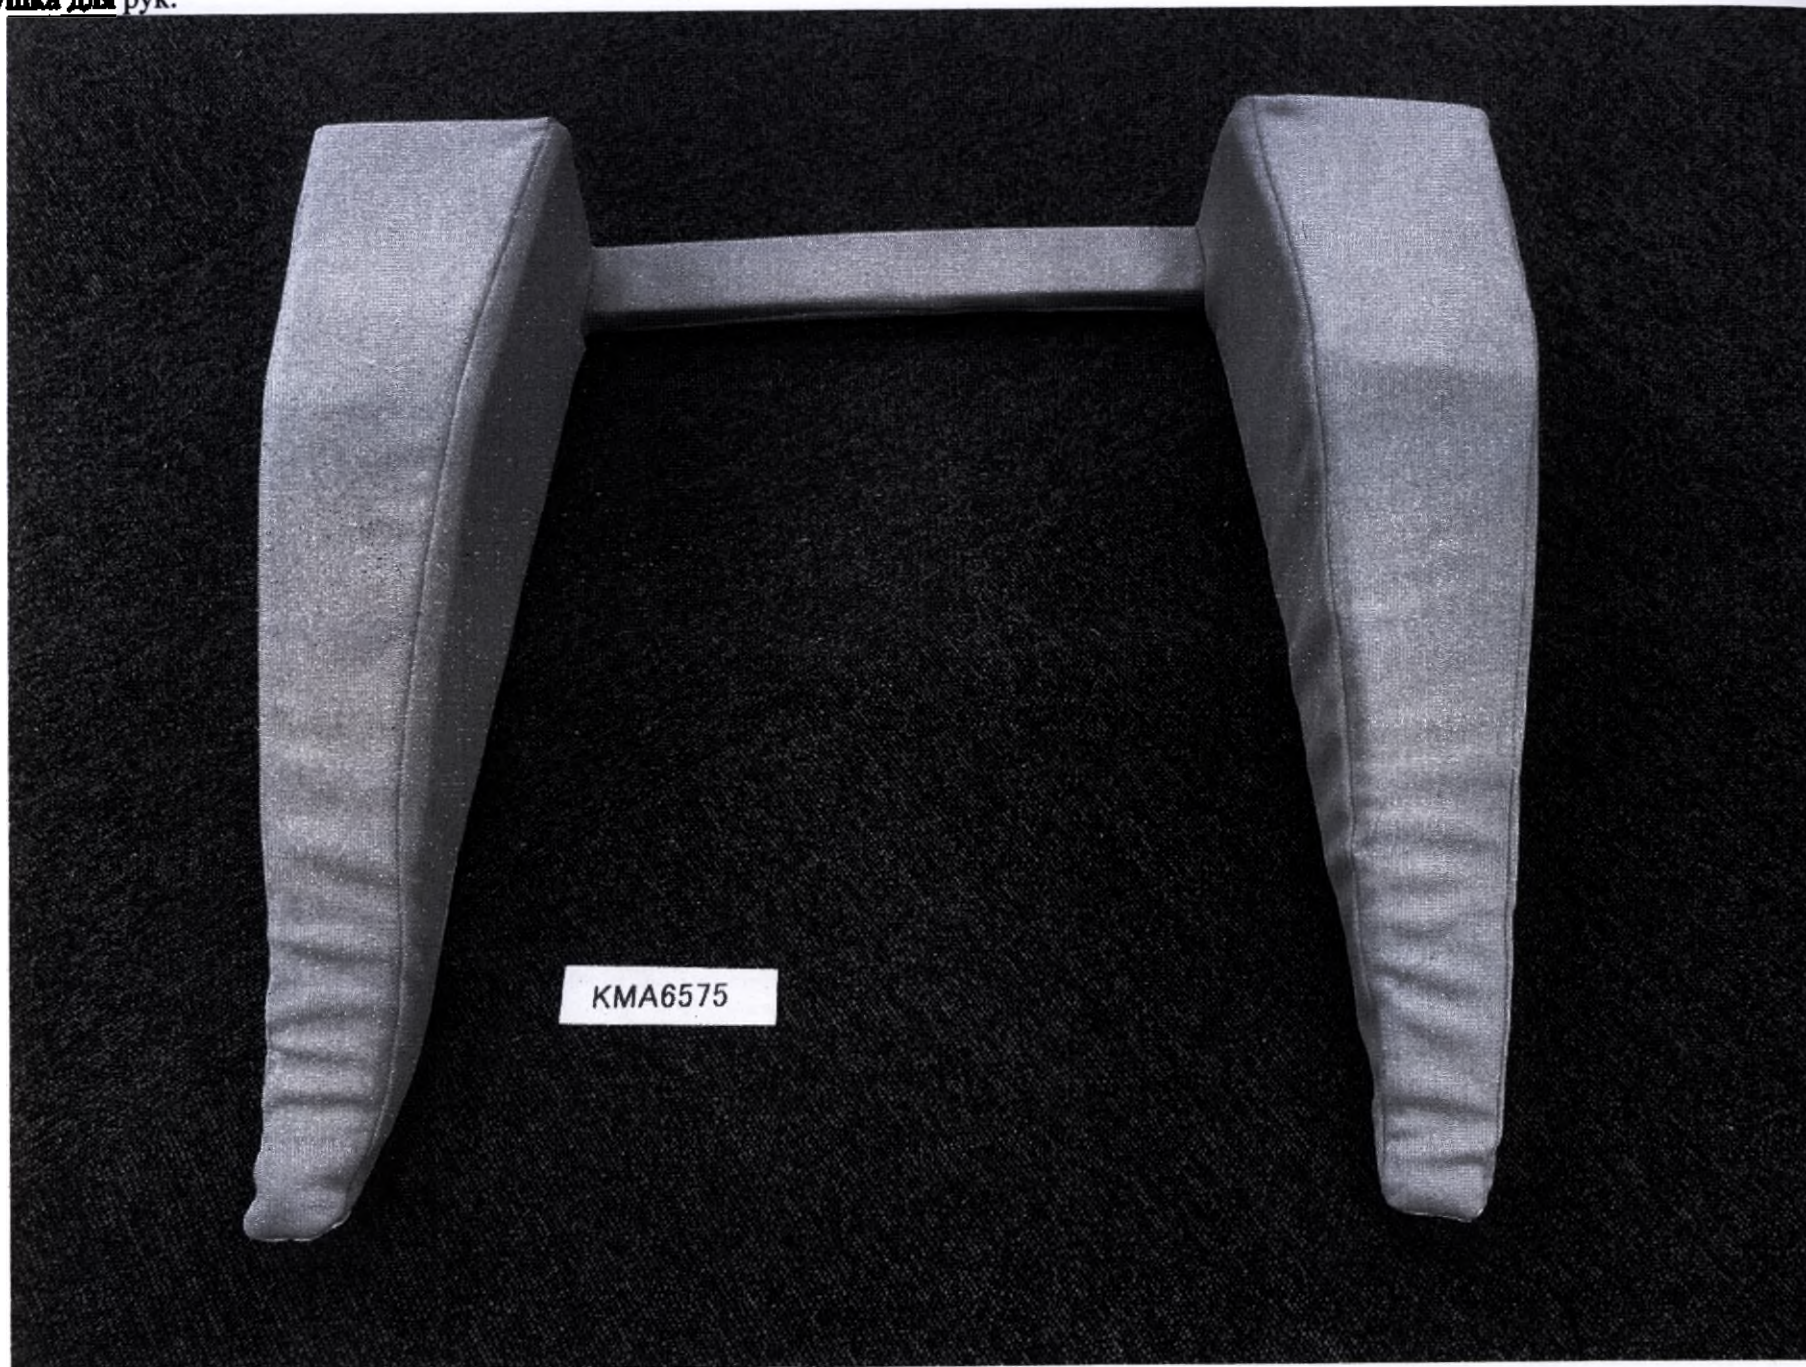


8. Чехол для ног надувной (для фиксации каждой ступни).




VCV6922


KDA6508

10. Фильтр радиатора.

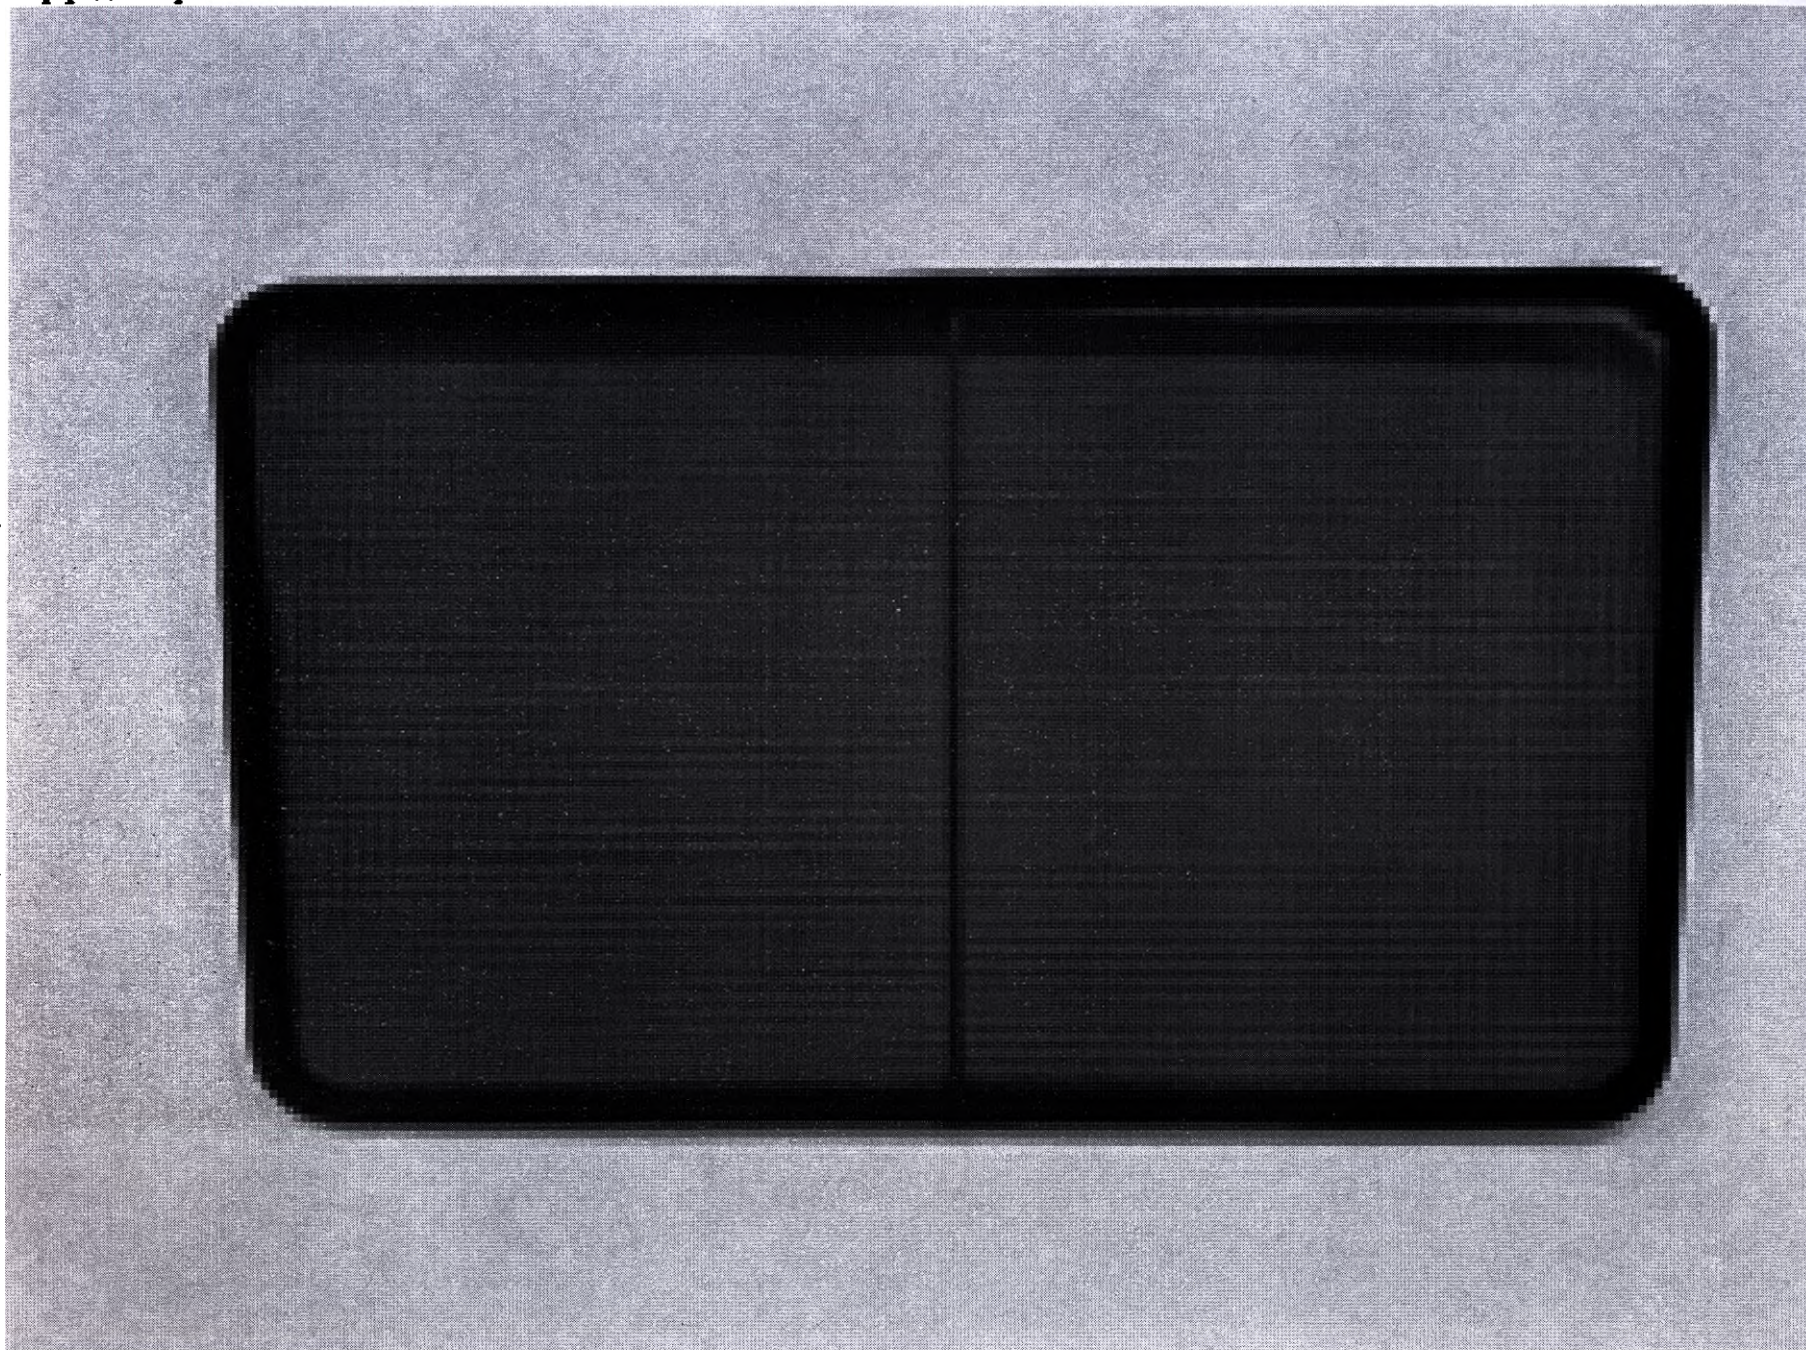

11. Кабель питания.

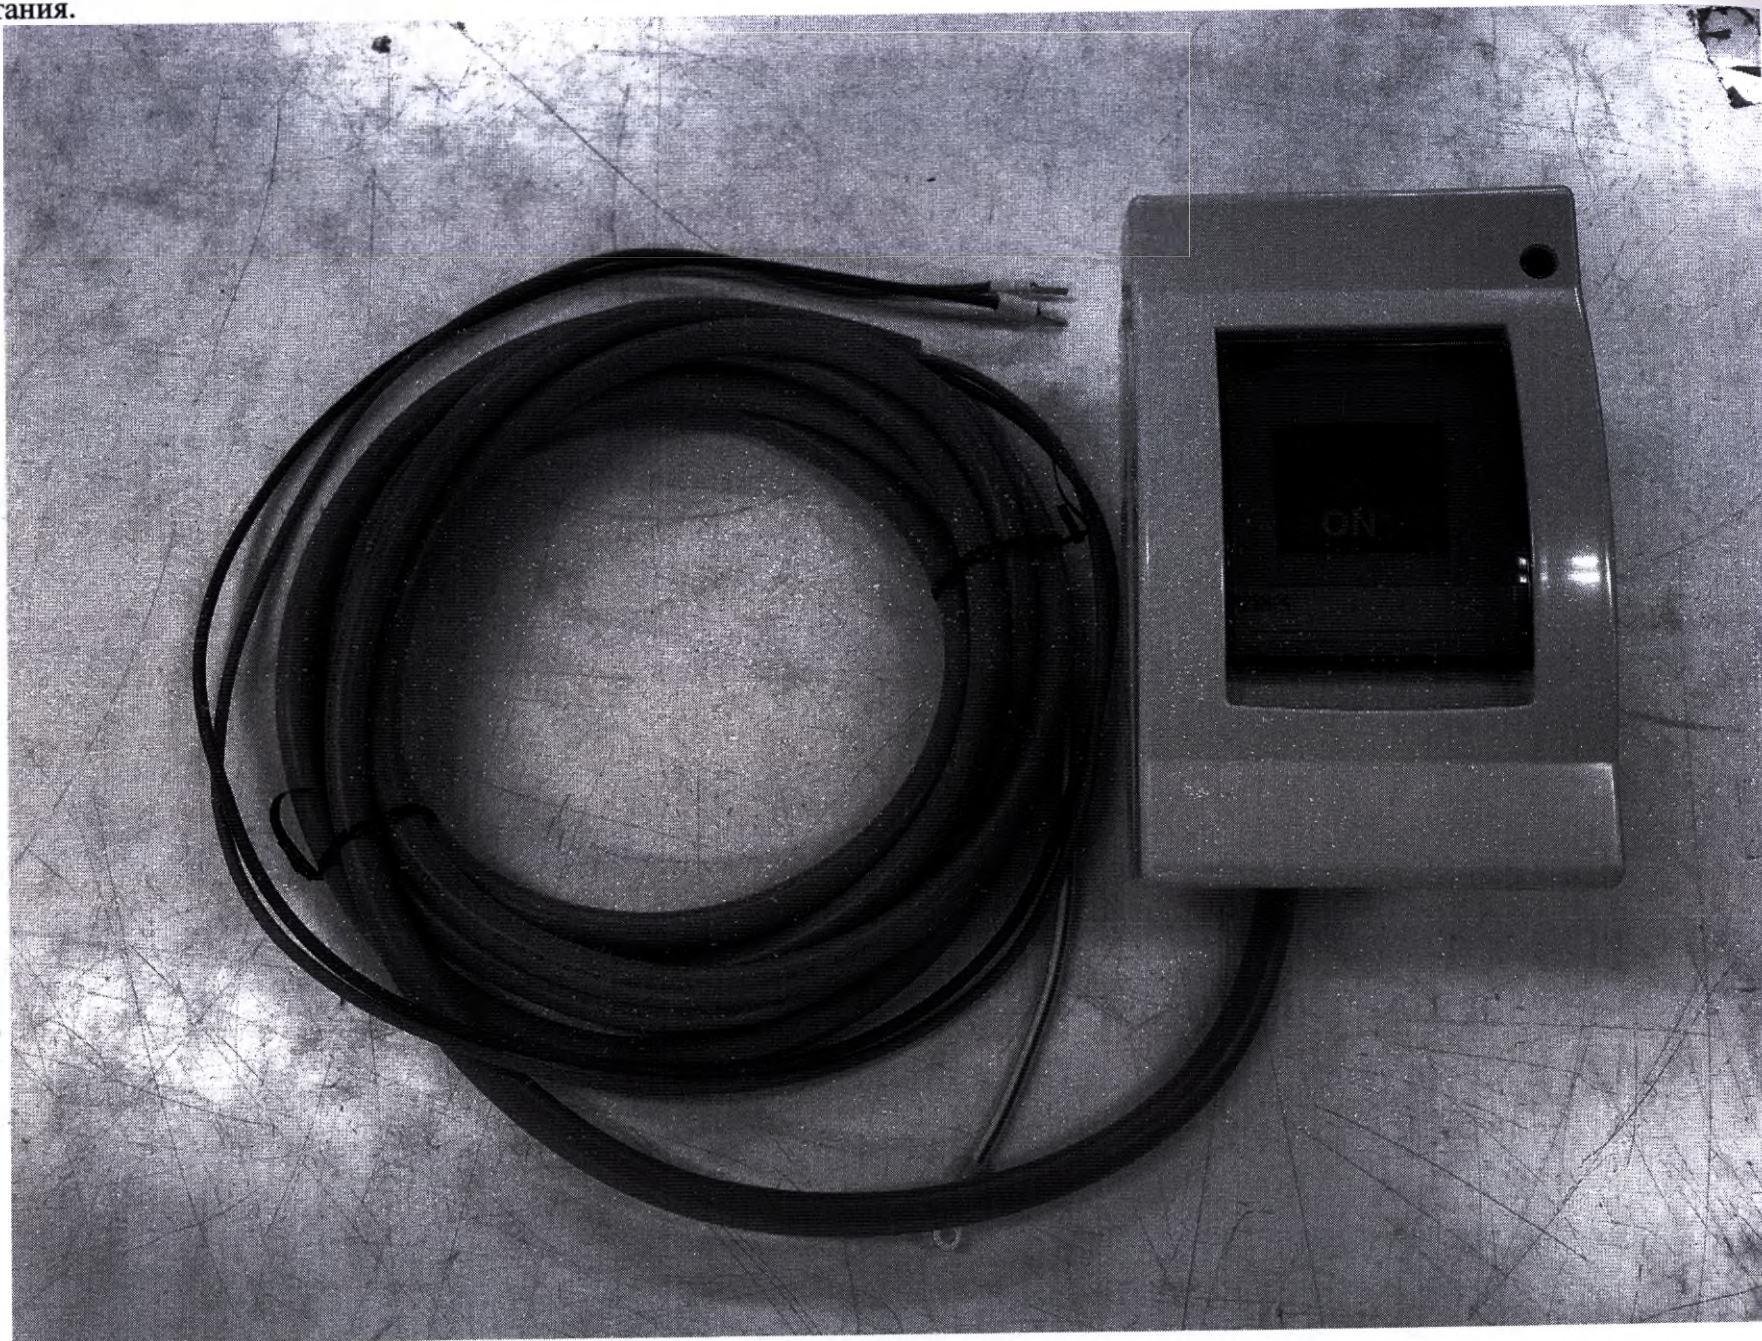

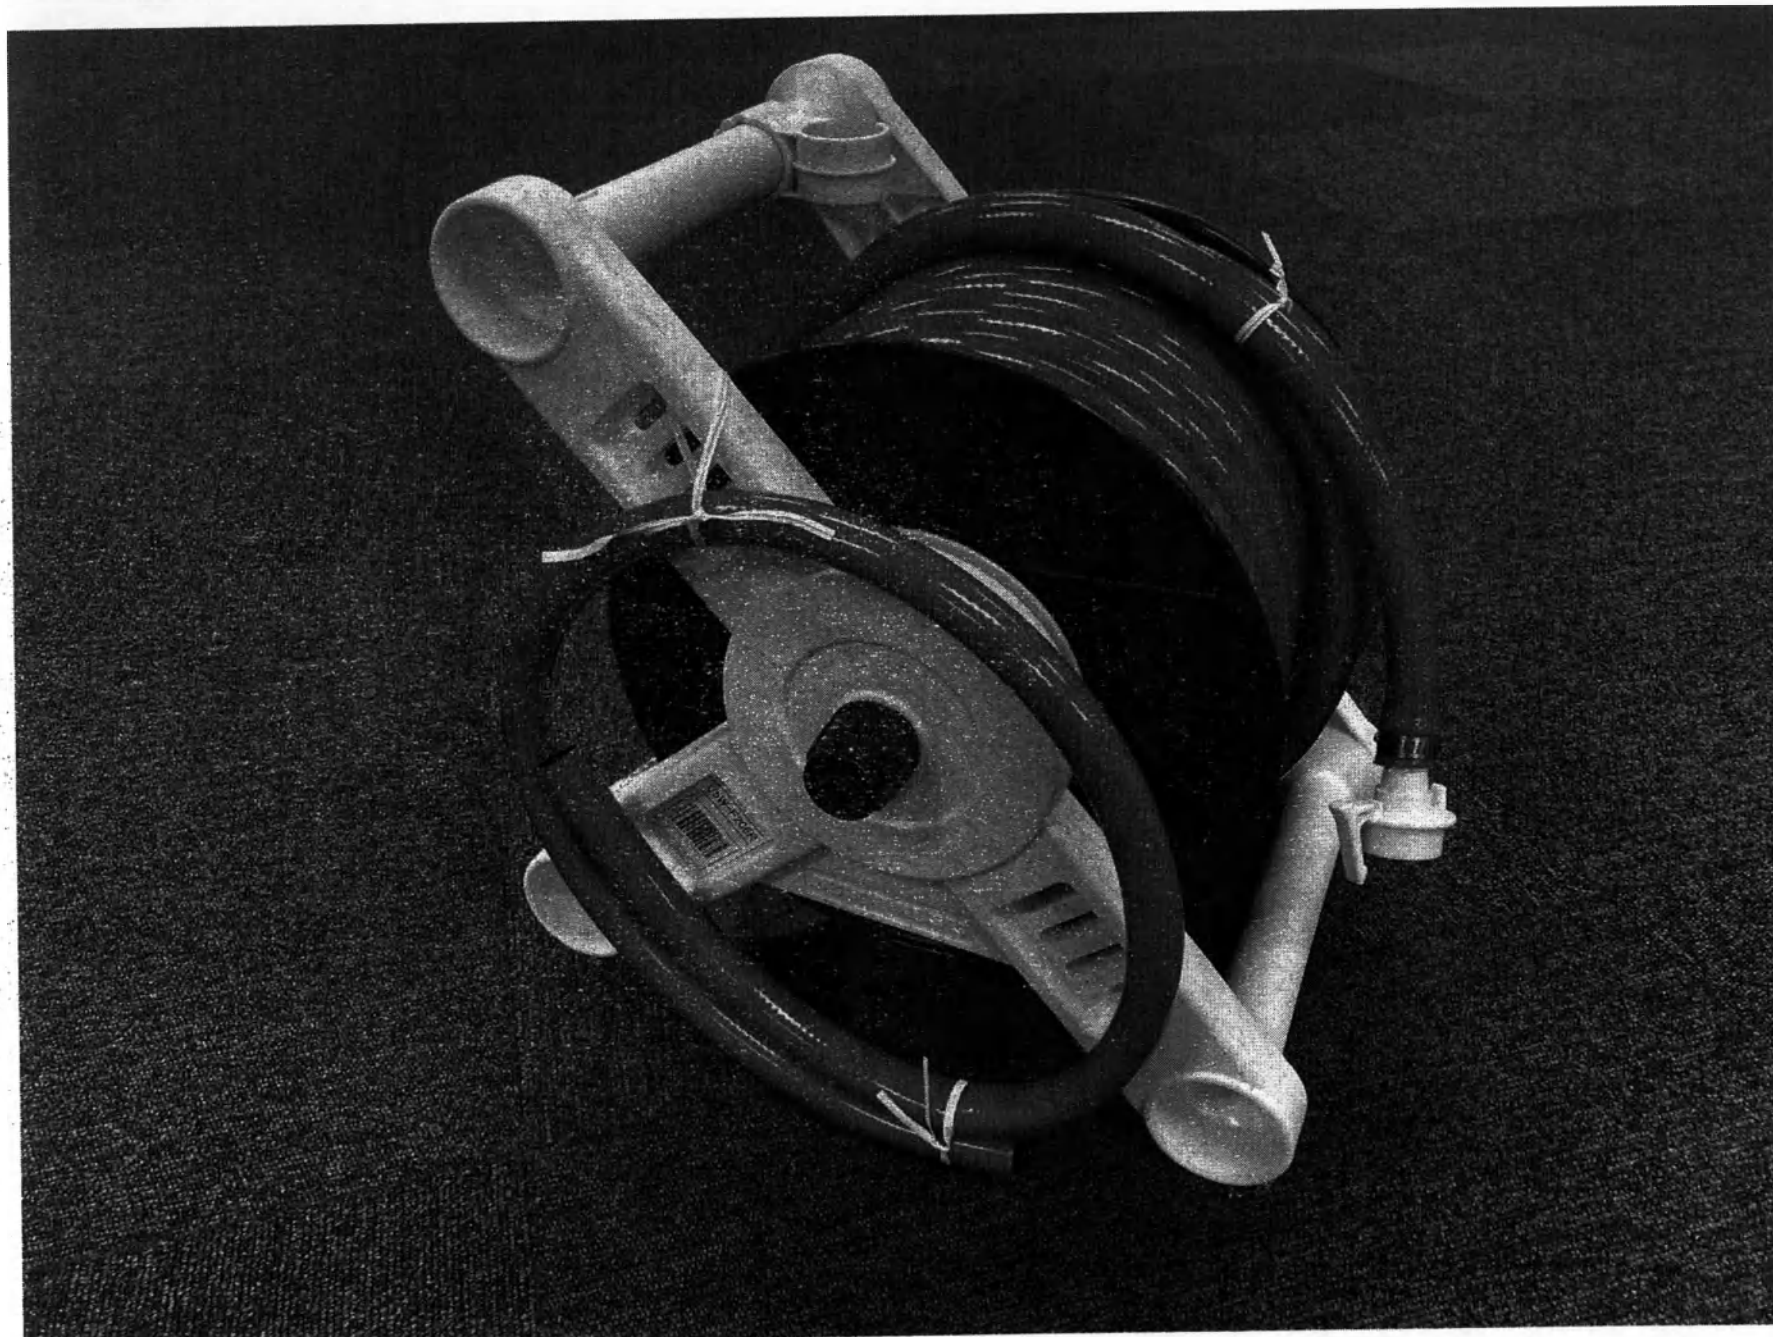

Rehabilitation & Wellness

MINATO

Аппарат физиотерапевтический для сухого
гидромассажа AQUATIZER QZ-240SG

AQUATIZER

Dry Hydro Jet Massage Bed **QZ-240**

Руководство по эксплуатации



AQUATIZER QZ-240SG

«Подтверждаю точность, правильность и
I hereby certify accuracy, correctness and
достоверность содержания текста
reliability of this document
на русском языке»
into Russian

____ (President: Mr. Nobuyuki Kurusu)

Перед использованием необходимо прочитать данное руководство по эксплуатации, чтобы обеспечить наиболее эффективную и безопасную работу этого изделия. После прочтения руководства сохраните его для последующего использования.

MINATO MEDICAL SCIENCE CO.,LTD.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 16 листов

Генеральный директор
ООО «Форте Медикал Сервис»



Бурмистрова Н.В.