

Ворошилов Н.А.




« 22 »

Фотографическое изображение на медицинское изделие

«Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, рН, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro»

(Редакция 1)

Рисунок 1. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 150 (общий вид МИ)

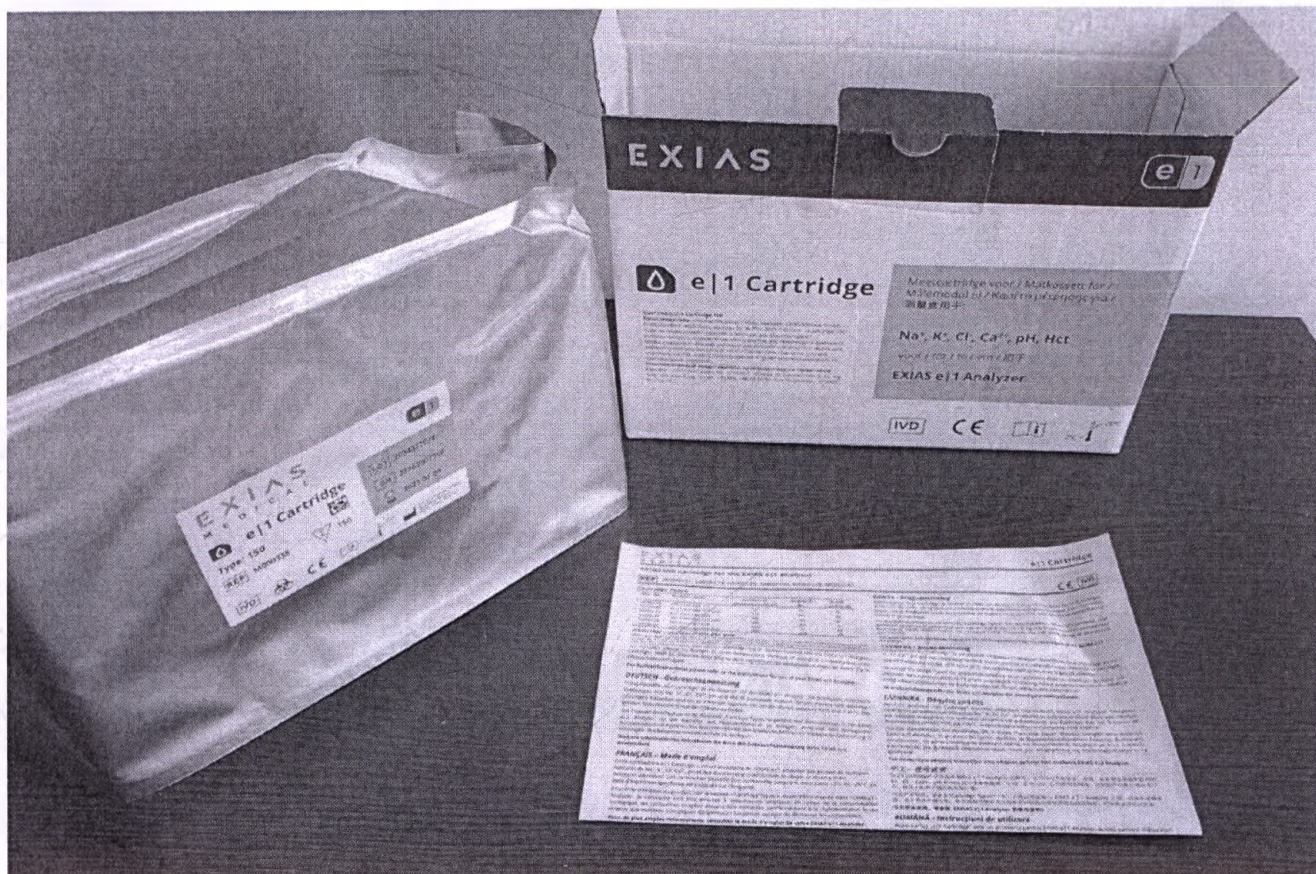

EXIAS

e|1



e|1 Cartridge

Картридж e|1 Cartridge 150

Производитель: «Эксияс Медикал ГмбХ», Австрия, EXIAS Medical GmbH, Klatzgrustraße 2, 8020 Graz, Austria / EU № PZH 2021/15029 от 18 декабря 2021 года на медицинское изделие "Картридж для анализатора e|1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro" / Серию, срок годности, условия хранения, состав, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке.


Уполномоченный представитель производителя на территории России: ООО «Эко-мед-с М», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1, пом. 105, ком. 3, оф. 2, Тел.: +7 (495) 748-43-50/51, 614-91-52; Факс: +7 (495) 612-39-18

Meetcartridge voor / Mätkassett för /
Målemodul til / Κασέτα μέτρησης για /
測量盒用于:

Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , pH, Hct

voor / för / til / για / 用于

EXIAS e|1 Analyzer



EXIAS

e | 1 Cartridge

Type:

150

REF


M000338

LOT

2034327078



2023-07-29



150



EXIAS Medical GmbH
Kratkystrasse 2
8020 Graz, Austria






Рисунок 2. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 150 (Макет маркировки для обращения на территории РФ)

Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 150

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
 Производитель EXIAS Medical GmbH, Kratkystraße 2, 8020 Graz, Austria
 Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Эко-мед-с М», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1, пом. 105, ком.3, оф. 2



Рисунок 3. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e1 Cartridge 150 oQC (общий вид МИ)

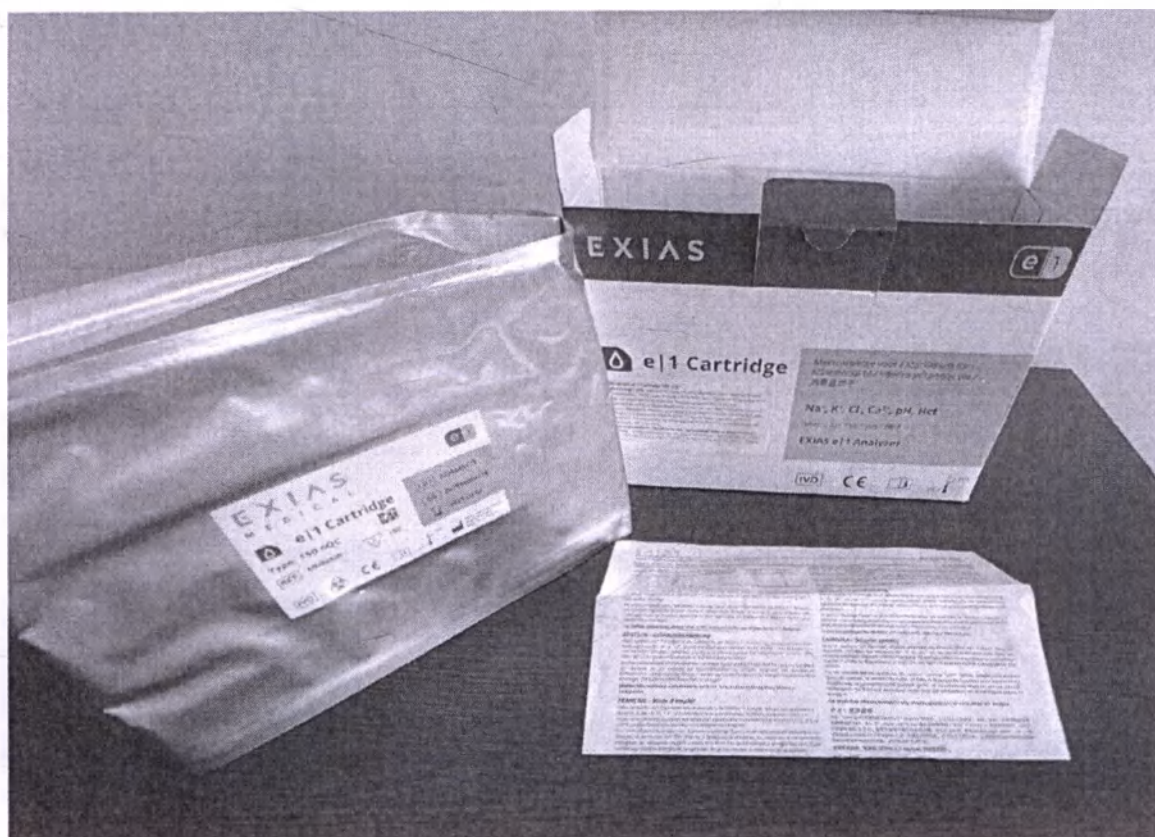

EXIAS



e|1 Cartridge

Картридж e|1 Cartridge 150 eQC
Производитель: EXIAS Medical GmbH, Австрия, EXIAS Medical GmbH, Industriestraße 2, 6020 Gars, Austria / PZ № PZN 202 1740229 от 16 декабря 2021 года. На неидентифицируемые изделия "Картридж для анализатора e|1" (далее - изделия) распространяется гарантия, срок годности в течение которой гарантируется соответствие изделий требованиям, указанным в технической документации производителя. В случае, если срок годности изделий, указанных в технической документации, истек, срок годности изделий, указанных в технической документации, истекает. Уполномоченный представитель производителя на территории России: ООО "Система-М", 117183, г. Москва, ул. Савская, д. 28, стр. 1, пом. 102, оф. 2, факс: 7 (495) 748-43-50/51, 8 (800) 52-00-00, 7 (495) 748-43-50.

Meetcartridge voor / Måtkassett för /
Målemodul til / Κασέτα μέτρησης για /
測量盒用于:

Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, pH, Hct

voor / för / til / για / 用于

EXIAS e|1 Analyzer



EXIAS

e|1 Cartridge

Type: 150 oQC

REF

M000339

LOT

2034446678



2023-09-08



150



EXIAS Medical GmbH
Kratkystrasse 2
8020 Graz, Austria






Рисунок 4. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 150 oQC (Макет маркировки для обращения на территории РФ)

Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 150 oQC

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
 Производитель EXIAS Medical GmbH, Kratkystraße 2, 8020 Graz, Austria
 Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Эко-мед-с М», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1, пом. 105, ком.3, оф. 2



Рисунок 5. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|l Cartridge 300 (общий вид МИ)

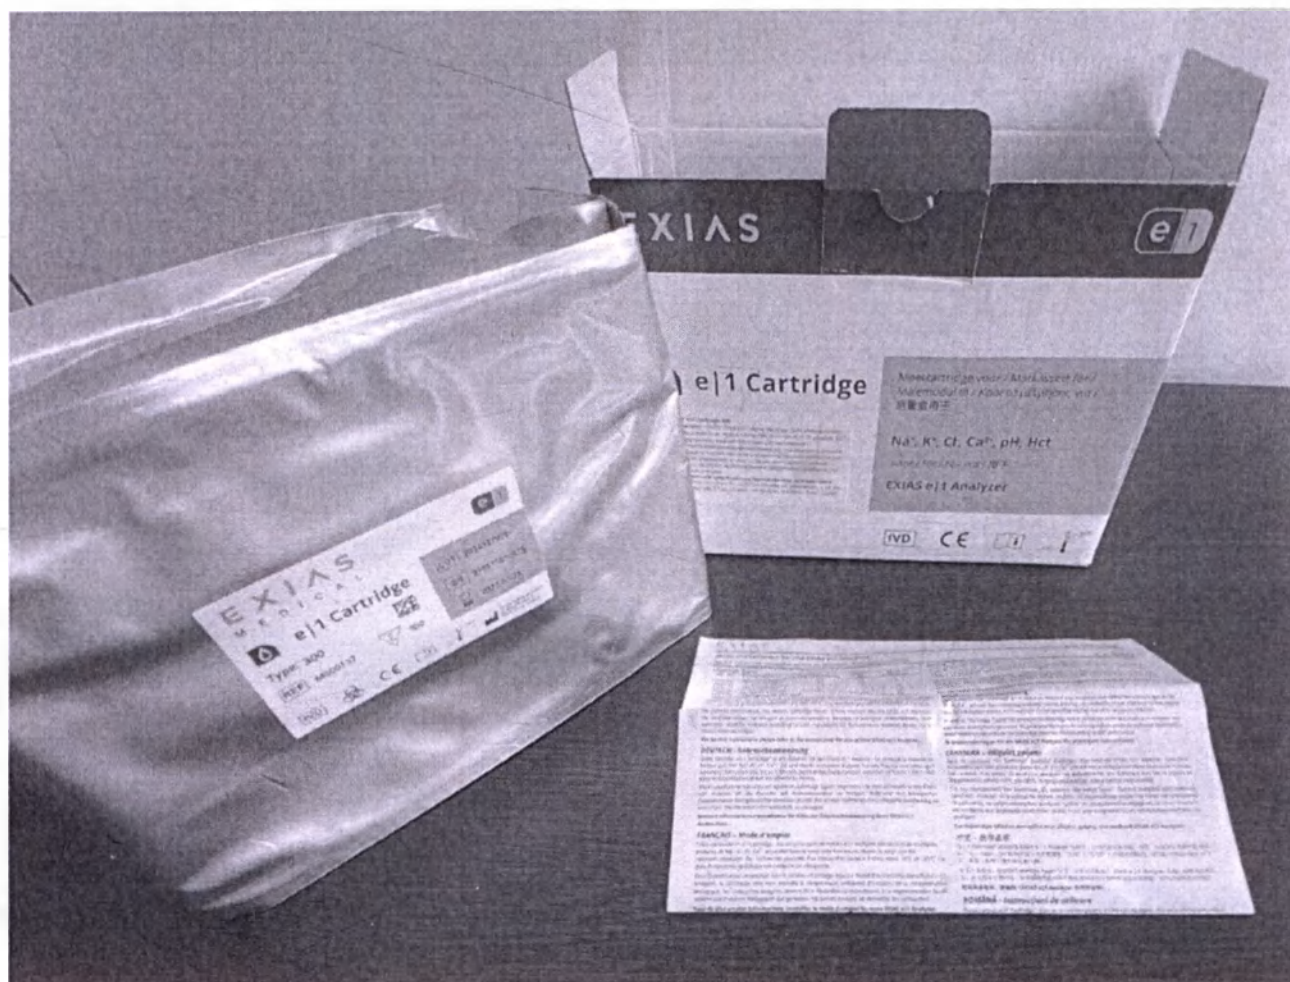

EXIAS

e|1

e|1 Cartridge

Картридж e|1 Cartridge 200

Производитель: EXIAS Medical GmbH, Австрия, EXIAS Medical GmbH, Klatzkustraße 2, 8020 Graz, Austria / RU № РЗН 2021/16029 от 16 декабря 2021 года на медицинское изделие "Картридж для анализатора e|1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro" / Серию, срок годности, условия хранения, состав, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке.

Уполномоченный представитель производителя на территории России: ООО «Эко-мед» М., 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 28, стр. 1, пом. 105, код з. оф. 2, Тел: +7 (495) 748-43 50/51; 614-91-52; факс: +7 (495) 612-39-18

Meetcartridge voor / Mätkassett för /
Målemodul til / Μετέτα μέτρησης για /
测量盒用于:

Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, pH, Hct

voor / för / til / για / 用于

EXIAS e|1 Analyzer

IVD

CE



25°C
2°C

EXIAS

e|1 Cartridge

Type: 300

REF M000137

LOT 2034327978

 2023-07-29

 300

 EXIAS Medical GmbH
Kratkystrasse 2
8020 Graz, Austria

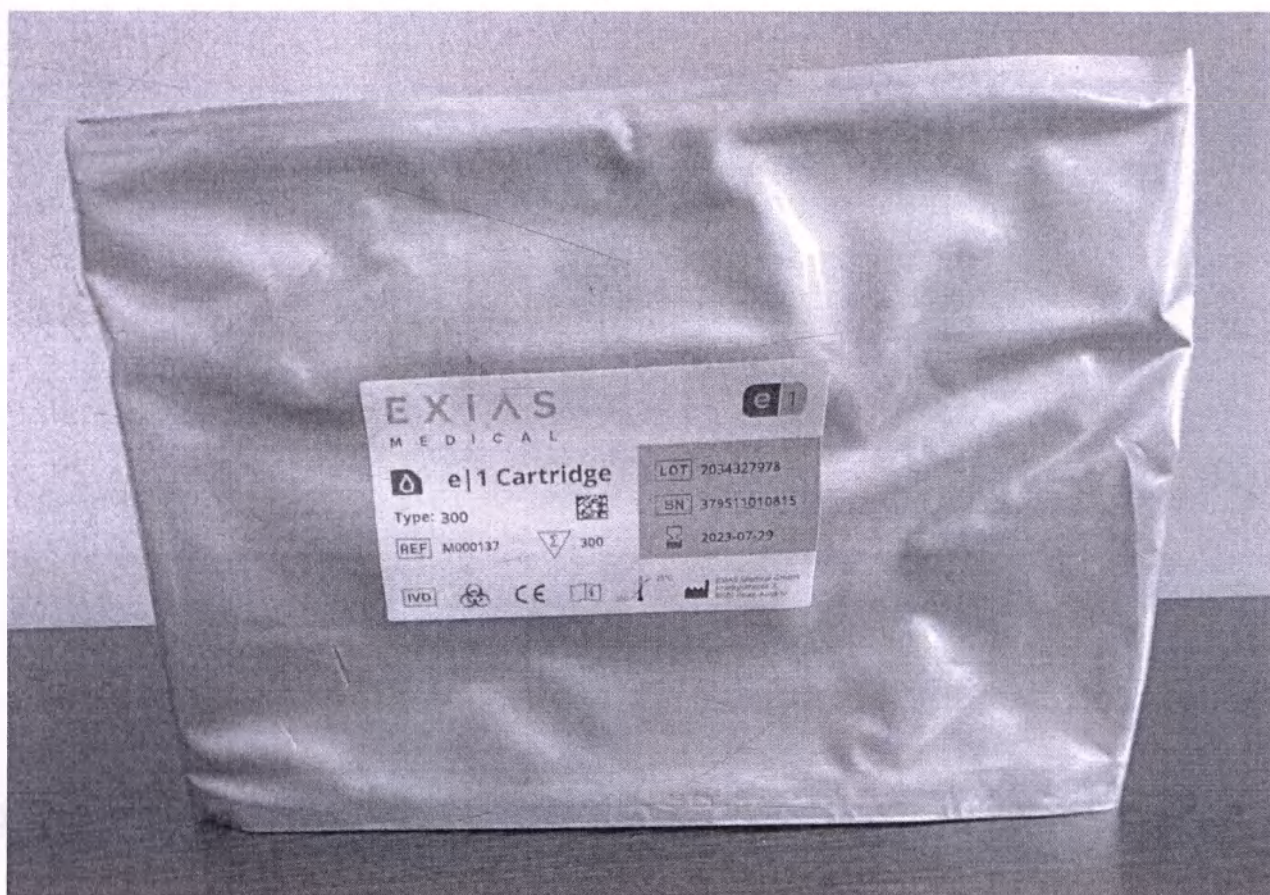




Рисунок 6. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 300 (Макет маркировки для обращения на территории РФ)

Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 300


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Производитель EXIAS Medical GmbH, Kratkystraße 2, 8020 Graz, Austria

Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Эко-мед-с М», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1, пом. 105, ком.3, оф. 2



Рисунок 7. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e1 Cartridge 300 oQC (общий вид МИ)

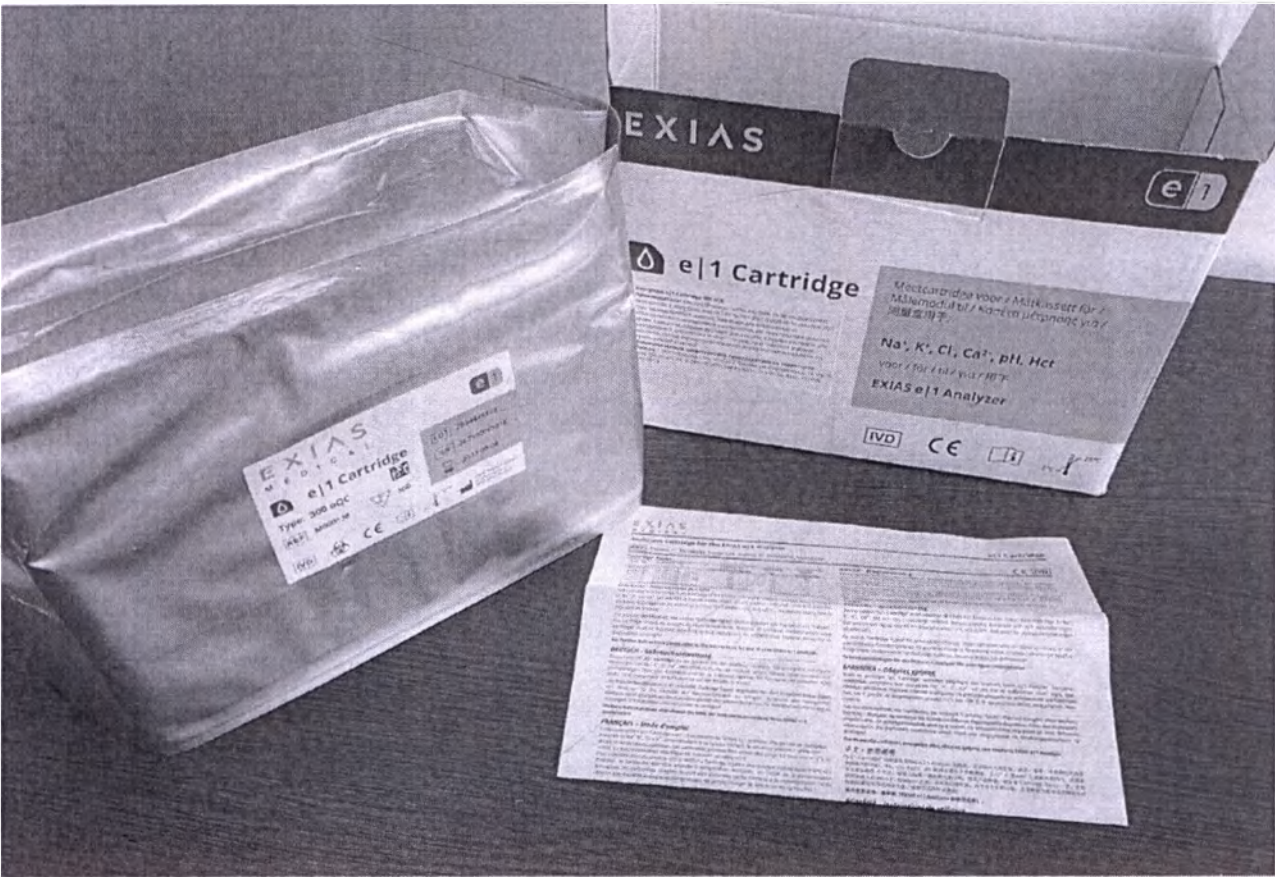

EXIAS

e|1



e|1 Cartridge

Картридж e|1 Cartridge 300 µQC

Производитель: «Эксияс Медикал ГмбХ», Австрия, EXIAS Medical GmbH, Kitzbühlerstraße 2, 8020 Grotz, Austria / РУ № РЗН 2021/16029 от 16 декабря 2021 года на медицинское изделие "Картридж для анализатора e|1" количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro / Серию, срок годности, условия хранения, состав, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке.


Уполномоченный представитель производителя на территории России: ООО «Эко-мед-с М», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1, пом. 105, ком. 3, оф. 2, Тел.: +7 (495) 748-43-50/51, 614-91-52; Факс: +7 (495) 612-39-18

Meetcartridge voor / Mätkassett för /
Målemodul til / Κασέτα μέτρησης για /
测量盒用于:

Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , pH, Hct

voor / för / til / για / 用于

EXIAS e|1 Analyzer



EXIAS

e|1 Cartridge

Type: 300 oQC

REF

M000138

LOT

2034445178



2023-09-08



300



EXIAS Medical GmbH
Kratkystrasse 2
8020 Graz, Austria





Рисунок 8. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 300 oQC (Макет маркировки для обращения на территории РФ)

Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 300 oQC


Регистрационное удостоверение № _____ от _____


Производитель EXIAS Medical GmbH, Kratkystraße 2, 8020 Graz, Austria

Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Эко-мед-с М», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1, пом. 105, ком.3, оф. 2



Рисунок 9. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 600 (общий вид МИ)

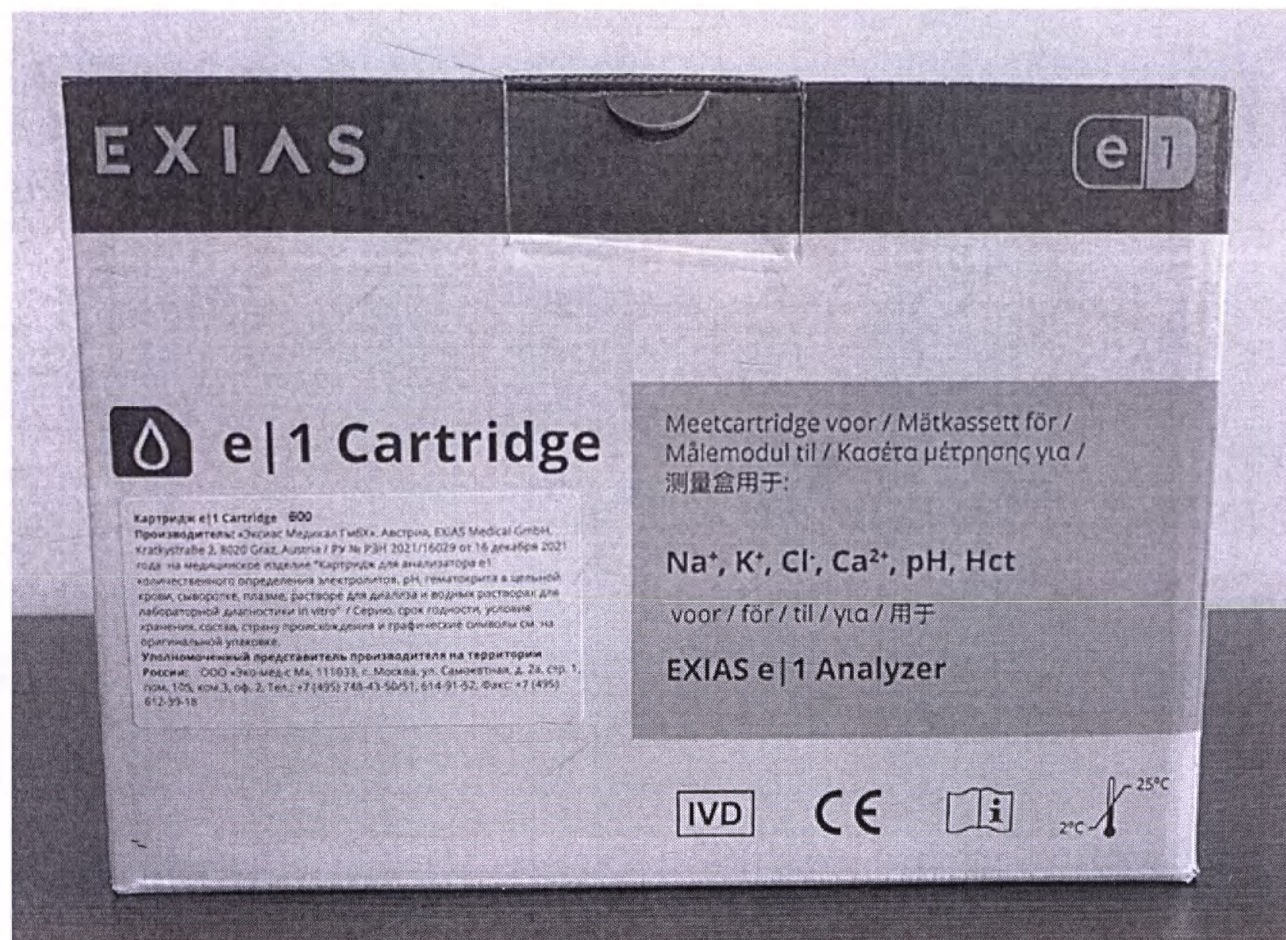

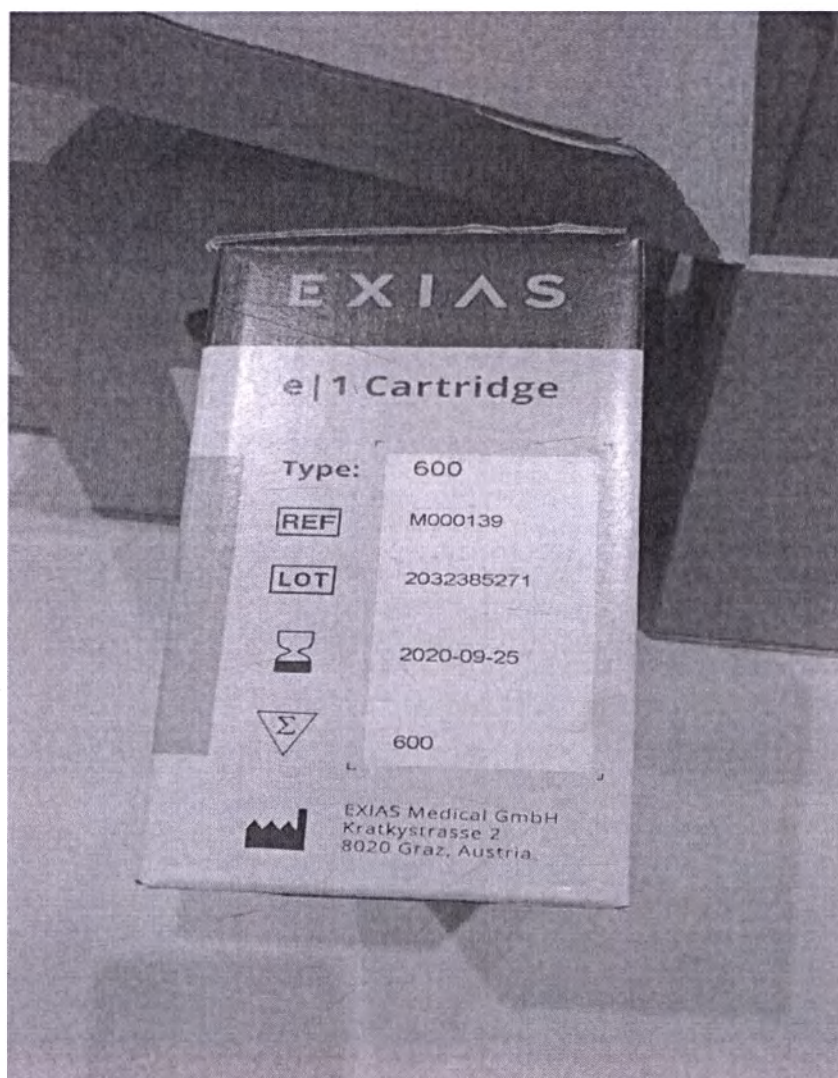

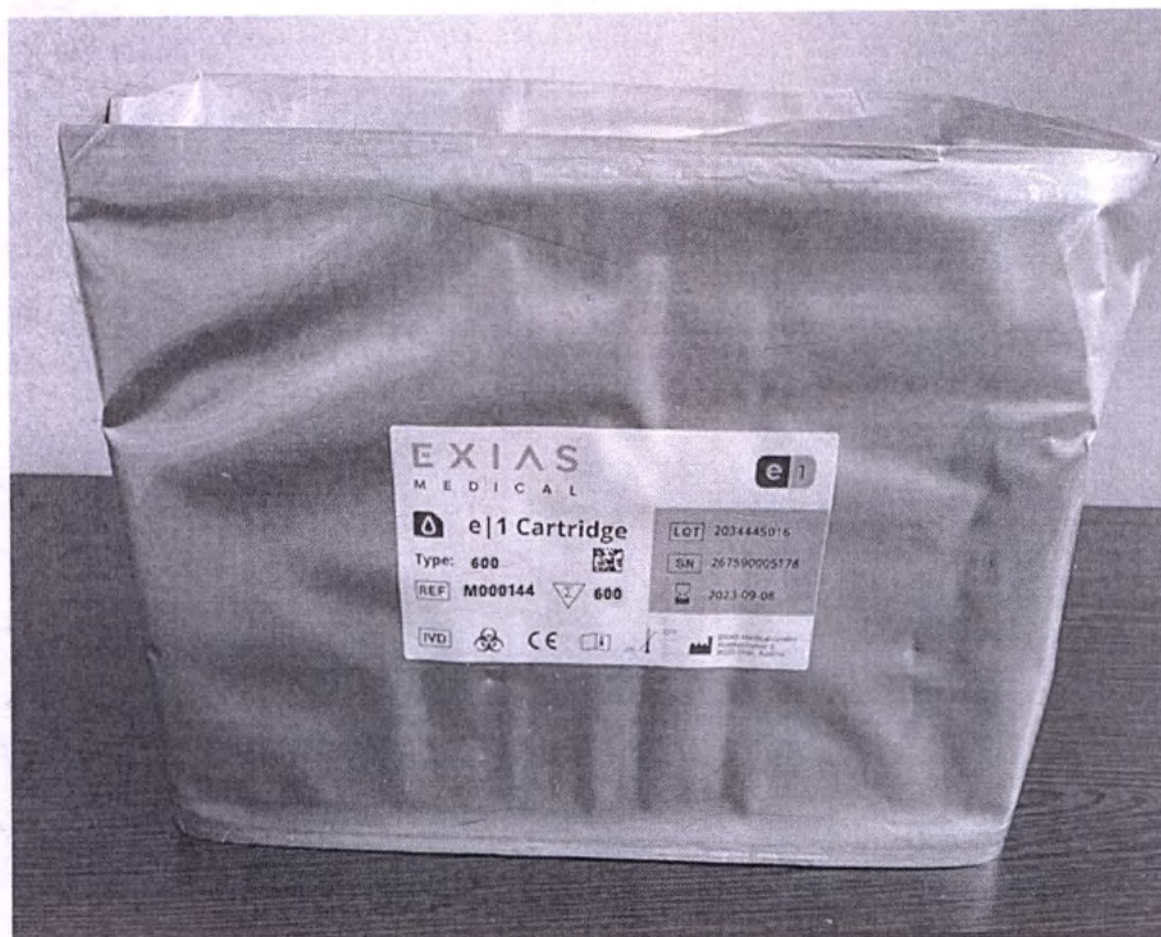





Рисунок 10. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 600 (Макет маркировки для обращения на территории РФ)

Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 600

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
 Производитель EXIAS Medical GmbH, Kratkystraße 2, 8020 Graz, Austria
 Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Эко-мед-с М», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1, пом. 105, ком.3, оф. 2



Рисунок 11. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e|1 Cartridge 600 oQC (общий вид МИ)

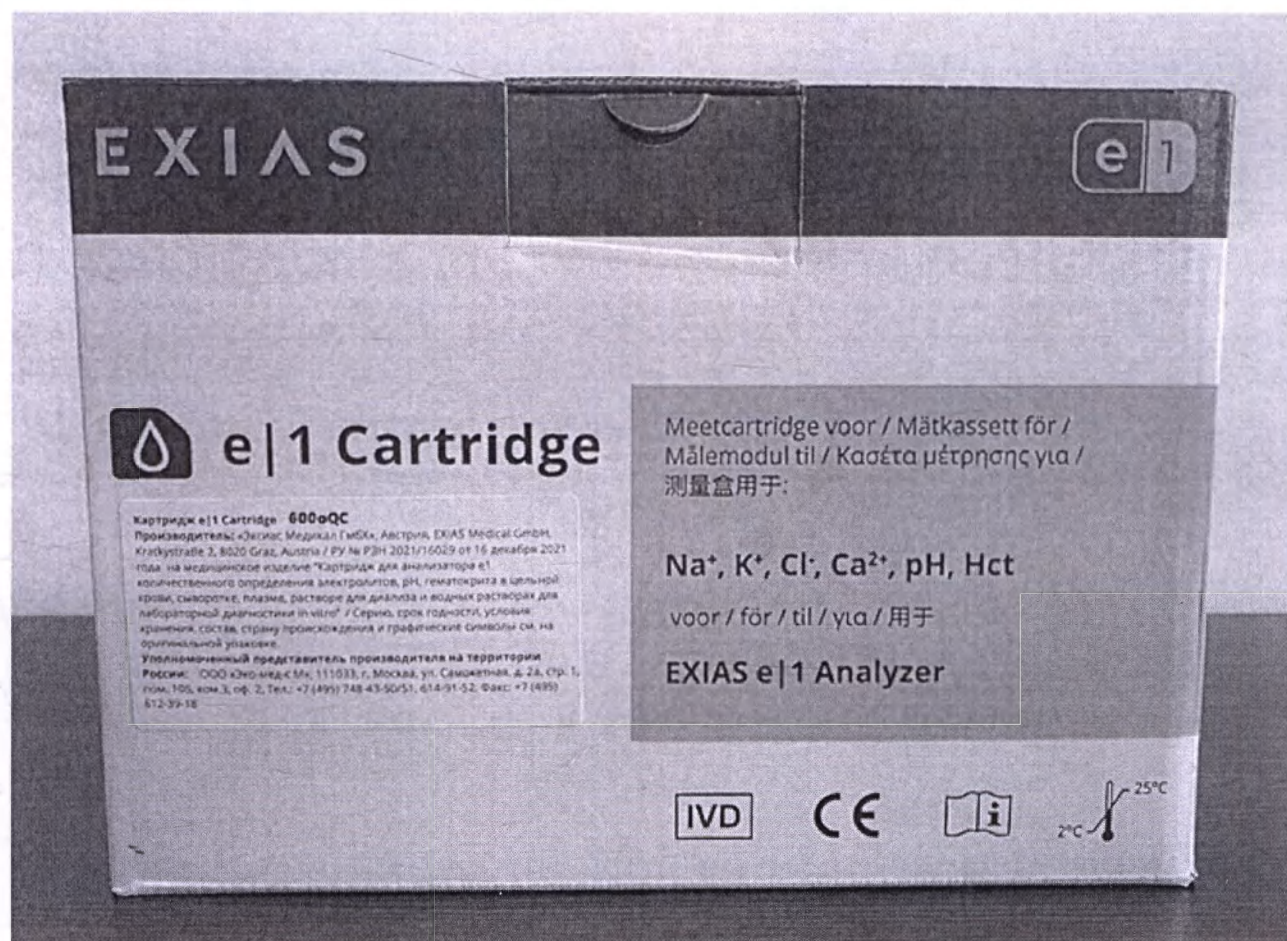

EXIAS
MEDICAL

e|1 Cartridge

Type: 600 eQC

REF: MC00140

600

LOT: 202207607B

SN: 628831004321

2020-09-25

IVD

CE

CE

CE

CE

CE

EXIAS MEDICAL GmbH
85051 Garching, Germany

EXIAS
MULTI-USE

Multi-use cartridge for the EXIAS e|1 Analyzer

REF: MC00140 MODULAR ANALYZER EXIAS e|1 ANALYZER

Cartridge Types

Cartridge Type	Volume of Reagent (mL)	Test Time (min)	Test Time (min)
EXIAS e 1 Cartridge	100	15	15
EXIAS e 1 Cartridge	100	15	15
EXIAS e 1 Cartridge	100	15	15
EXIAS e 1 Cartridge	100	15	15
EXIAS e 1 Cartridge	100	15	15

ENGLISH - Instructions for use

The EXIAS e|1 Cartridge is a multi-use cartridge for the EXIAS e|1 Analyzer. It contains reagents for the detection of COVID-19. The cartridge is used to detect the presence of COVID-19 in a sample. The cartridge is used to detect the presence of COVID-19 in a sample. The cartridge is used to detect the presence of COVID-19 in a sample.

For further information, please refer to the Instructions for use of the EXIAS e|1 Analyzer.

DEUTSCH - Gebrauchsanleitung

Das EXIAS e|1 Cartridge ist ein Mehrfach-Testkassette für den EXIAS e|1 Analyzer. Es enthält Reagenzien zur Erkennung von COVID-19. Die Kassette wird verwendet, um das Vorhandensein von COVID-19 in einer Probe zu erkennen. Die Kassette wird verwendet, um das Vorhandensein von COVID-19 in einer Probe zu erkennen.

Für weitere Informationen, siehe die Gebrauchsanleitung des EXIAS e|1 Analyzers.

FRANÇAIS - Mode d'emploi

Le EXIAS e|1 Cartridge est une cassette multi-usage pour l'EXIAS e|1 Analyser. Il contient des réactifs pour la détection du COVID-19. La cassette est utilisée pour détecter la présence de COVID-19 dans un échantillon. La cassette est utilisée pour détecter la présence de COVID-19 dans un échantillon.

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'EXIAS e|1 Analyser.

e|1 Cartridge

CE IVD

DANISH - Brugsinstruktion

EXIAS e|1 Cartridge er en multi-brugskassette til EXIAS e|1 Analyzer. Den indeholder reagenser til detektion af COVID-19. Kassetten bruges til at detektere tilstedeværelsen af COVID-19 i en prøve. Kassetten bruges til at detektere tilstedeværelsen af COVID-19 i en prøve.

For yderligere oplysninger, se brugsanvisningen til EXIAS e|1 Analyzer.

SVENSKA - Bruksanvisning

EXIAS e|1 Cartridge är en multi-användningskassett för EXIAS e|1 Analyser. Den innehåller reagenser för detektion av COVID-19. Kassetten används för att detektera närvaron av COVID-19 i en prov. Kassetten används för att detektera närvaron av COVID-19 i en prov.

För ytterligare information, se bruksanvisningen för EXIAS e|1 Analyser.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Οδηγίες χρήσης

Η EXIAS e|1 Cartridge είναι μια πολλαπλής χρήσης κάσета για τον EXIAS e|1 Αναλυτή. Περιέχει αντιδραστήρια για την ανίχνευση του COVID-19. Η κάσета χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει την παρουσία του COVID-19 σε ένα δείγμα. Η κάσета χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει την παρουσία του COVID-19 σε ένα δείγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Οδηγία χρήσης του EXIAS e|1 Αναλυτή.

ROMÂNĂ - Instrucțiuni de utilizare

EXIAS e|1 Cartridge este o casetă multi-uz pentru EXIAS e|1 Analizator. Conține reagenți pentru detectarea COVID-19. Casetta este folosită pentru a detecta prezența COVID-19 în eșantion. Casetta este folosită pentru a detecta prezența COVID-19 în eșantion.

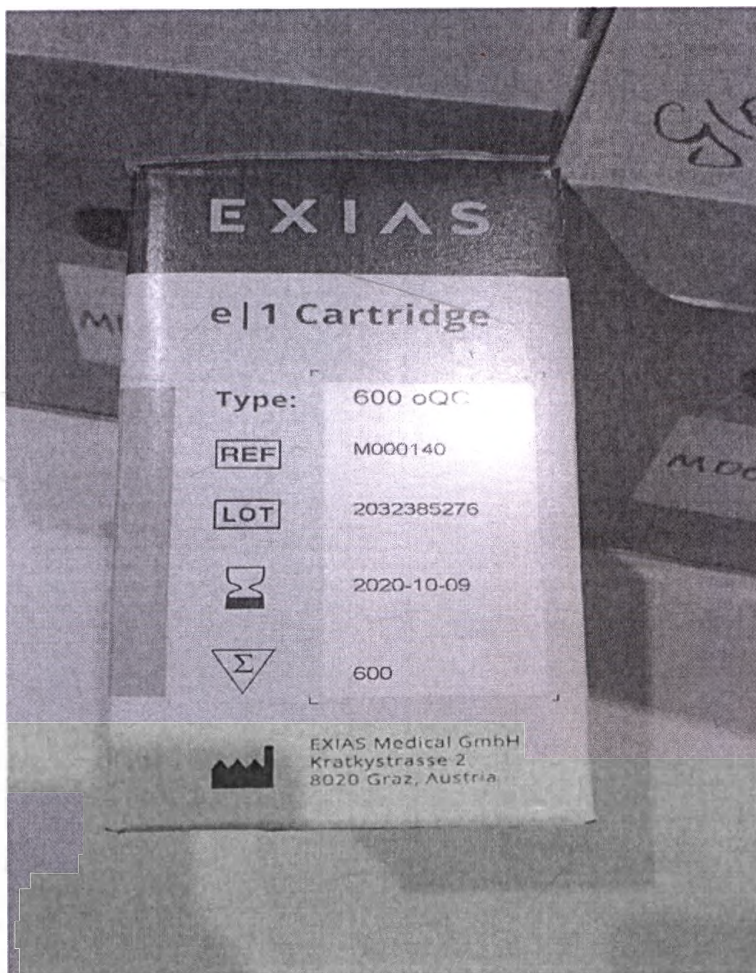

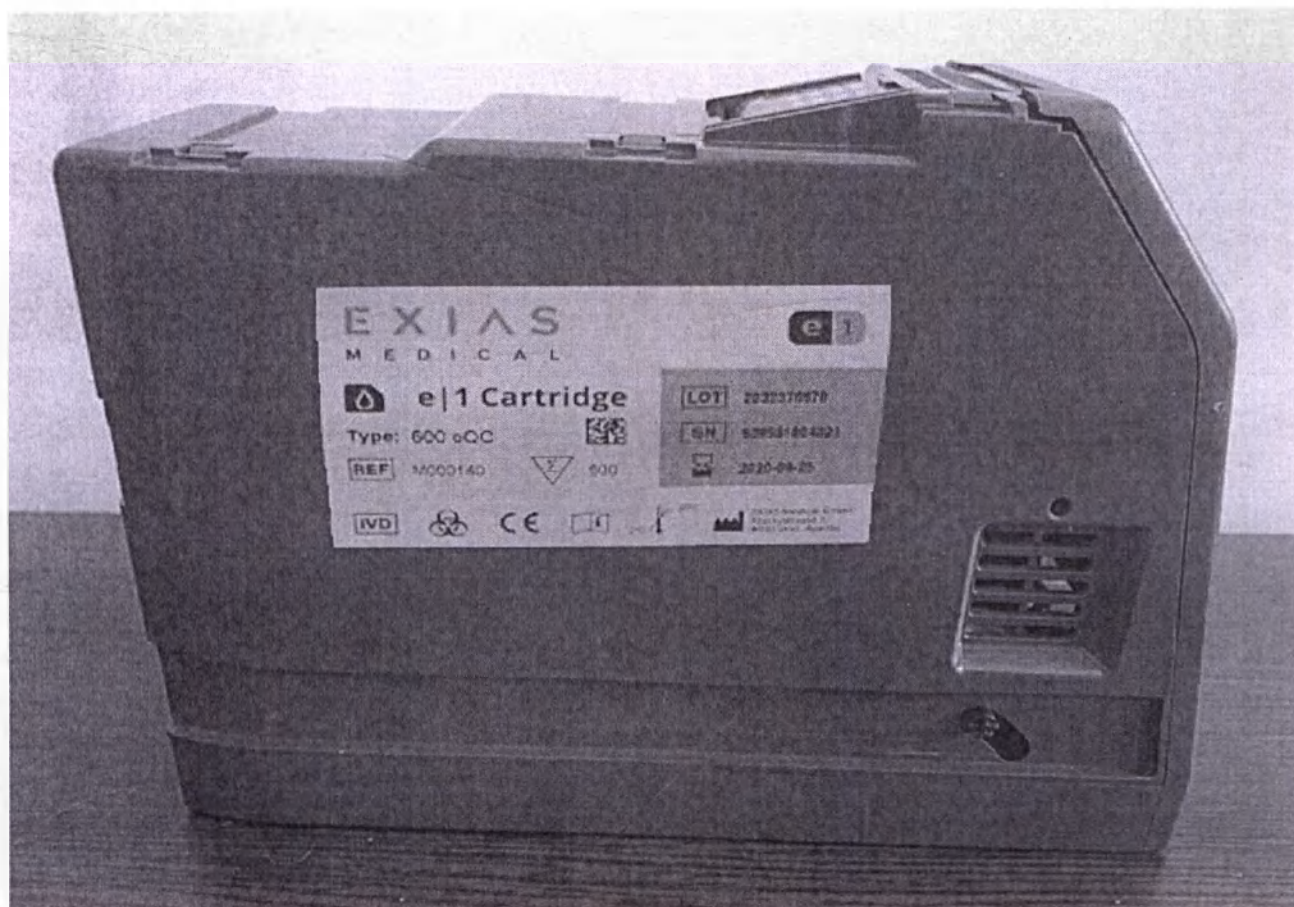


Рисунок 12. Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e1 Cartridge 600 oQC (Макет маркировки для обращения на территории РФ)

Картридж для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. Картридж e1 Cartridge 600 oQC

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Производитель EXIAS Medical GmbH, Kratkysstraße 2, 8020 Graz, Austria

Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Эко-мед-с М», 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1, пом. 105, ком.3, оф. 2



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 29

(продать детям)
листов. Генеральный директор

/ Н.А. Ворошилов

