
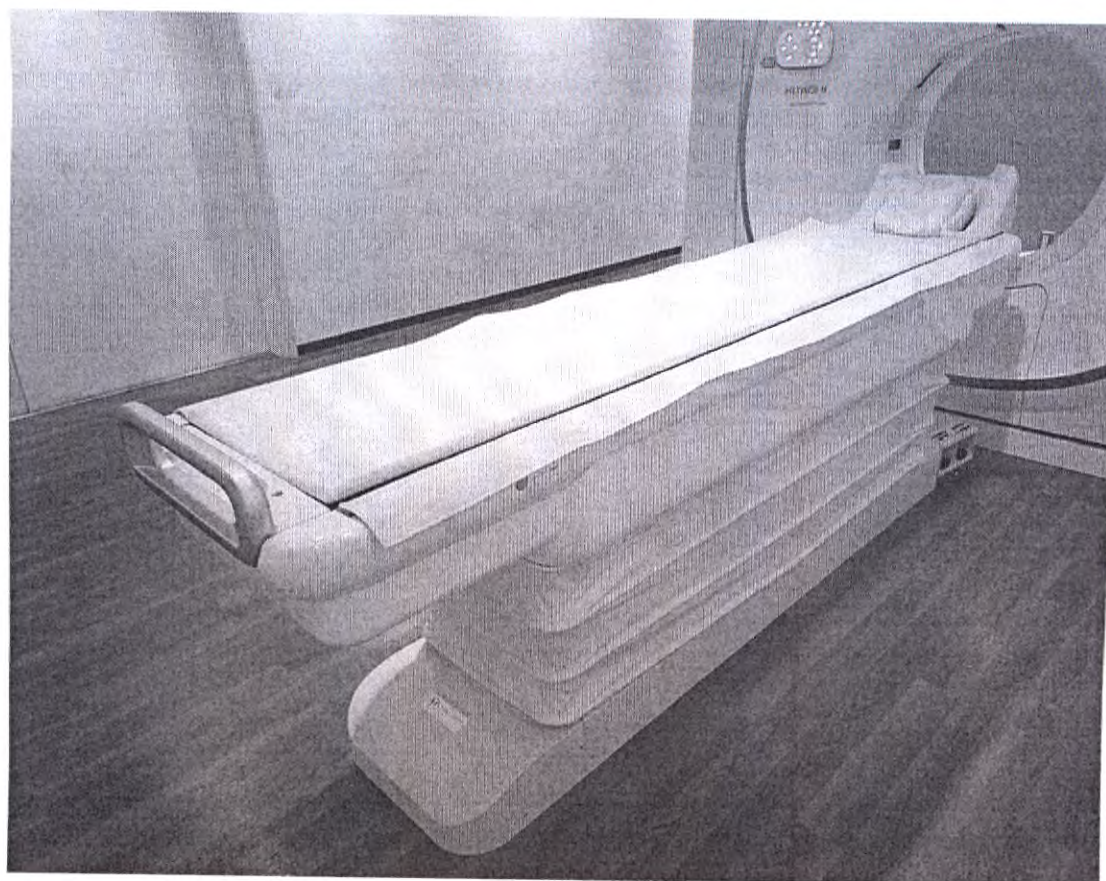


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Томограф компьютерный "Scenaria" с принадлежностями

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Томограф компьютерный с принадлежностями, варианты исполнения
Общие виды:

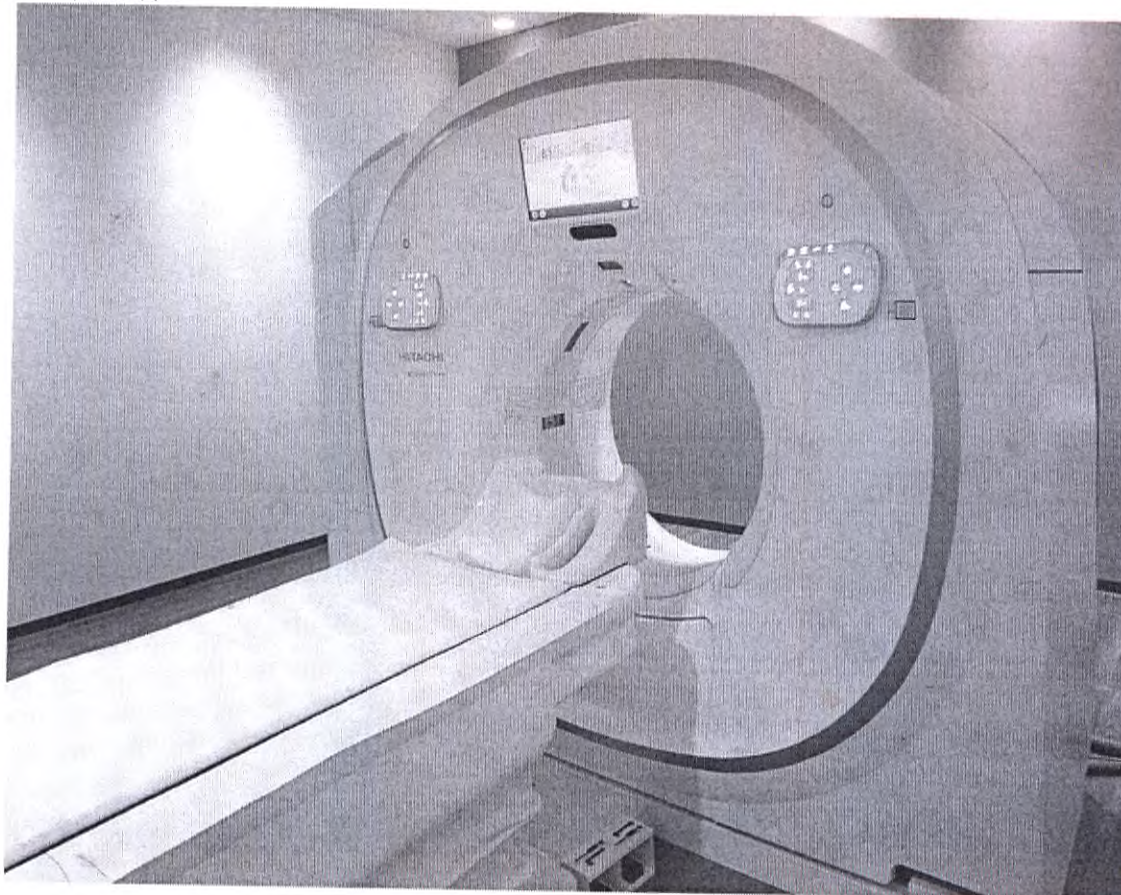

HITACHI

Whole Body X-ray CT System

REF

SCENARIO View

SYSTEM SN V0018

SN

GXX1247627



2018-01

MAINS VOLTAGE: 380/400V 3~

FREQ: 50/60Hz

INPUT: 100kVA



Hitachi, Ltd.

MADE IN JAPAN


2-16-1, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0015, Japan A42592NB

(01-12)




(01)04580292760864(11)181119(23)V0000(250)GXX1234567

1. Устройство сканирующее в составе:
- гентри;

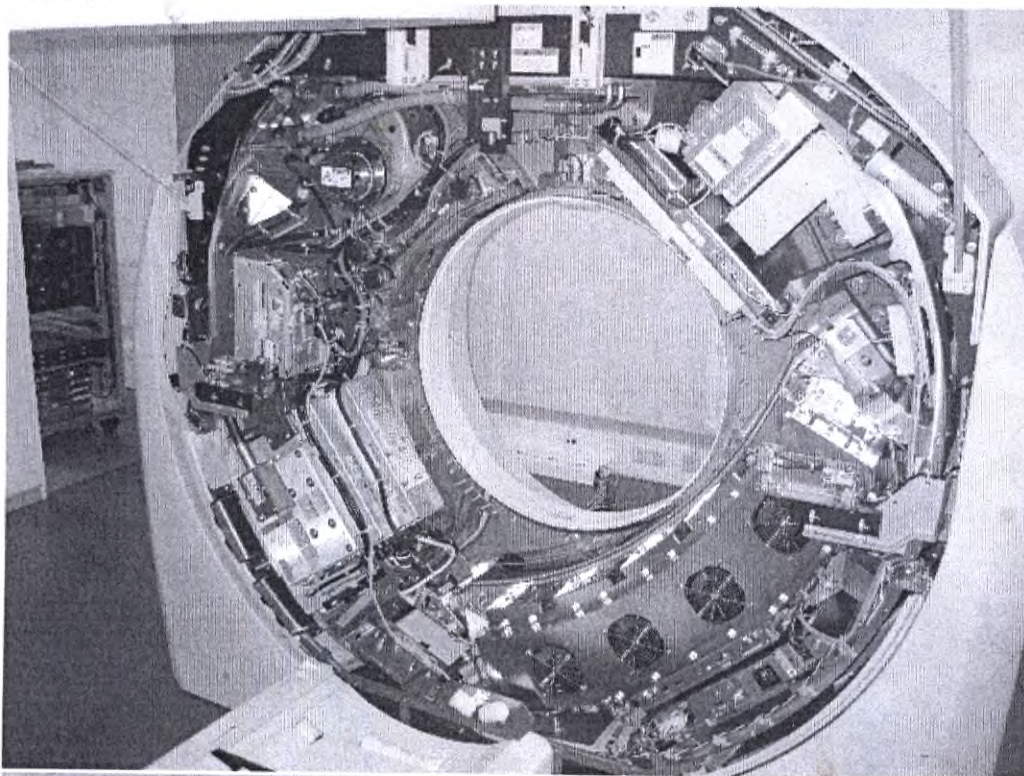


- генератор;


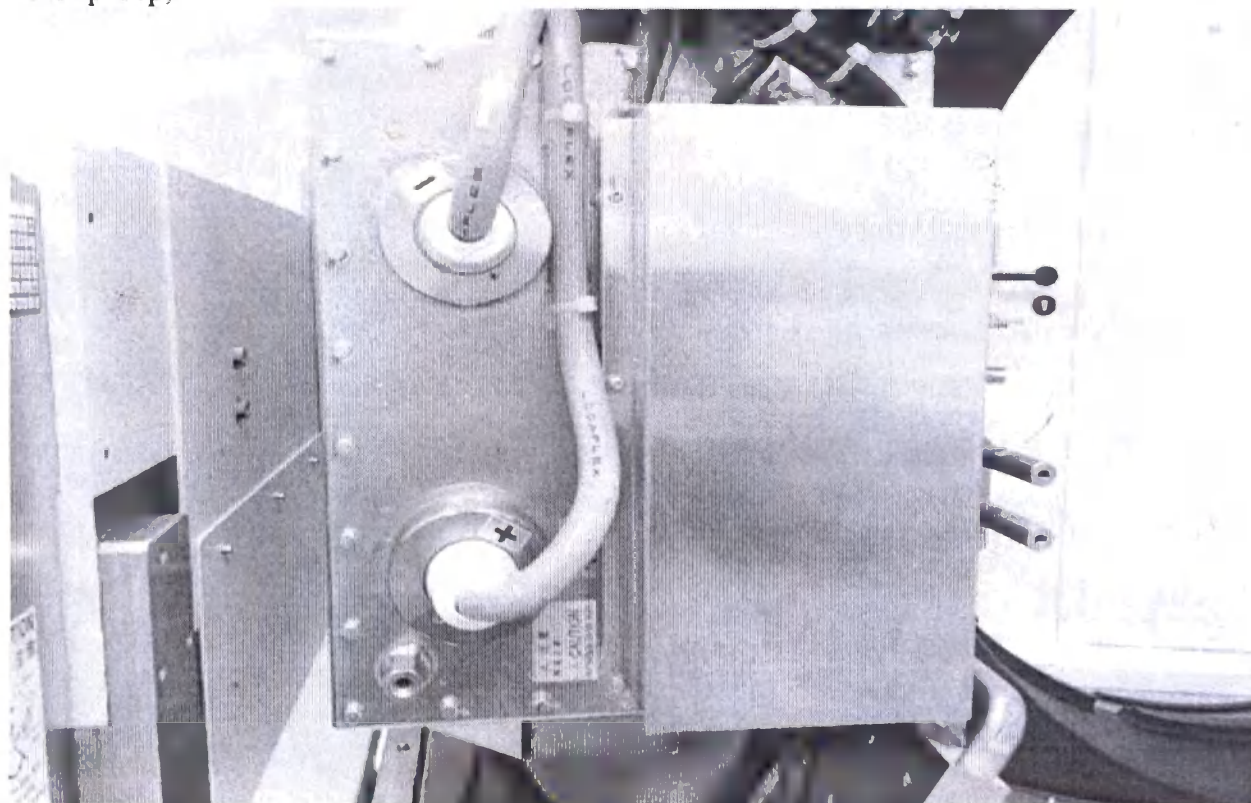





- блок твердотельных детекторов.

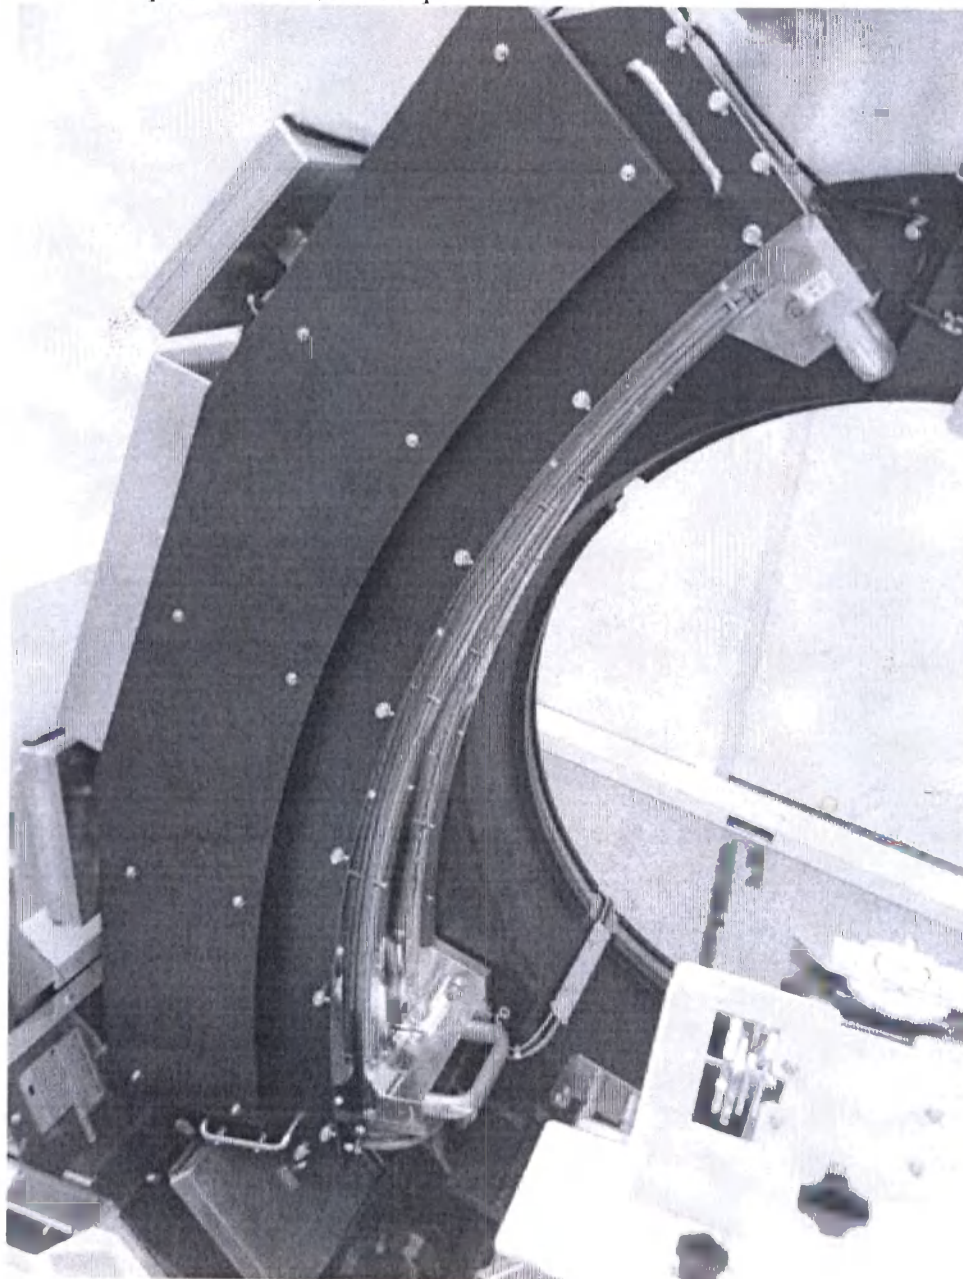

2. Стол пациента.

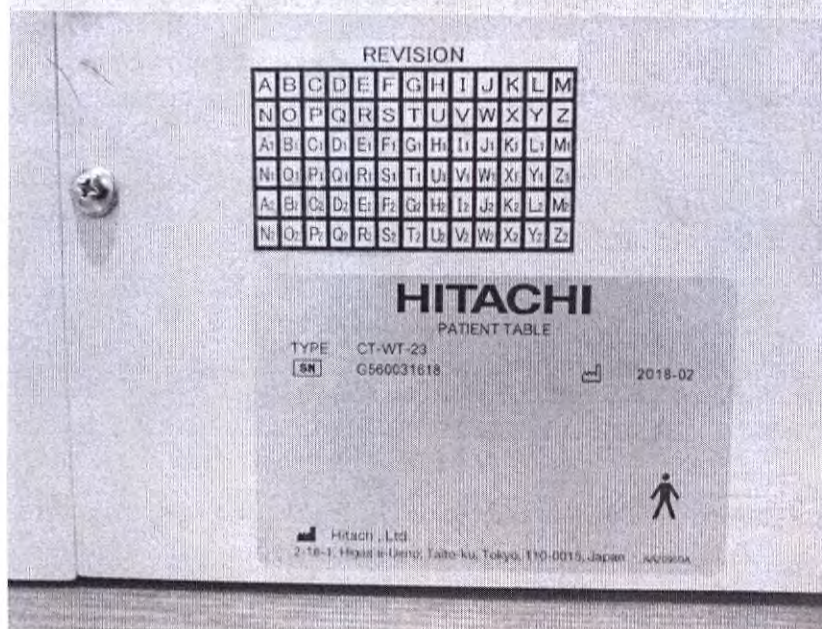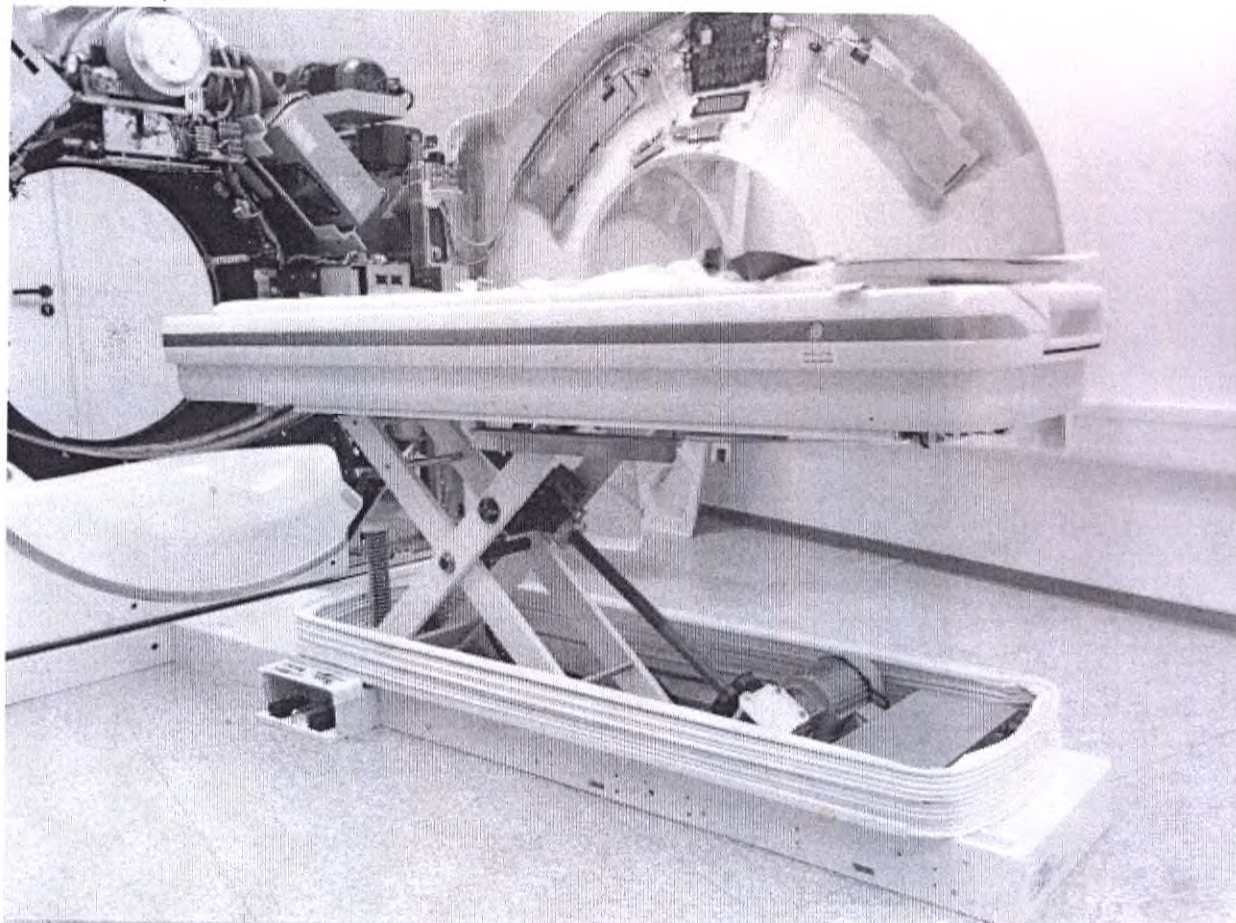

3. Педальный ножной переключатель.

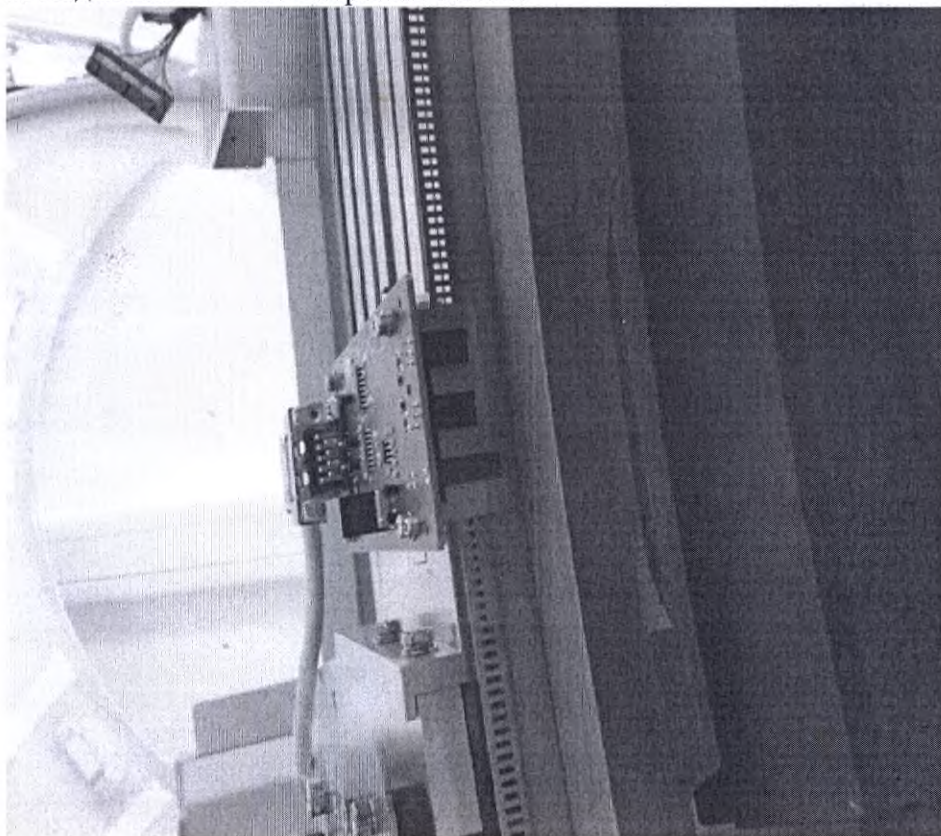


4. Консоль оператора.
- центральный процессор;




- монитор широкоформатный;




- блок управления;

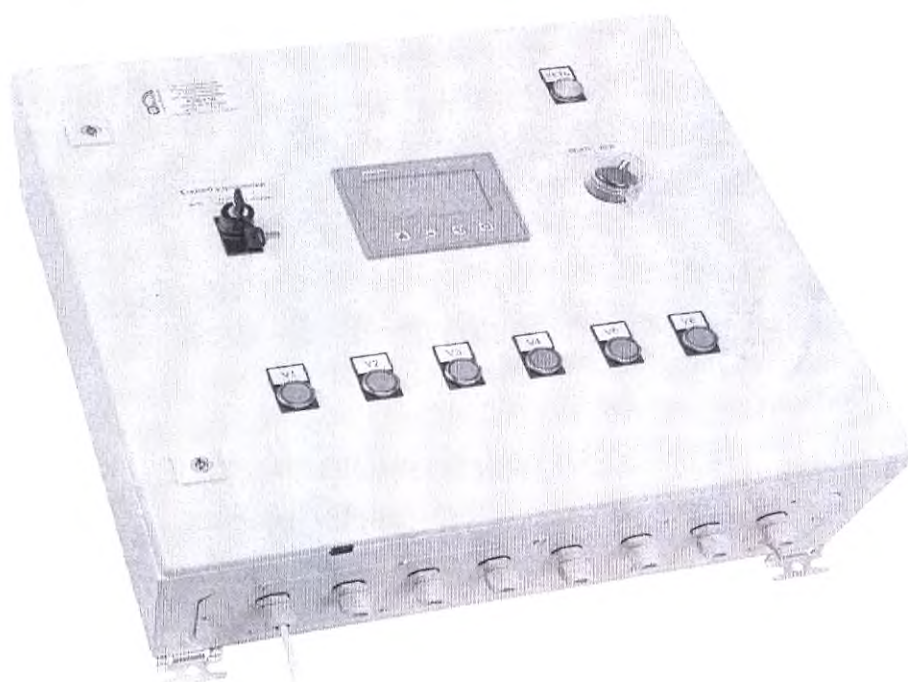


6. Программа контроля рентгеновского излучения.

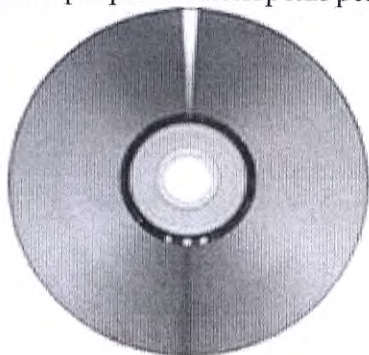


7. Программное обеспечение для архивирования и связи в стандарте DICOM.

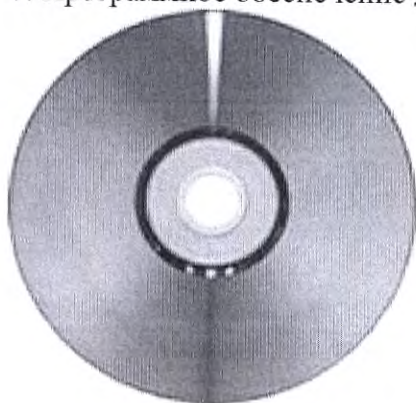


8. Программное обеспечение для передачи данных на устройство печати медицинских изображений в стандарте DICOM.

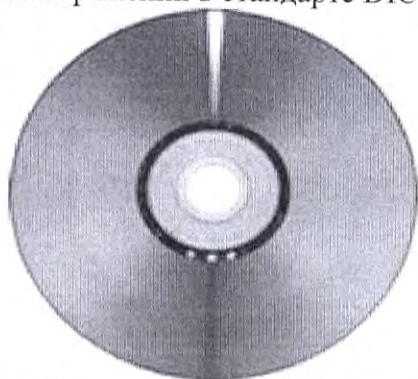


9. Программное обеспечение для построения изображения полых органов.

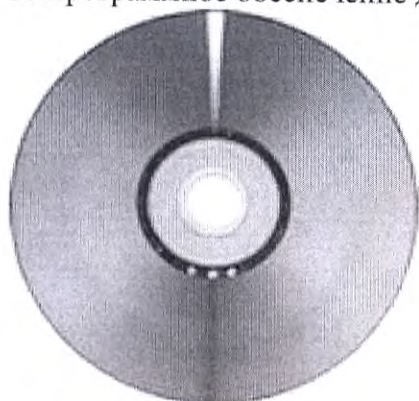


10. Программное обеспечение для получения копий на DVD и CD.

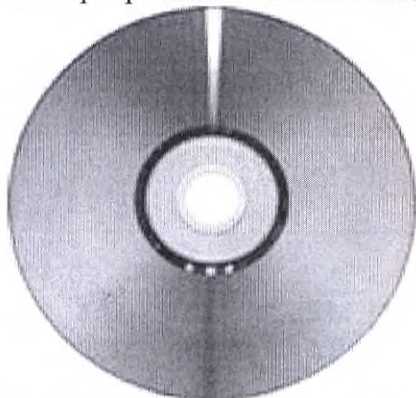


11. Устройство оповещения пациента (громкоговоритель).

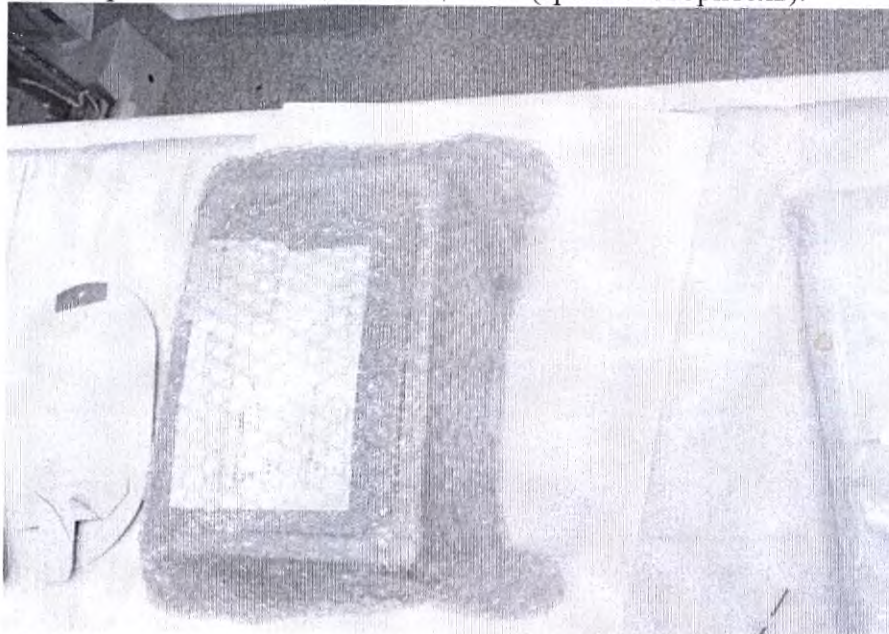


12. Жесткие диски для записи исходных изображений и данных.

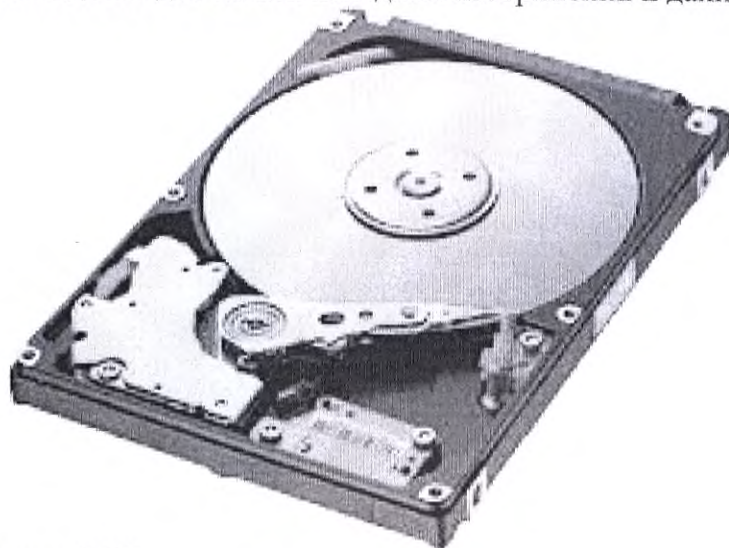

13. Дисковод DVD.

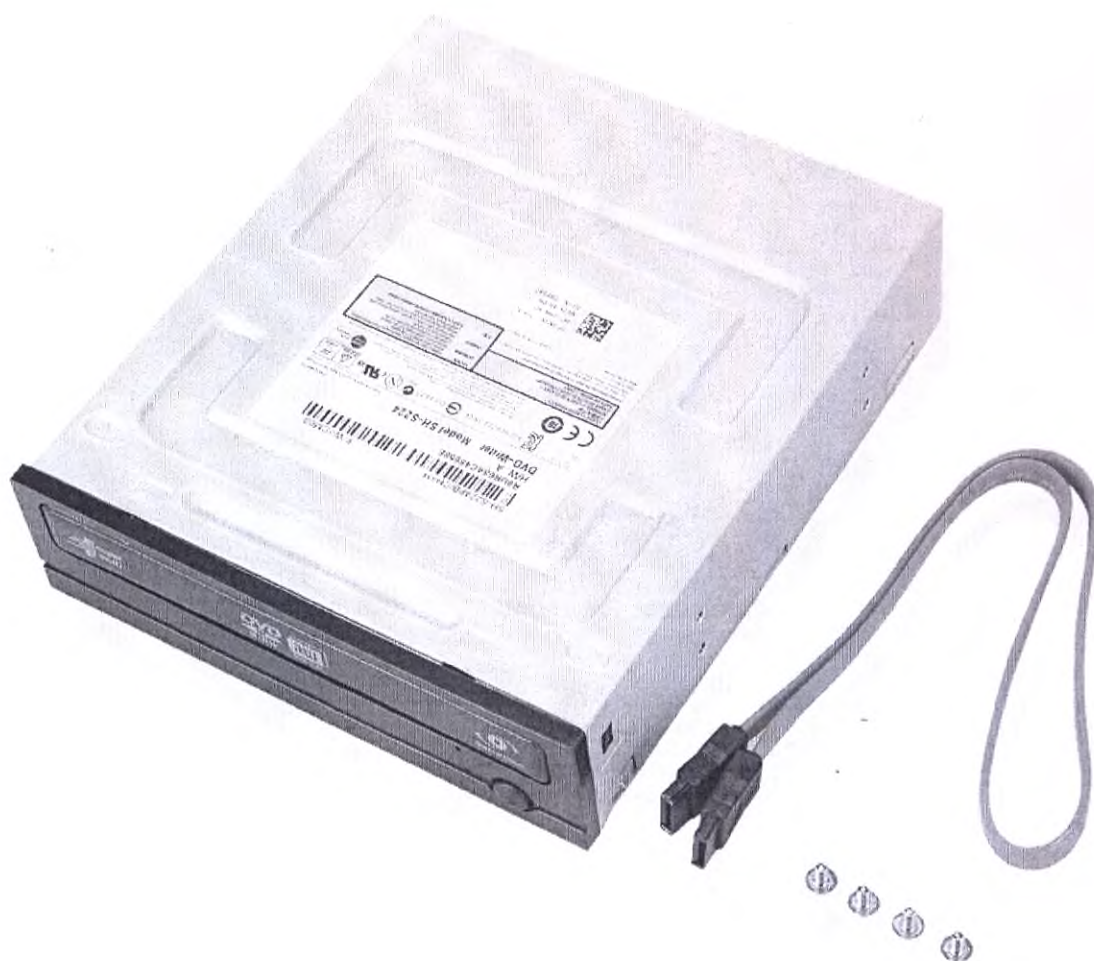


14. Инструкция по эксплуатации.

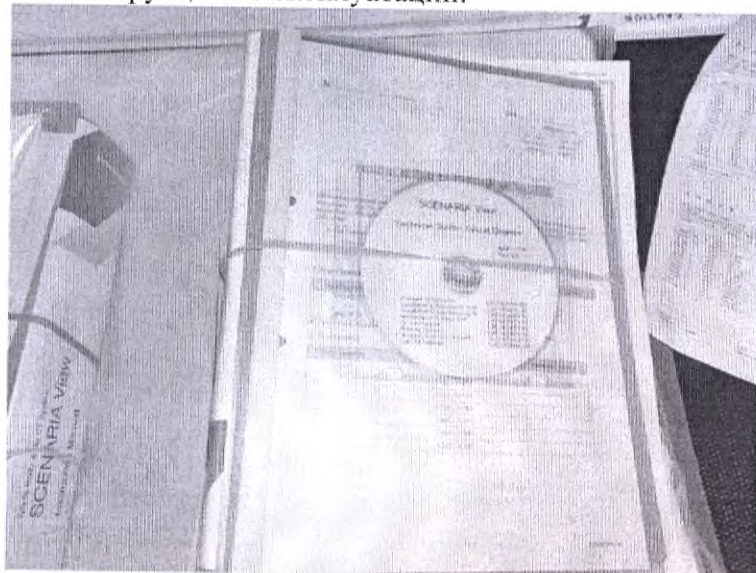


Принадлежности:


1. Программное обеспечение для предсказывающего сканирования для определения начала сканирования с контрастом.

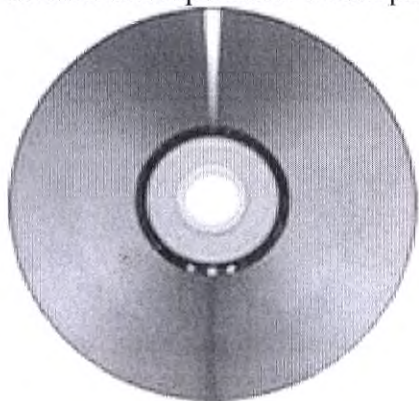


2. Программное обеспечение для дентальных исследований.

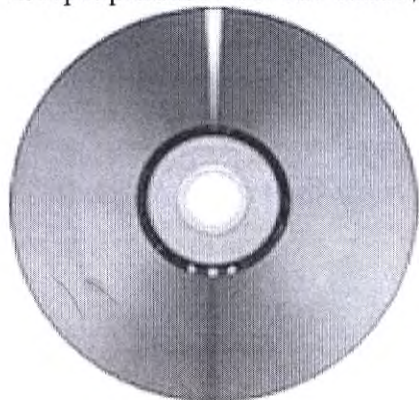


3. Программное обеспечение с 3-х мерной визуализацией для ПК пользователей.

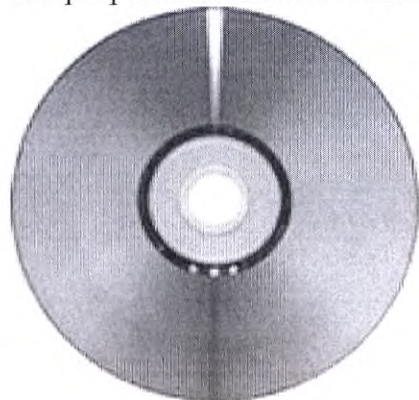


4. Программное обеспечение с 3-х мерной визуализацией для дополнительного ПК пользователя.

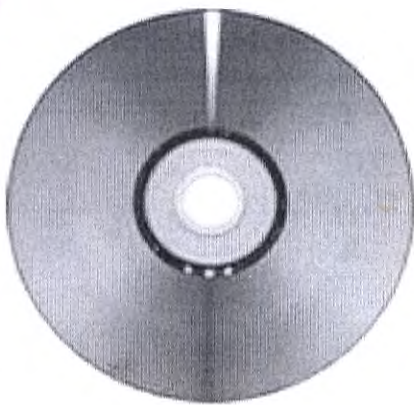


5. Лицензия для программного обеспечения с 3-х мерной визуализацией для дополнительного ПК пользователя.

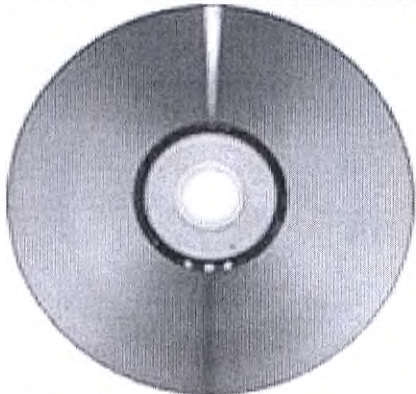


6. Программное обеспечение для построения изображения по перфузии.

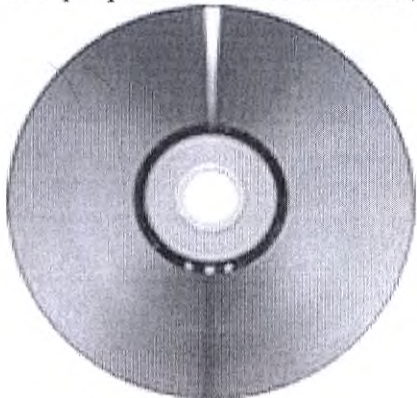


7. Программное обеспечение для работы в сети, включая MWM.

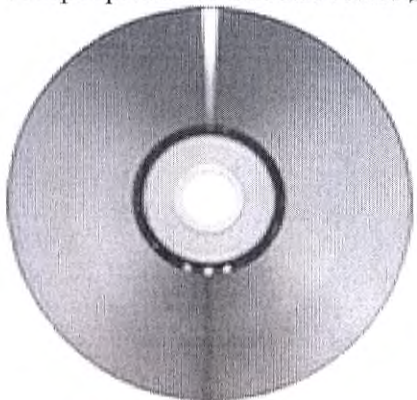


8. Программное обеспечение для передачи данных на лазерную камеру в стандарте DICOM.

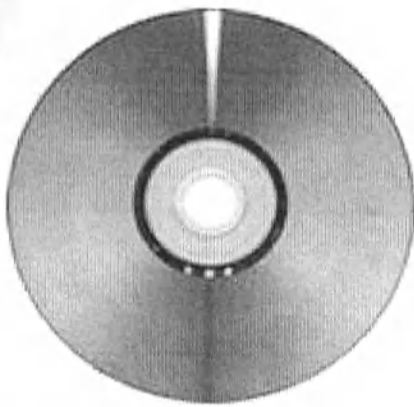


8. Программное обеспечение для дифференцирования жировых тканей.

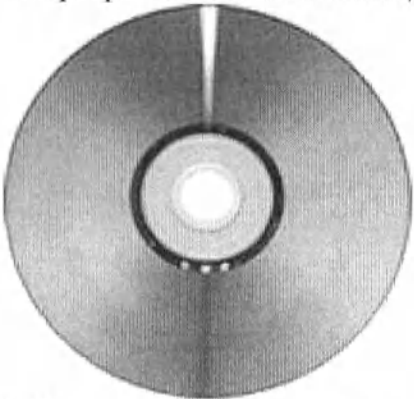


9. Программное обеспечение для исследования и диагностики легочной системы.

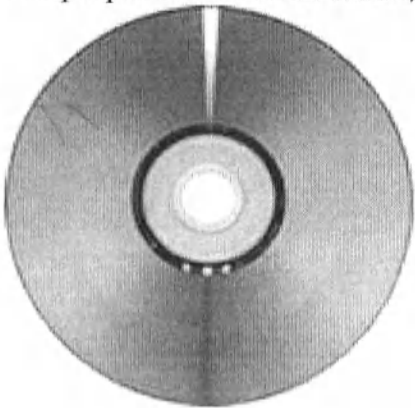


10. Программное обеспечения для кардиологии.

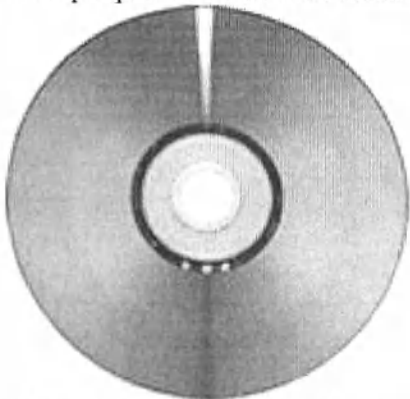


11. Дополнительная рабочая станция для обработки изображений.

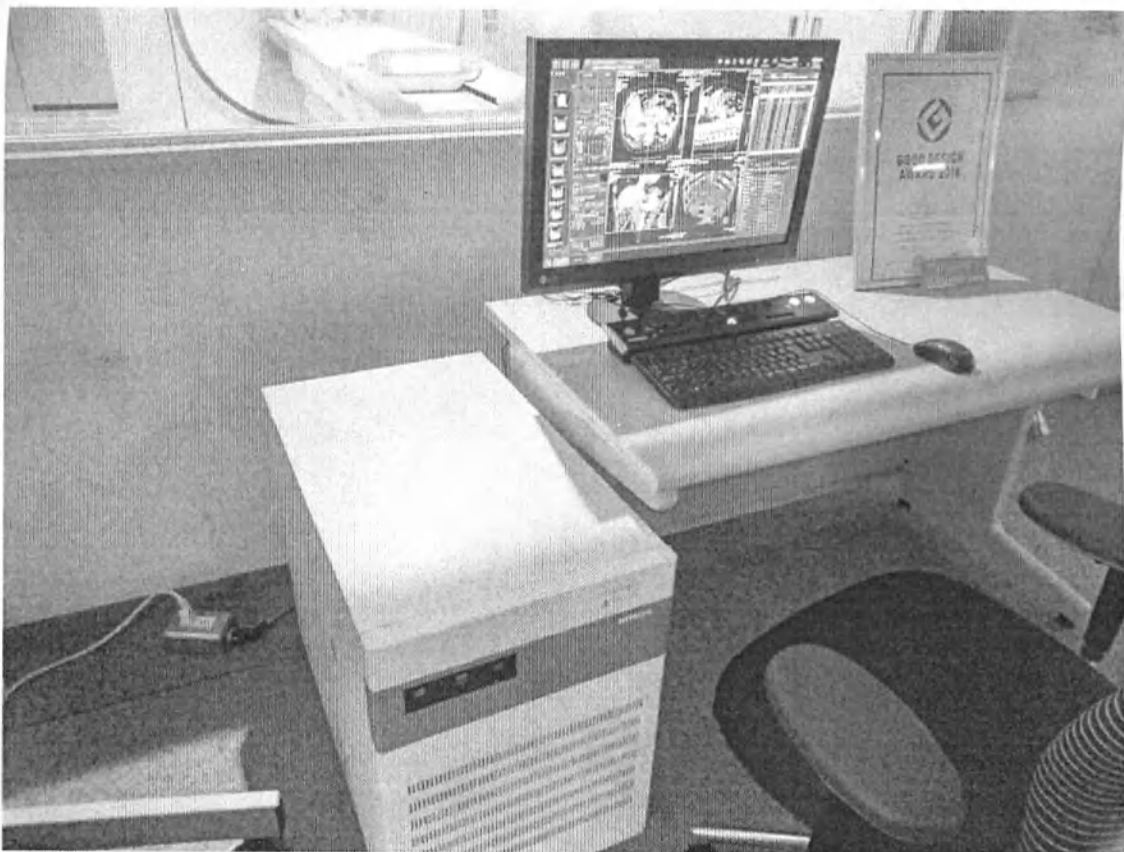


12. Радиологическая информационная система на основе использования протокола передачи изображений Dicom 3.0.

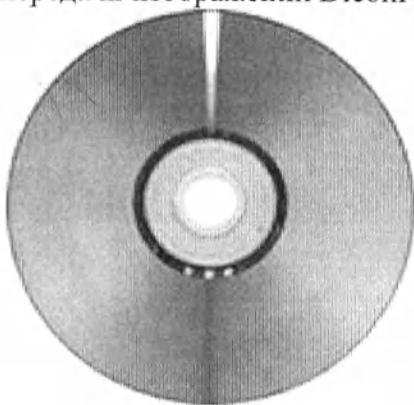


13. Платы приема и обработки информации для консоли оператора от 1 до 15 шт.

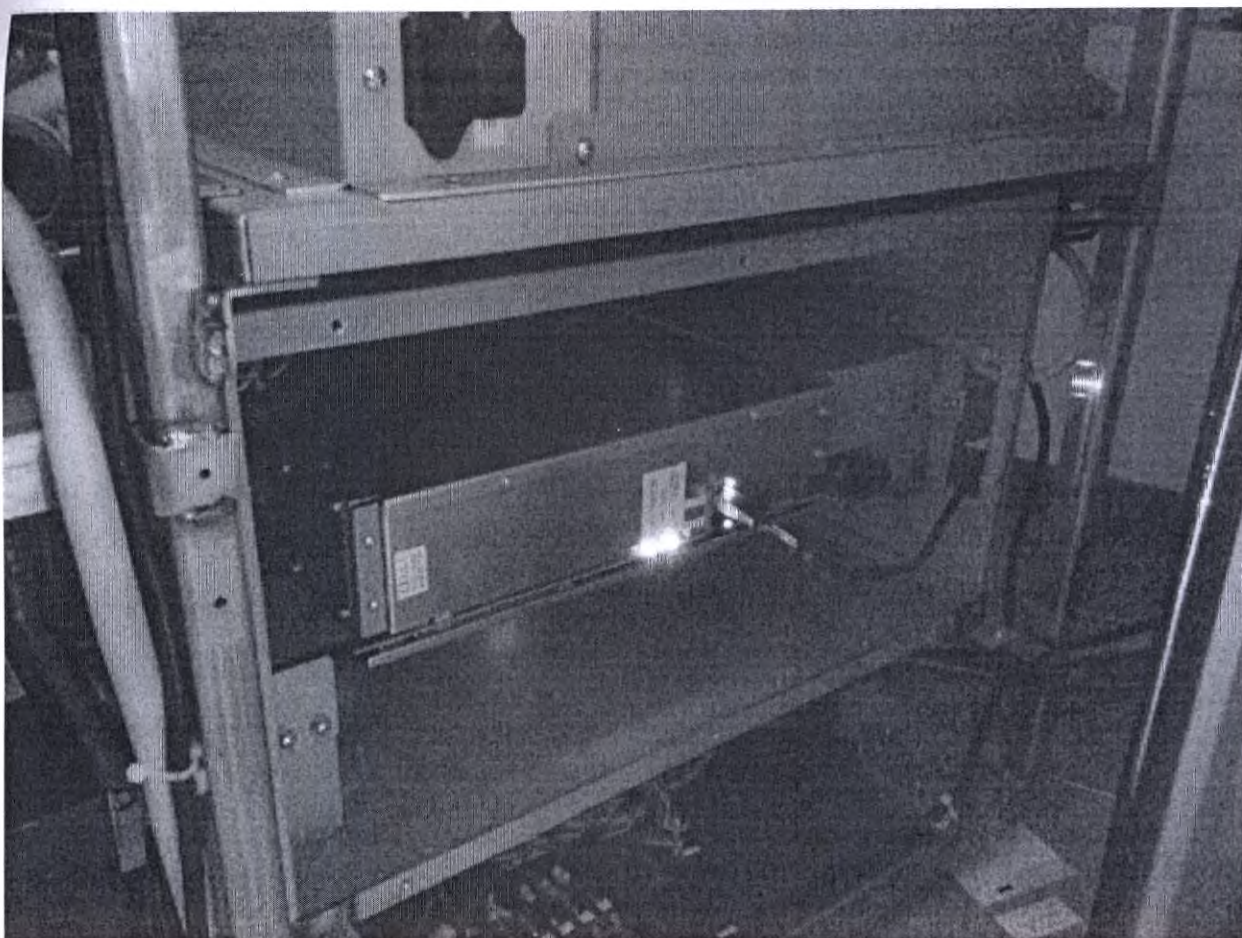


14. Платы управления сбора и передачи данных для гентри от 1 до 5 шт.

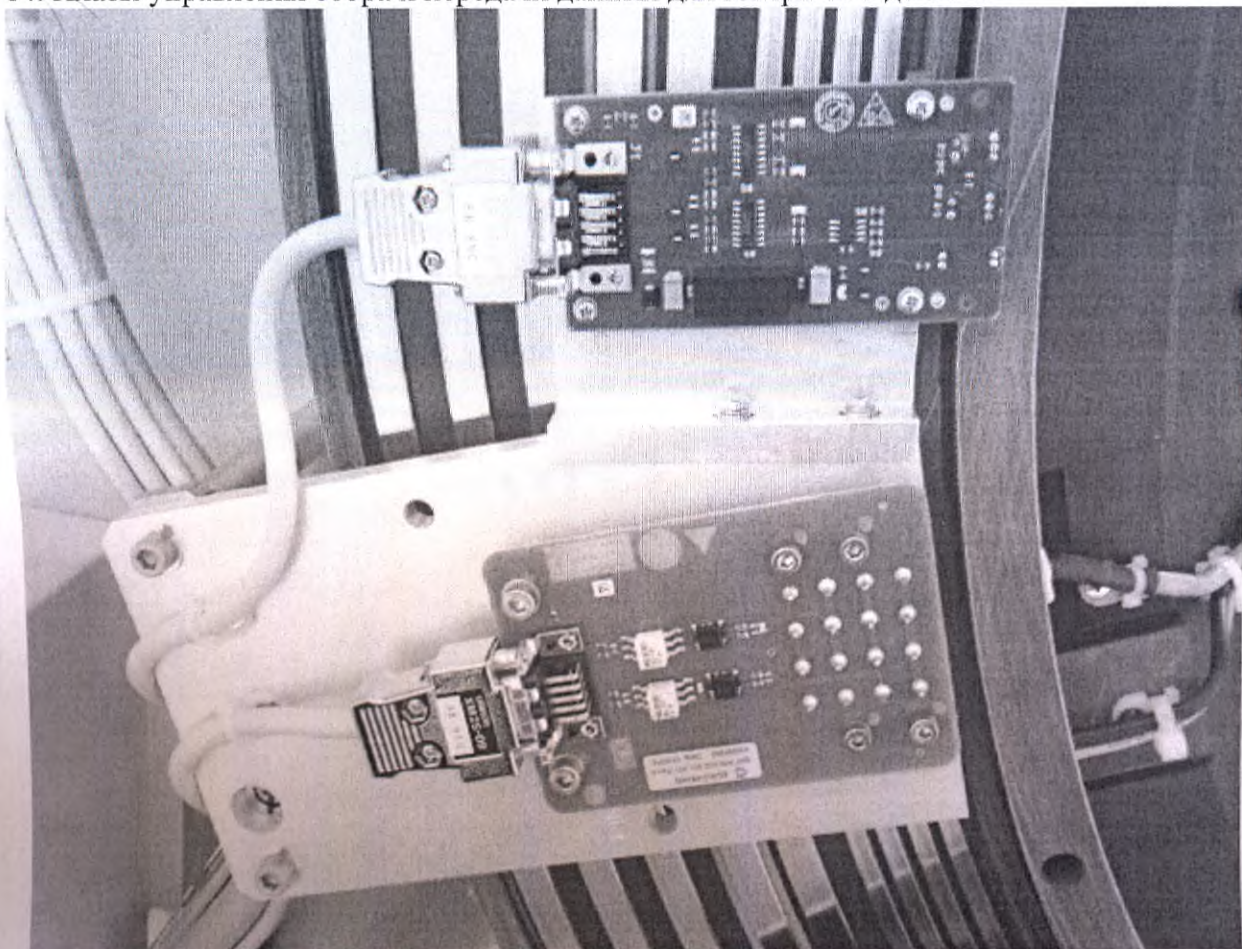


15. Плата управления столом пациента.

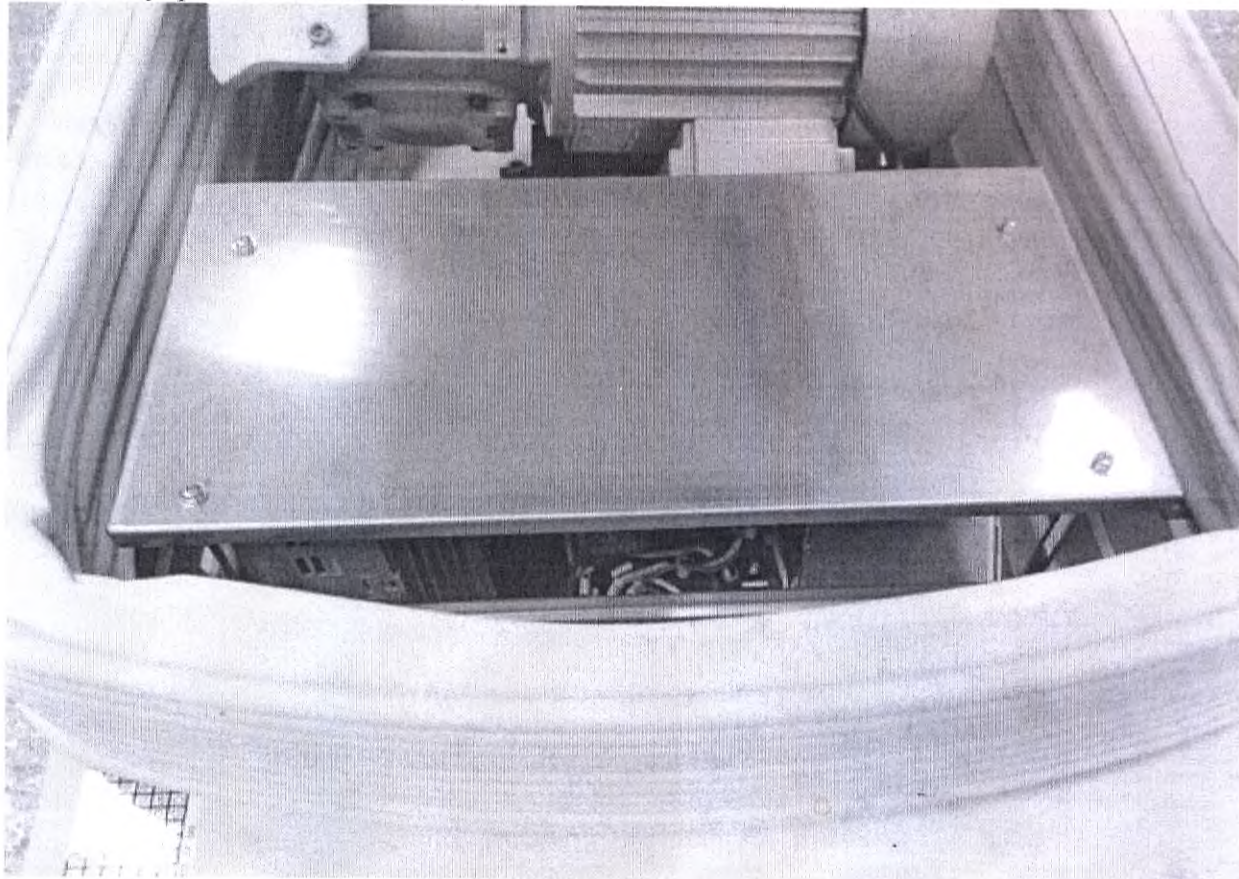


16. Плата управления блоком детекторов.

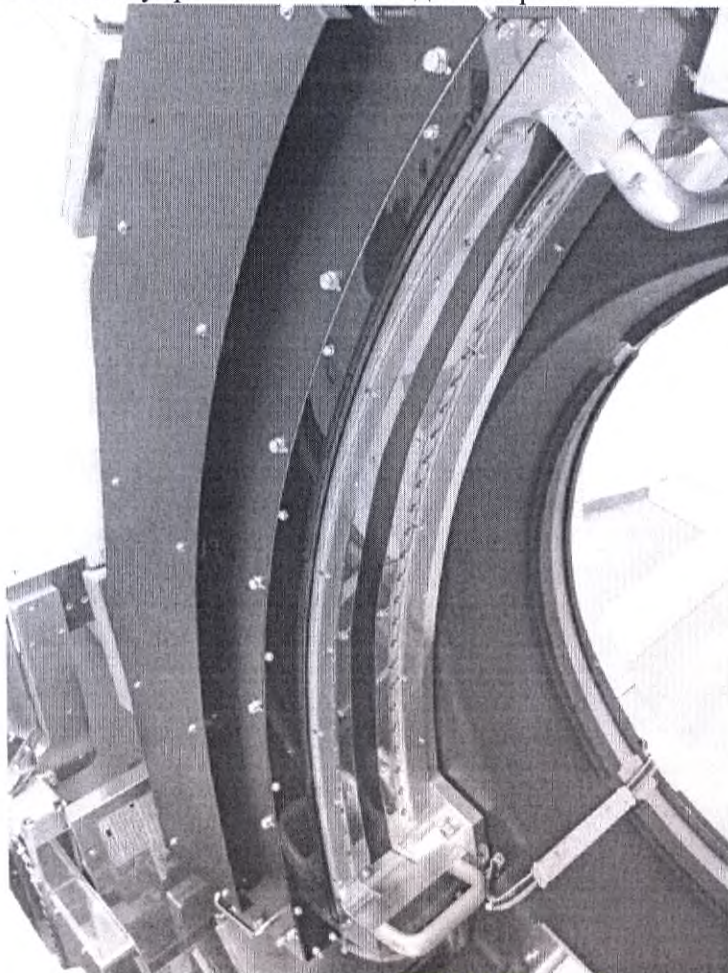


17. Плата управления высоковольтным генератором.

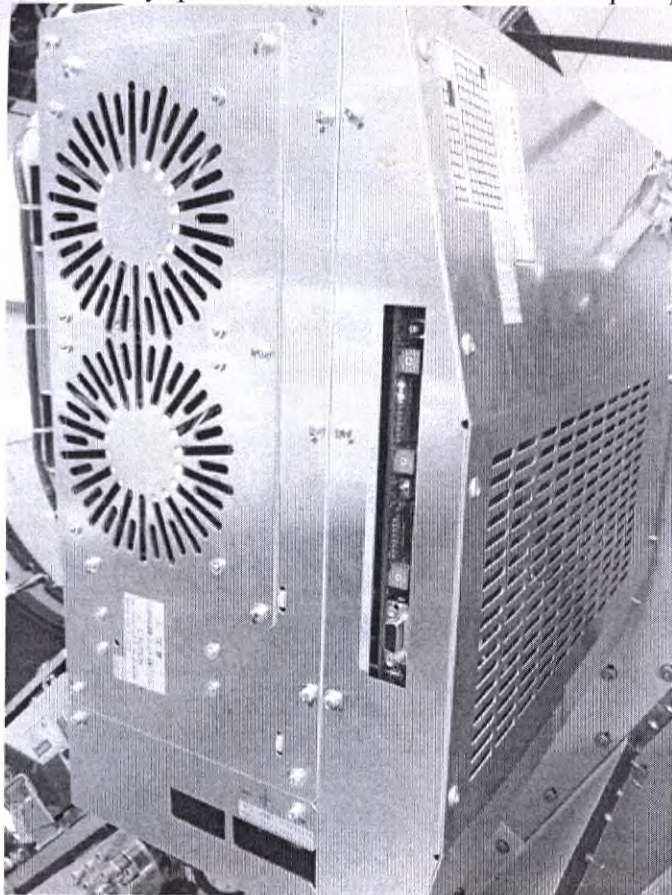


18. Оптические узлы для канала передачи данных в гентри от 1 до 20 шт.

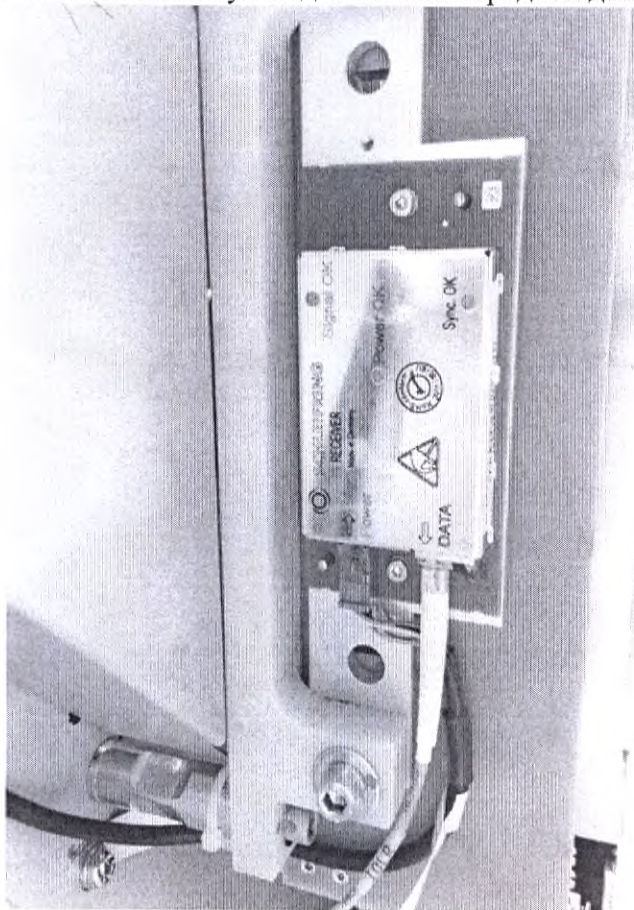


19. Декодер вращения трубки в гентри.

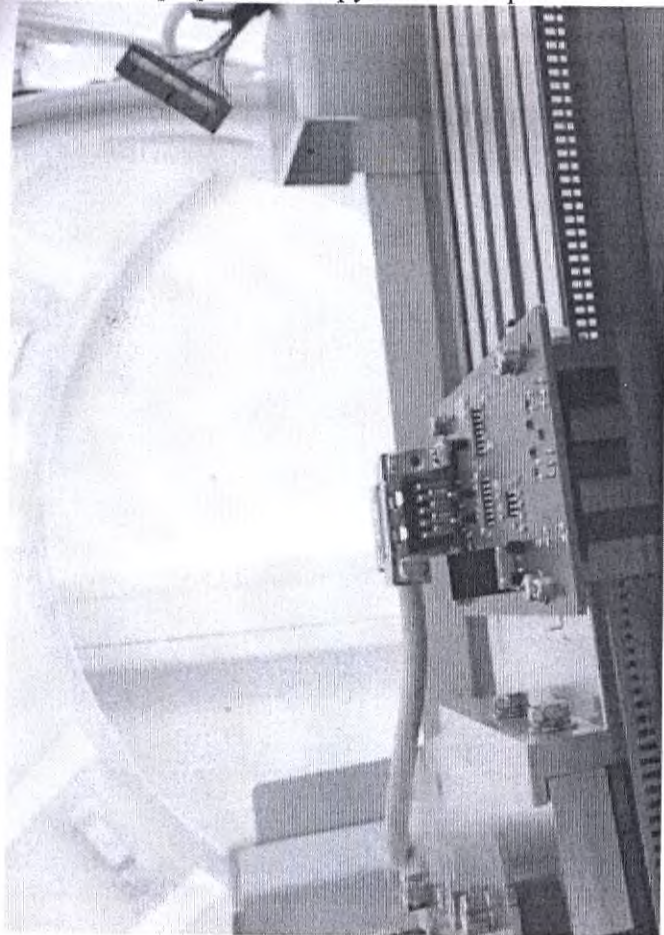


20. Фотосенсор гентри.

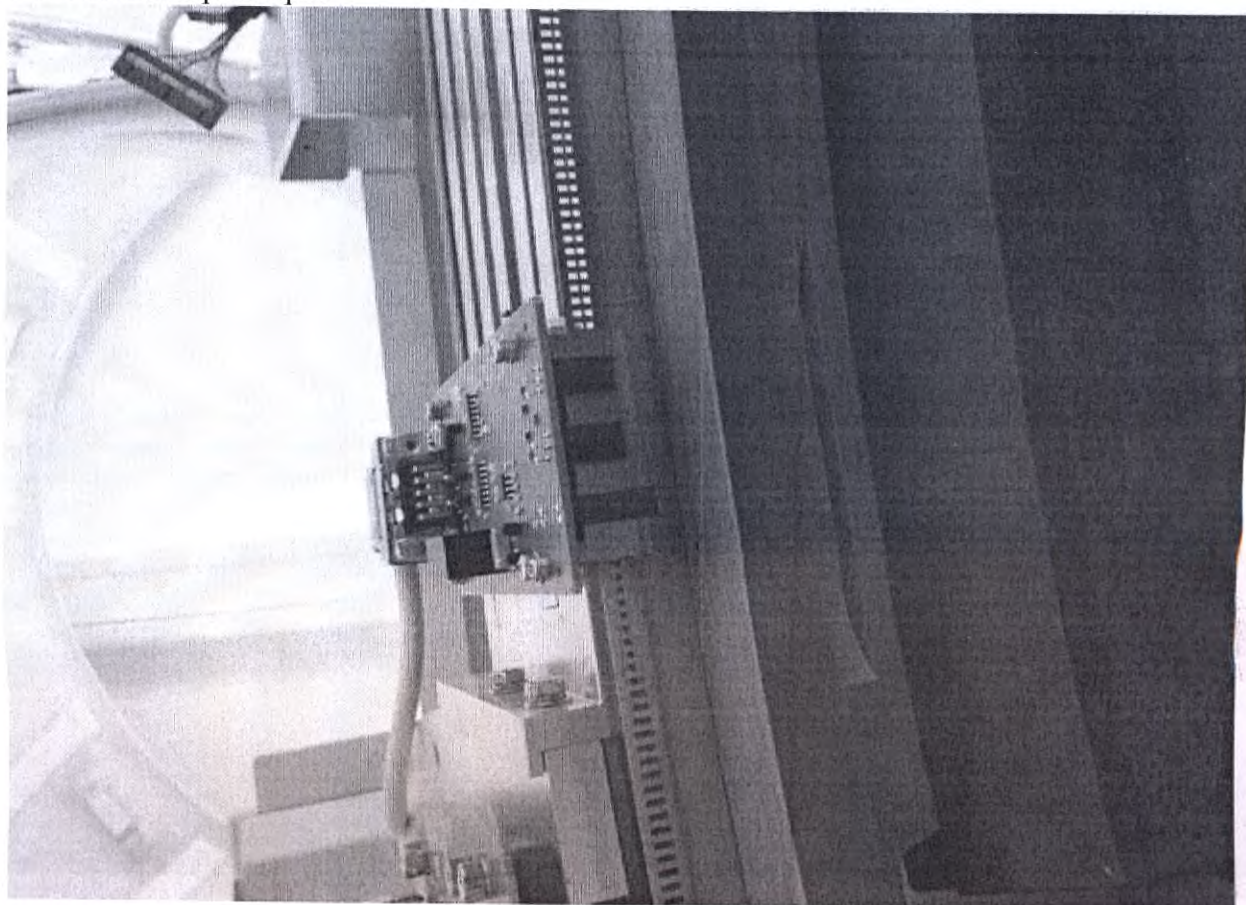

21. Блок питания гентри.

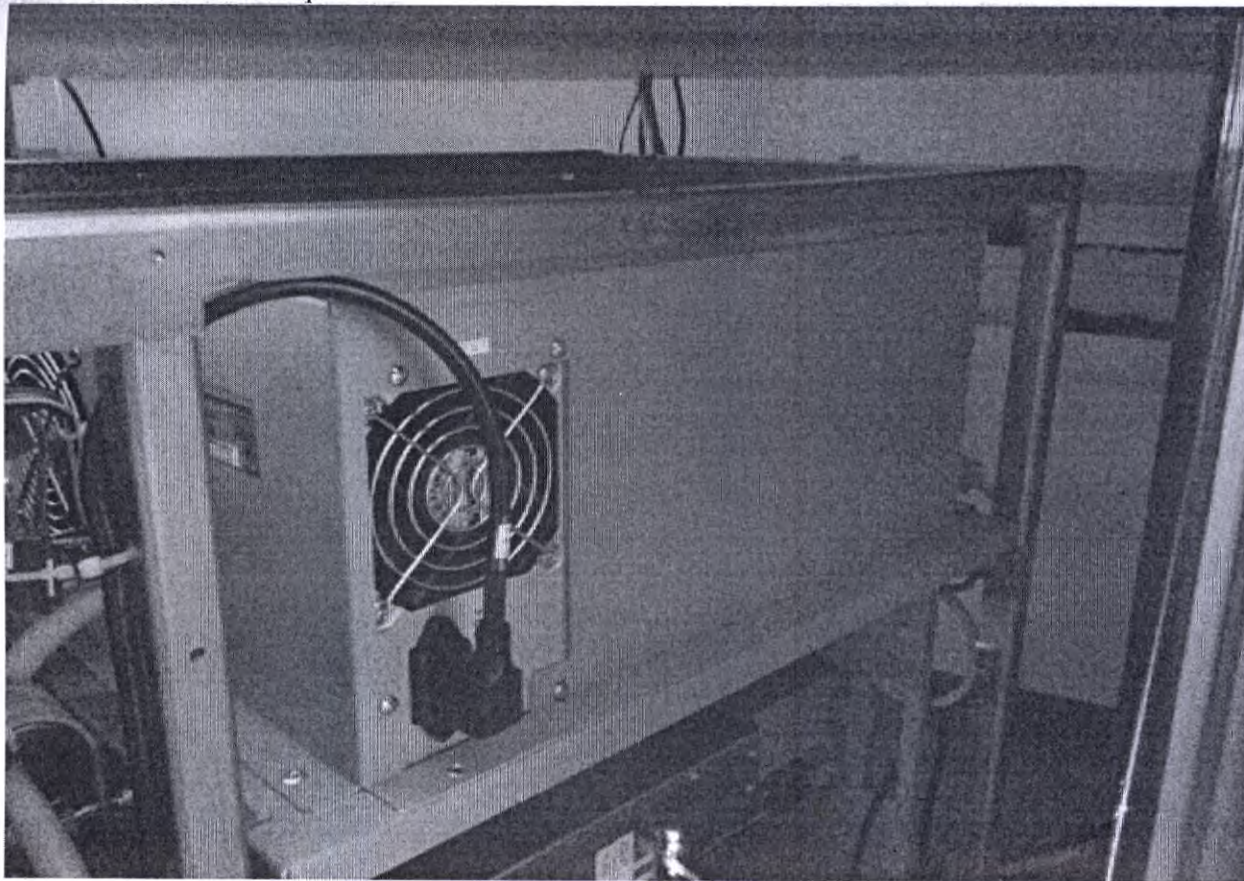


22. Устройство для фиксации ребенка (кювета с ремнями).

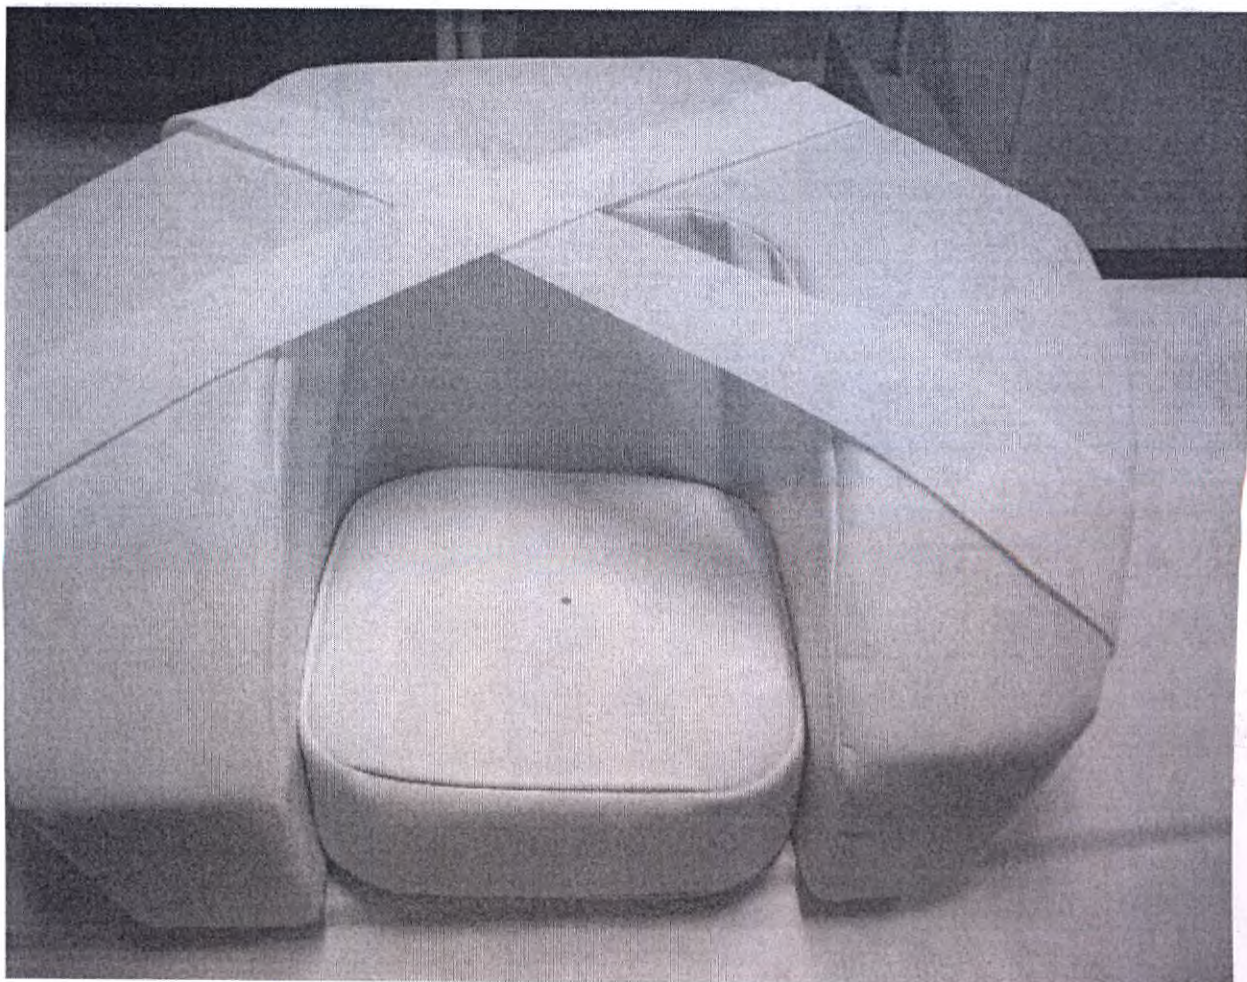


23. Набор фиксирующих лент:

- фиксирующая лента для подбородка 1 комплект;

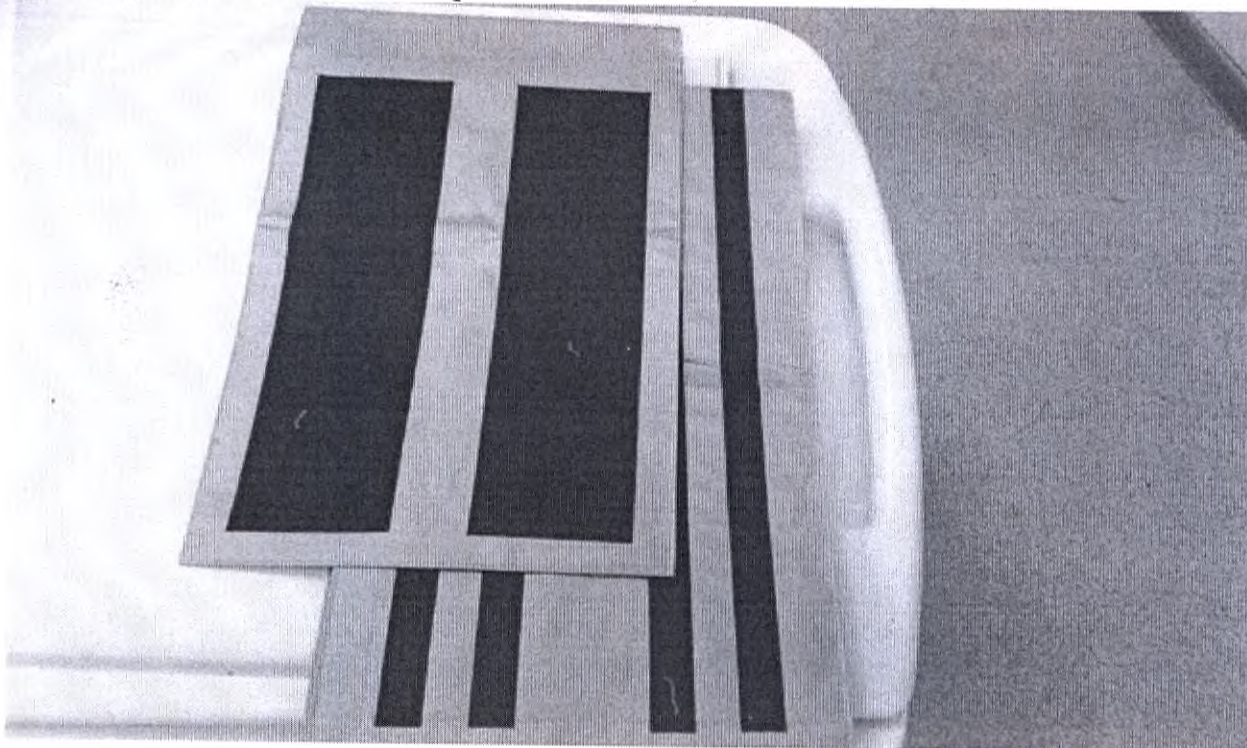

- фиксирующая лента для головы 1 комплект;

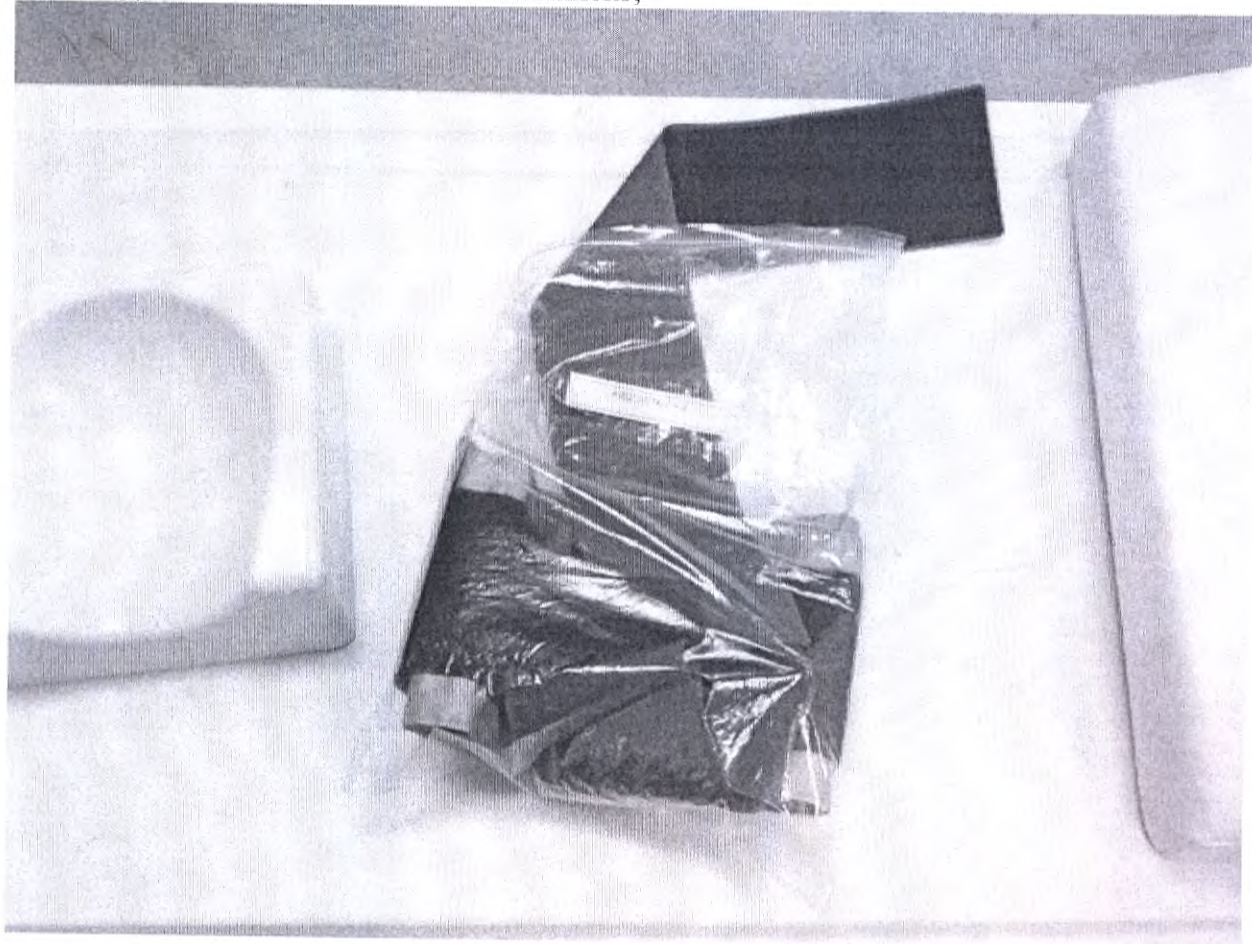

- фиксирующая лента для рук 1 комплект.




25. Подлокотник для внутреннего введения контраста.



26. Подголовник.



27. Держатель подголовника.

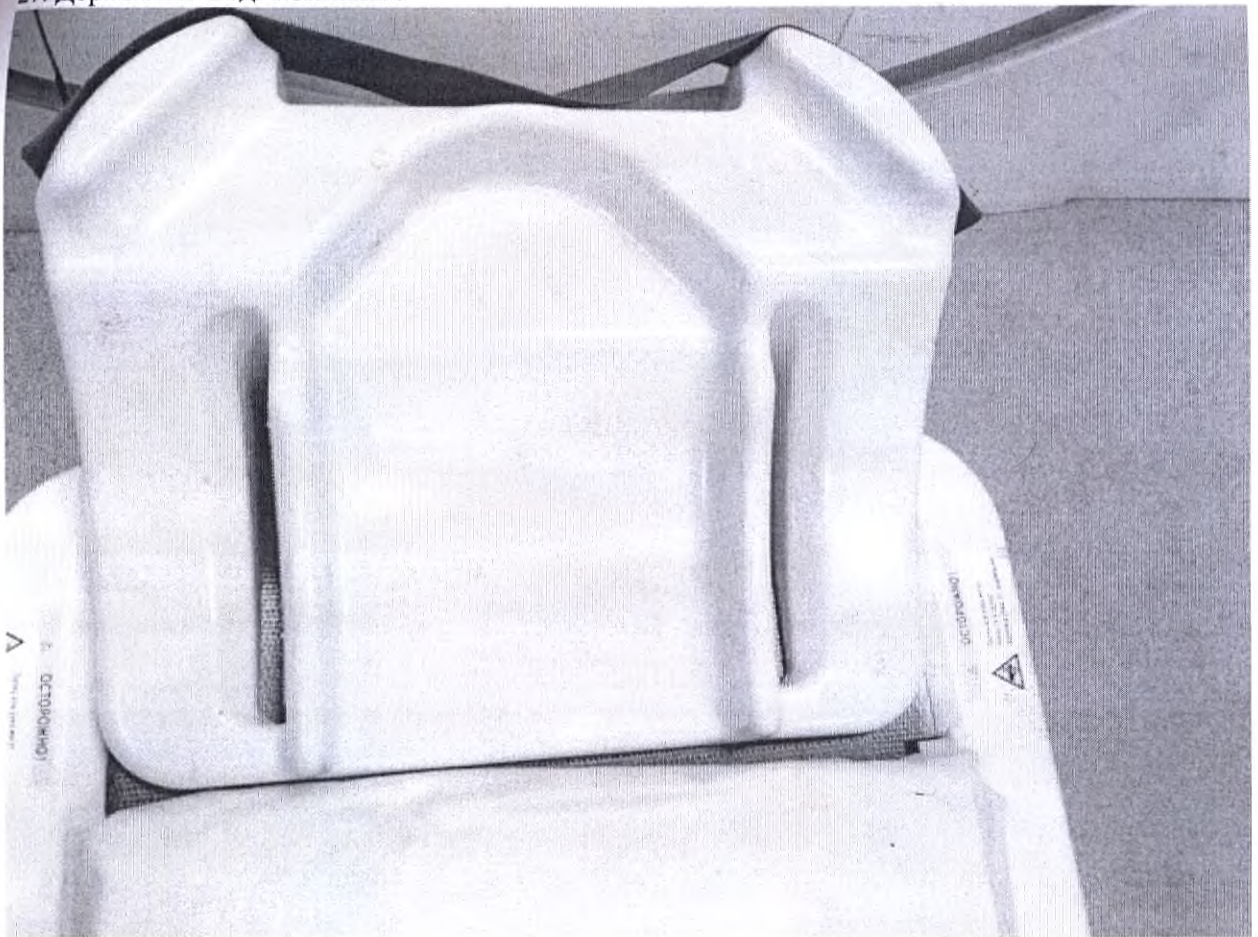


28. Треугольная подставка под колени.




29. Матрас пациента.




30. Защитное стекло.

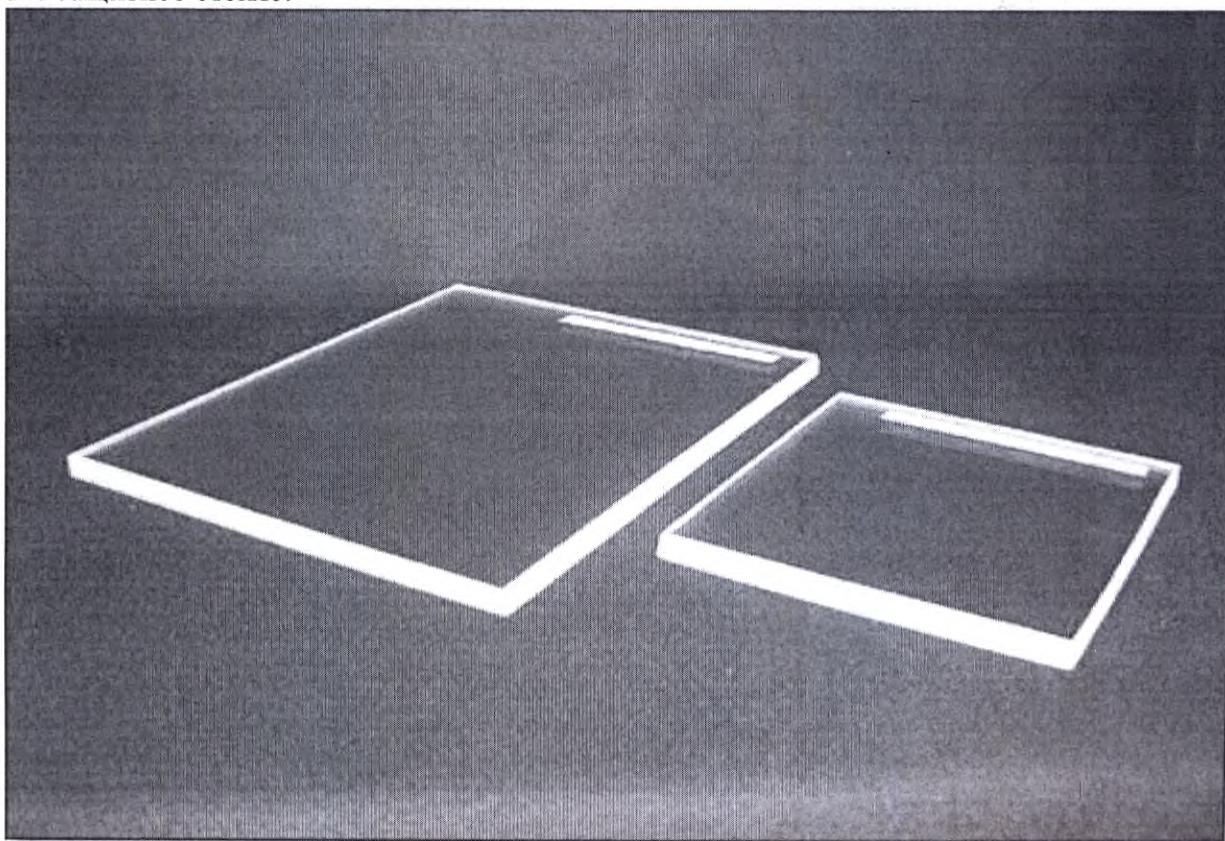

31. Устройство для печати медицинских изображений

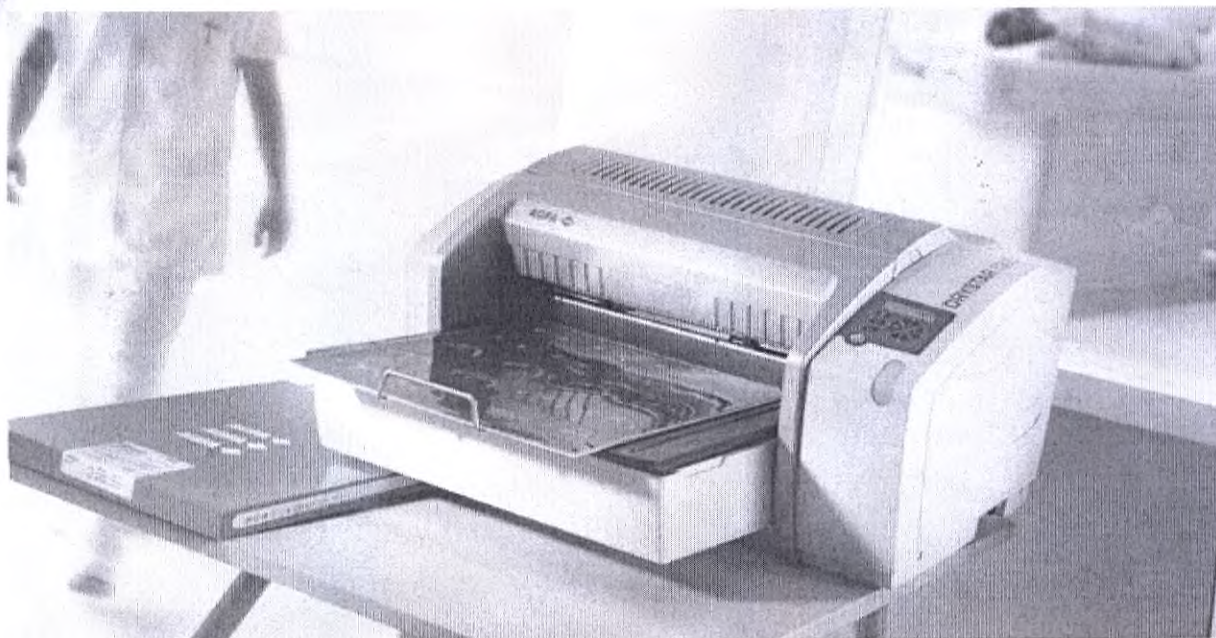


32. Пленка для печати медицинских изображений от 1 до 10 коробок (количество пленки в одной коробке 100 или 125 шт.).

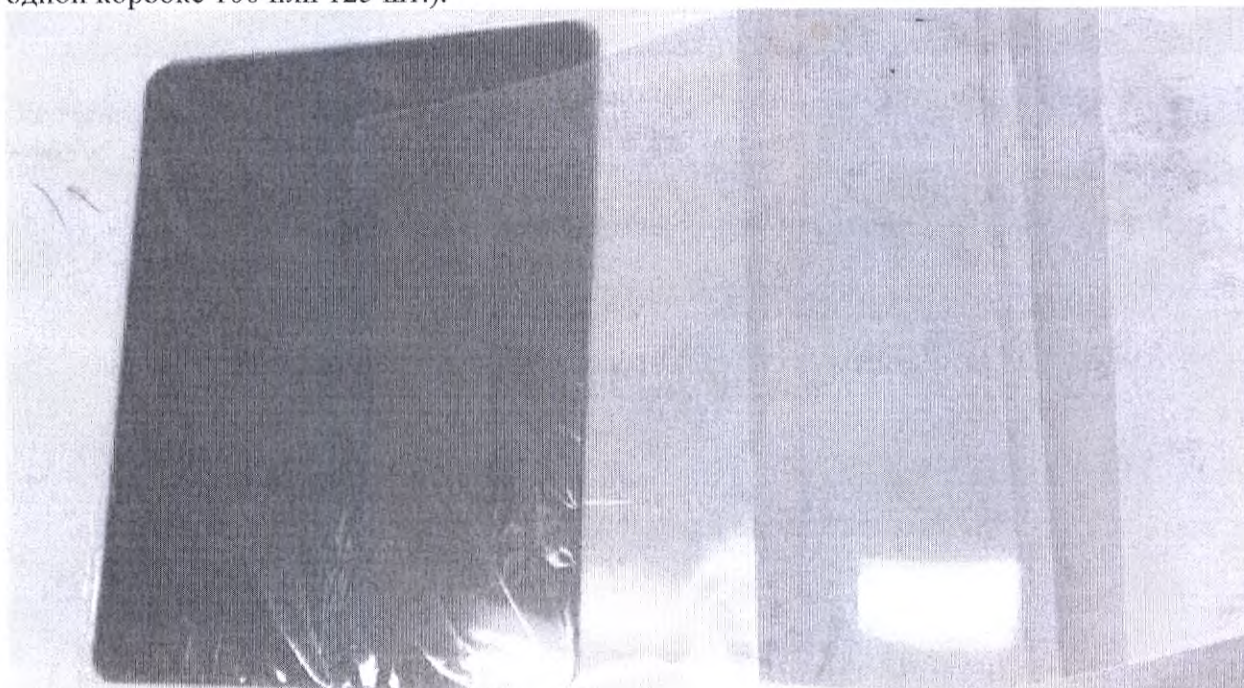

34. Устройства для калибровки (настройки) компьютерного томографа.




35. Набор для проведения денситометрии:
- фантом;

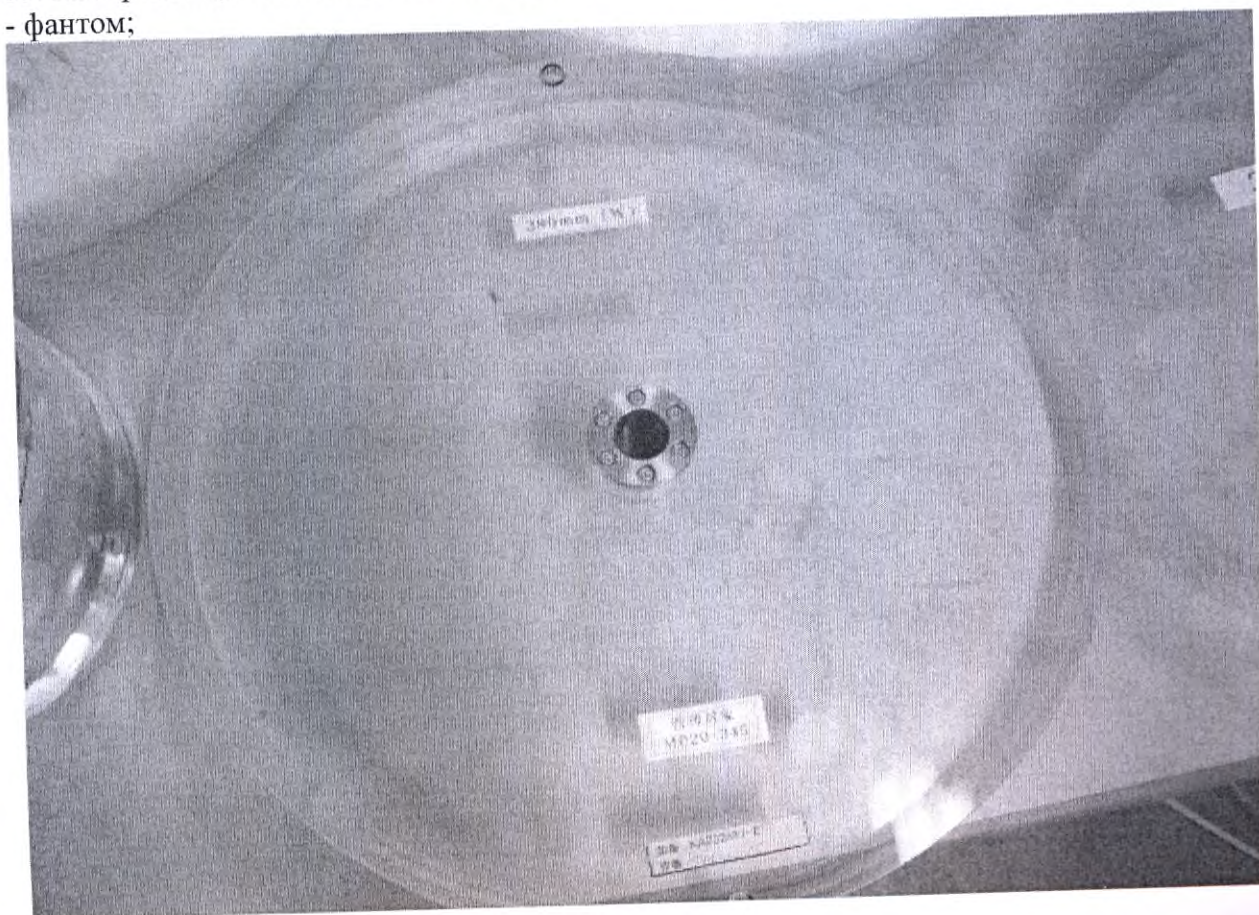

- матрасик;




- программное обеспечение.

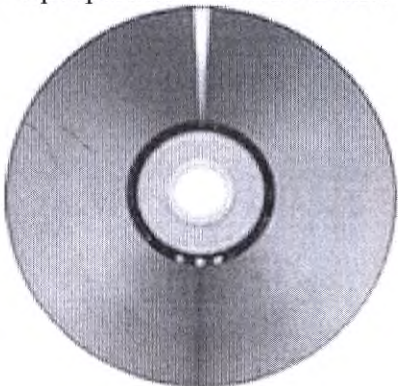


36. Набор для монтажа компьютерного томографа




37. Понижающий трансформатор.

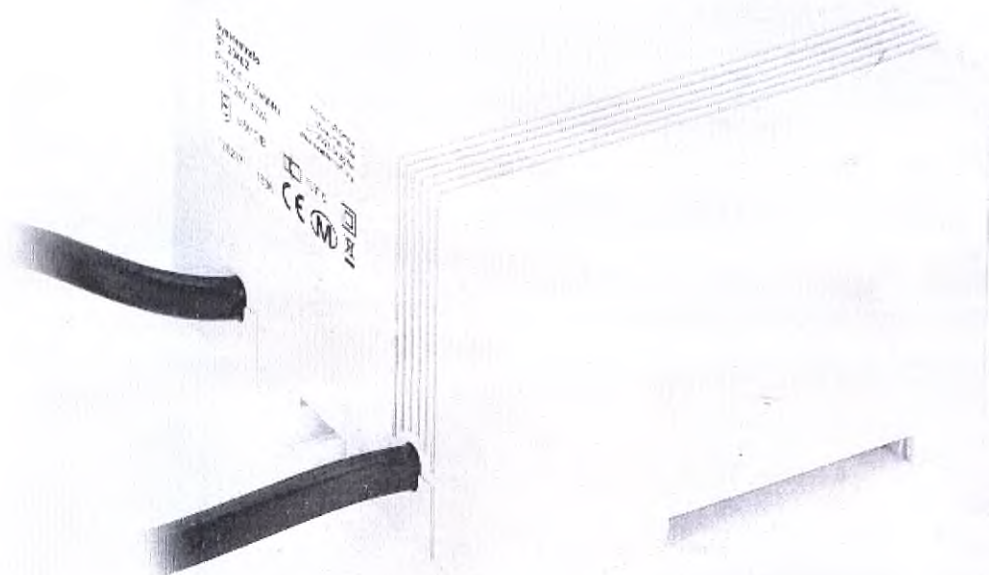

38. Высоковольтные преобразователи от 1 до 3 шт.

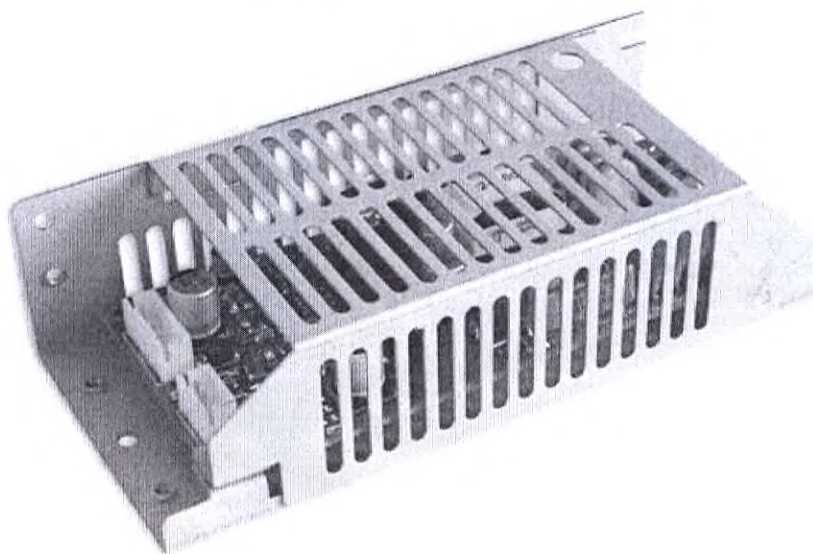

39. Источник бесперебойного питания.

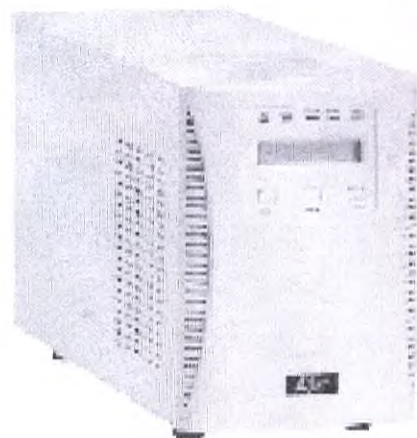

40. Тележки от 1 до 5 шт.





41. Балки транспортировочные от 1 до 4 шт.





ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Томограф компьютерный с принадлежностями, варианты исполнений
Общие виды:

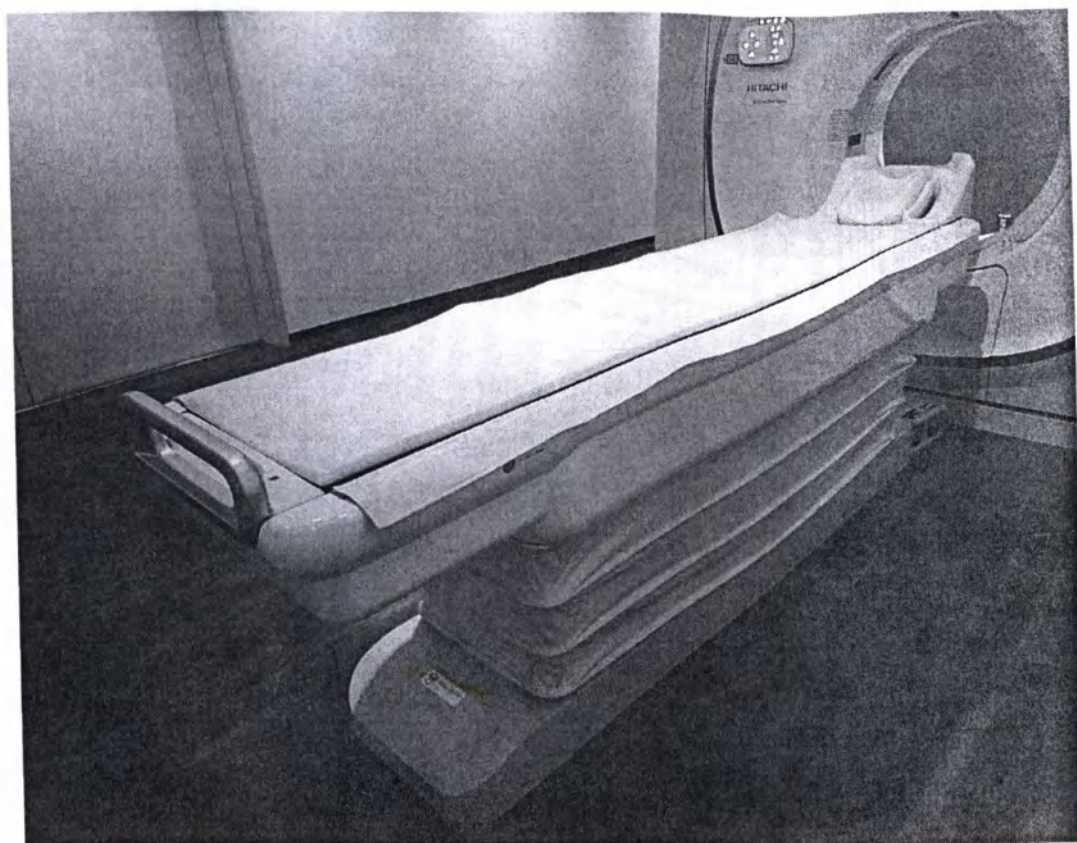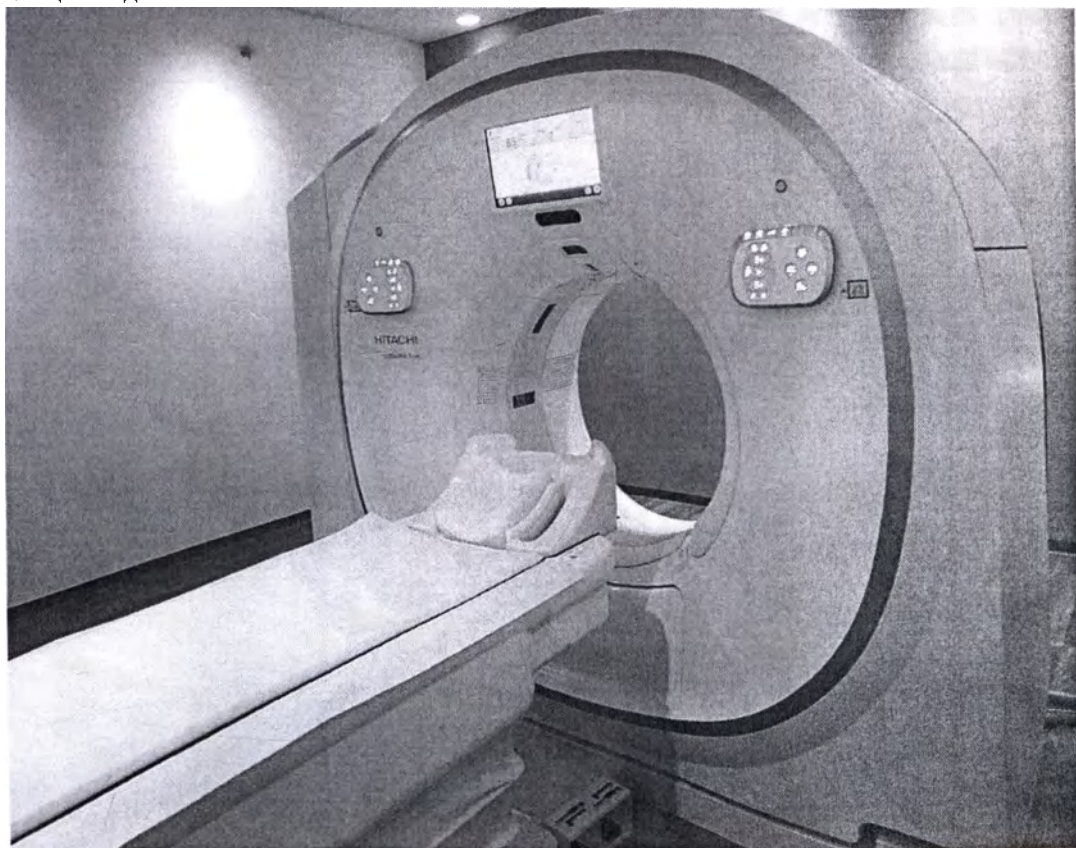



HITACHI

Whole Body X-ray CT System

REF

SCENARIO View

SYSTEM SN V0000

SN

GXX1234567



2018-11

MAINS VOLTAGE: 380/400V 3~

FREQ: 50/60Hz

INPUT: 100kVA



Hitachi, Ltd.

MADE IN JAPAN



2-16-1, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0015, Japan AA200248

001-126





(01)0458029276694(11)181119(21)V0000(250)GXX1234567



1. Устройство сканирующее в составе:
- гентри;

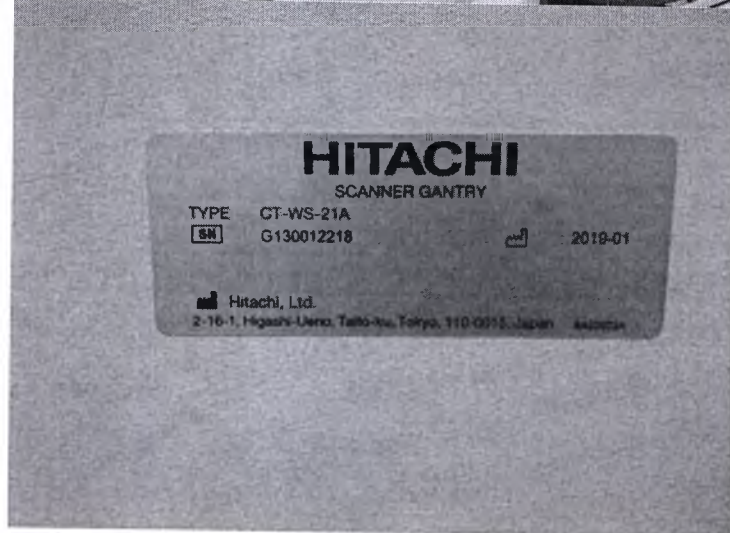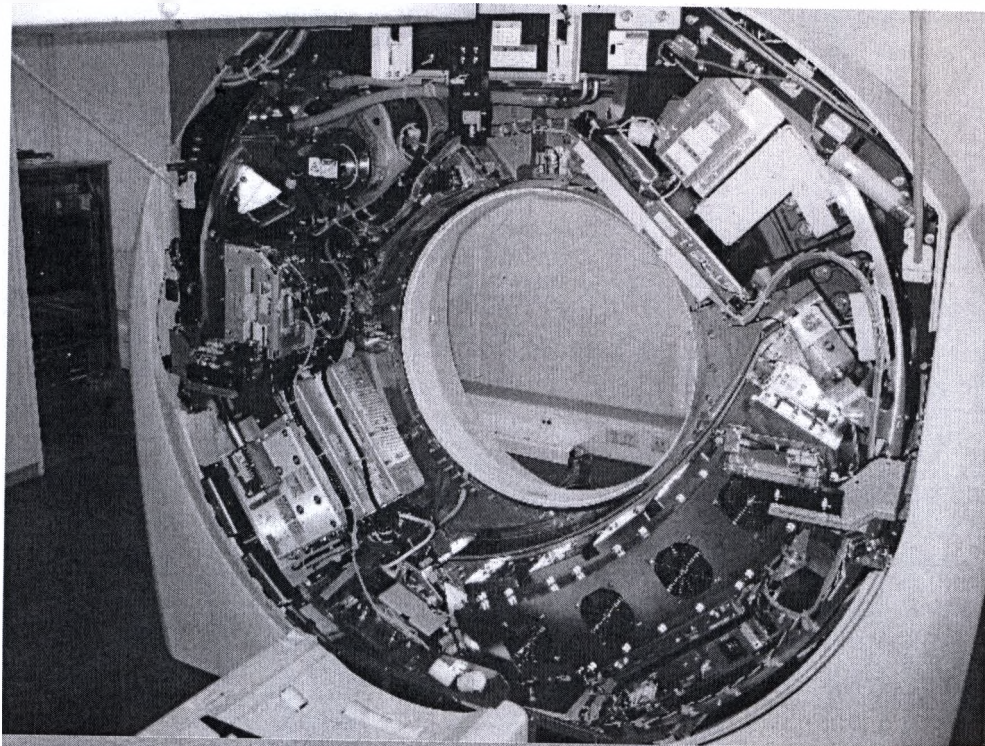


- генератор;

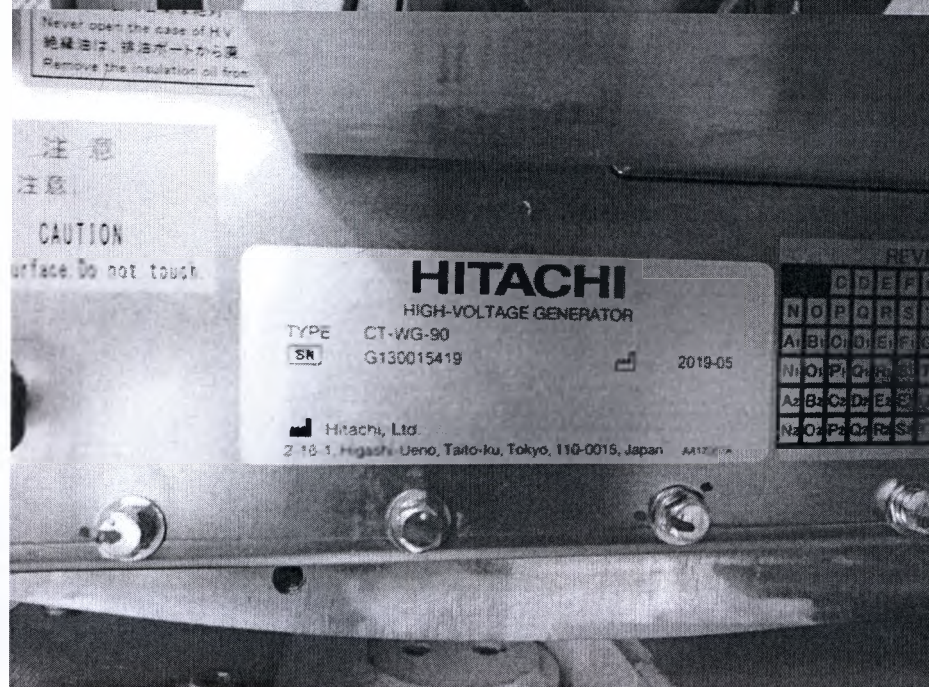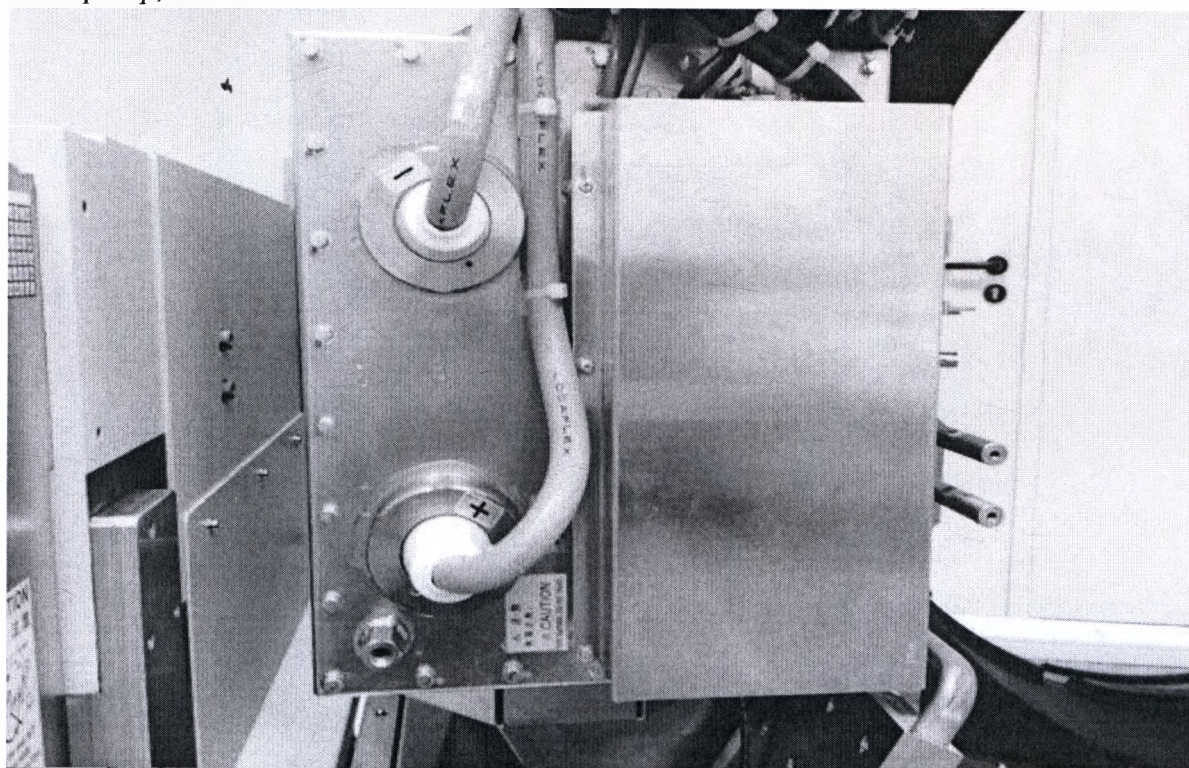



- трубка рентгеновская;

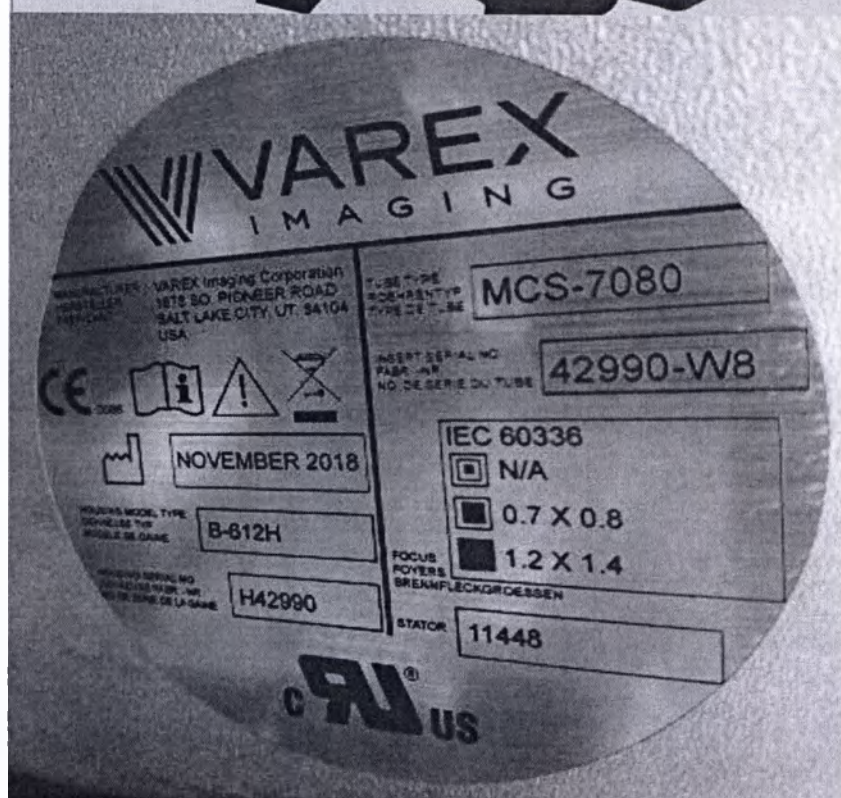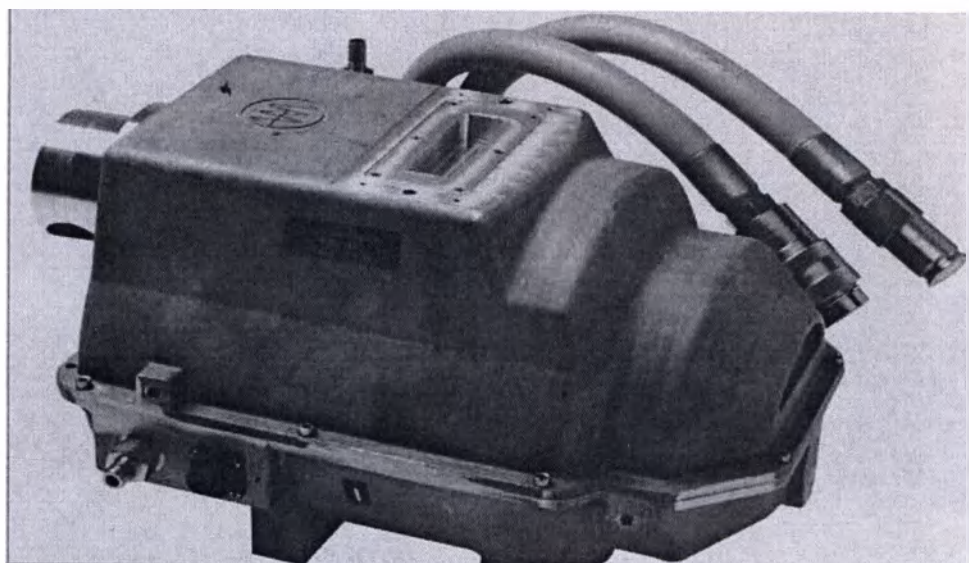


- блок твердотельных детекторов.

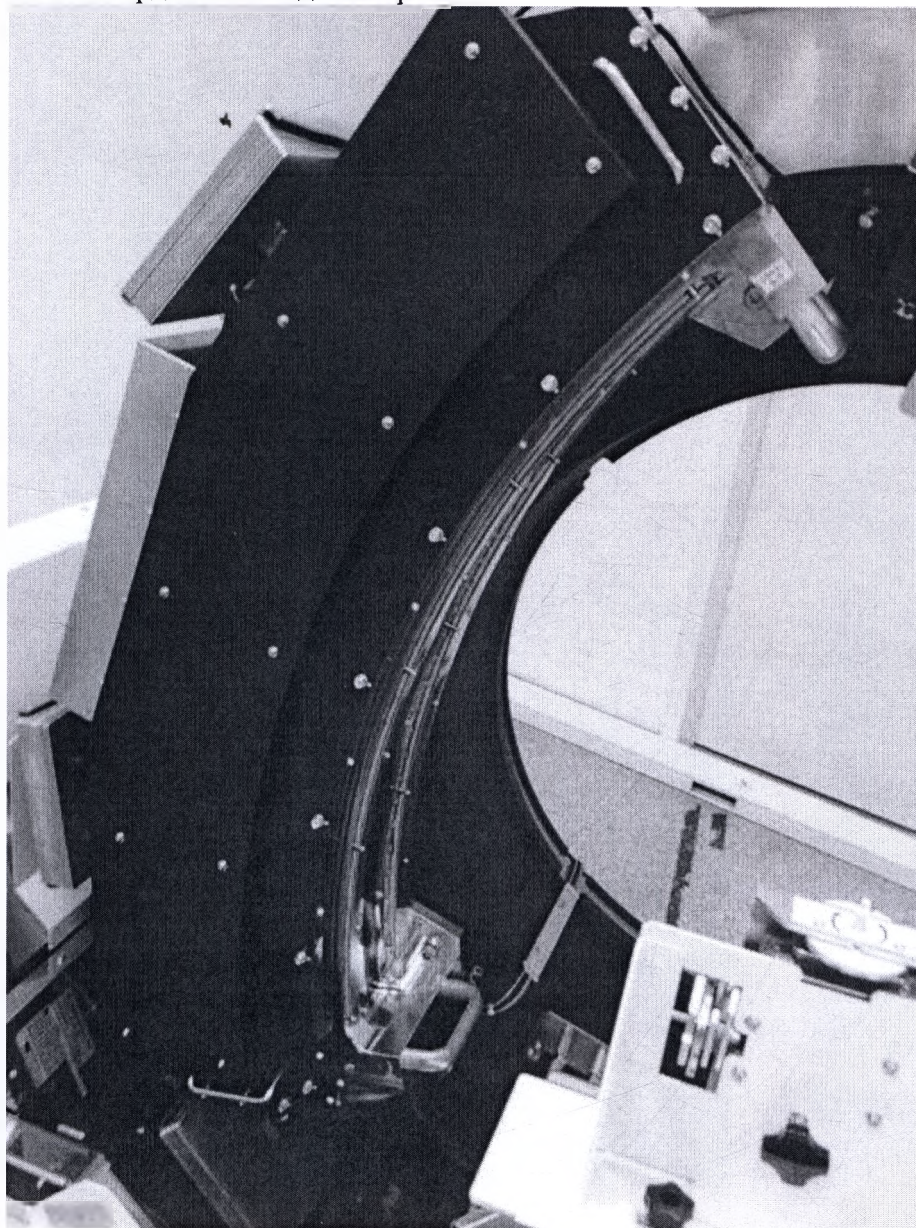

2. Стол пациента.

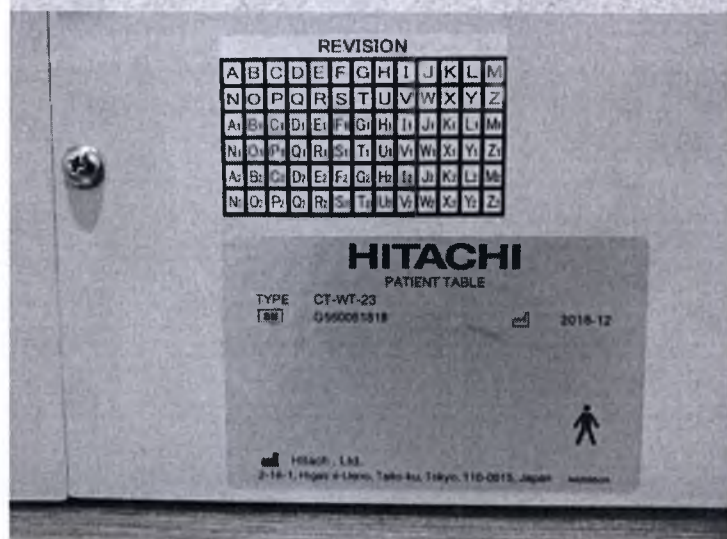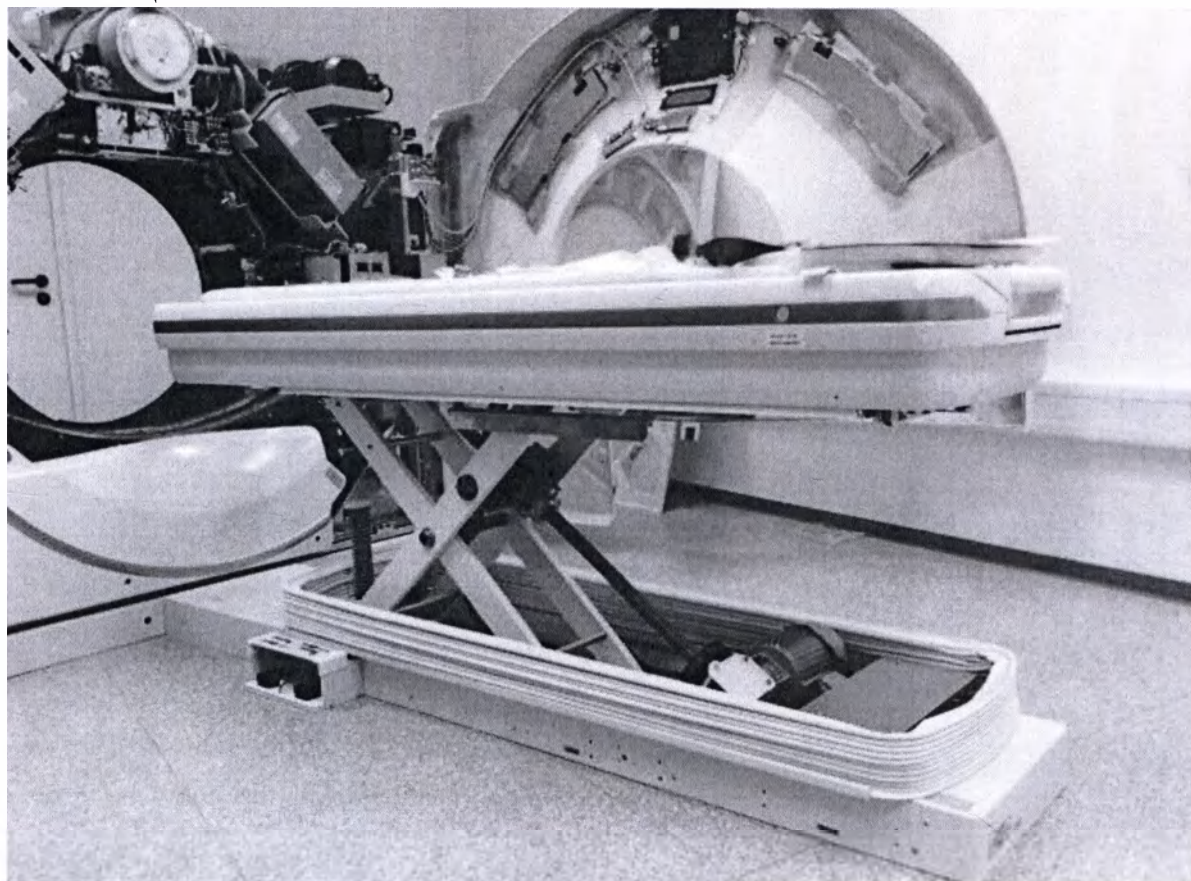

3. Педальный ножной переключатель.

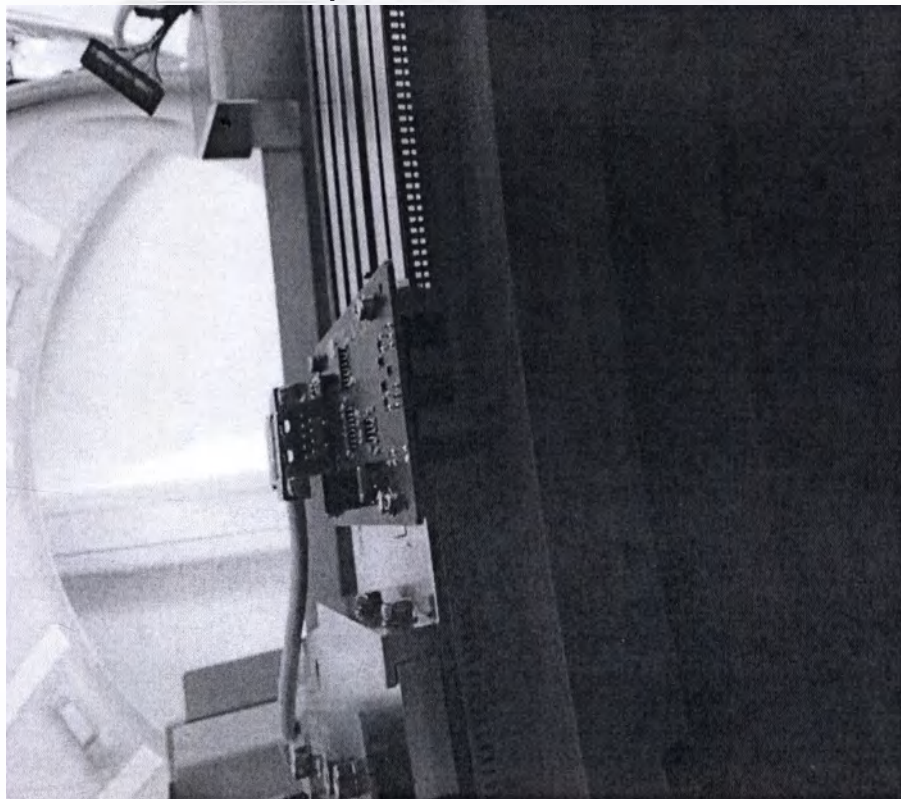


4. Консоль оператора.
- центральный процессор;






- монитор широкоформатный;

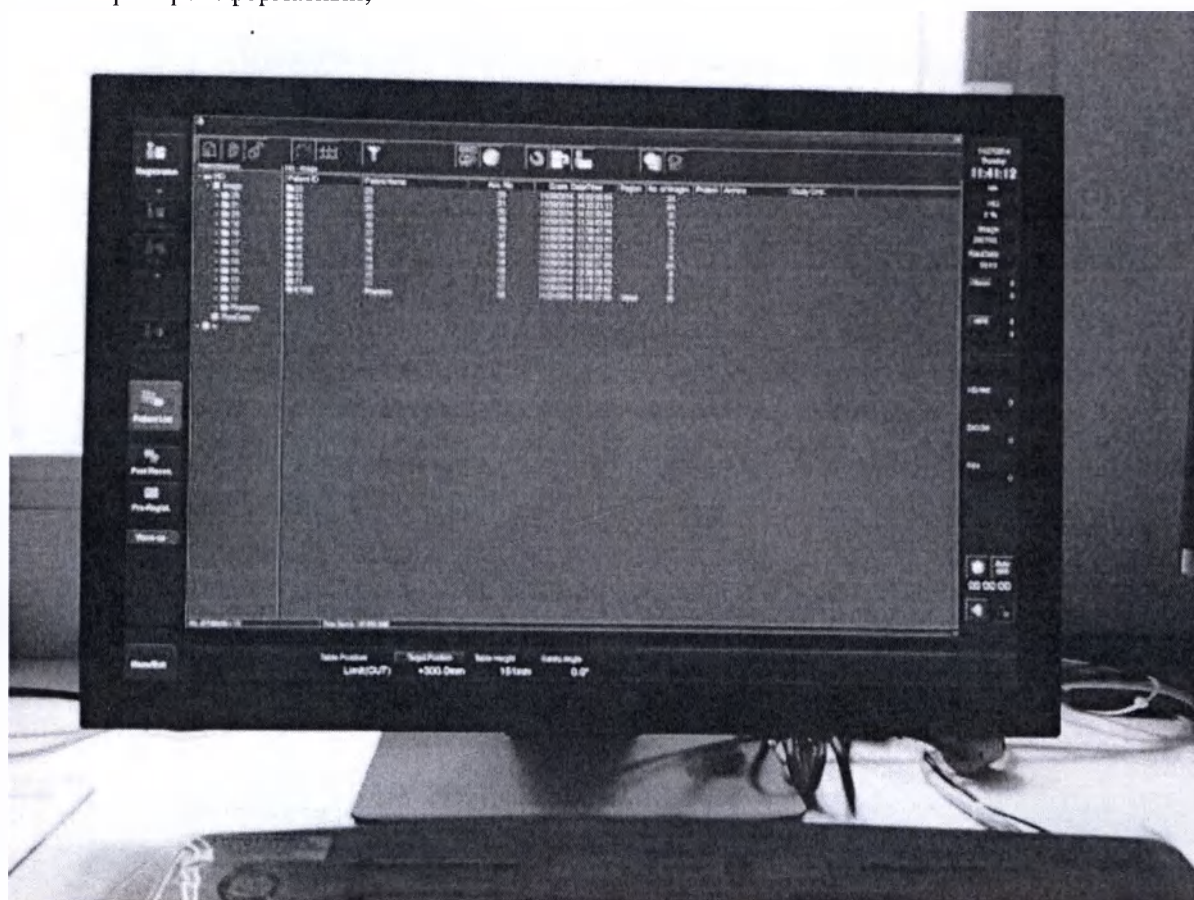

- блок управления;

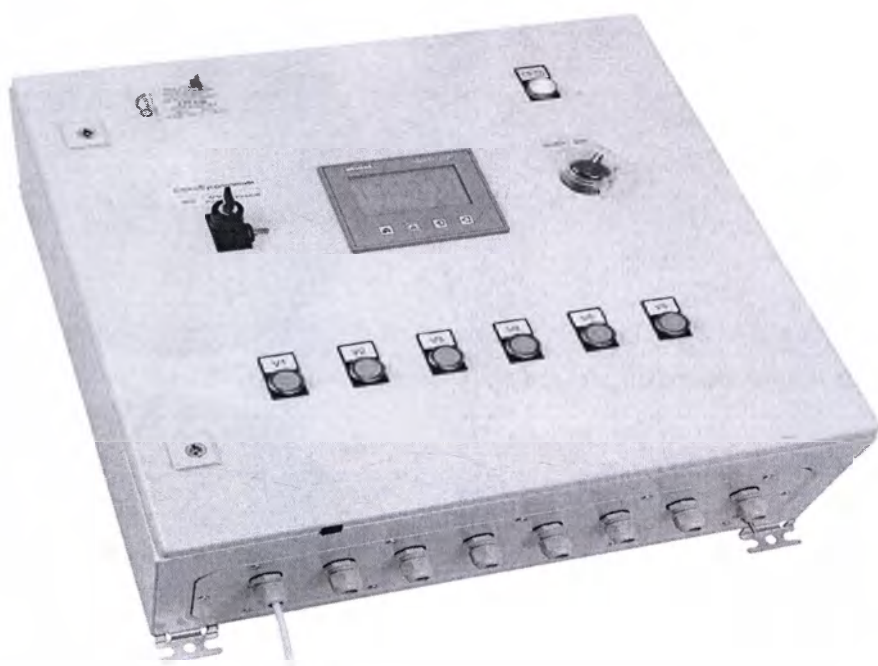

6. Программа контроля рентгеновского излучения.



7. Программное обеспечение для архивирования и связи в стандарте DICOM.



8. Программное обеспечение для передачи данных на устройство печати медицинских изображений в стандарте DICOM.



9. Программное обеспечение для построения изображения полых органов.




10. Программное обеспечение для получения копий на DVD и CD.



11. Устройство оповещения пациента (громкоговоритель).




12. Жесткие диски для записи исходных изображений и данных.

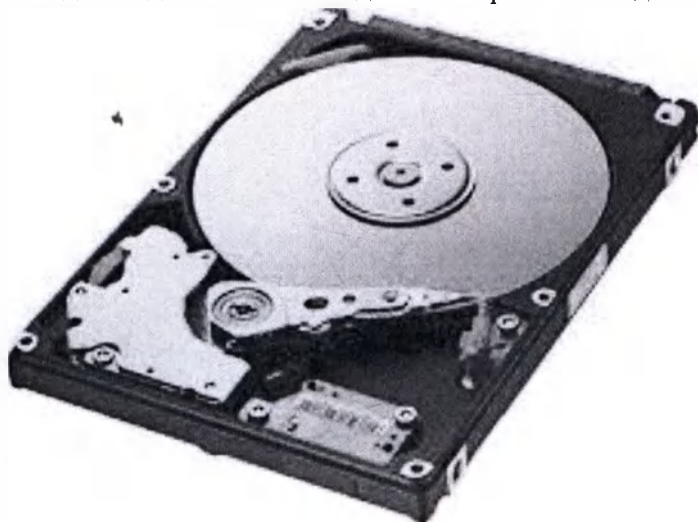

13. Дисковод DVD.




14. Инструкция по эксплуатации.

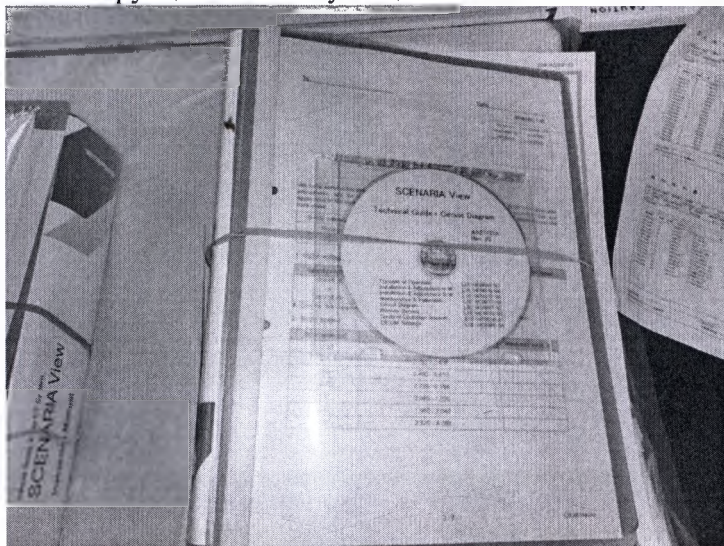

Принадлежности:

1. Программное обеспечение для предсказывающего сканирования для определения начала сканирования с контрастом.

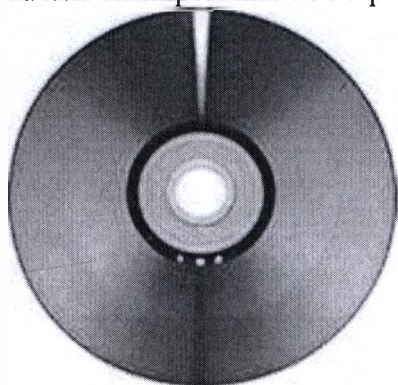

2. Программное обеспечение для дентальных исследований.




3. Программное обеспечение с 3-х мерной визуализацией для ПК пользователей.



4. Программное обеспечение с 3-х мерной визуализацией для дополнительного ПК пользователя.



5. Лицензия для программного обеспечения с 3-х мерной визуализацией для дополнительного ПК пользователя.

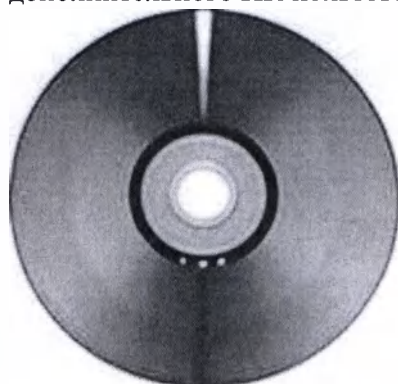


6. Программное обеспечение для построения изображения по перфузии.



7. Программное обеспечение для работы в сети, включая MWM.



8. Программное обеспечение для передачи данных на лазерную камеру в стандарте DICOM.

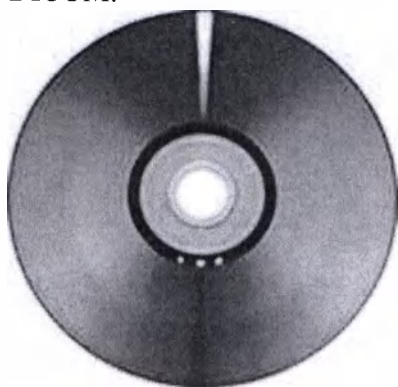

8. Программное обеспечение для дифференцирования жировых тканей.




9. Программное обеспечение для исследования и диагностики легочной системы.




10. Программное обеспечение для кардиологии.




11. Дополнительная рабочая станция для обработки изображений.

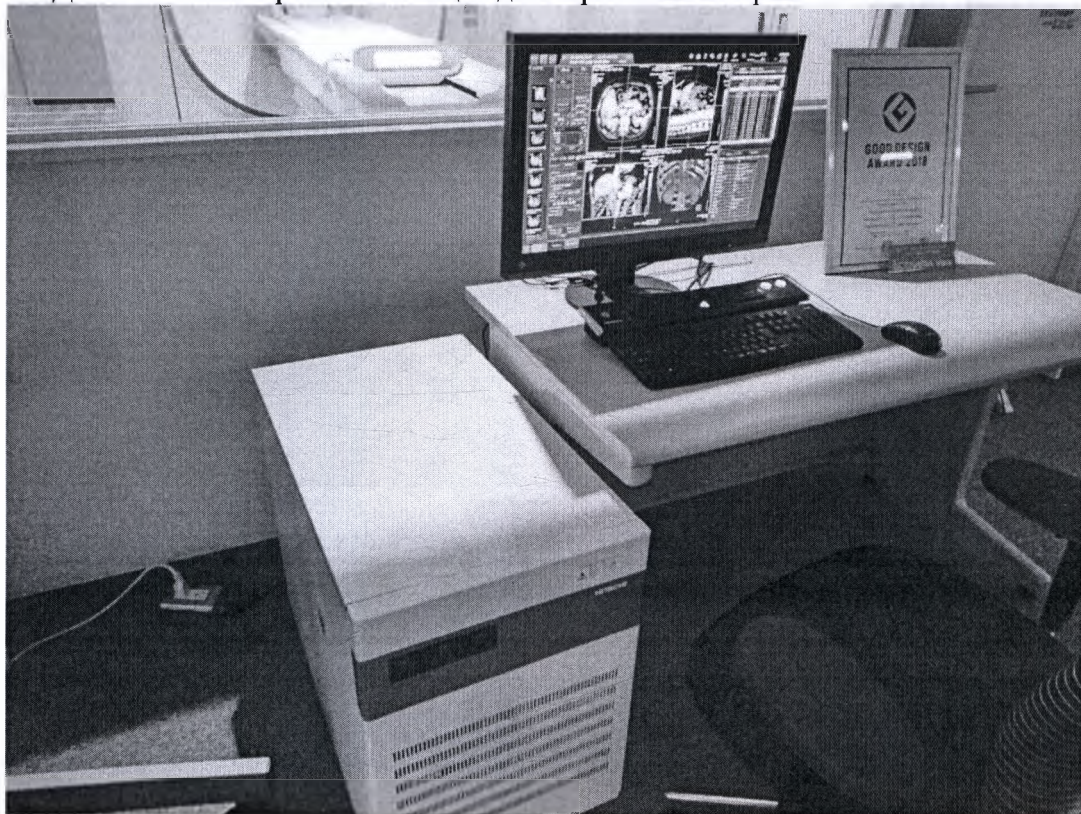


12. Радиологическая информационная система на основе использования протокола передачи изображений Dicom 3.0.

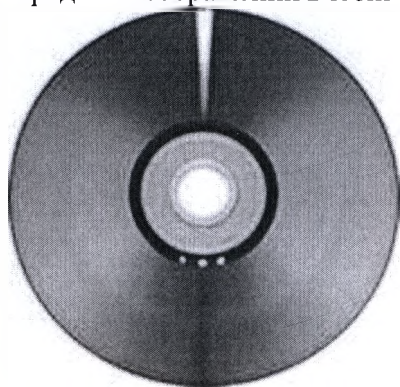

13. Платы приема и обработки информации для консоли оператора от 1 до 15 шт.

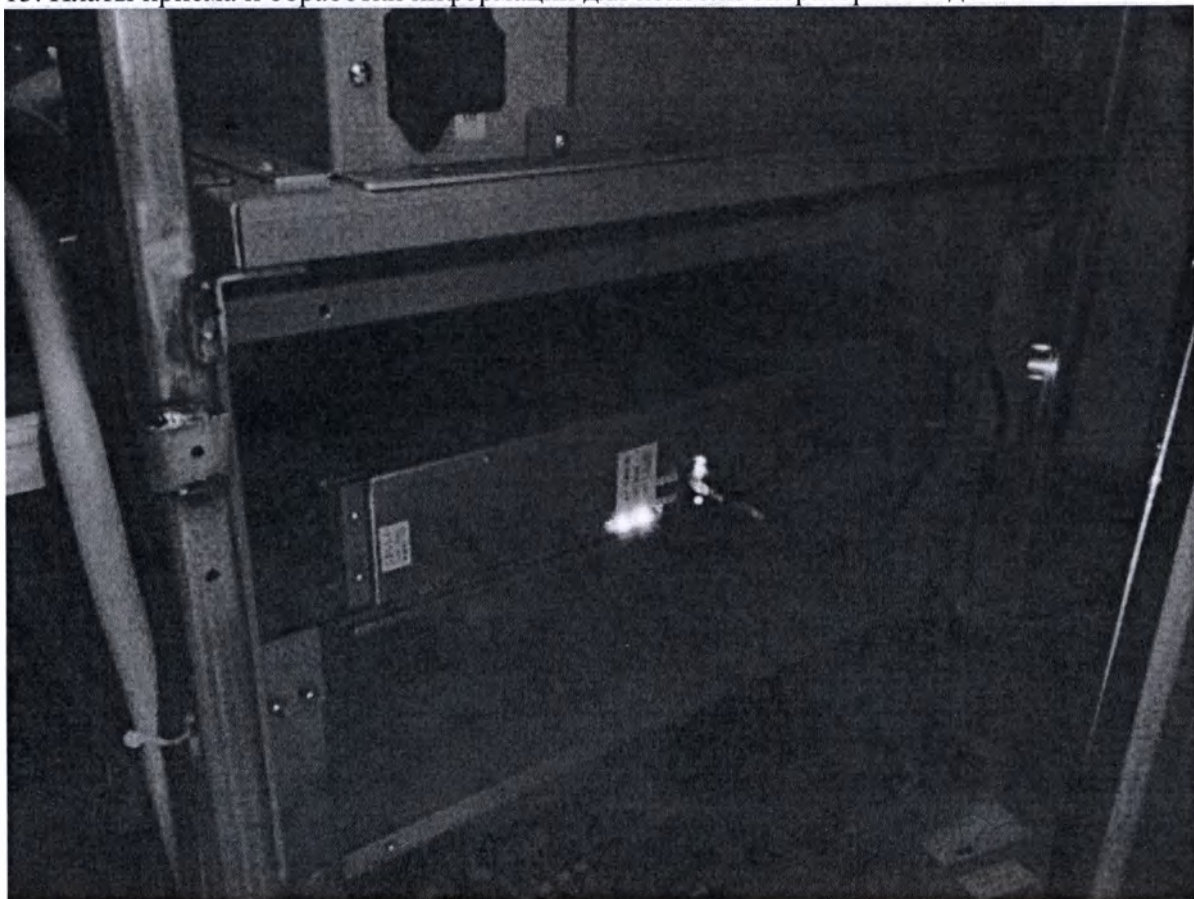


14. Платы управления сбора и передачи данных для гентри от 1 до 5 шт.

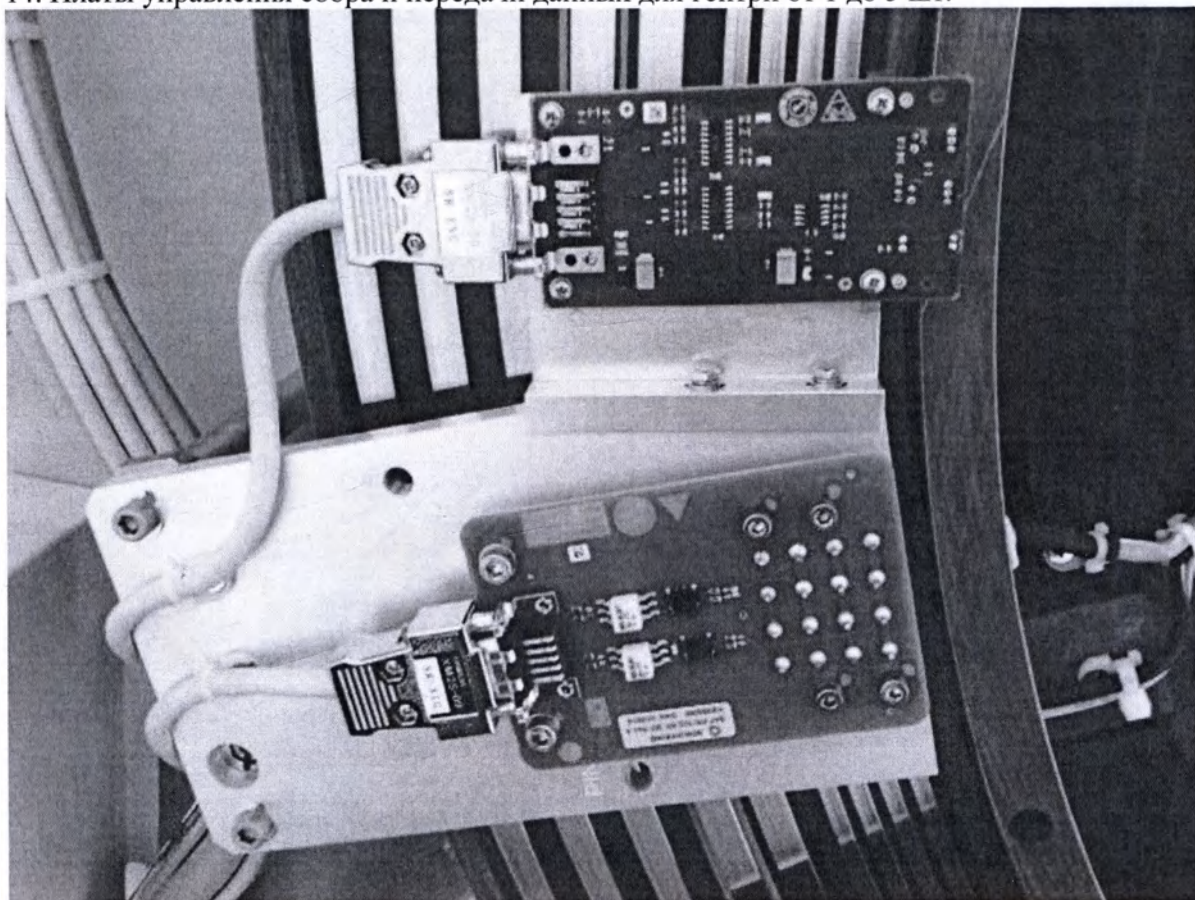





15. Плата управления столом пациента.

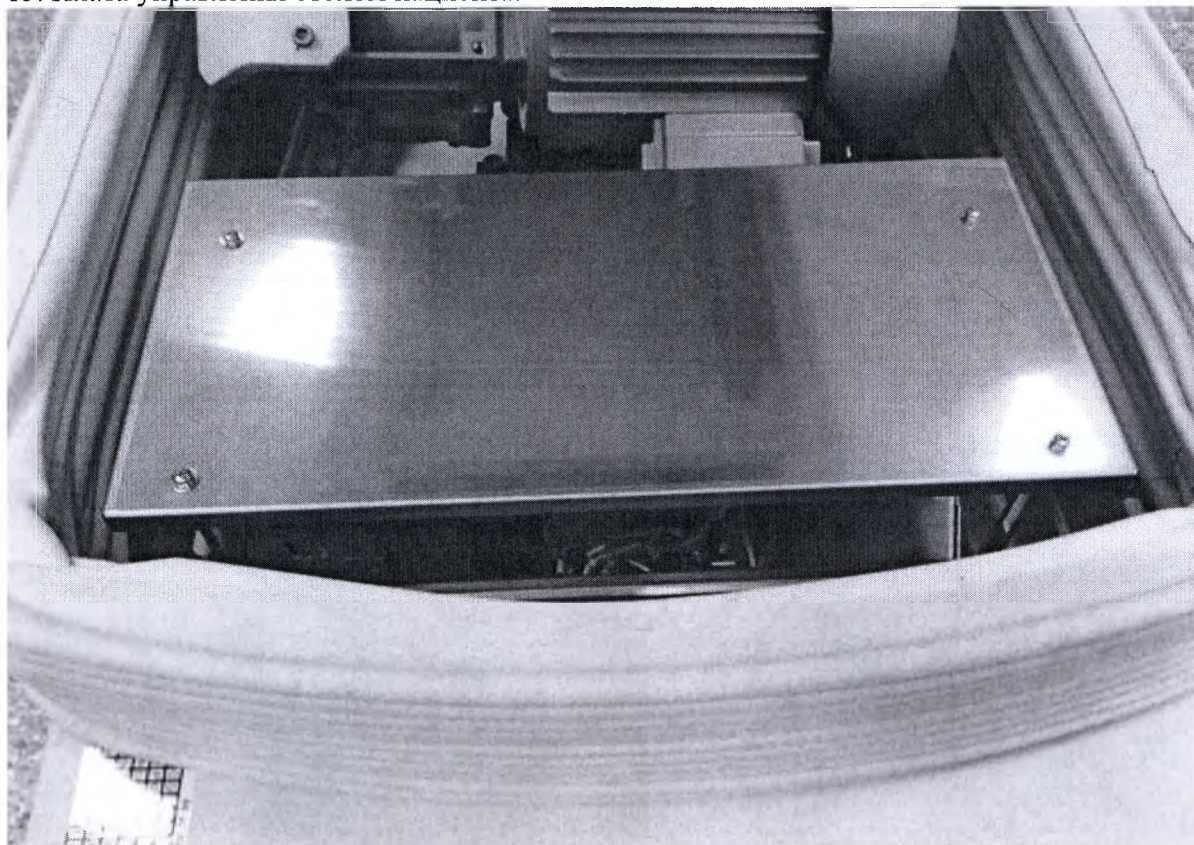


16. Плата управления блоком детекторов.

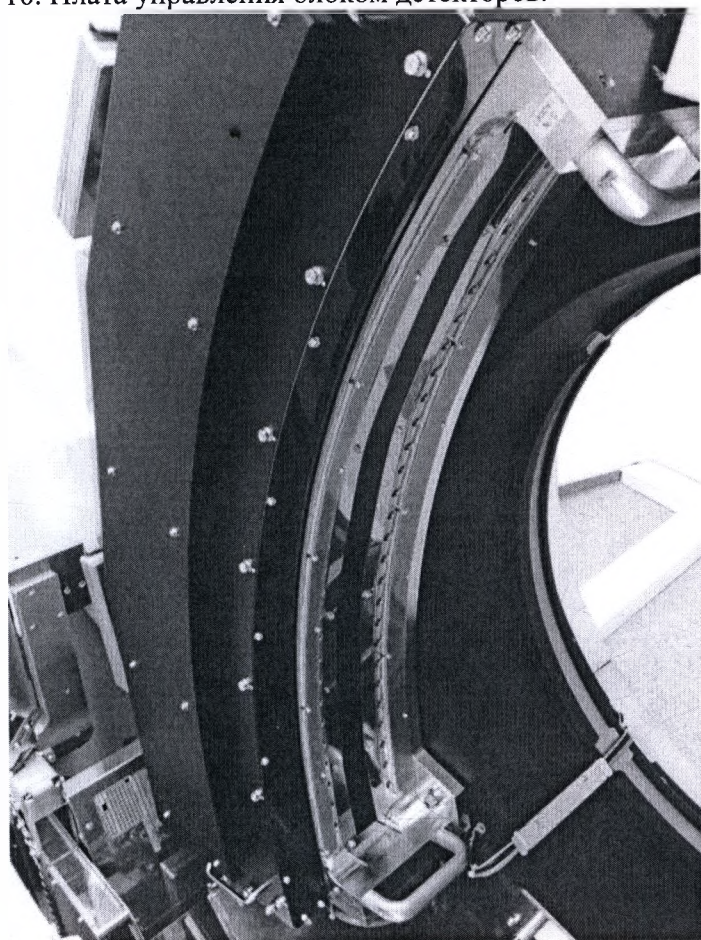


17. Плата управления высоковольтным генератором.

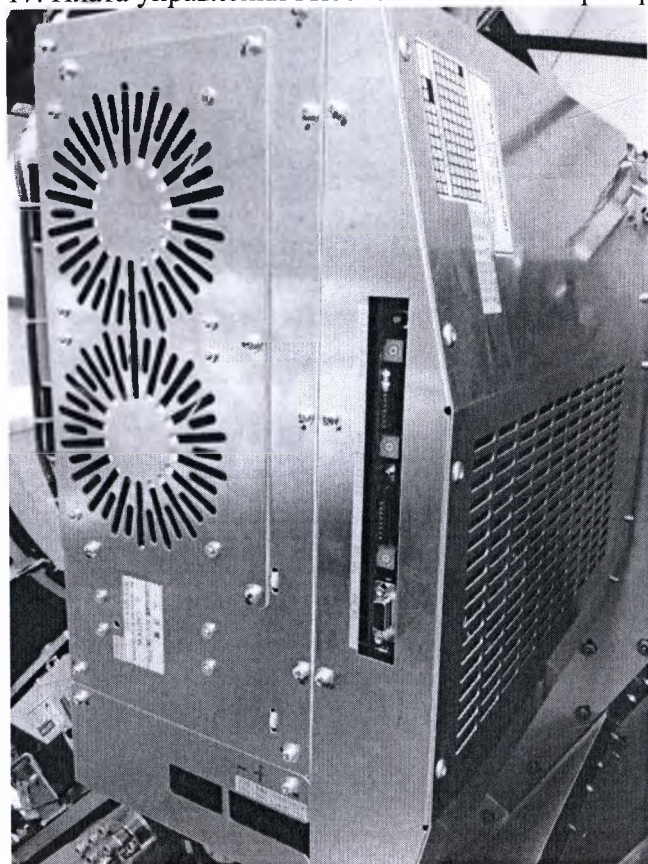


18. Оптические узлы для канала передачи данных в гентри от 1 до 20 шт.

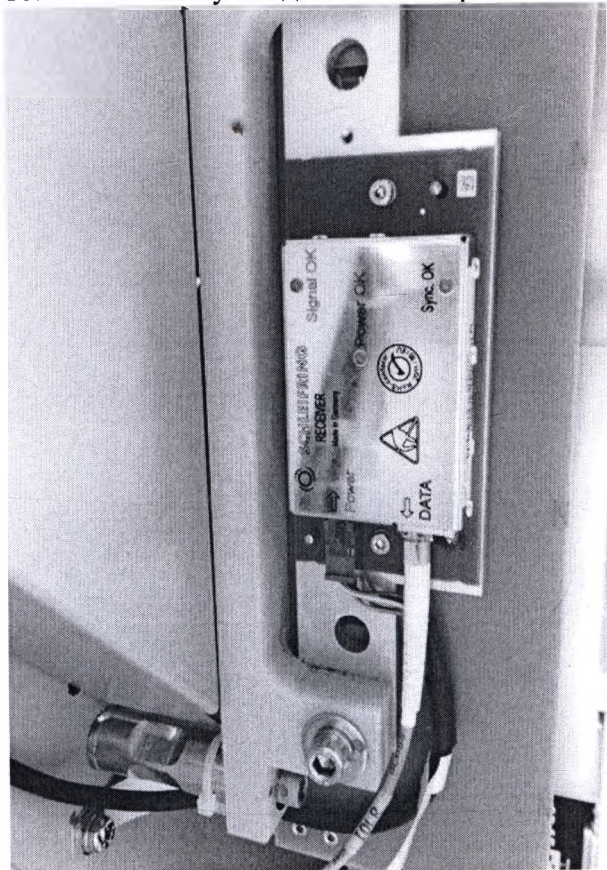


19. Декодер вращения трубки в гентри.

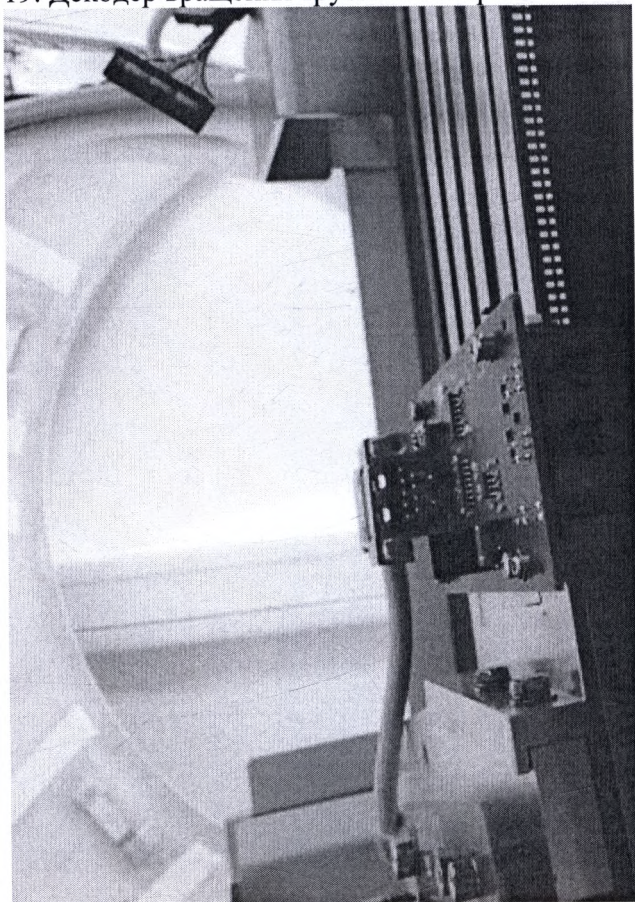


18. Оптические узлы для канала передачи данных в гентри от 1 до 20 шт.

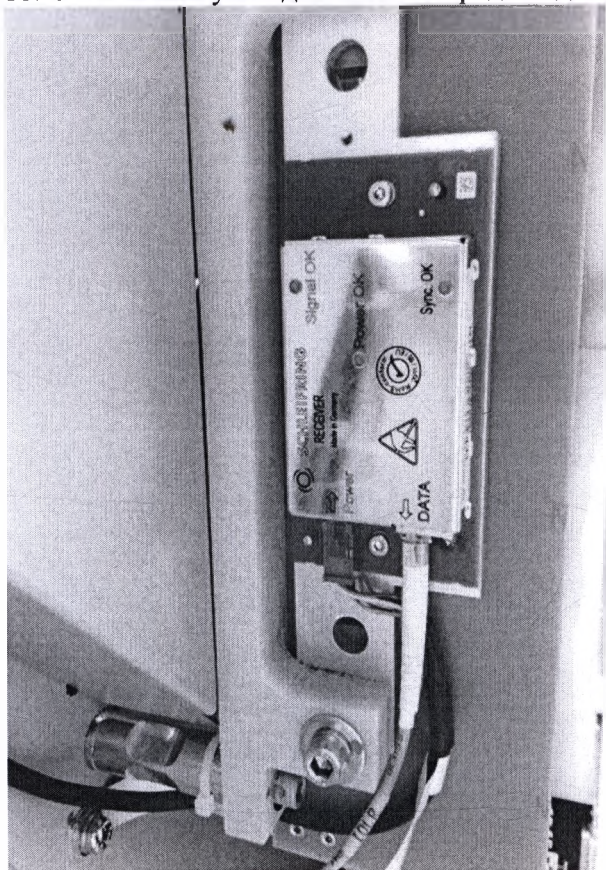


19. Декодер вращения трубки в гентри.

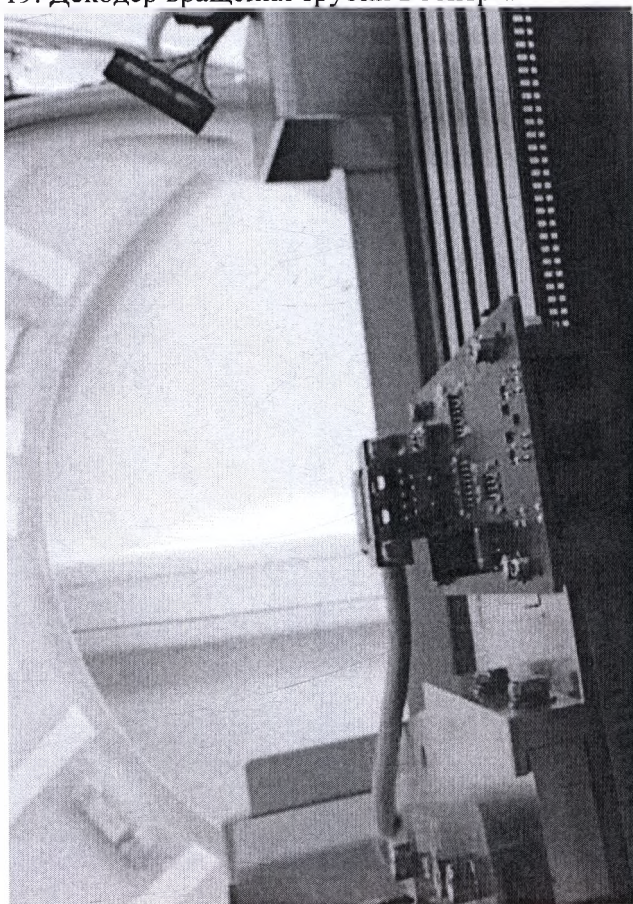


20. Фотосенсор гентри.

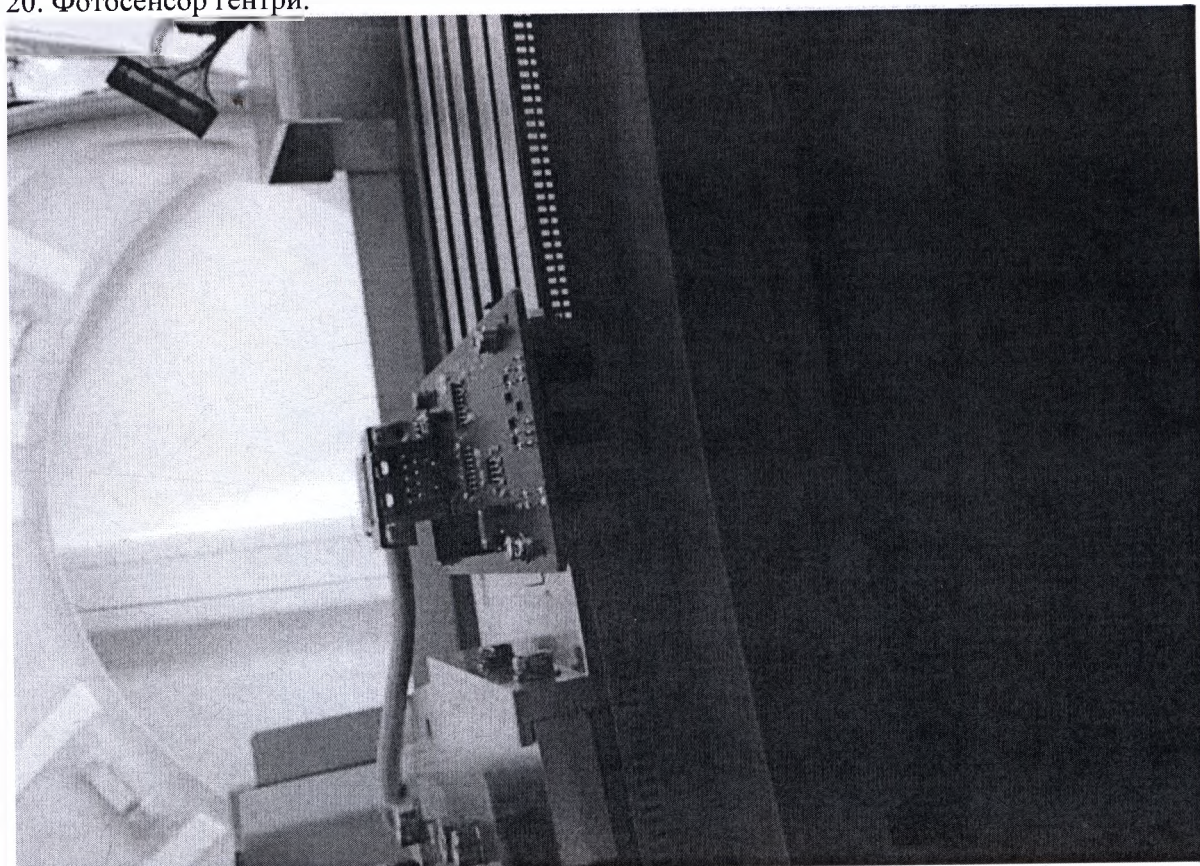


21. Блок питания гентри.

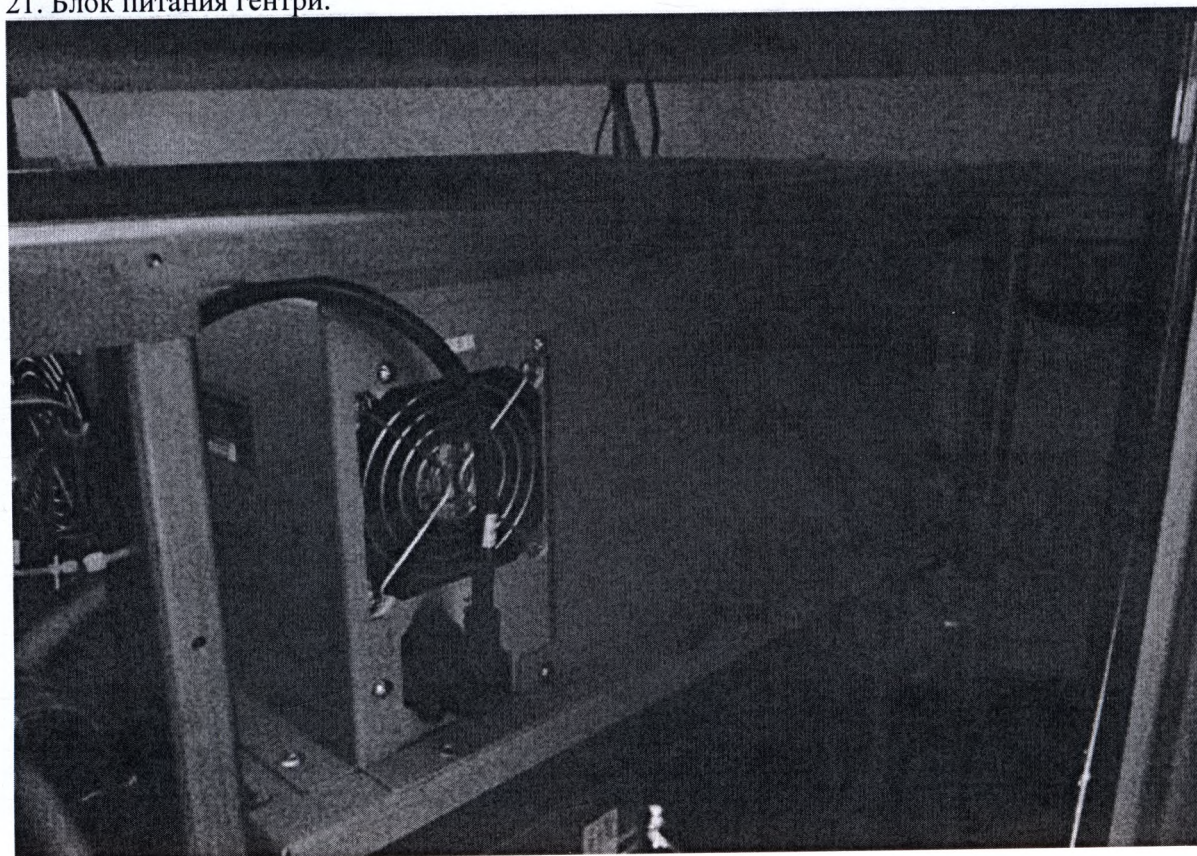

22. Устройство для фиксации ребенка (кювета с ремнями).

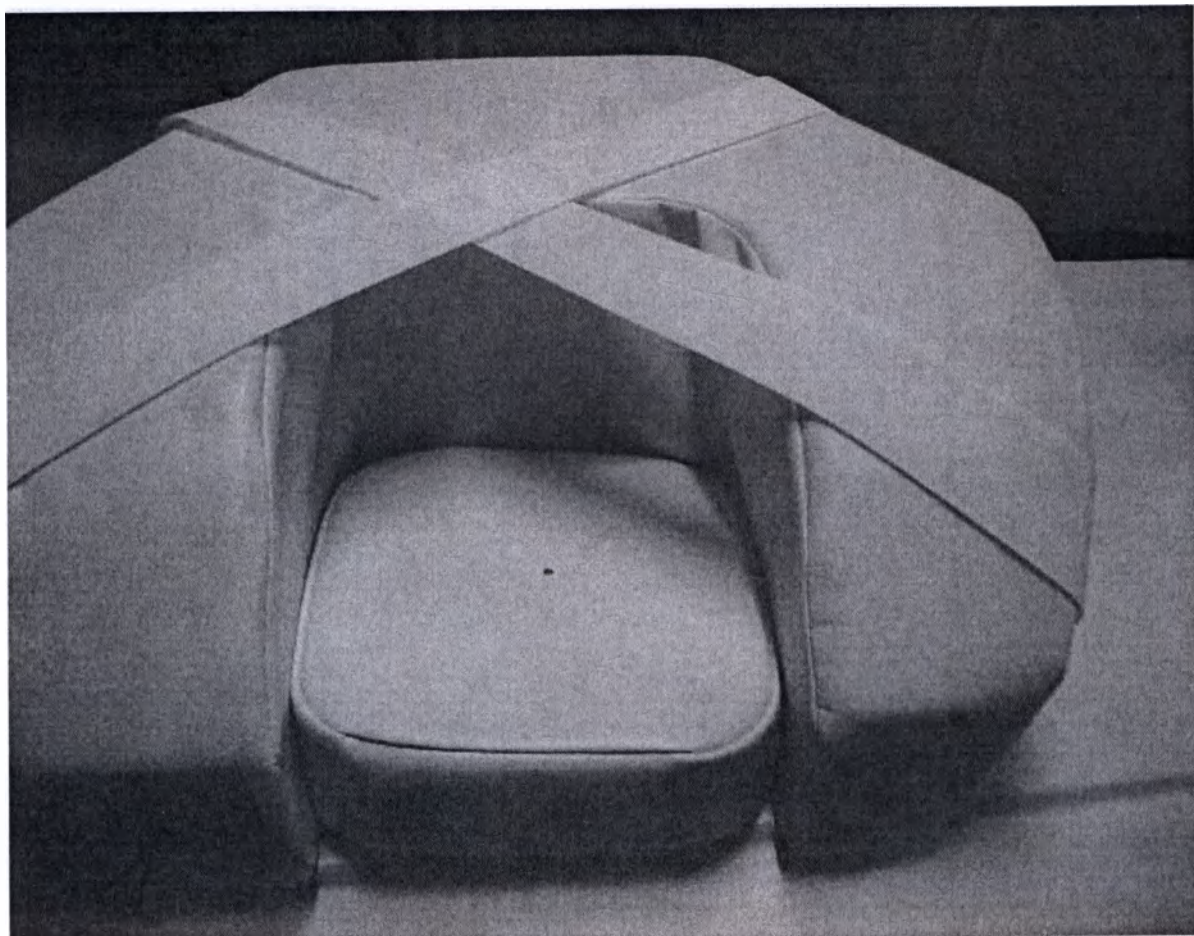

23. Набор фиксирующих лент:
- фиксирующая лента для подбородка 1 комплект;

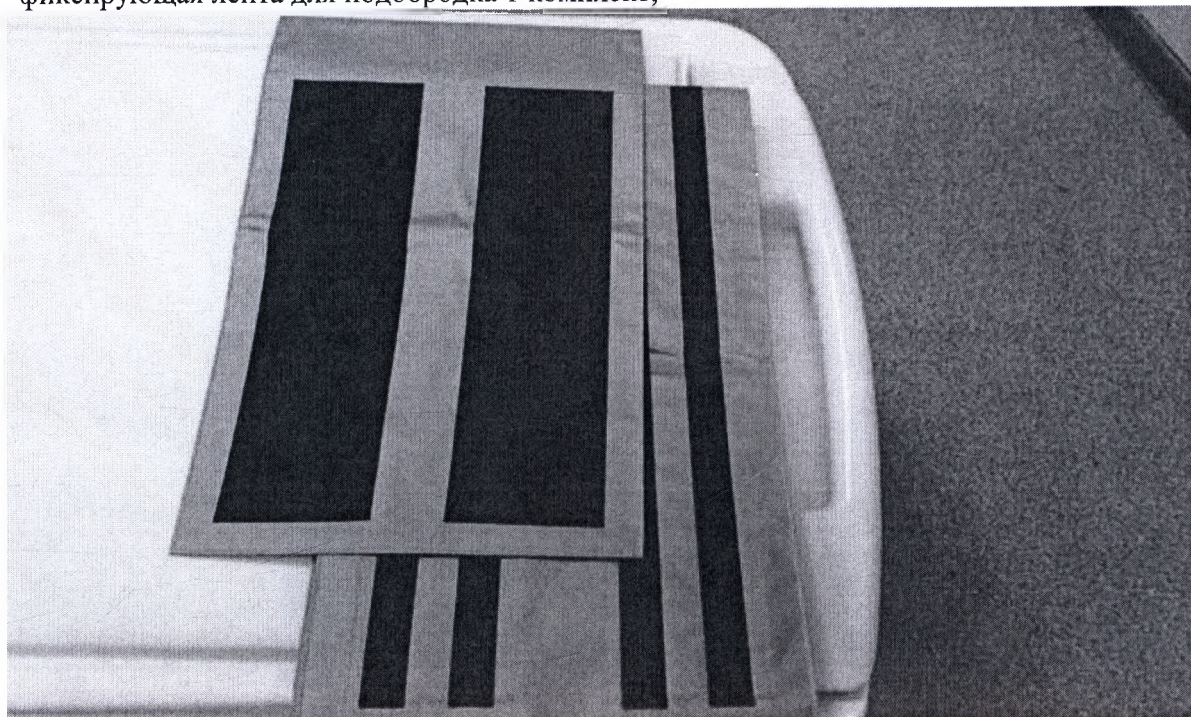

- фиксирующая лента для головы 1 комплект;



- фиксирующая лента для рук 1 комплект.




24. Подлокотник.


25. Подлокотник для внутреннего введения контраста.



26. Подголовник.

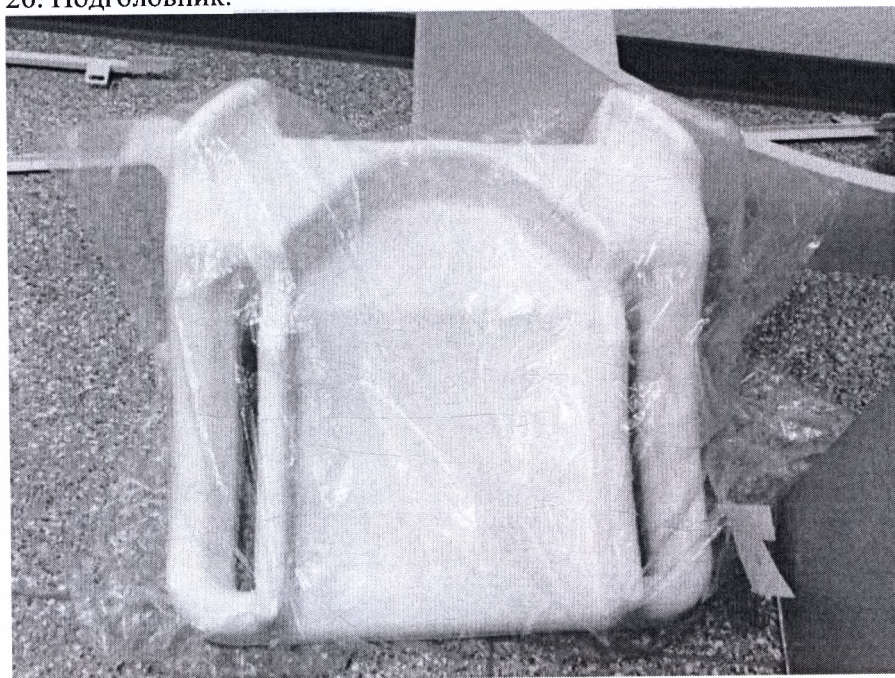


27. Держатель подголовника.

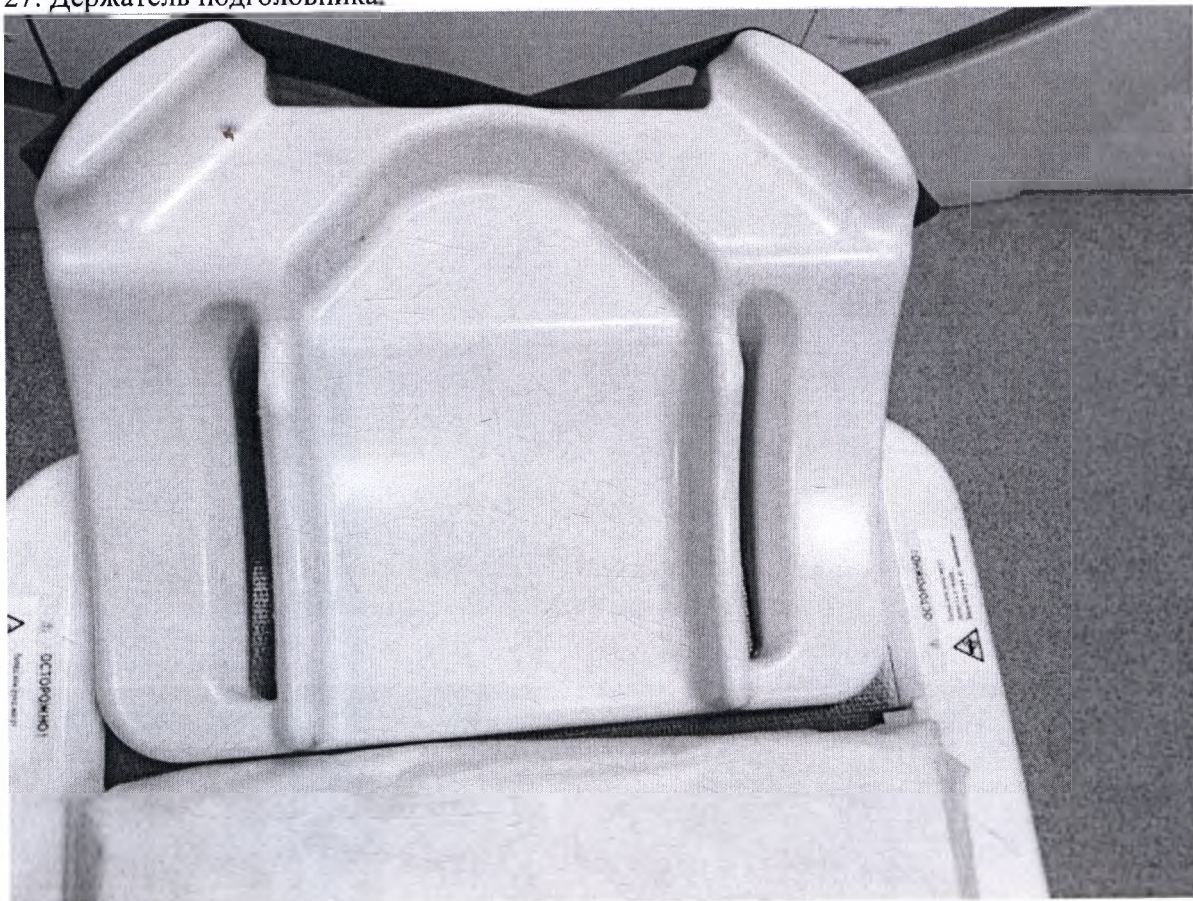


28. Треугольная подставка под колени.




29. Матрас пациента.

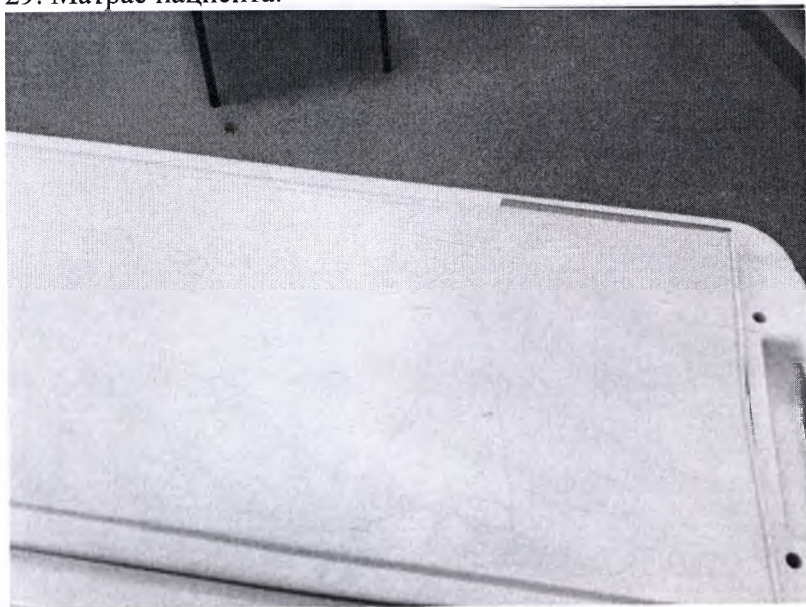


30. Защитное стекло.

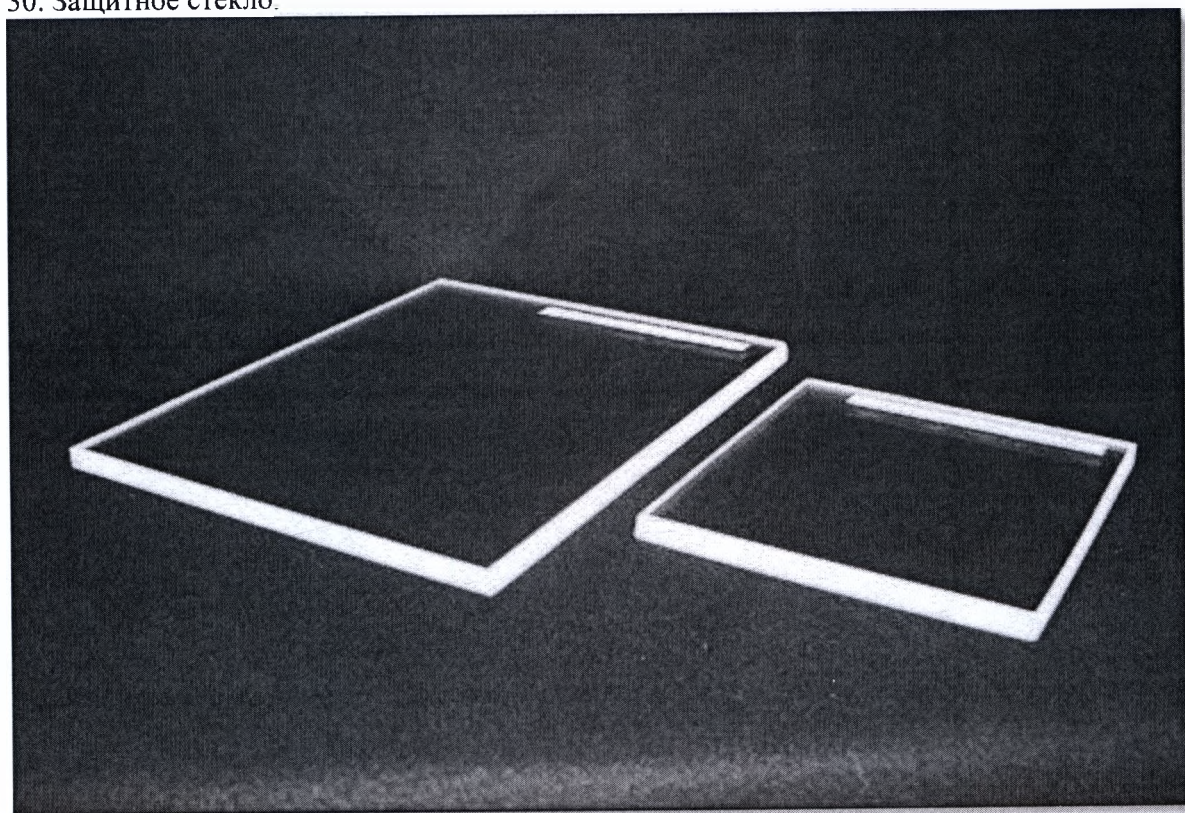

31. Устройство для печати медицинских изображений

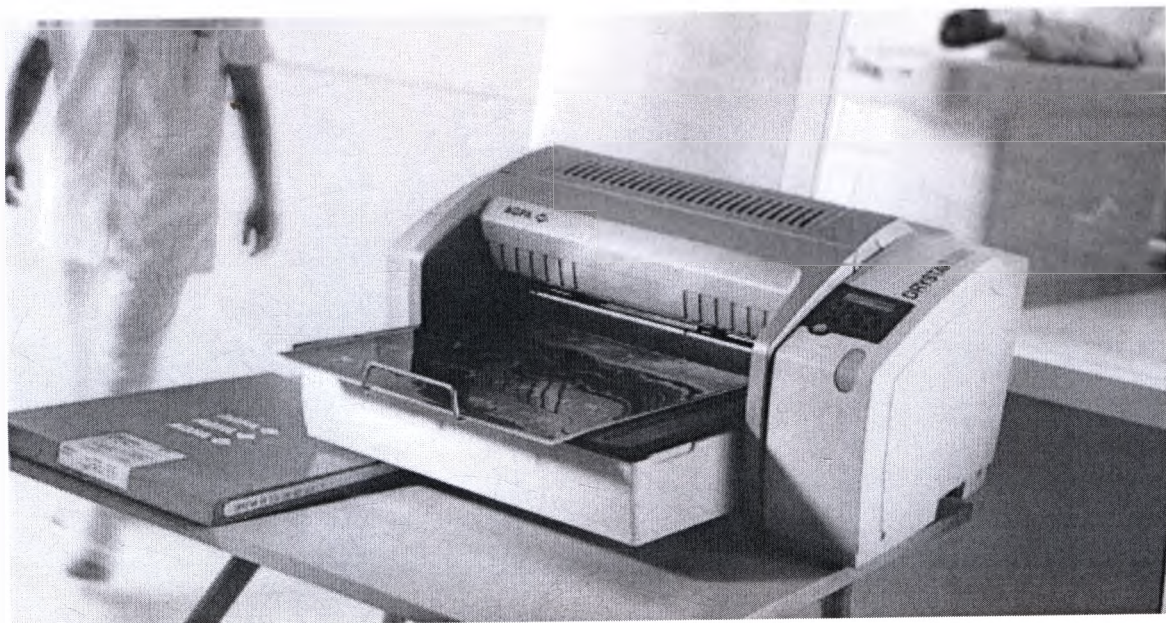


32. Пленка для печати медицинских изображений от 1 до 10 коробок (количество пленки в одной коробке 100 или 125 шт.).

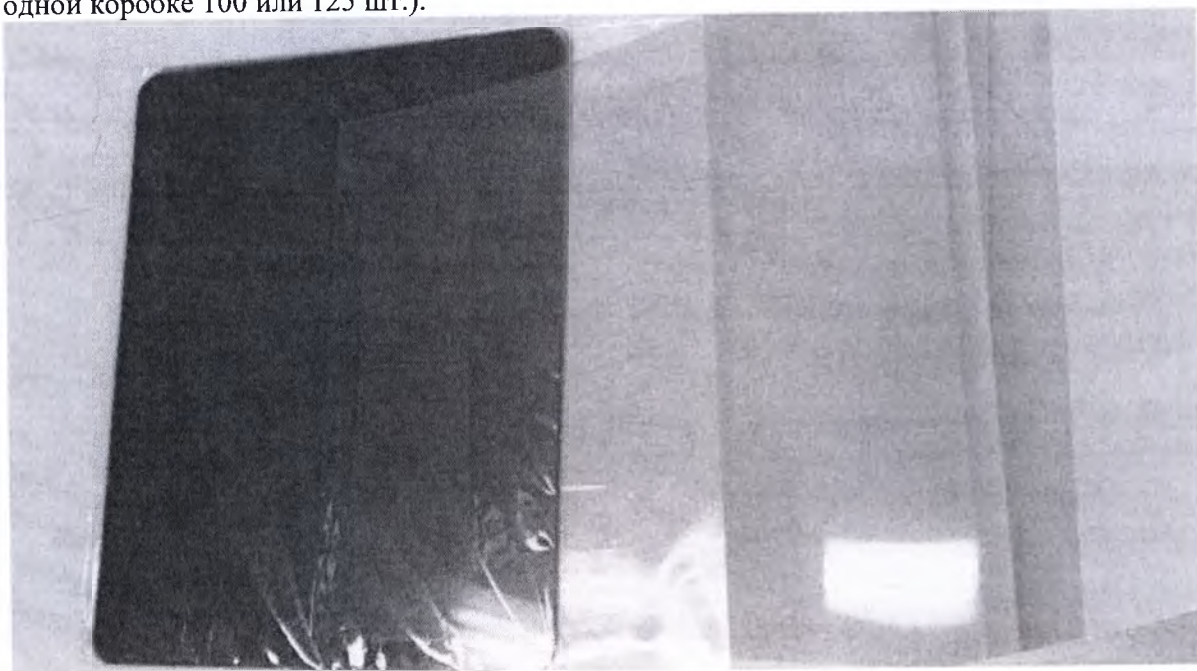


34. Устройства для калибровки (настройки) компьютерного томографа.



35. Набор для проведения денситометрии:
- фантом;

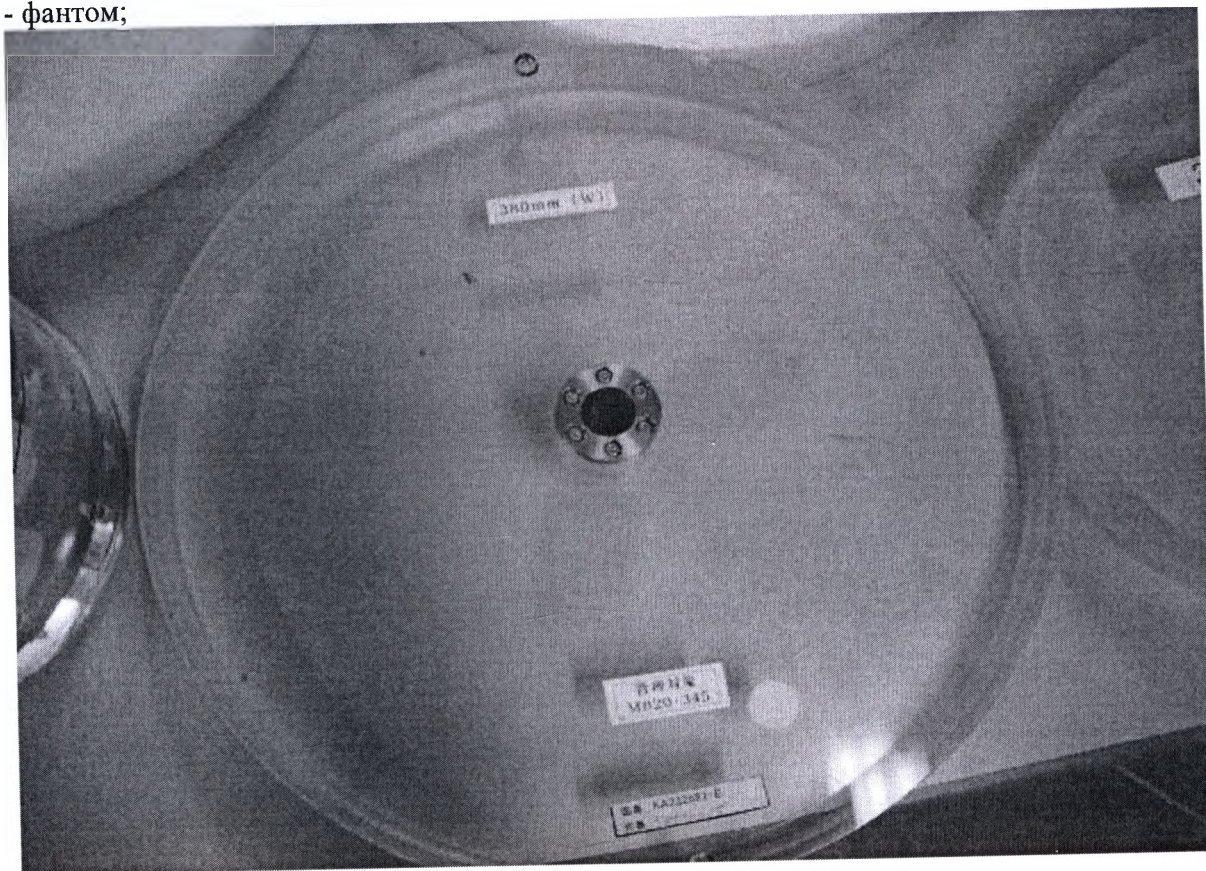

- матрасик;

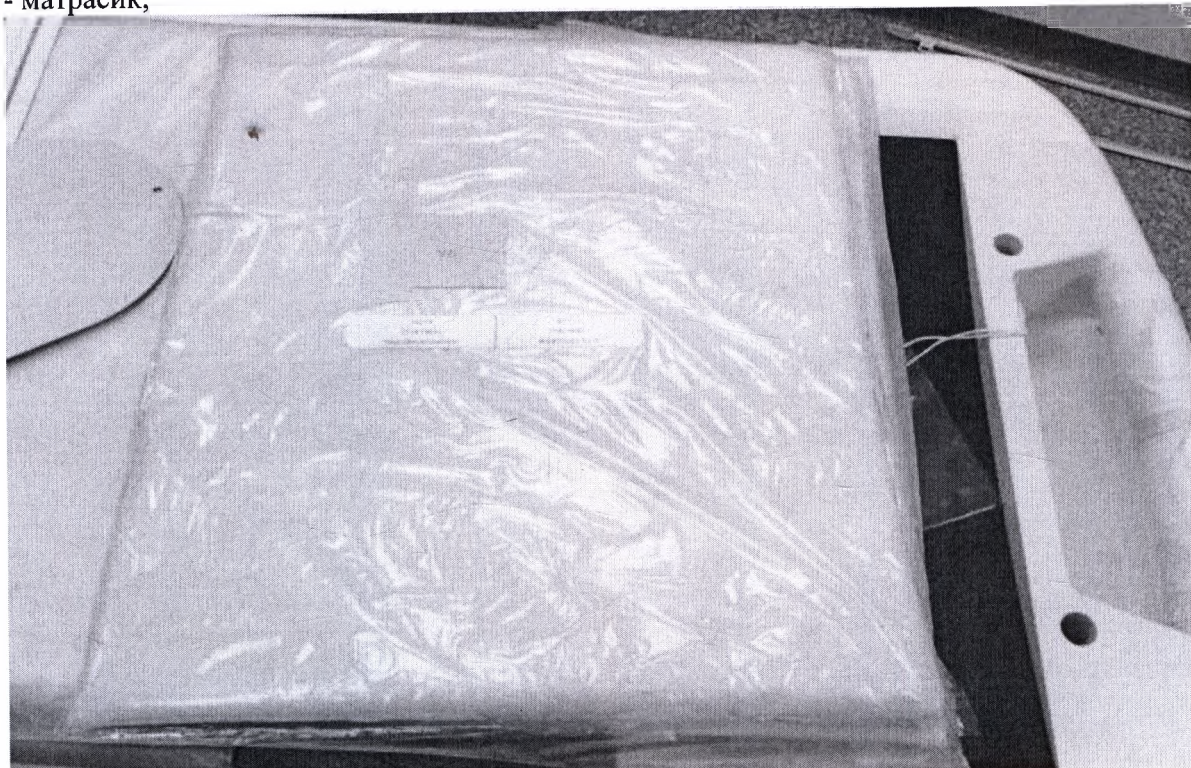


- программное обеспечение.



36. Набор для монтажа компьютерного томографа



37. Понижающий трансформатор.

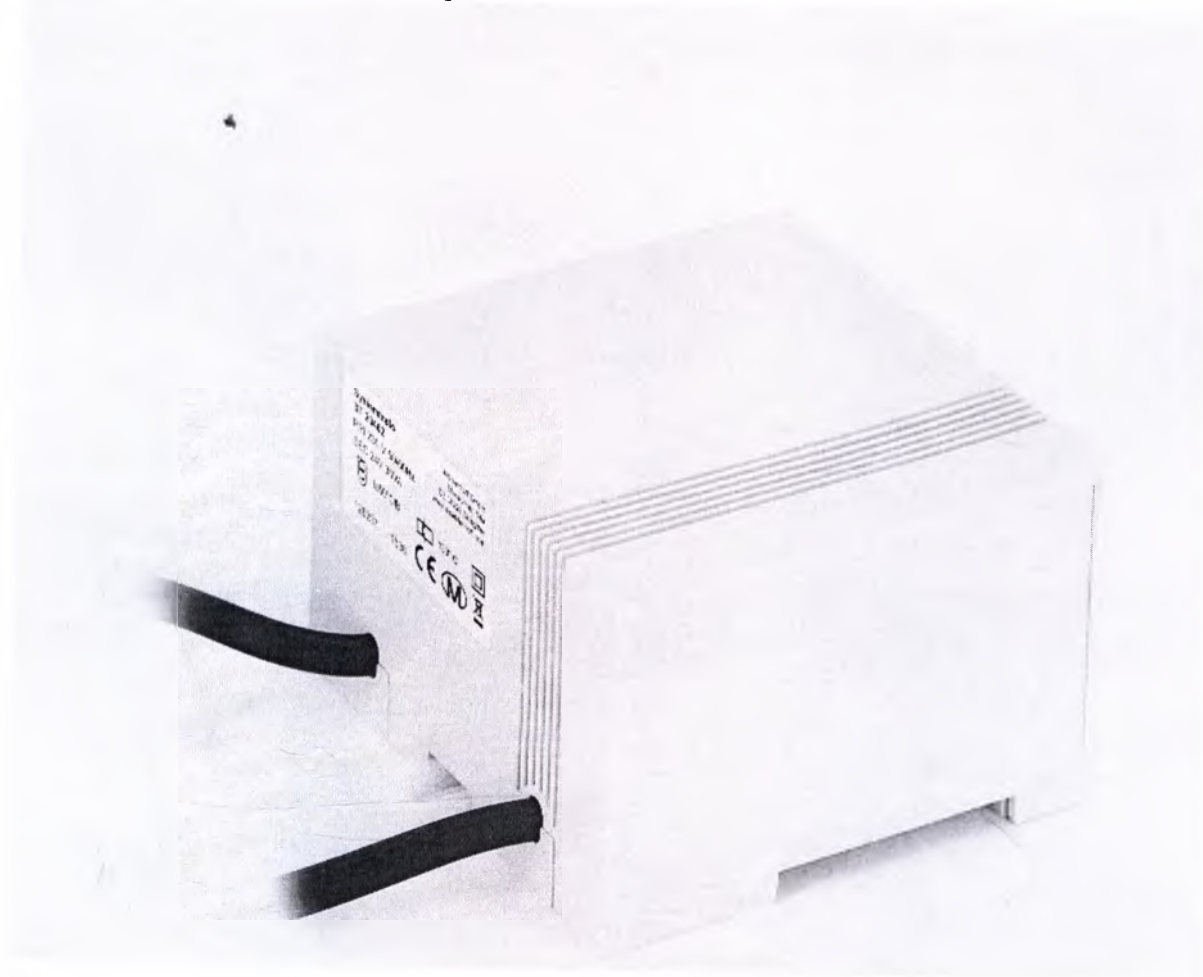

38. Высоковольтные преобразователи от 1 до 3 шт.



39. Источник бесперебойного питания.



40. Тележки от 1 до 5 шт.



41. Балки транспортировочные от 1 до 4 шт.



Генеральный директор
ООО «ИПС»



Кириченко В. В.

32 (прислать глв)
листа)