

Фотографические изображения

Набор калибраторов для количественного определения прогастрин рилизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 3
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru


Roche Diagnostics Rus LLC

2, Letnikovskaya street, bld.3
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia


Tel.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

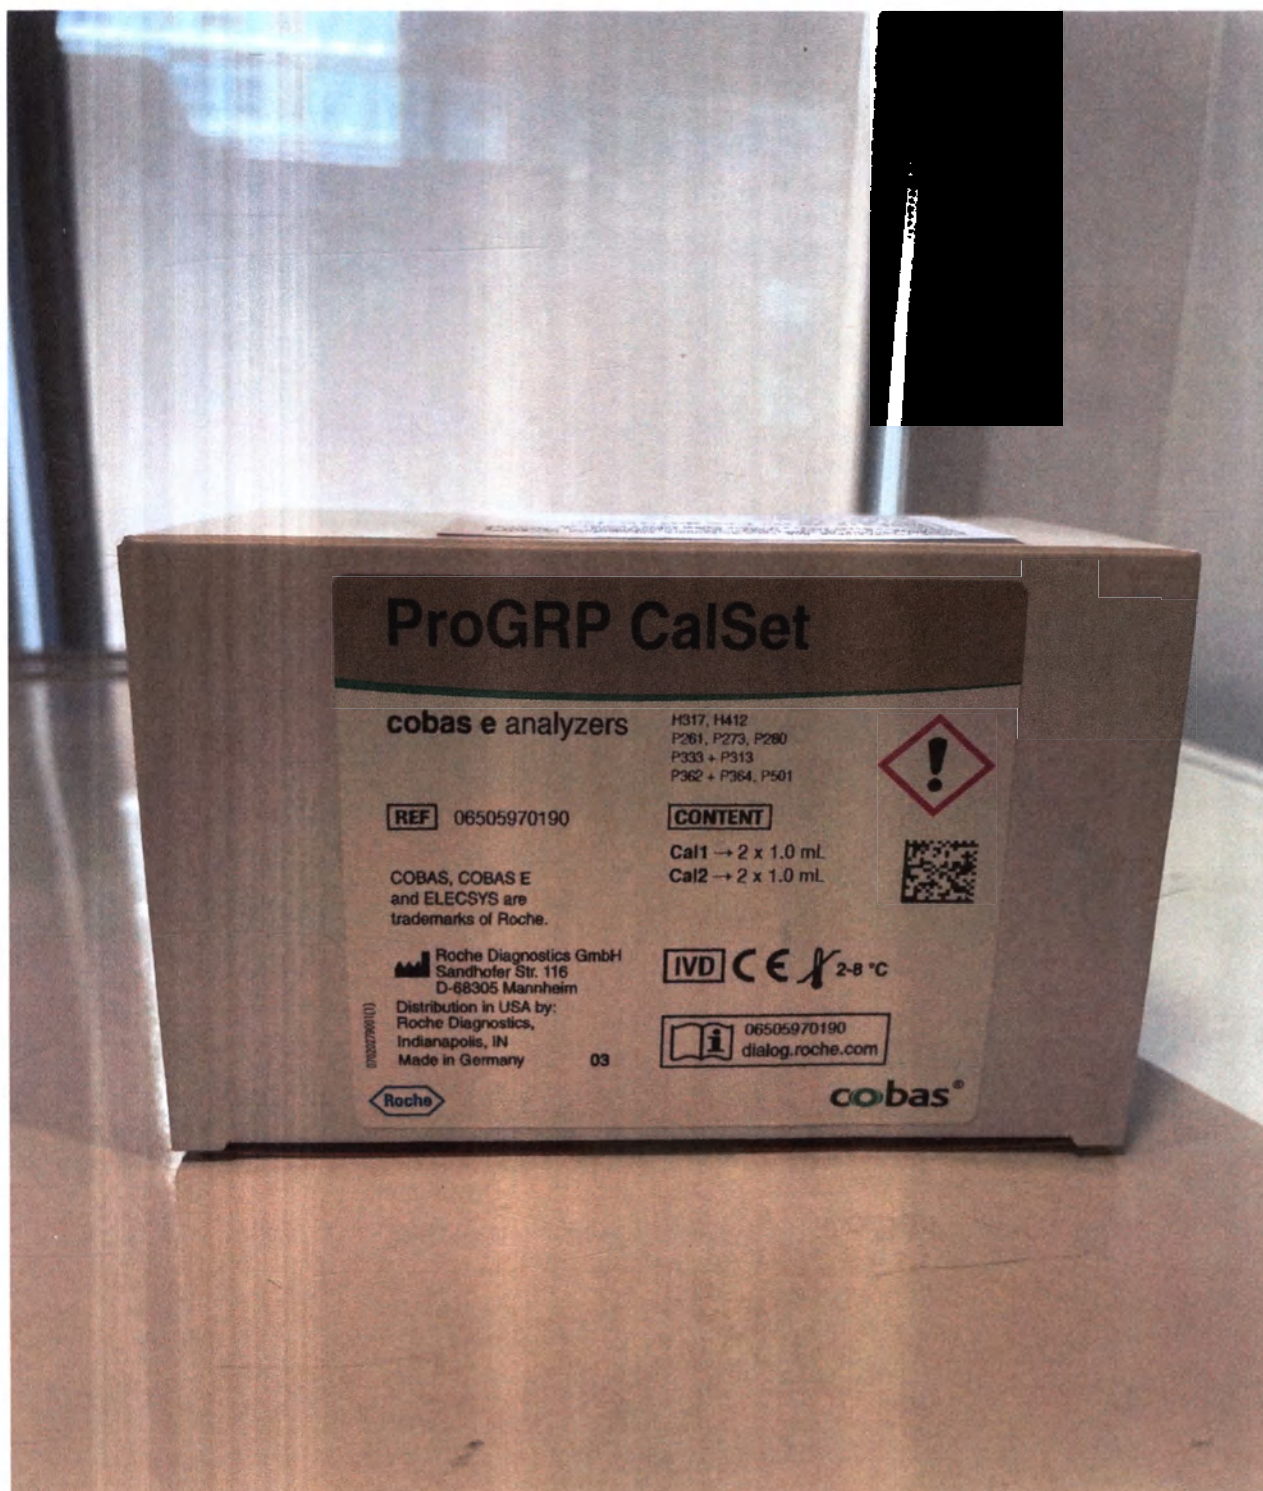

Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических
cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

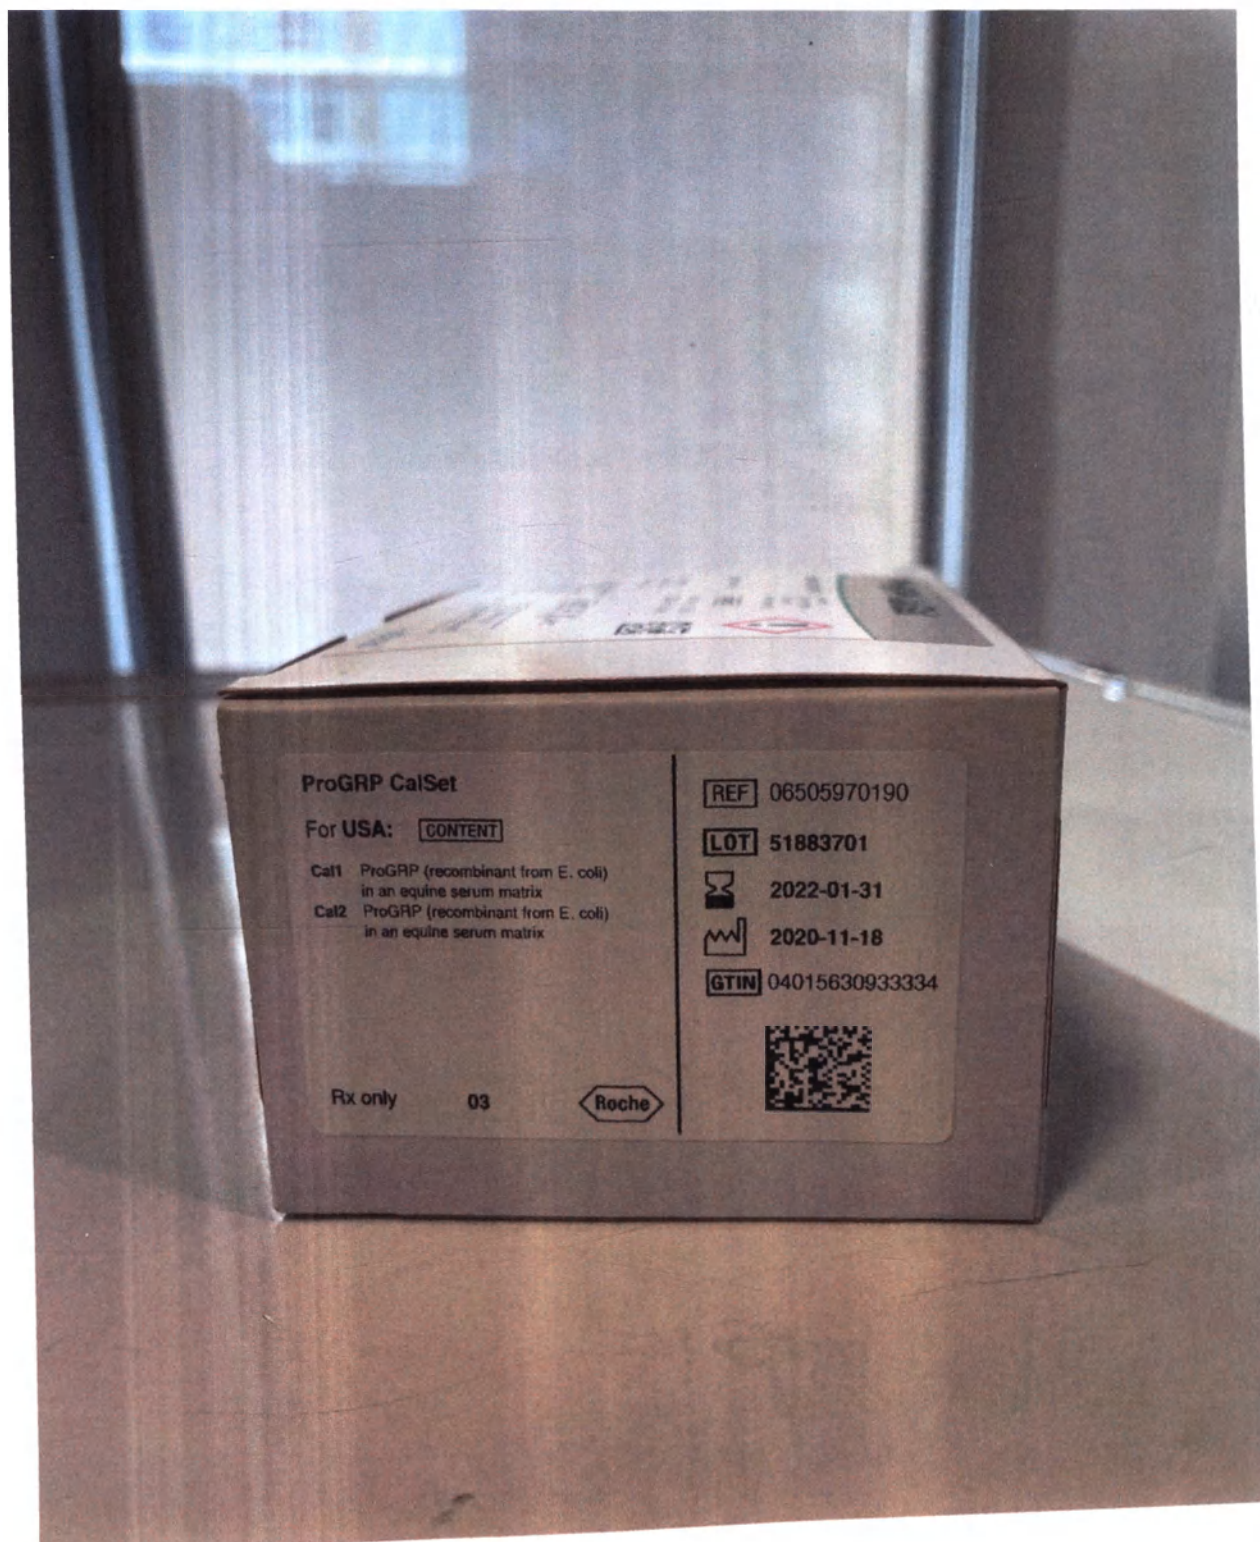

Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

(Макет маркировки на русском языке)

«Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers),

в составе:

1. Калибратор 1 (ProGRP Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (ProGRP Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Флакон пустой – 4 шт.;
4. Карта с штрих-кодом – 1 шт.;
5. Лист с штрих-кодами – 1 шт.;
6. Этикетка со штрих-кодом для флакона – 12 шт.;
7. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» («Рох Диагностикс ГмбХ»), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия


Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел. +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-84. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 06505970190


Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

-Калибратор 1 (ProGRP Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

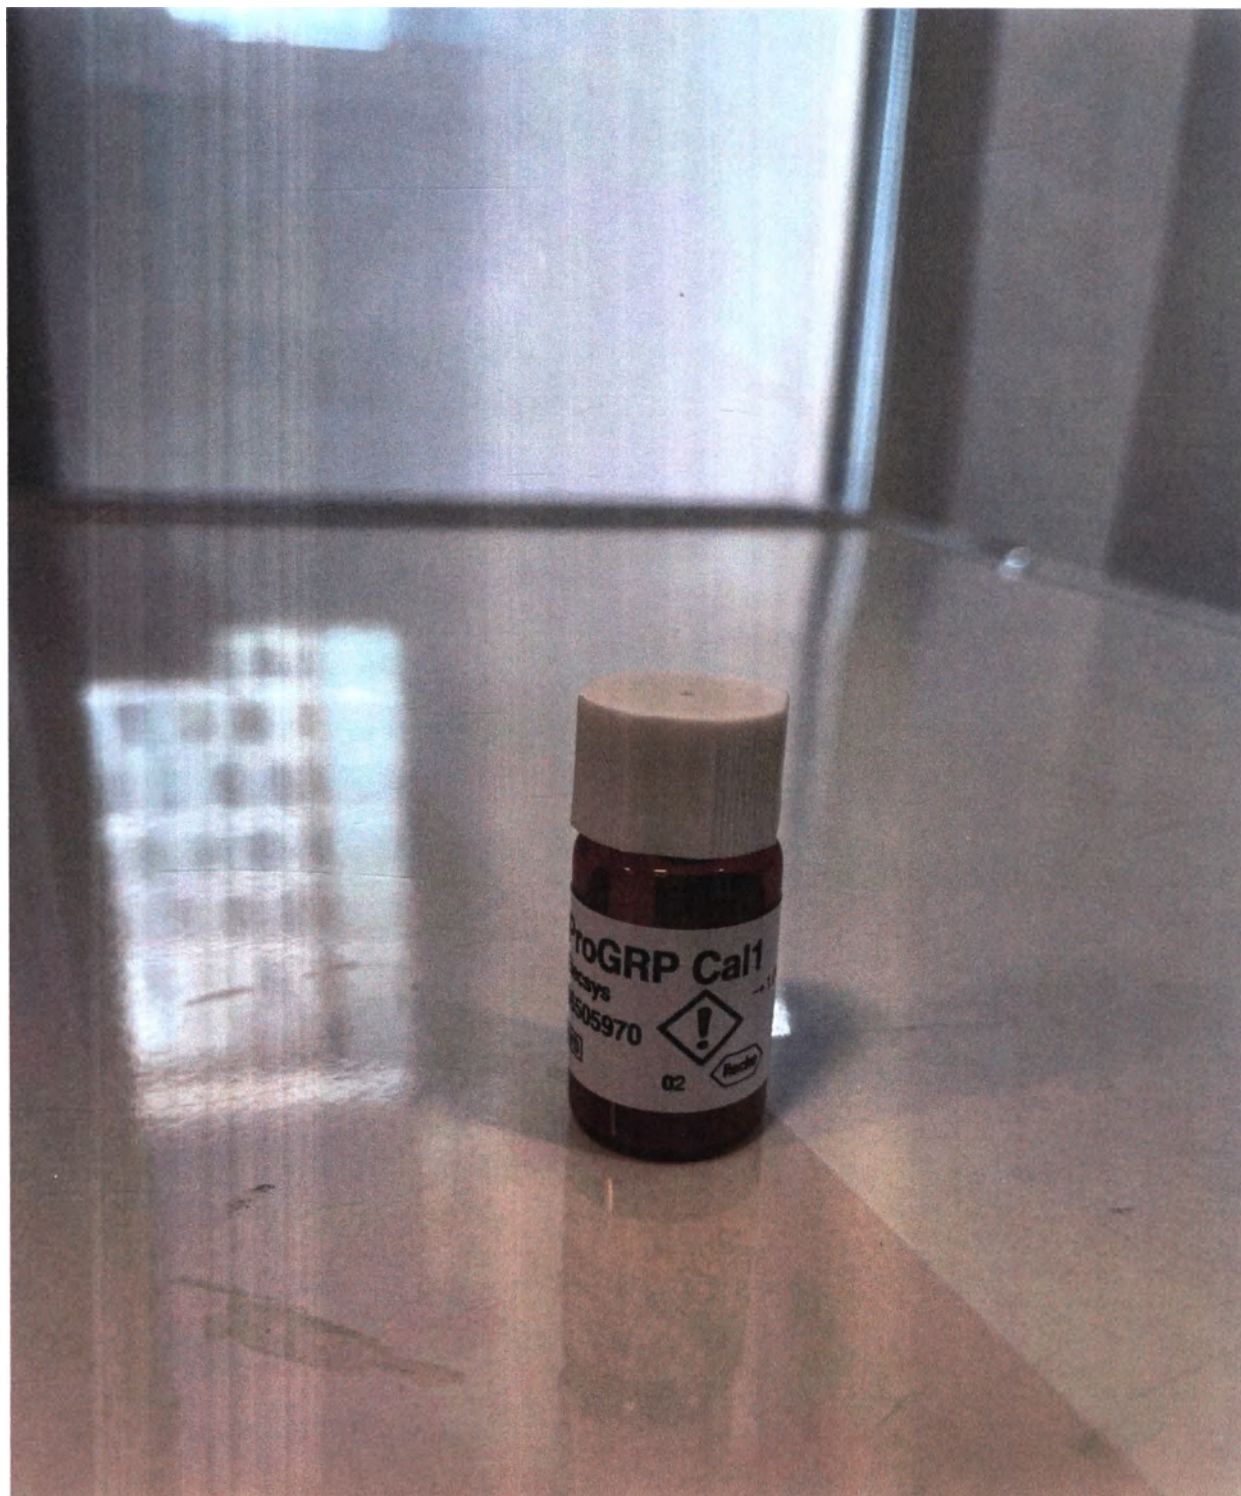

Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических
cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

- Калибратор 1 (ProGRP Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

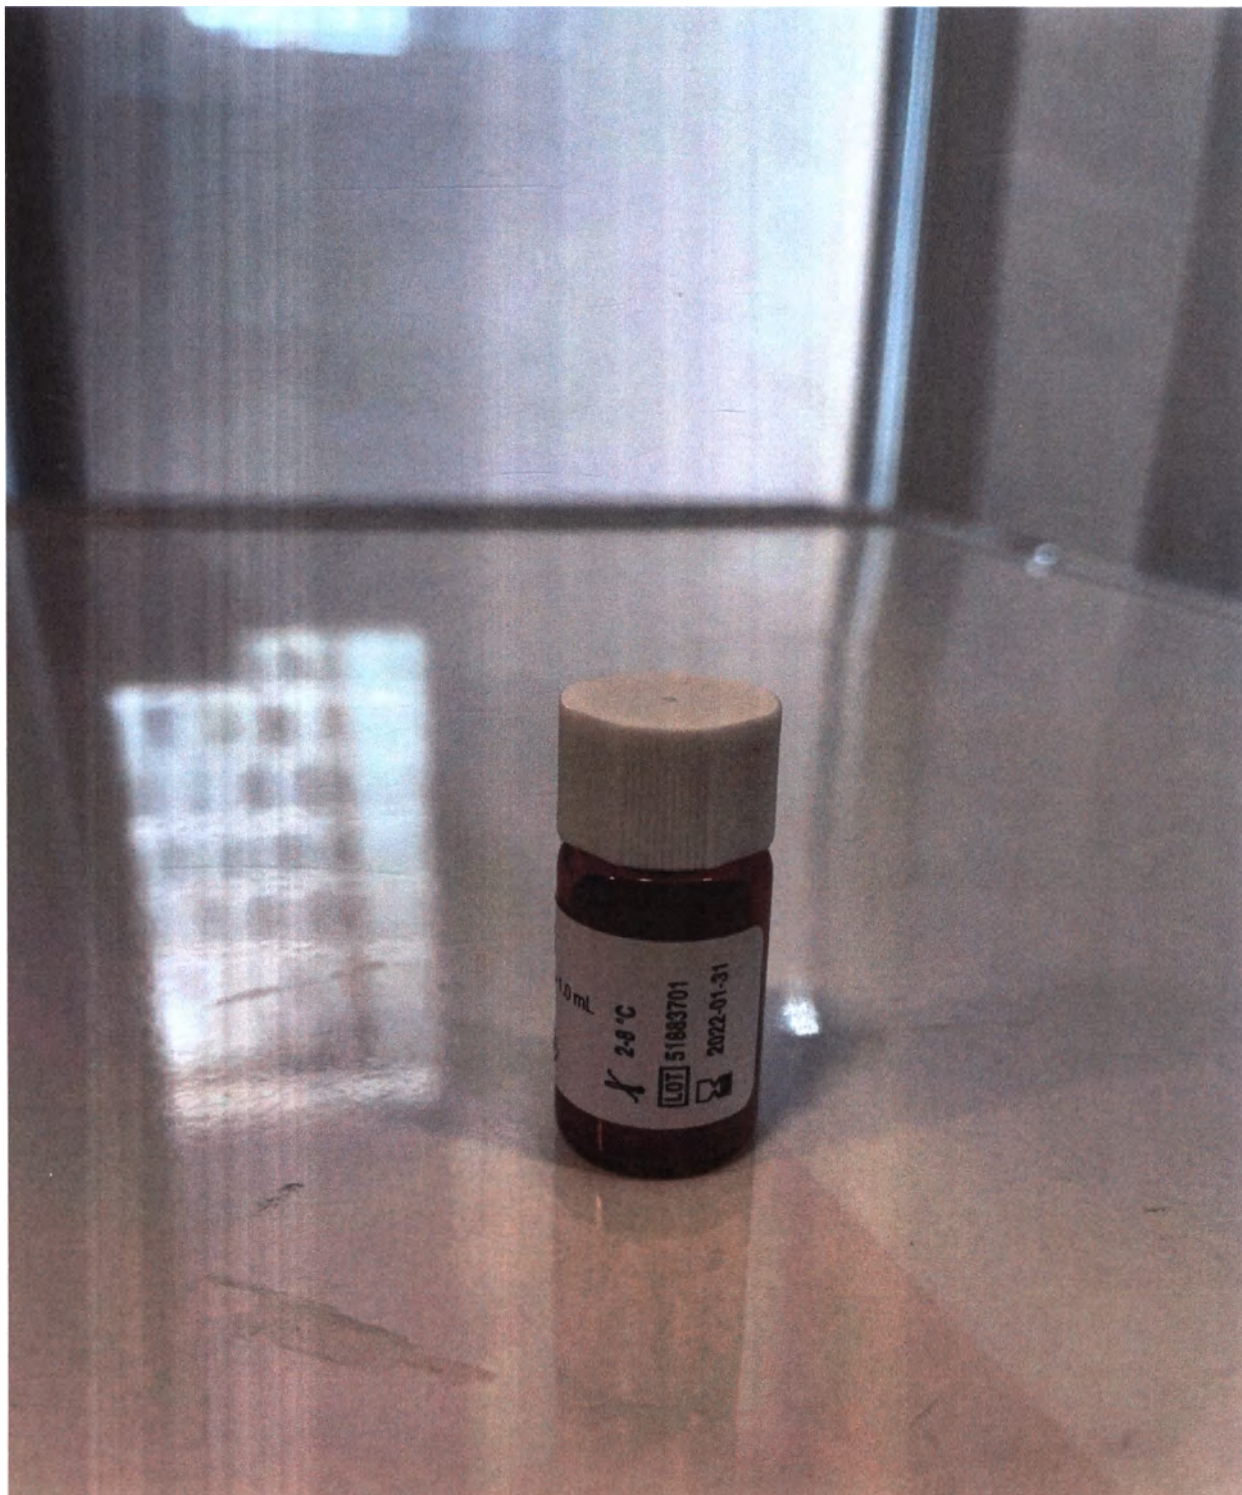

Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических
cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

- Калибратор 1 (ProGRP Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;




Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

- Калибратор 2 (ProGRP Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;




Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

-Калибратор 2 (ProGRP Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

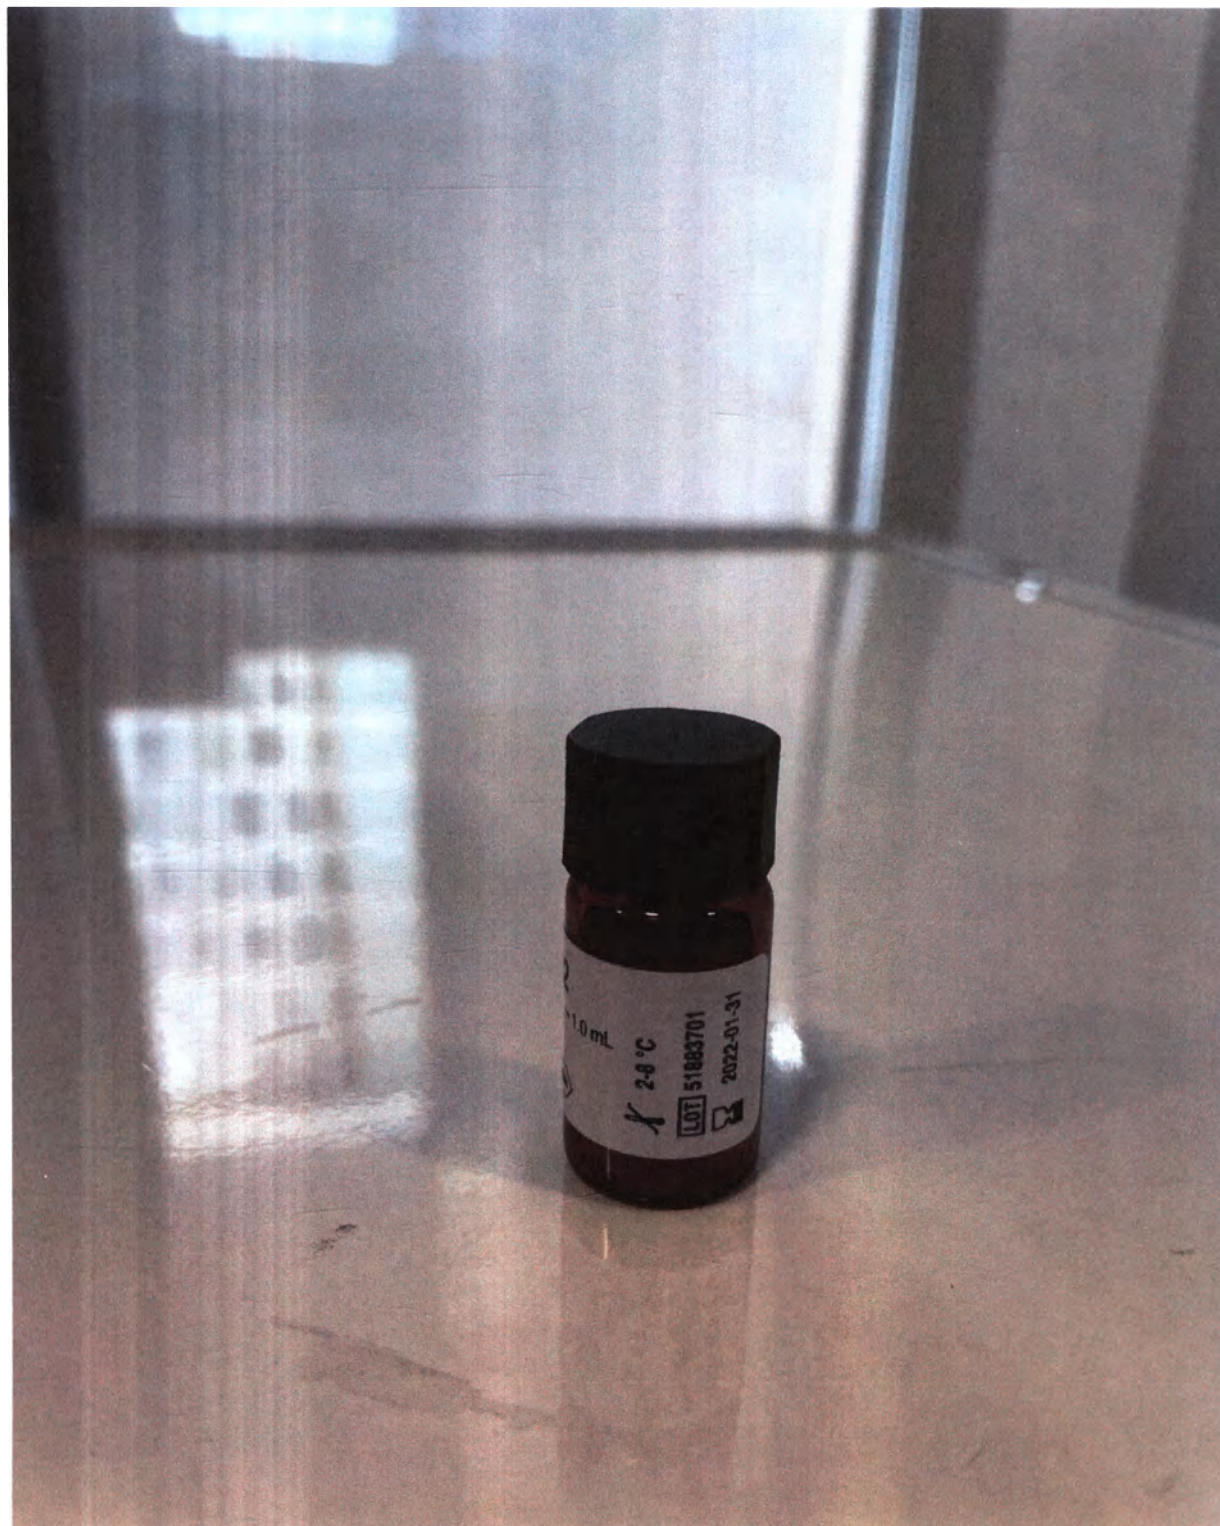


Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических
cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

- Калибратор 2 (ProGRP Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

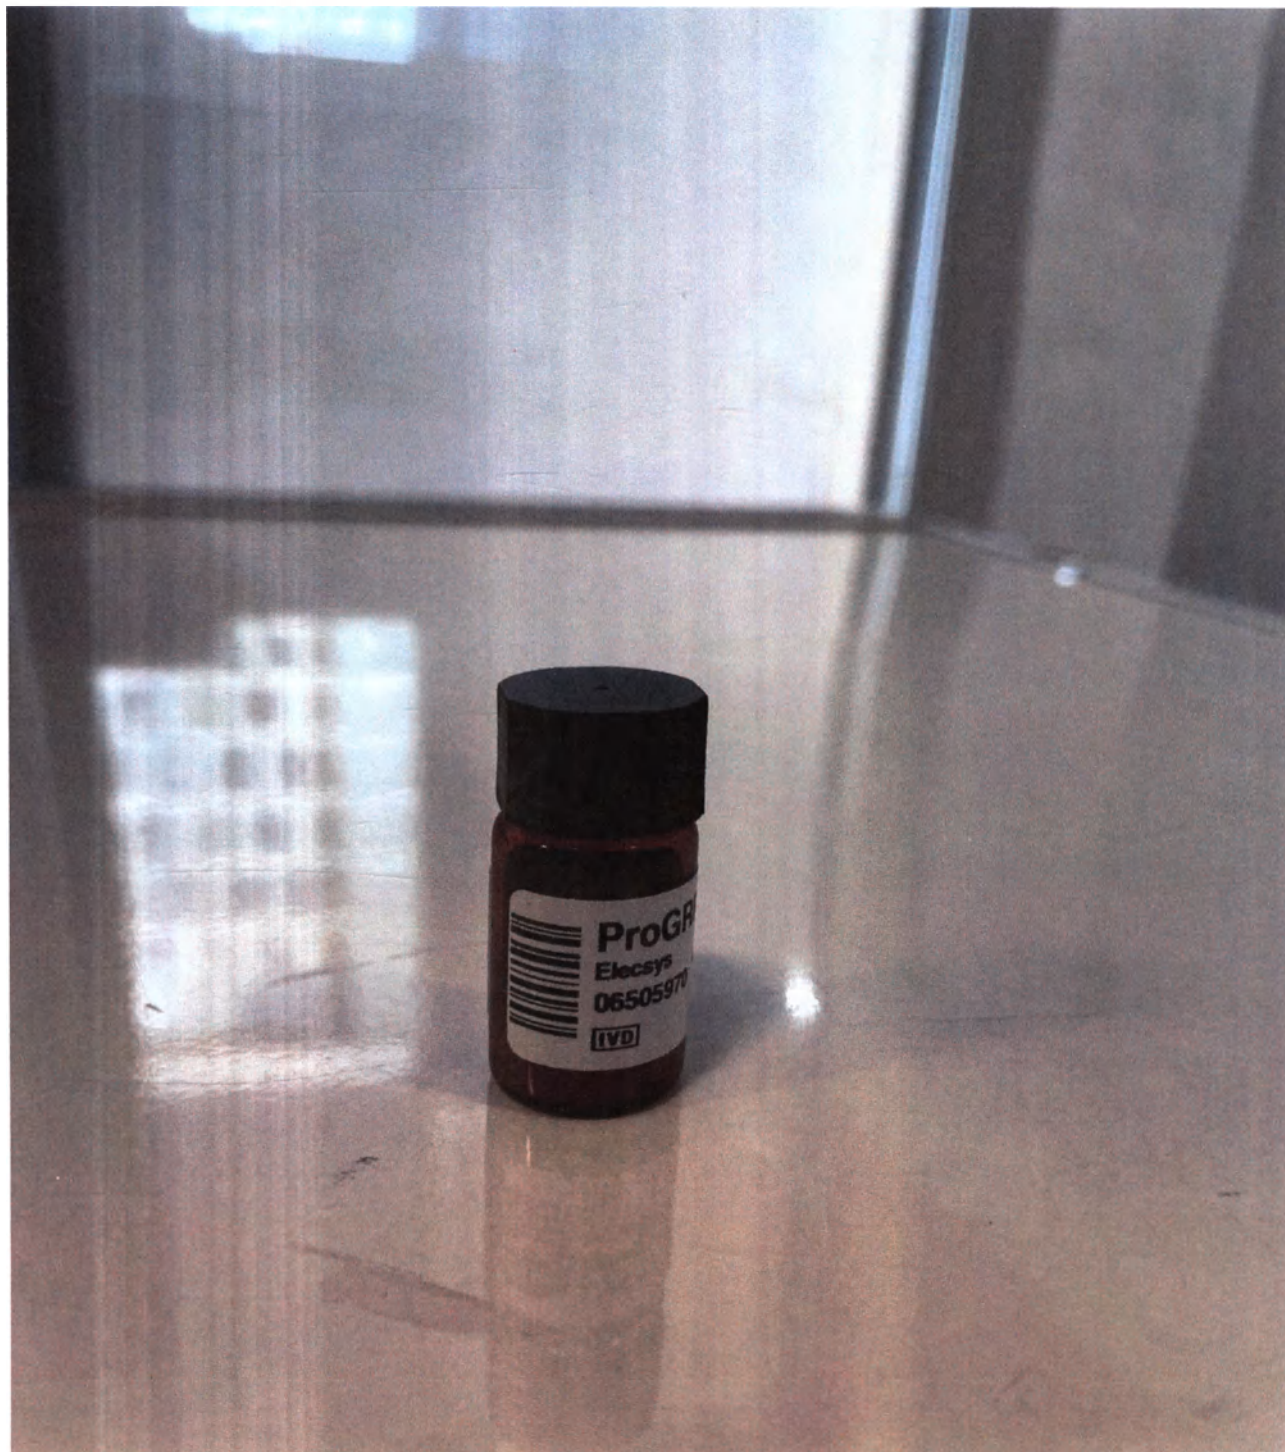

Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

Флакон пустой – 4 шт.;

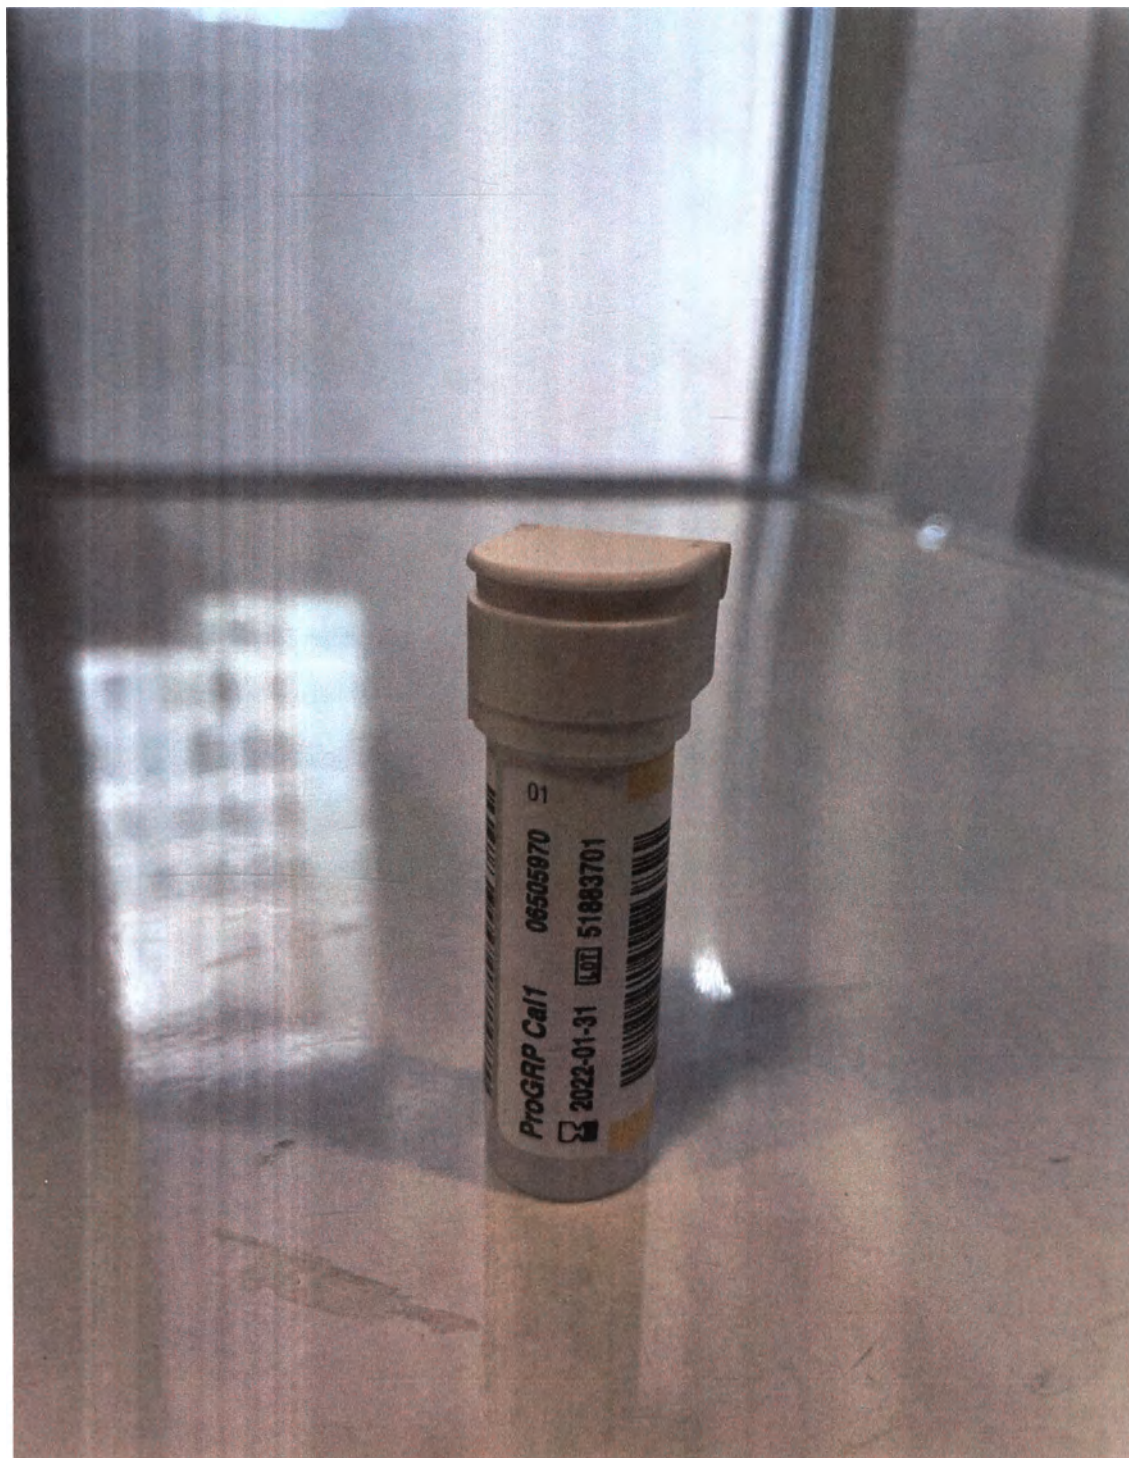


Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

-Флаккон пустой – 4 шт.;




Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

- Флакон пустой – 4 шт.;

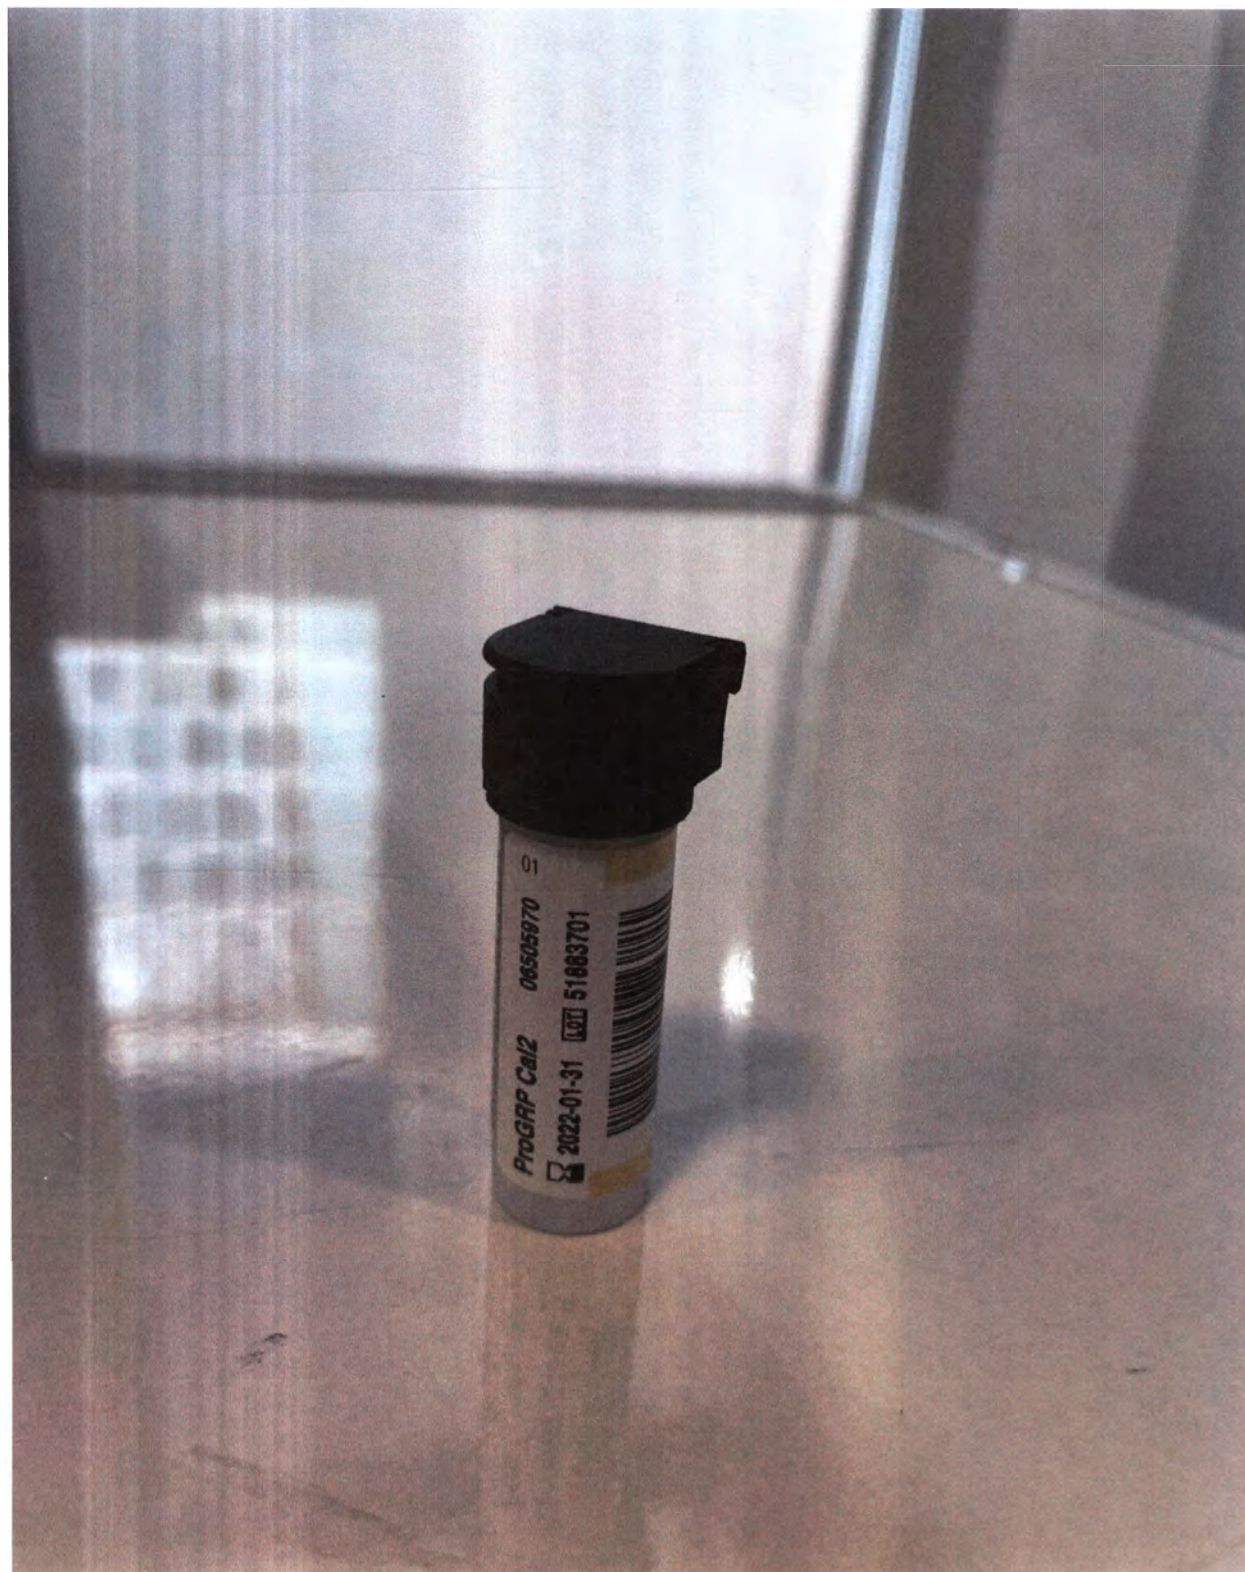

Набор калибраторов для количественного определения прогастрин релизинг пептида (ProGRP) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ProGRP CalSet cobas e analyzers)

- Флаккон пустой – 4 шт.;

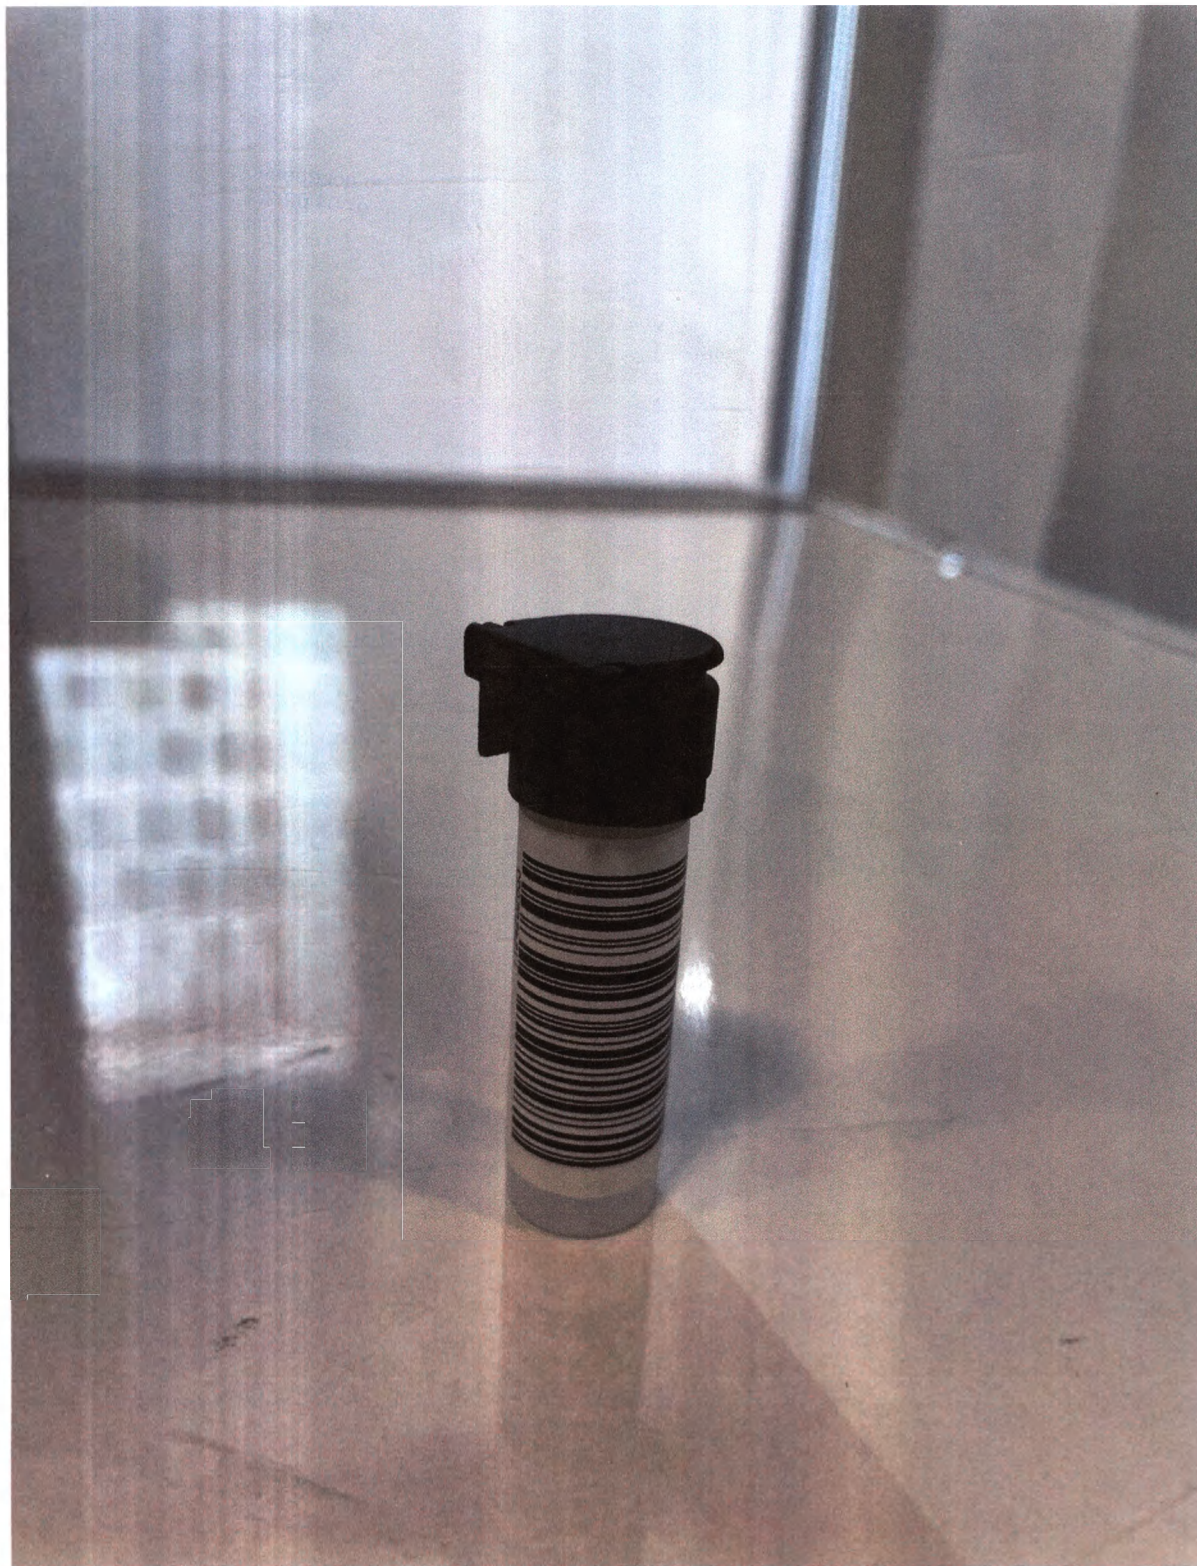

13



по доверенности
от 04.02.2021