

ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»


Чигринец Е.А.
2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

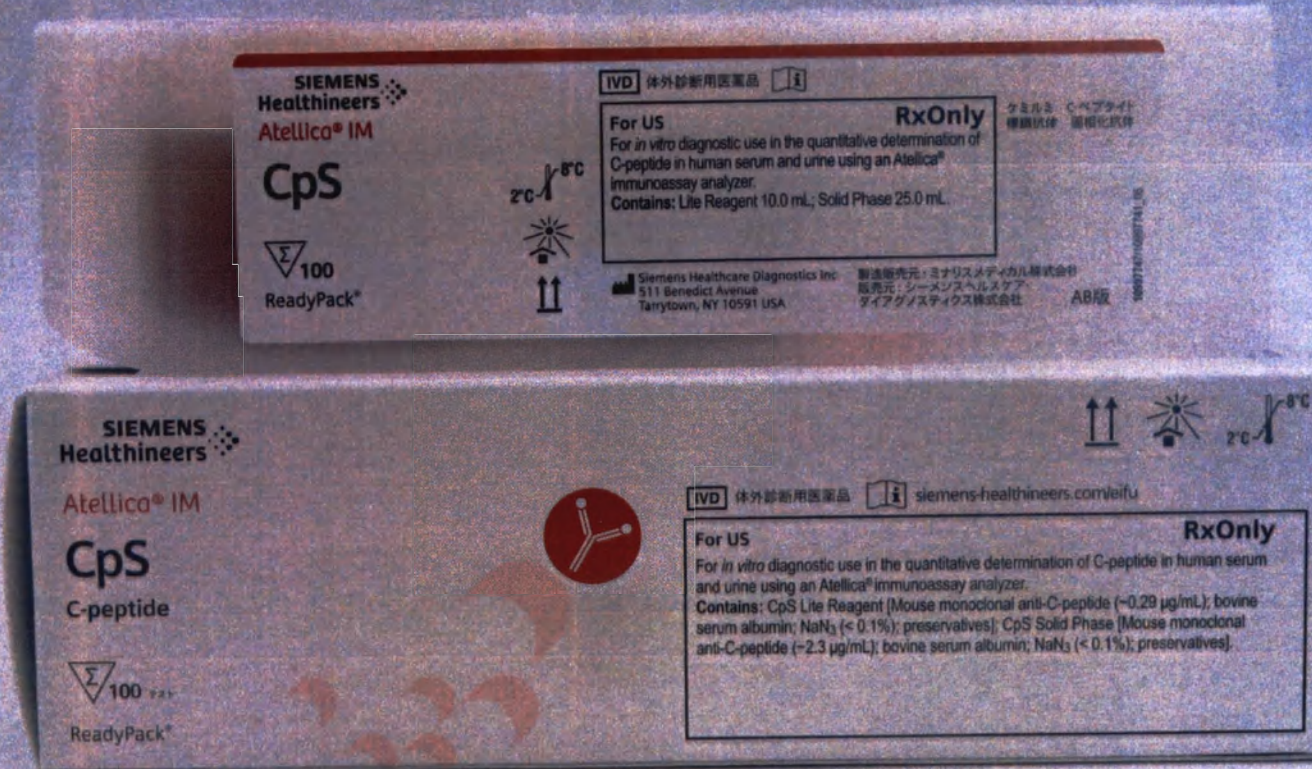


Рисунок 1. Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS)). Общий вид

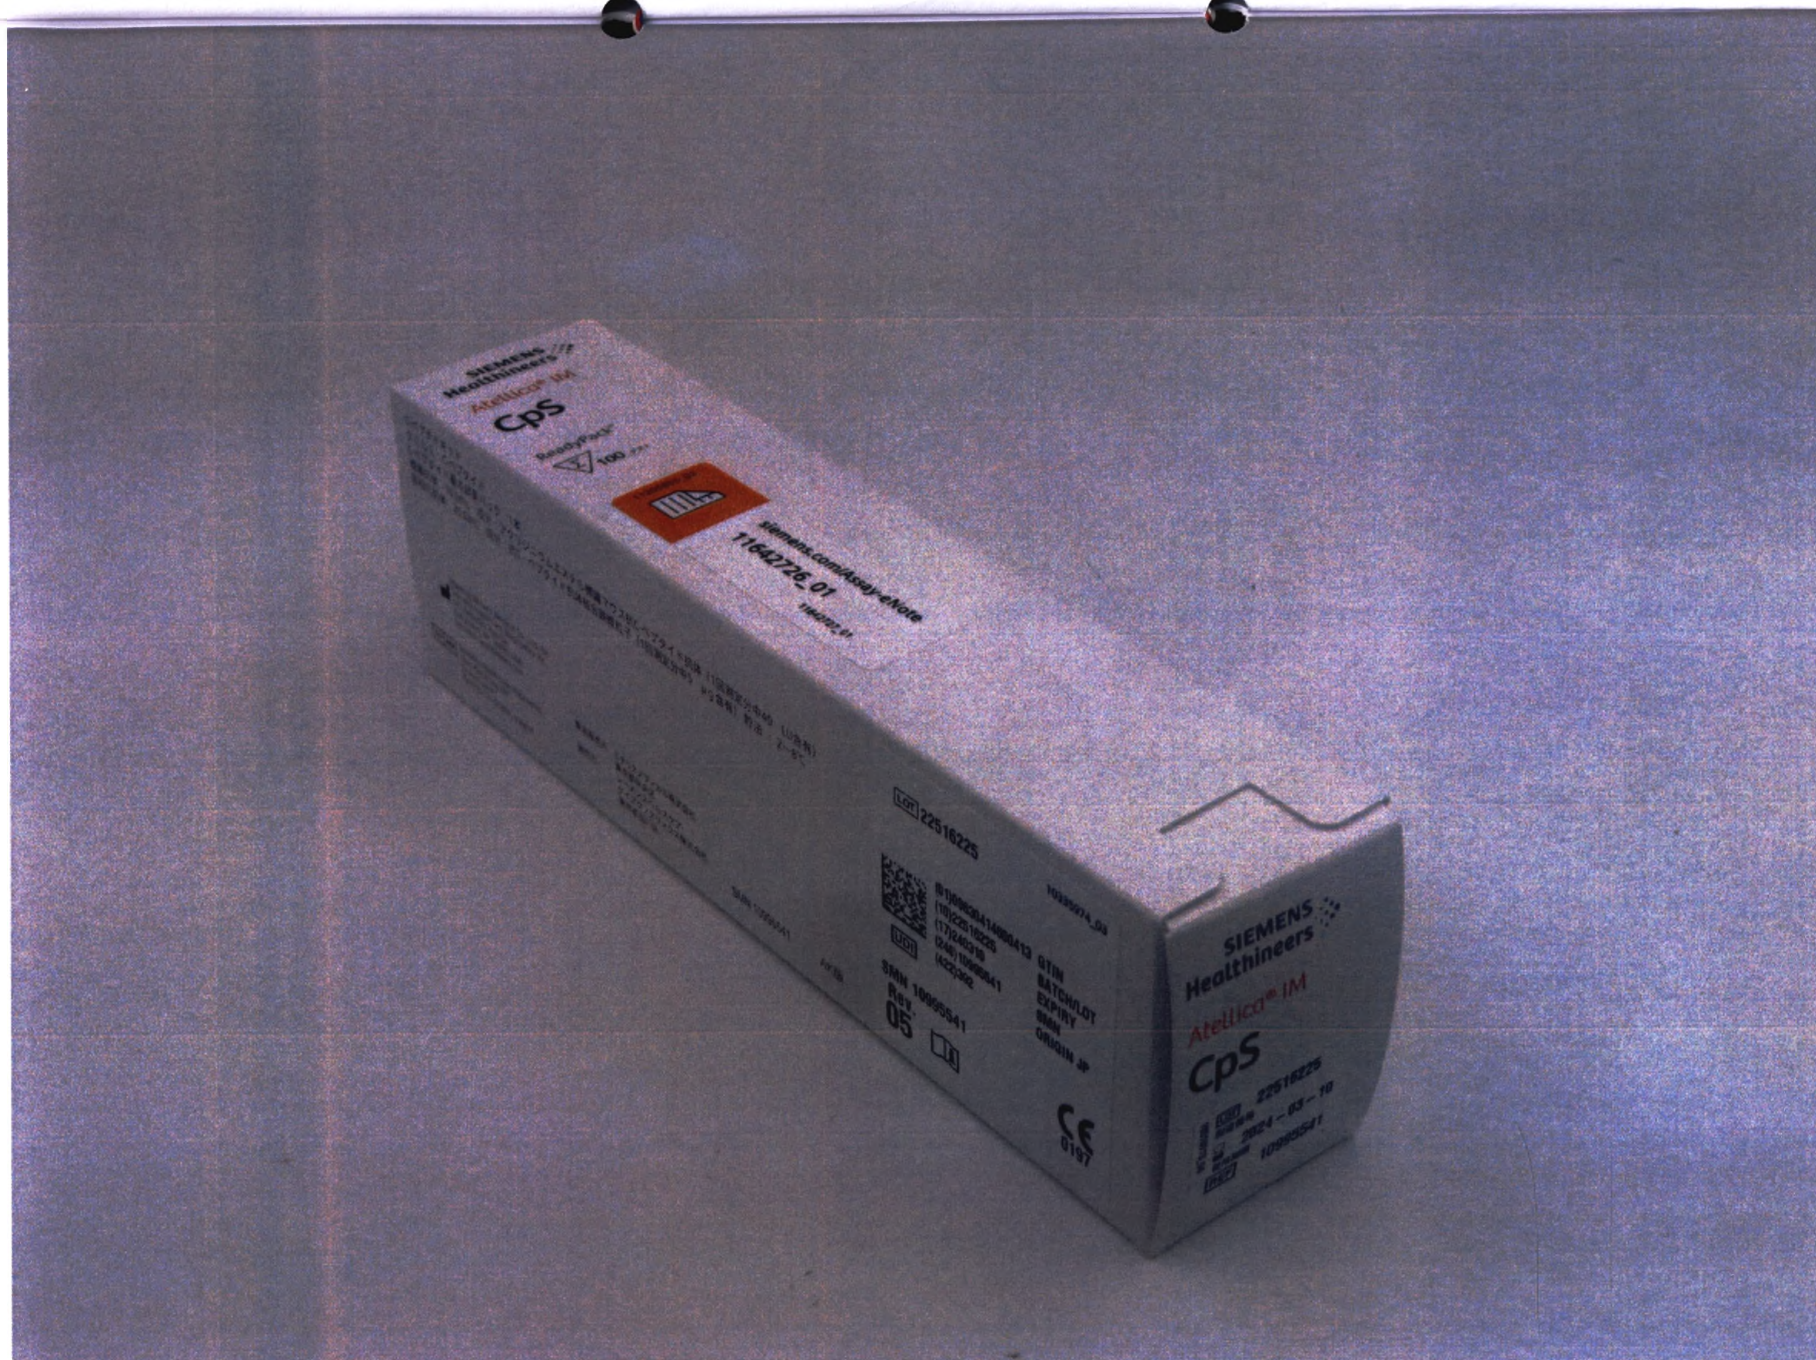


Рисунок 2. Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS)). Общий вид

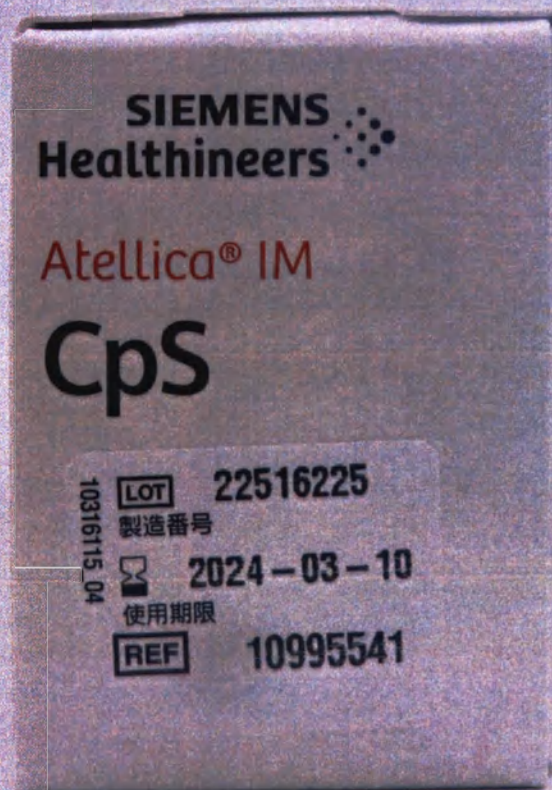


Рисунок 3. Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS)). Общий вид

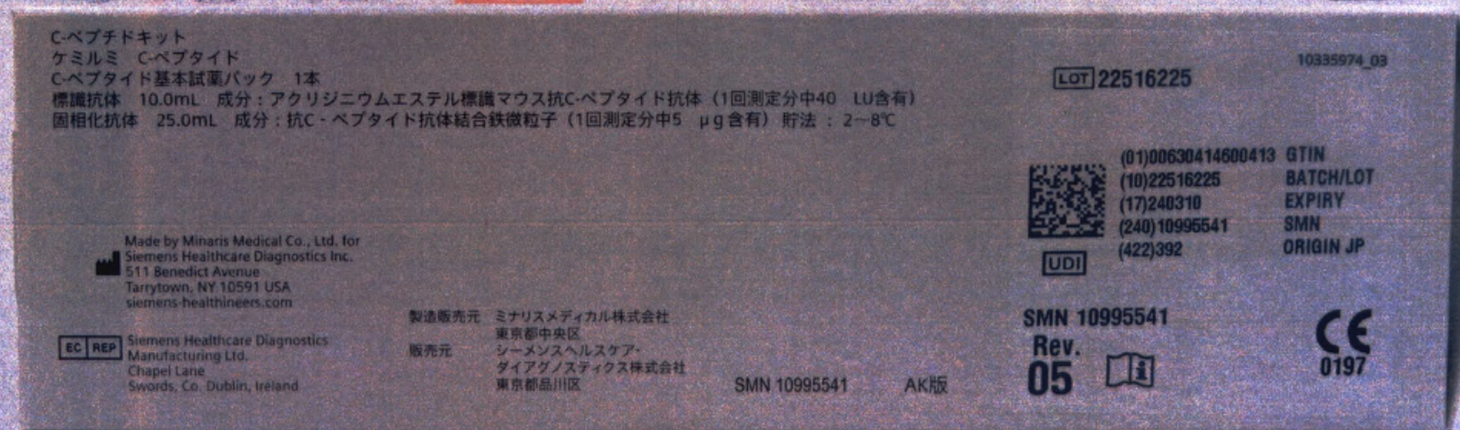


Рисунок 4. Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS)). Общий вид

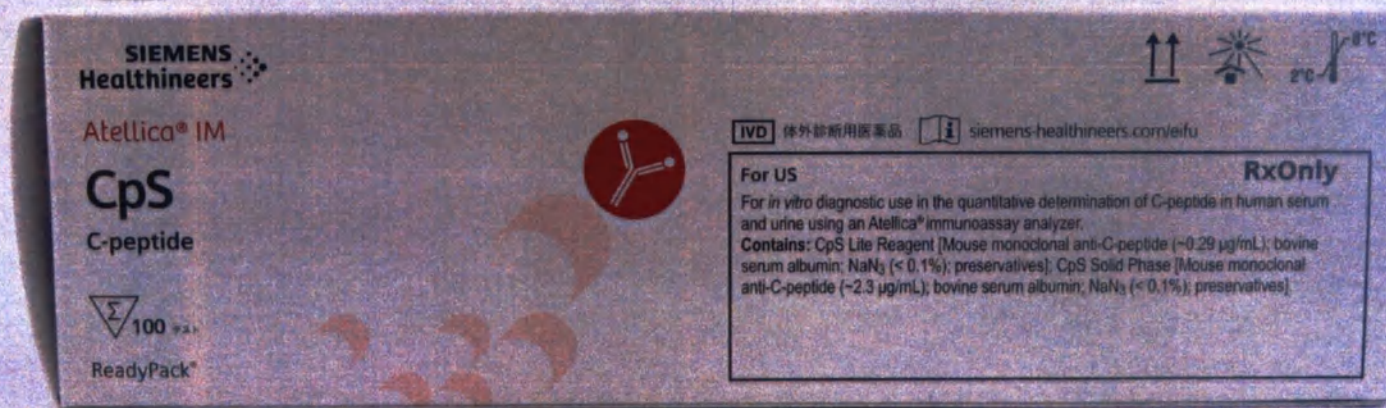


Рисунок 5. Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS)). Общий вид



Рисунок 6. Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS)). Общий вид

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CpS

Σ 100

ReadyPack®

IVD 体外診断用医薬品



For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative determination of C-peptide in human serum and urine using an Atellica® immunoassay analyzer.

Contains: Lite Reagent 10.0 mL; Solid Phase 25.0 mL.

ケミルミ C-ペプチド
標識抗体 固相化抗体

2°C 8°C



Siemens Healthcare Diagnostics Inc
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA

製造販売元: ミナリスメディカル株式会社
販売元: シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

AB版

10997747/10997741_05

SIEMENS
Healthineers



2°C

Рисунок 7. Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS)): Основной реагент

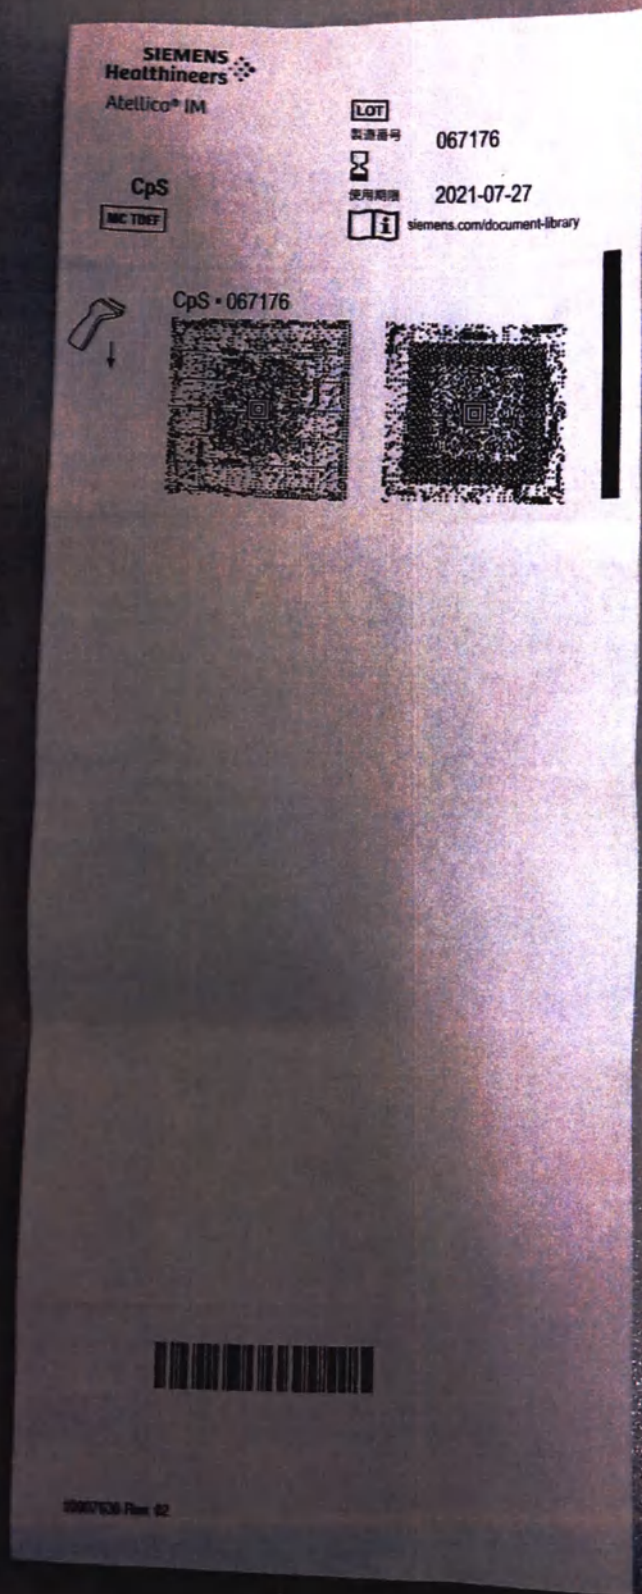


Рисунок 8. Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM CpS

10995541

Набор реагентов для определения С-пептида на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM C-peptide (Atellica IM CpS))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2021/14371 от 08.11.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96



Всего прошито и пронумеровано
10 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

