

ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
«ООО «Сименс Здравоохранение»



Чигринцев Е.А.
2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Дилуент для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

IRI DIL

DIL

1 x 20.0 mL

検体希釈液

2°C ~ 8°C

For US

For in vitro diagnostic use with an Atellica® immunoassay analyzer.

Contains: Buffered saline; casein, potassium thiocyanate (3.89%); NaH₂PO₄ (< 0.1%); preservatives.

RxOnly

FVD

体外診断用医薬品

18

siemens.com/elfu

Made by Minerva Medical Co., Ltd. for
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA
siemens-healthineers.com

BC REF

Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

製造販売元
販売元

ミネリスメディカル株式会社
東京都中央区
シーブンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社
東京都品川区大崎1-11-1

AS版

10995631_00

REF

SMN 10995631

LOT

製造番号

D0114

🕒

使用期限

2023-03-10

UDI



(01) 00630414600475
(10) D0114
(17) 230310
(240) 10995631
(422) 392

GTIN
BATCH/LOT
EXPIRY
SMN
ORIGIN JP

CE

20.0 mL

Рисунок 1. Дилуэнт для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL)). Фасовка флакон: Дилуэнт для инсулина Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL) - 20,0 мл/флакон.



Рисунок 2. Дилуэнт для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL)). Фасовка флакон: Дилуэнт для инсулина Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL) - 20,0 мл/флакон.



Рисунок 3. Дилуент для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL)). Фасовка флакон: Дилуент для инсулина Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL) - 20,0 мл/флакон.



Рисунок 4. Дилуент для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL)). Фасовка флакон: Дилуент для инсулина Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL) - 20,0 мл/флакон.

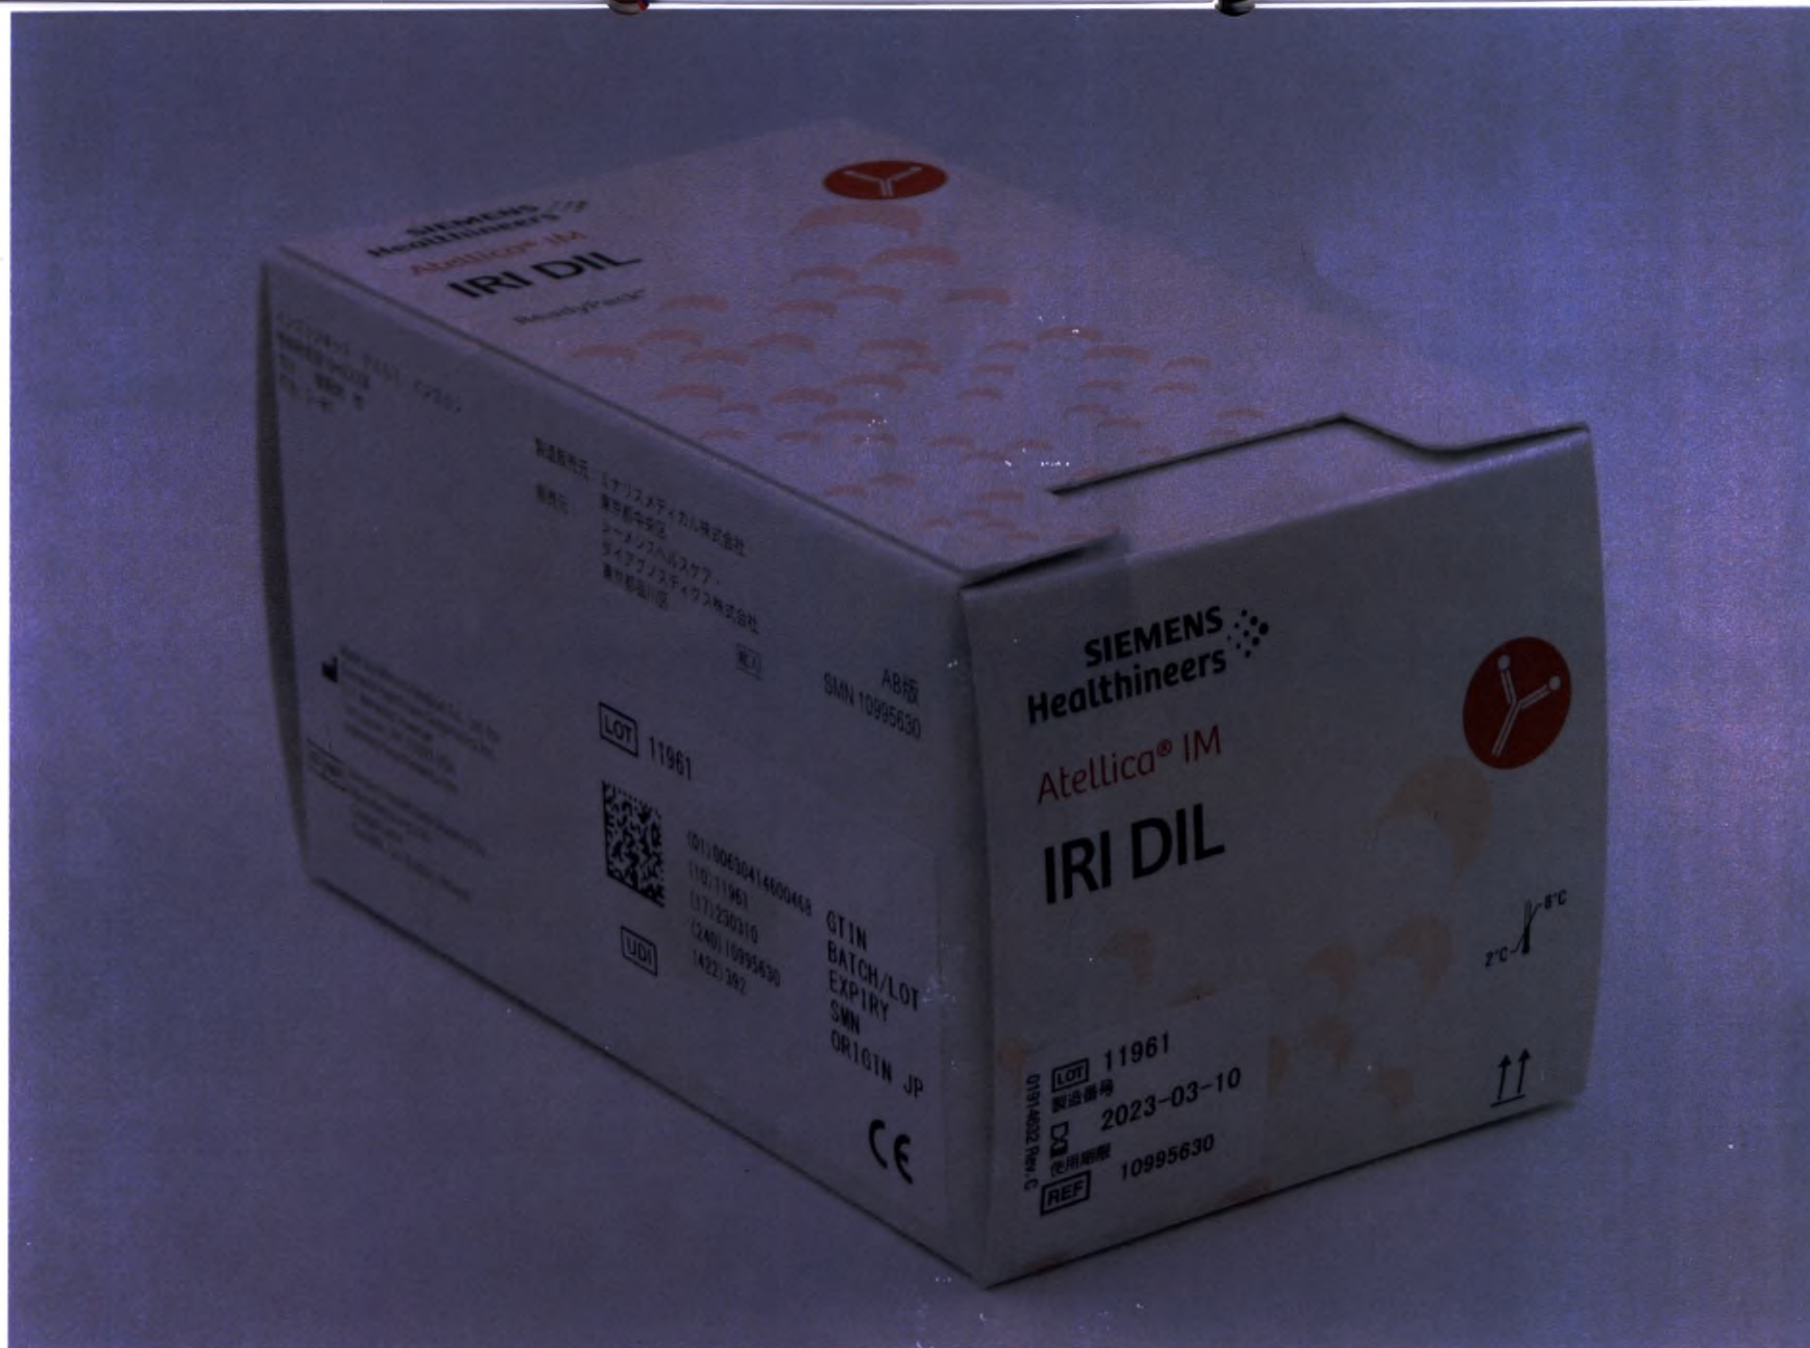


Рисунок 5. Дилуэнт для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL)): Фасовка 2 упаковки: Дилуэнт для

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

IRI DIL

DIL

2 x 10.0 mL

検体希釈液

ReadyPack®



2°C 8°C

IVD

体外診断用医薬品



siemens.com/eifu

For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use with an Atellica® immunoassay analyzer.

Contains: Buffered saline; casein, potassium thiocyanate (3.89%); NaN_3 (< 0.1%); preservatives.

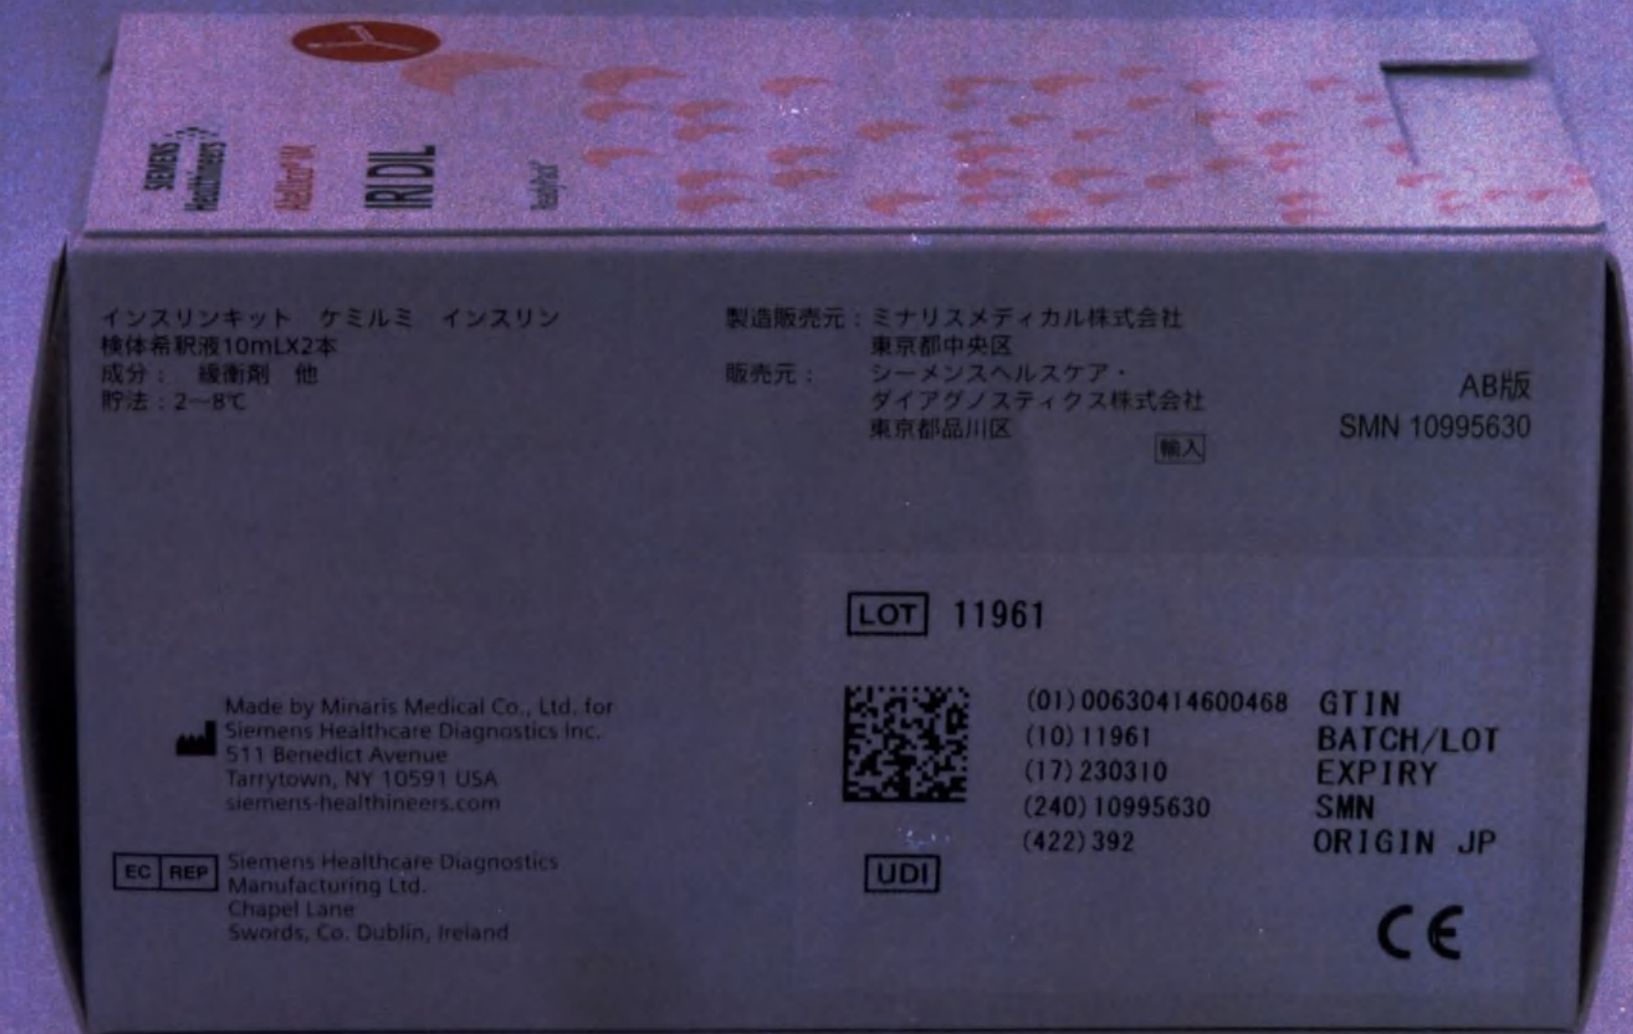


Рисунок 7. Дилуэнт для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL)): Фасовка 2 упаковки: Дилуэнт для

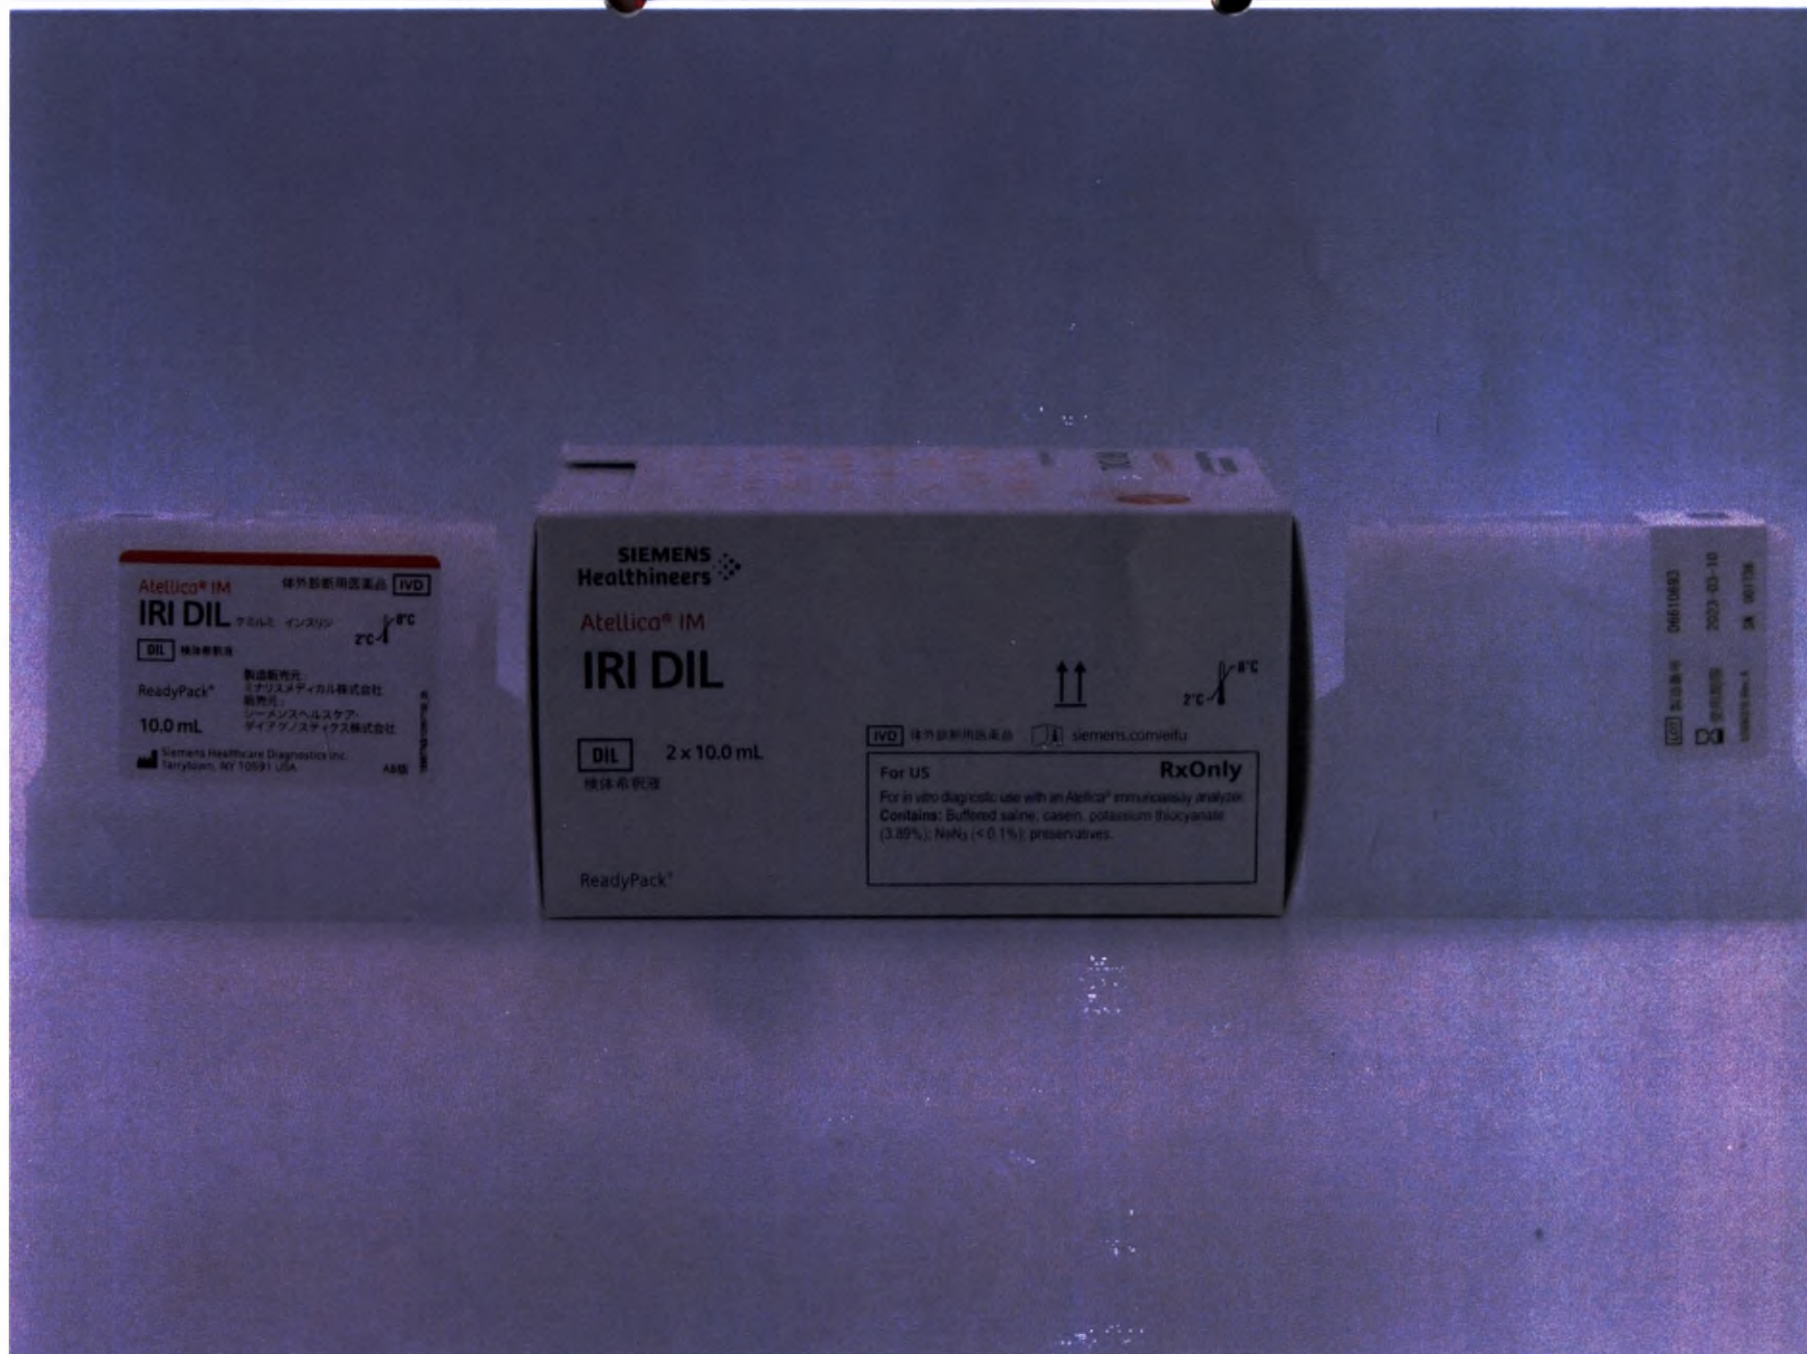


Рисунок 8. Дилуэнт для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL)): Фасовка 2 упаковки: Дилуэнт для

Atellica® IM

体外診断用医薬品 IVD

IRI DIL ケミルミ インスリン

2°C 8°C

DIL 検体希釈液

ReadyPack®

製造販売元:
ミナリスメディカル株式会社

販売元:
シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

10.0 mL

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

AB版

10997763/10997758_05

Рисунок 9. Дилуэнт для инсулина для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Insulin Diluent (Atellica IM IRI DIL)): Фасовка 2 упаковки: Дилуэнт для

Всего прошито и пронумеровано
10 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

