

Фотографические изображения медицинского изделия:

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественный», серия E001, производства ООО «Компания Алкор Био»

1. Фотография общего вида – стр. 2
2. Фотография коробки после вскрытия – стр.3
3. Флаконы реагентов, размещенный во вкладыше из полиэтилентерефталата – стр.4
4. «Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2» и «Стрипы чистые» - стр.5
5. Флаконы с реагентами – стр.6
6. Флаконы с контрольной и калибровочными пробами – стр.7
7. Пакет закрывающийся полиэтиленовый – стр.8
8. Пленка для ИФА планшетов – стр.9
9. Одноразовые наконечники и ванночки – стр. 10

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.**



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-8779

ПАСПОРТ №

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления вирусного белка класса G в реактор-связывающей домене коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный, серия E001»

Кат. №	Формирование №	Количество
200-85	2020-04-02	200 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
Медицинского назначения для
Набор реагентов для количественного
выявления иммуноглобулинов
связывающей домену поверхностного
коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD)
«SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный, серия E001»

SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный



АЛКОР БИО

SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный

Набор реагентов для количественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G в реактор-связывающей домену поверхностного гликопротеина S (спайк) коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный, серия E001»

Состав набора:

1. Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2	1 упак.	6. Стоп-реагент	1 фл.
2. Калибровочные пробы	6 фл.	7. Стрипы чистые	1 шт.
3. Контрольные пробы	1 фл.	8. Опорный стандарт	1 шт.
4. Буфер А	1 фл.	9. Опорный стандарт	2 шт.
5. Конъюгат Е	1 фл.	10. Пластины для ИФА	2 шт.
6. Буфер Н (20X)	1 фл.	11. Пластины для ИФА	2 шт.
7. Раствор ТМБ	1 фл.	12. Пластины для ИФА	2 шт.

ТУ 21.20.23-573-98539446-2021
РУ №

ООО «Компания Алкор Био»
192149, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162,
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный»
серия № 001
годен до: 2023-09-02
хранить при +2...+8 °C
готовить и использовать только для диагностики in vitro

Стрипы чистые SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный
серия № H82323
годен до: 2022-09-02
хранить при +2...+8 °C
готовить и использовать только для диагностики in vitro

Стоп-реагент
объем 50 мл
серия № 5518
годен до: 2023-09-16
хранить при +2...+8 °C
готовить и использовать только для диагностики in vitro

Буфер А SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный
объем 25 мл
серия № 001
годен до: 2022-09-02
хранить при +2...+8 °C
готовить и использовать только для диагностики in vitro

Буфер Н (20X)
объем 50 мл
серия № H086
годен до: 2022-09-30
хранить при +2...+8 °C
готовить и использовать только для диагностики in vitro


Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 157AB
годен до: 2023-03-06
хранить при +2...+8 °C
готовить и использовать только для диагностики in vitro

Конъюгат Е SARS-CoV-2-ИФА-анти-RBD-количественный
объем 14 мл
серия № 001
годен до: 2022-09-02
хранить при +2...+8 °C
готовить и использовать только для диагностики in vitro

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для количественного иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов класса G к рецептор-
связывающему домену поверхностного гликопротеина S (Spike)
коронавируса SARS-CoV-2 (анти-RBD) «SARS-CoV-2ИФА-анти-
RBD-количественный», серия E001





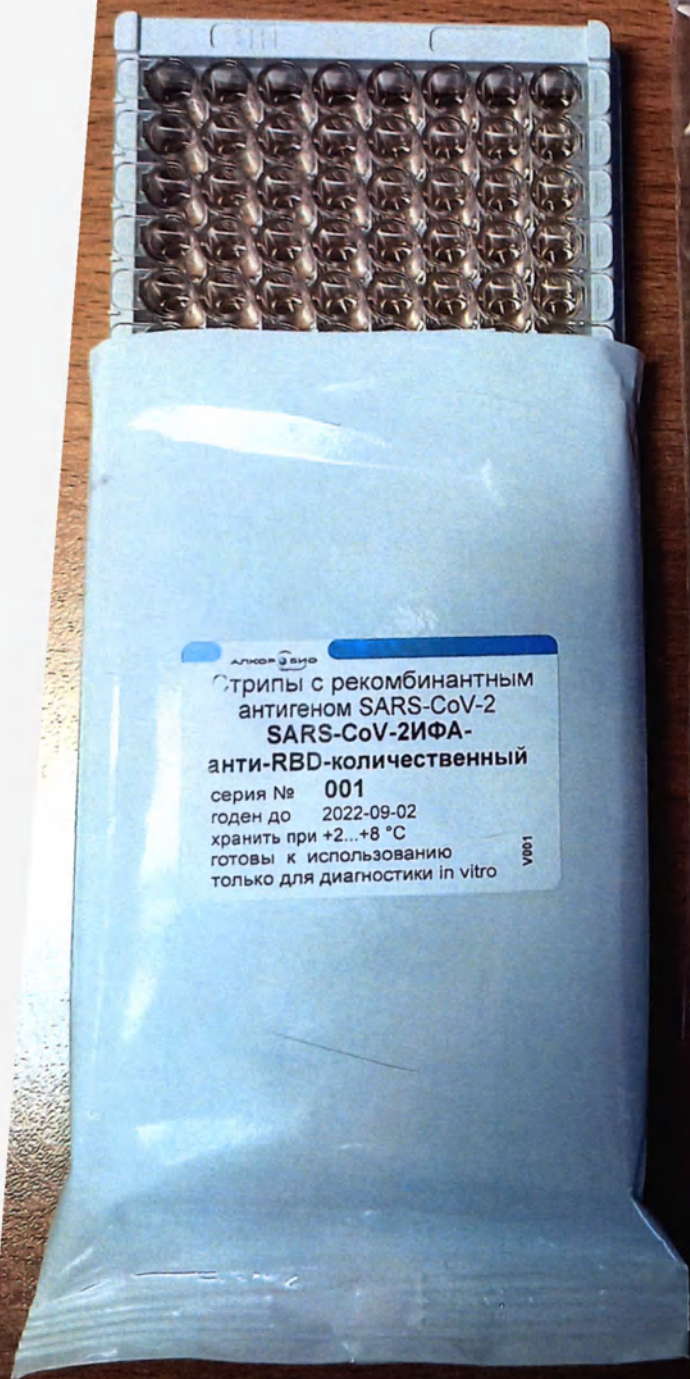





Контрольная проба
S-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественная
1,8 мл годен до 2022-09-02
готова к использованию
№ 001 хранить при +2...+8°C
для диагностики in vitro

проба №1
S-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественная
1,8 мл до 2022-09-02
к использованию
при +2...+8°C
in vitro

проба №2
S-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественная
1,8 мл до 2022-09-02
к использованию
при +2...+8°C
in vitro


проба №3
S-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественная
1,8 мл до 2022-09-02
к использованию
при +2...+8°C
in vitro


Калибровочная проба
S-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественная
1,8 мл годен до 2022-09-02
готова к использованию
№ 001 хранить при +2...+8°C
для диагностики in vitro

проба №4
S-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественная
1,8 мл до 2022-09-02
к использованию
при +2...+8°C
in vitro

проба №6
S-CoV-2ИФА-анти-RBD-количественная
1,8 мл до 2022-09-02
к использованию
при +2...+8°C
in vitro



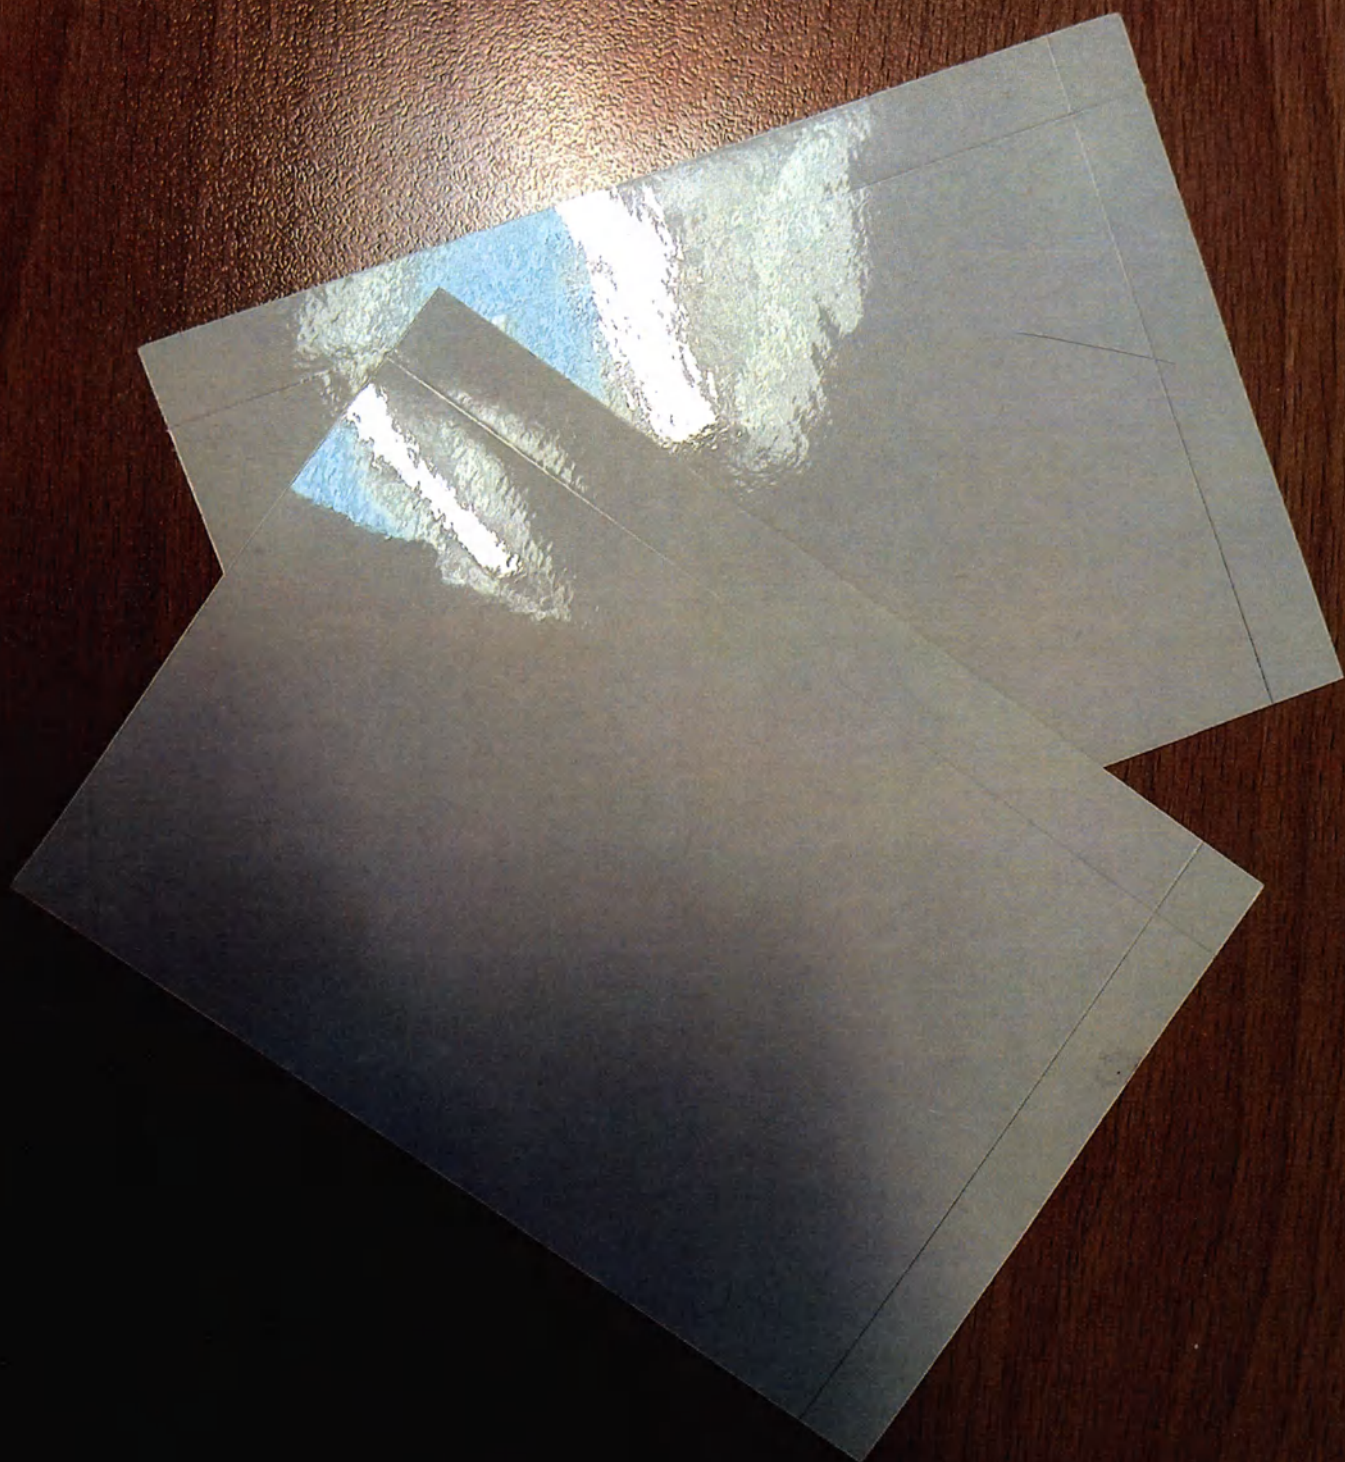

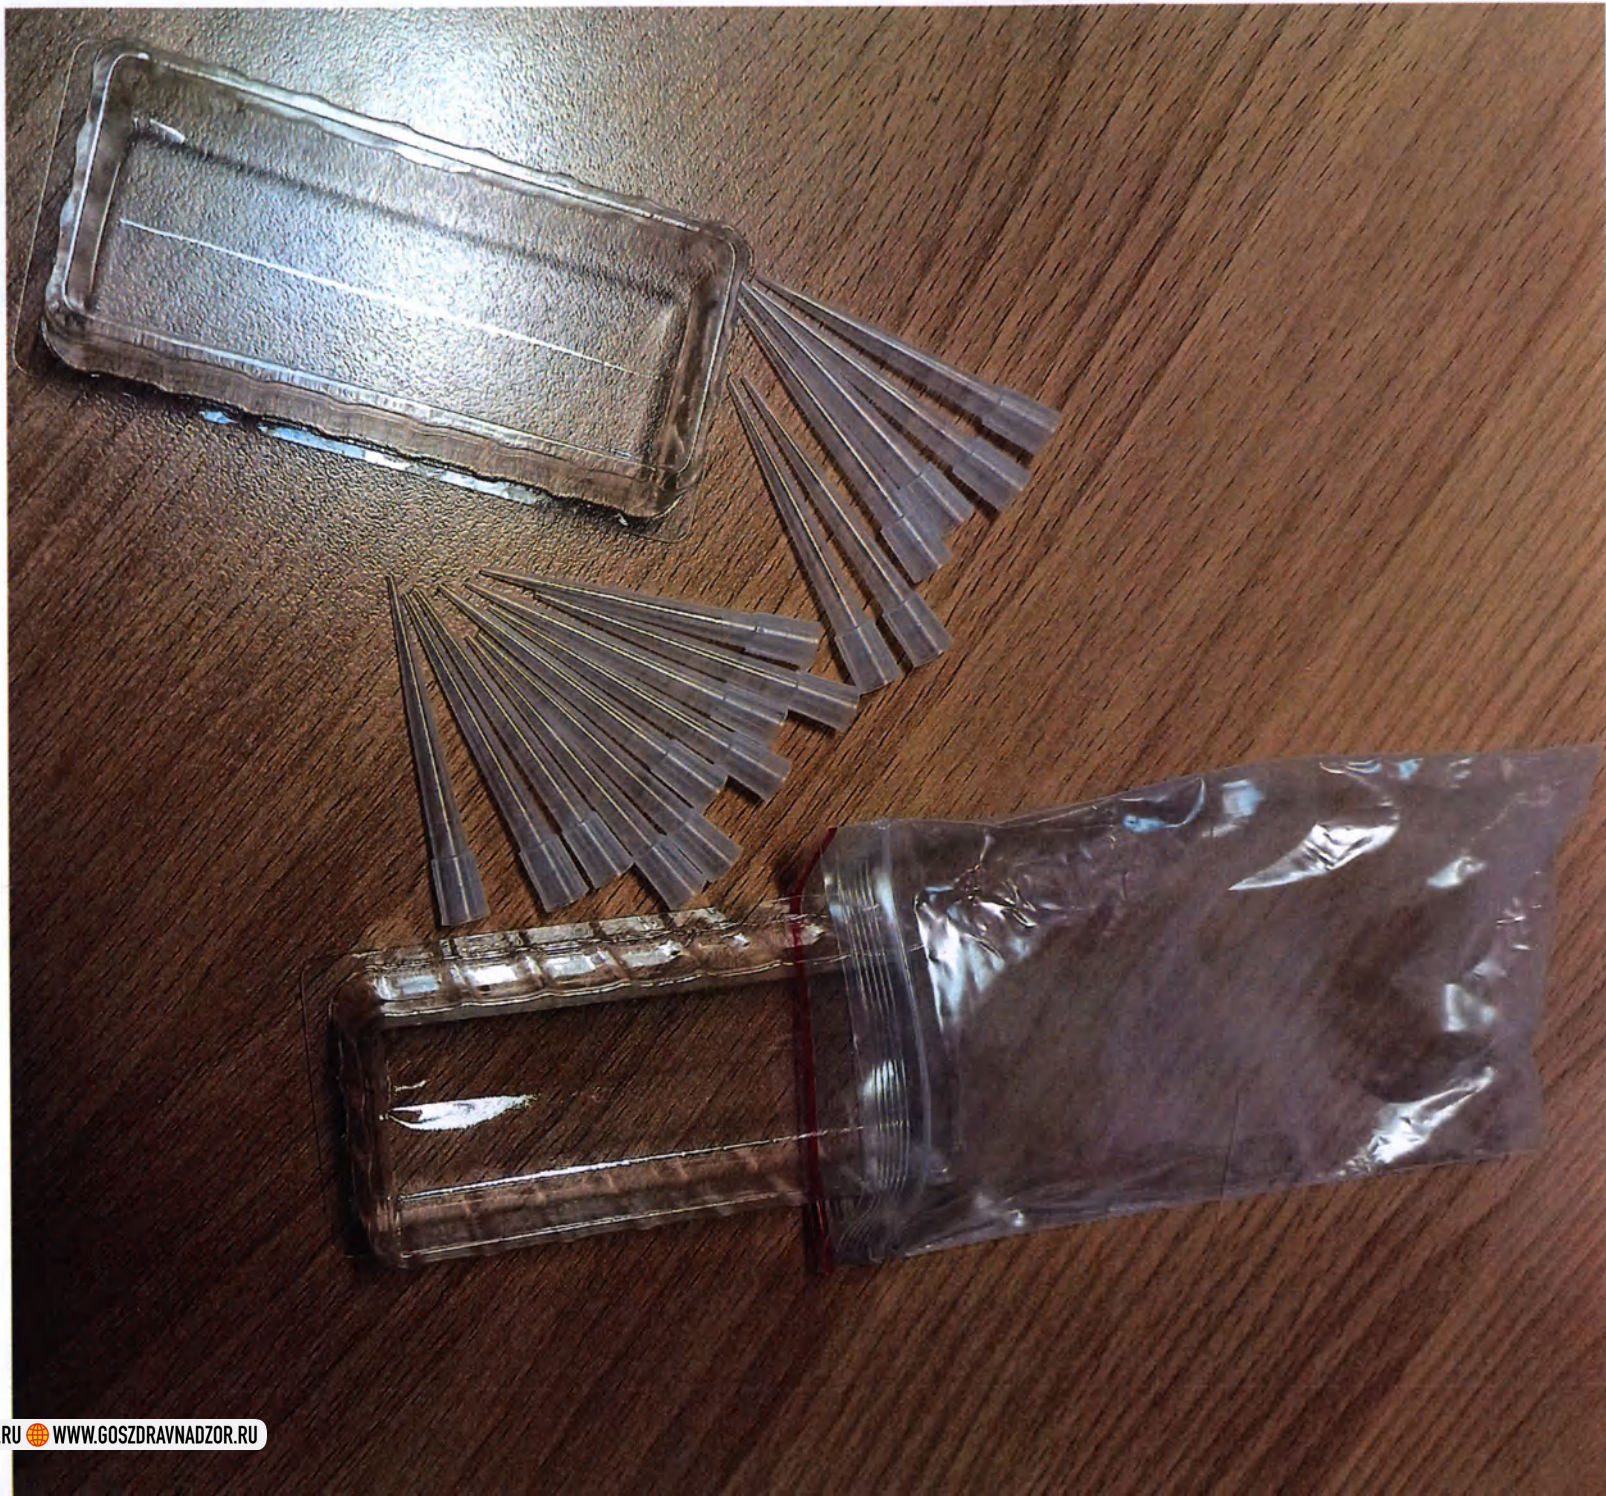

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 10 (десять)
лист 28



Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

8