

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
АО «ПФК Обновление»
Калустров В.Б.

Фотографические изображения

**«Презервативы WELOVE® из натурального латекса
в различных вариантах исполнения»**

Производство:
ТЯНЬЦЗИНЬ ХЬЮМАН - КЭА ЛАТЕКС КОРПОРЕЙШН
(TIANJIN HUMAN-CARE LATEX CORPORATION)
№ 223 West 14 Road, Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Area)
300308 Tianjin China, Китай



Медицинское изделие вариант исполнения:
«Презервативы WELOVE® Classic (классические)» (изделие без упаковки).



Медицинское изделие вариант исполнения:
«Презервативы WELOVE® Extra thin (особо тонкие)» (изделие без упаковки).



Медицинское изделие вариант исполнения:
«Презервативы WELOVE® Ultraglide (с дополнительной силиконовой смазкой)» (изделие без упаковки).



Медицинское изделие вариант исполнения:
«Презервативы WELOVE® Ribbed&Dotted (с точечным и ребристым рифлением)» (изделие без упаковки).



Медицинское изделие вариант исполнения:
«Презервативы WELOVE® XXL (увеличенного размера)» (изделие без упаковки).



Медицинское изделие вариант исполнения:
«Презервативы WELOVE® Supreme (анатомической формы)» (изделие без упаковки).



Медицинское изделие вариант исполнения:
«Презервативы WELOVE® Dotted (с точечным рифлением)» (изделие без упаковки).



Медицинское изделие вариант исполнения:
«Презервативы WELOVE® Maxsense
(ультратонкие, сверхчувствительные, со специальной силиконовой смазкой)» (изделие без упаковки).



Лицевая сторона/Face side

①




1 Проверьте срок годности на фольгированной упаковке, а так же ее целостность. Если срок годности истек или упаковка нарушена, используйте другой презерватив.

2. Надорвите упаковку со стороны зубчатой кромки и обращайтесь с презервативом осторожно, так как его можно повредить ногтями и острыми предметами (ювелирные украшения, пирсинг)



②

③



3. Достаньте презерватив из упаковки и посмотрите, как он раскатывается. Презерватив легко раскатывается в одном положении и практически не раскатывается в другом.

4. Презерватив надевается только на эрегированный половой член. Нажмите на кончик (накопитель) презерватива, чтобы удалить воздух. Расположите презерватив на конце полового члена и другой рукой раскатайте его по всей длине до самого основания.



④



6. Завяжите использованный презерватив и поместите в емкость для отходов. Не смывайте презерватив в канализацию.

5. После семяизвержения удалите презерватив, пока половой член еще находится в эрегированном состоянии.



⑥


Линейка WELOVE®



Классические



Особо тонкие



Maxsense

Ультратонкие, сверхчувствительные, со специальной силиконовой смазкой



с точечными ребристым рифлением



анатомической формы




с дополнительной силиконовой смазкой



с точечным рифлением



XXL

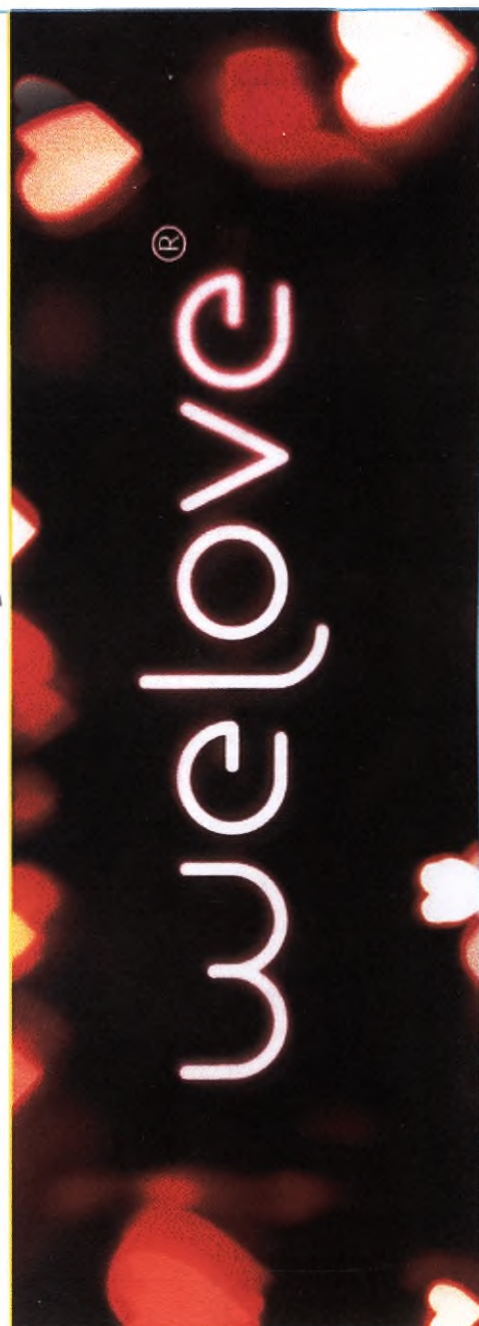

Презервативы WELOVE®

welovecondoms.com

Презервативы WELOVE®

Презервативы WELOVE® из натурального латекса в различных вариантах исполнения предназначены для предотвращения нежелательной беременности и защиты от заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в том числе вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

 Hypoallergenic
 Long Last Technology

Отсутствуют
ароматизаторы
и красители

Высококачественная
силиконовая смазка

 Skin effect

Используется только
высокоэластичный
натуральный латекс

 Ultra Thin Technology

Минимальная толщина
высокоэластичного
натурального латекса

Данное медицинское изделие может применяться в домашних условиях для индивидуального пользования. Презервативы прошли проверку электроникой.

Показания к применению

- Средство для предохранения от нежелательной беременности и ЗППП, в том числе ВИЧ;
- Как временный метод контрацепции, если женщина не хочет или не считает нужным принимать оральные контрацептивы, во время перерыва в использовании комбинированных оральных контрацептивов (КОК) или внутриматочной спирали (ВМС);
- В сочетании с другими методами контрацепции для достижения максимального эффекта.

Возможные побочные эффекты

Натуральный латекс, входящий в состав презервативов, может вызывать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок. В случае повышенной чувствительности или аллергии на натуральный латекс проконсультируйтесь со специалистом.

Меры предосторожности

- Каждый презерватив можно использовать только один раз.
- Не используйте в качестве дополнительной смазки растительные, животные и кулинарные жиры, а также лосьоны и вазелин, это может привести к разрушению структуры латекса и нарушению целостности презерватива.
- При необходимости используйте интимные гели-смазки на водной основе.
- Внимательно прочтите инструкцию - вкладыш внутри упаковки, особенно если вы собираетесь использовать презервативы для орального или анального секса.
- Если вы используете презерватив сначала для орального секса, вы должны использовать новый презерватив для любого другого вида секса впоследствии.
- Для анального секса необходимо использовать дополнительную смазку снаружи презерватива, чтобы снизить риск того, что презерватив порвется или спадет.
- Не касайтесь презервативом или половым членом влагалища после того, как презерватив снят.
- При использовании лекарственных препаратов, которые могут контактировать с презервативом, необходимо проконсультироваться с врачом. Ни один метод контрацепции не может обеспечить 100 % защиты от нежелательной беременности или передачи ВИЧ и других ЗППП.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

В соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 при повреждении упаковки изделие утилизируется в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами класса А.

Использованное изделие утилизируется в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами класса Б.

Взаимодействие с препаратами и смазками

Использование гелей-смазок с презервативами может увеличить наслаждение от секса. Гели-смазки на водной основе безопасны для использования с презервативами.

Гели-смазки на масляной основе, например, вазелин, детское масло и некоторые пессарии (маточные кольца) могут повредить презерватив. То же относится и к некоторым лекарствам местного действия, которые наносятся на половой член или во влагалище. Если вы не уверены, какое воздействие оказывает применяемый вами препарат на презерватив, проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания

Не использовать при наличии индивидуальной чувствительности к продуктам, содержащим натуральный каучуковый латекс и силиконовое масло.



Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.



Срок годности 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Производитель: Tianjin Human-Care Latex Corporation, Тяньцзинь Хьюман-Кэр Латекс Корпорейшн, Китай

Адрес производства:
Address: № 223 West 14 Road, Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Area) 300308 Tianjin China/№ 223 West 14 road, Pilot free trade zone (Экспортная зона Эриа) 300308 Тяньцзинь, Китай

Уполномоченный представитель в РФ/Импортёр:
АО «ПФК Обновление». Юридический адрес: Российская Федерация, 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зяткова, д. 18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя:
АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: pretenzi@pfk-obnovlenie.ru

Соответствуют: ISOXXXX XXXX
Регистрационное удостоверение XXXXX от XXXXXX



Пронумеровано, прошито

скреплено печатью на 8

Копеев В.Б. листа

