

ОАО «КЗХ «Бирюса»
КЗТ «Бирюса» ААҚ

КАМЕРА МЕДИЦИНСКАЯ
ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНАЛЫҚ ТОНАЗЫТҚЫШ-МУЗДАТҚЫШ
ЗЕРТХАНАЛЫҚ КАМЕРА

Модель/Үлгісі

Бирюса 385K-GB



Номинальное напряжение, частота и сила тока Номиналды кернеу, жиілік және қырманның күшінің	230 V~ 50 Hz 1,55 A
Номинальная потребляемая мощность Атаулы тұтыну қуаты	270 W
Максимальная мощность лампы Лампышның ең көп алымдылығы	14 W
Класс защиты Қорғудың сыныбы	I
Климатическое исполнение Климаттық орындау	УХЛ 4.2
Общий объем Ортақ көлем	380 dm ³
Изоляция Оршаулау	Циклопентан
Хладагент и его масса Хладагент және оның ел	R600a 0,025/0,045 kg
Степень защиты Ықтың сыныбы	IP20

Сделано в России
Ресейде жасалған
ТУ 35.35.13-026-07550191-2021
P740

№ 0 0247 0000001 (03.2021)

385K-GB

Условия транспортирования и хранения:
условия хранения 2 ГОСТ 15150-69 (от минус 40°C до 50°C)
Тасымалдау және сақтау шарттары:
сақтау шарттары 2 ГОСТ 15150-69 (минус 40°C-тан 50°C-қа дейін)

КАМЕРА МЕДИЦИНСКАЯ
ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНАЛЫҚ ТОНАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ
ЗЕРТХАНАЛЫҚ КАМЕРА

БИРЮСА 385K-GB

РУ №

ТУ 28.25.13-026-07550181-2021

230 В ~ 50 Гц

215 x 65 x 68 см

БРУТТО/НЕТТО 90/83 кг

БРУТТО/ТАЗА


ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 03.2021

ЖАСАУДЫ ДАТА

EAN-13



4 630084 112274

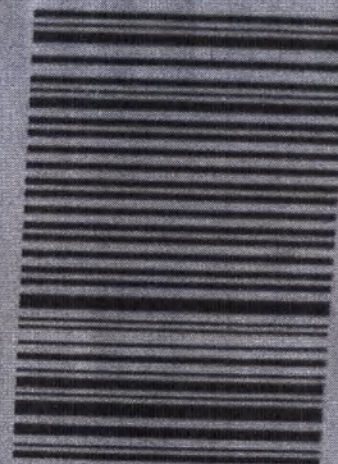

0 0247 0000001

385K-GB



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 03.2021

385K-GB

0 0247 0000001 385K-GB

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 лист(ов)

Руководитель организации



М. В. Тетров



Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса-385S-GB»

 **ООО ЦРМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU** **ильно-морозильная лабораторная «Бирюса 385S-RB»**



Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 315S-GB»

Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 315S-RB»



Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 315K-GB»

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru **Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 315 K-RB»**



Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 345K-GB»


ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru **ильно-морозильная лабораторная «Бирюса 345K-RB»**




Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 345S-GB»



Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 365K-GB»

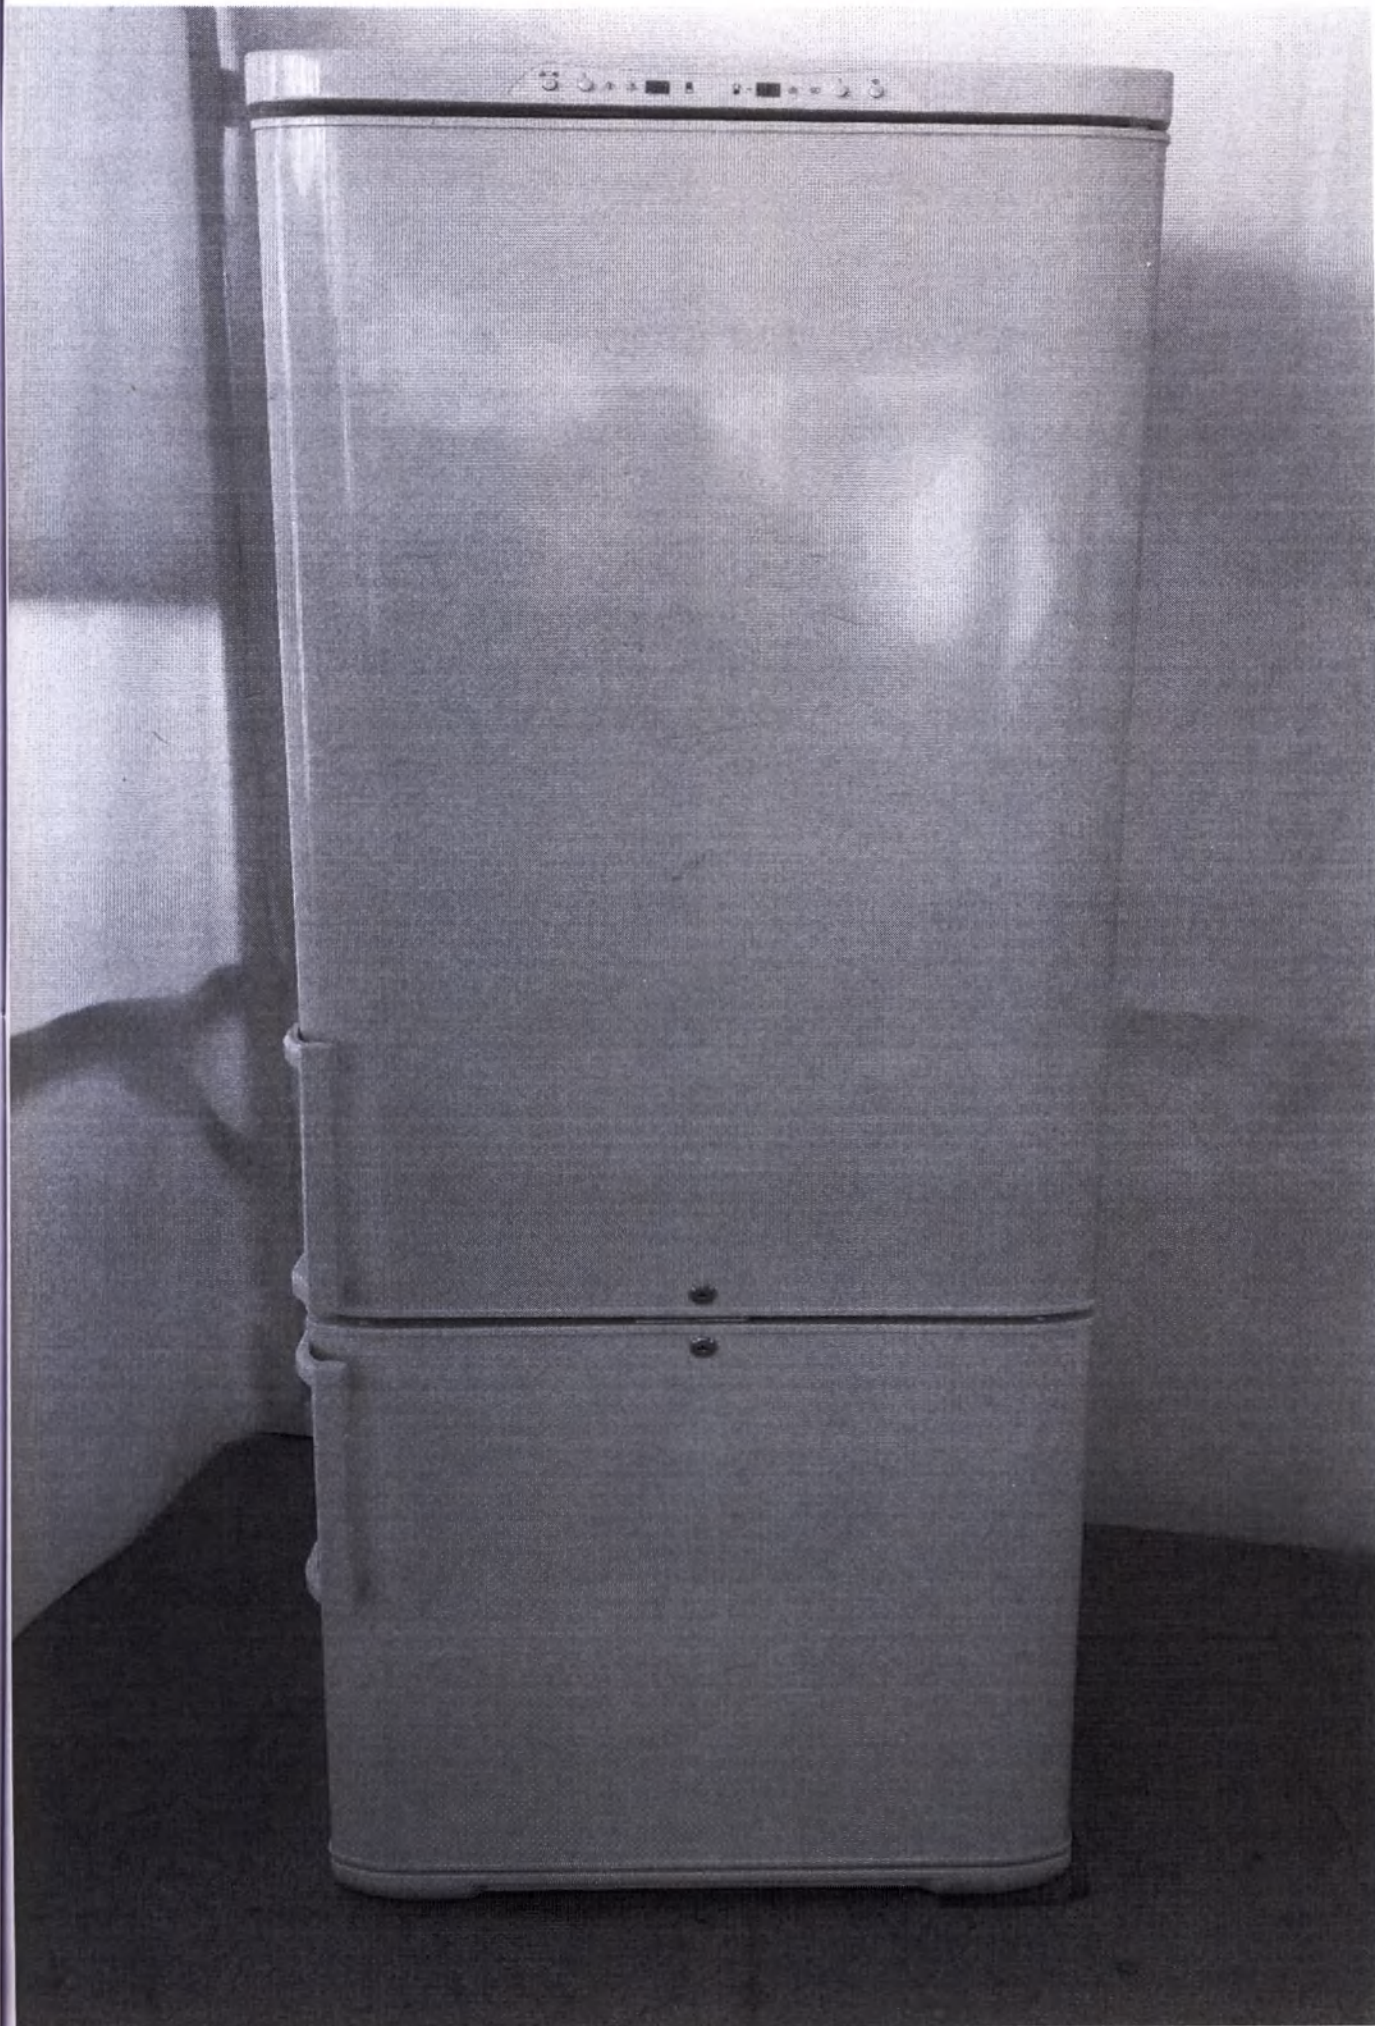

Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 365K-GB»

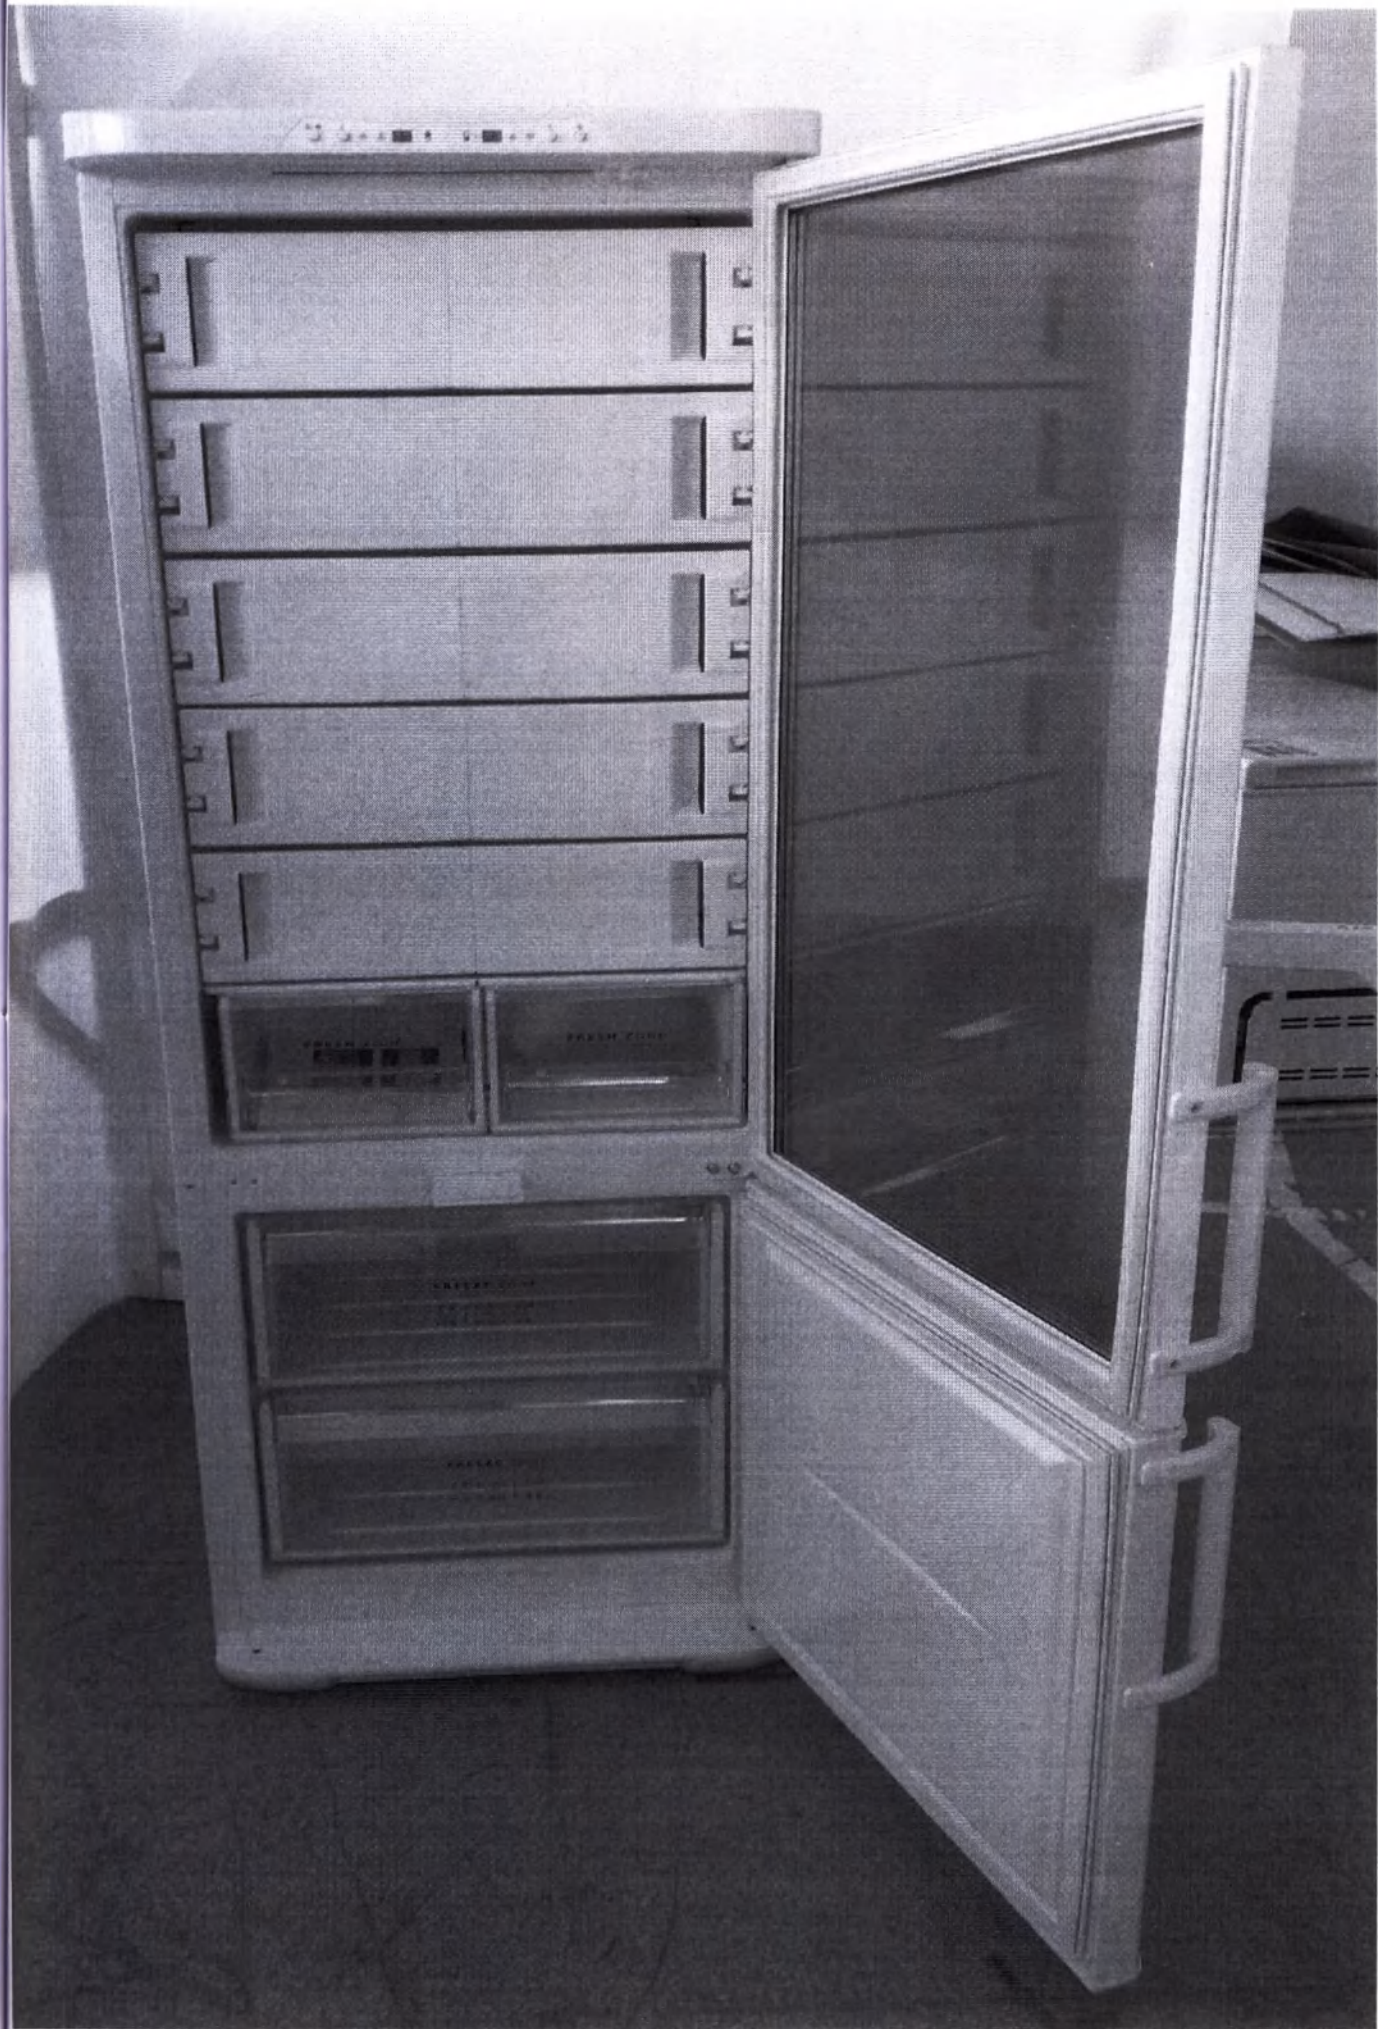

Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 365S-GB»



Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 370S-GB»




Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 370K-GB»



Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 375K-GB»

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU **холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 375K-RB»**

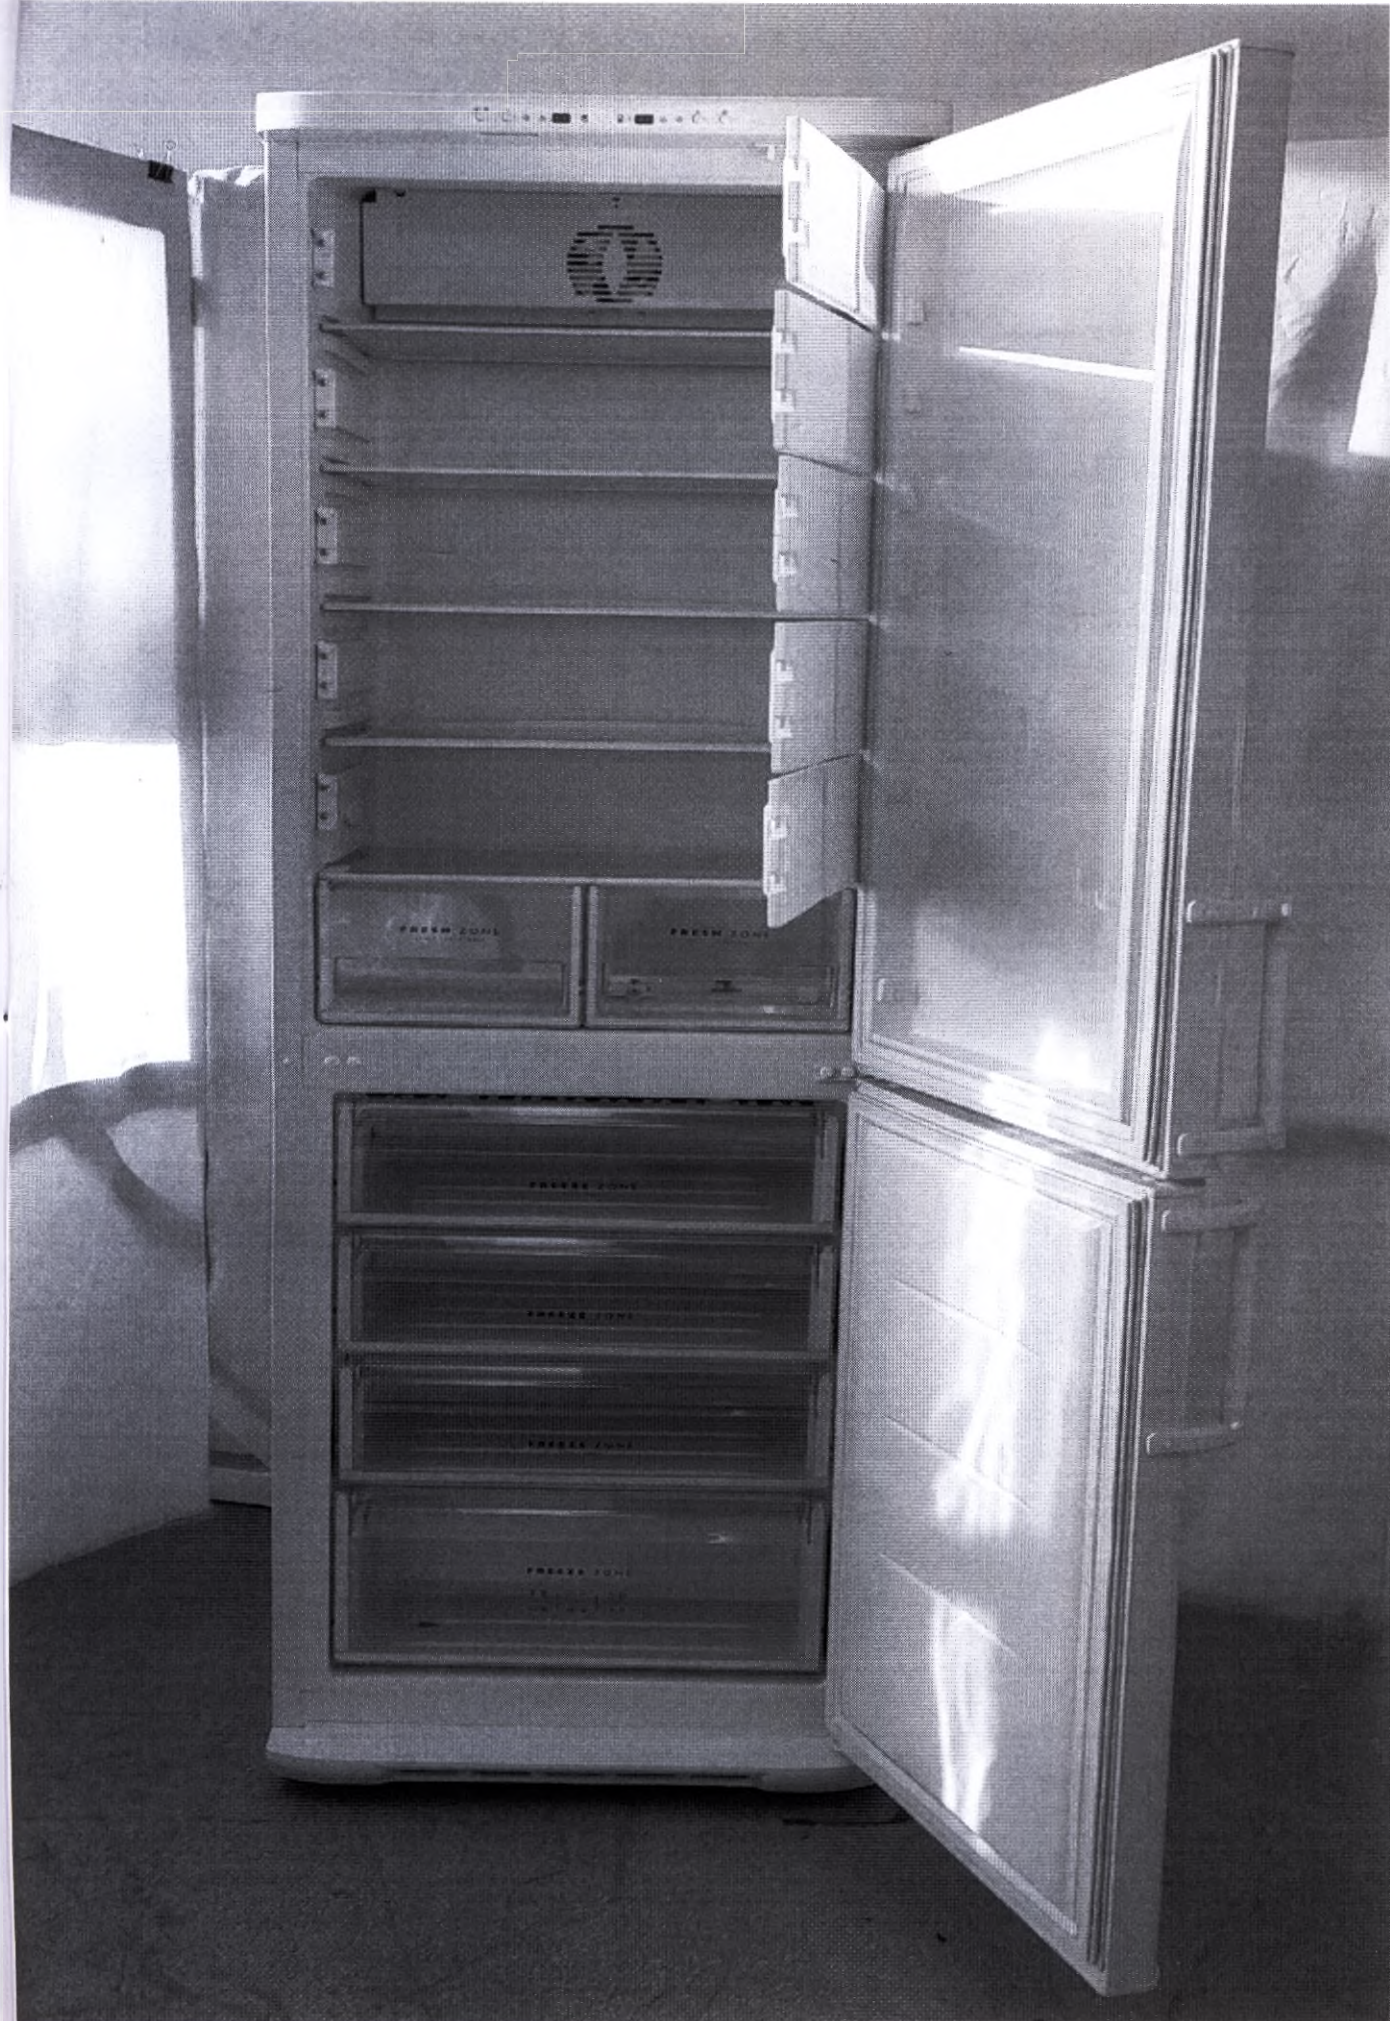

Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная «Бирюса 385K-GB»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12 лист(ов)

Руководитель организации