

Руководитель группы регистрации

Горшкова Н.А.

2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения иммуноглобулина А (IgA) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Immunoglobulin A_2 (Atellica CH IgA_2))

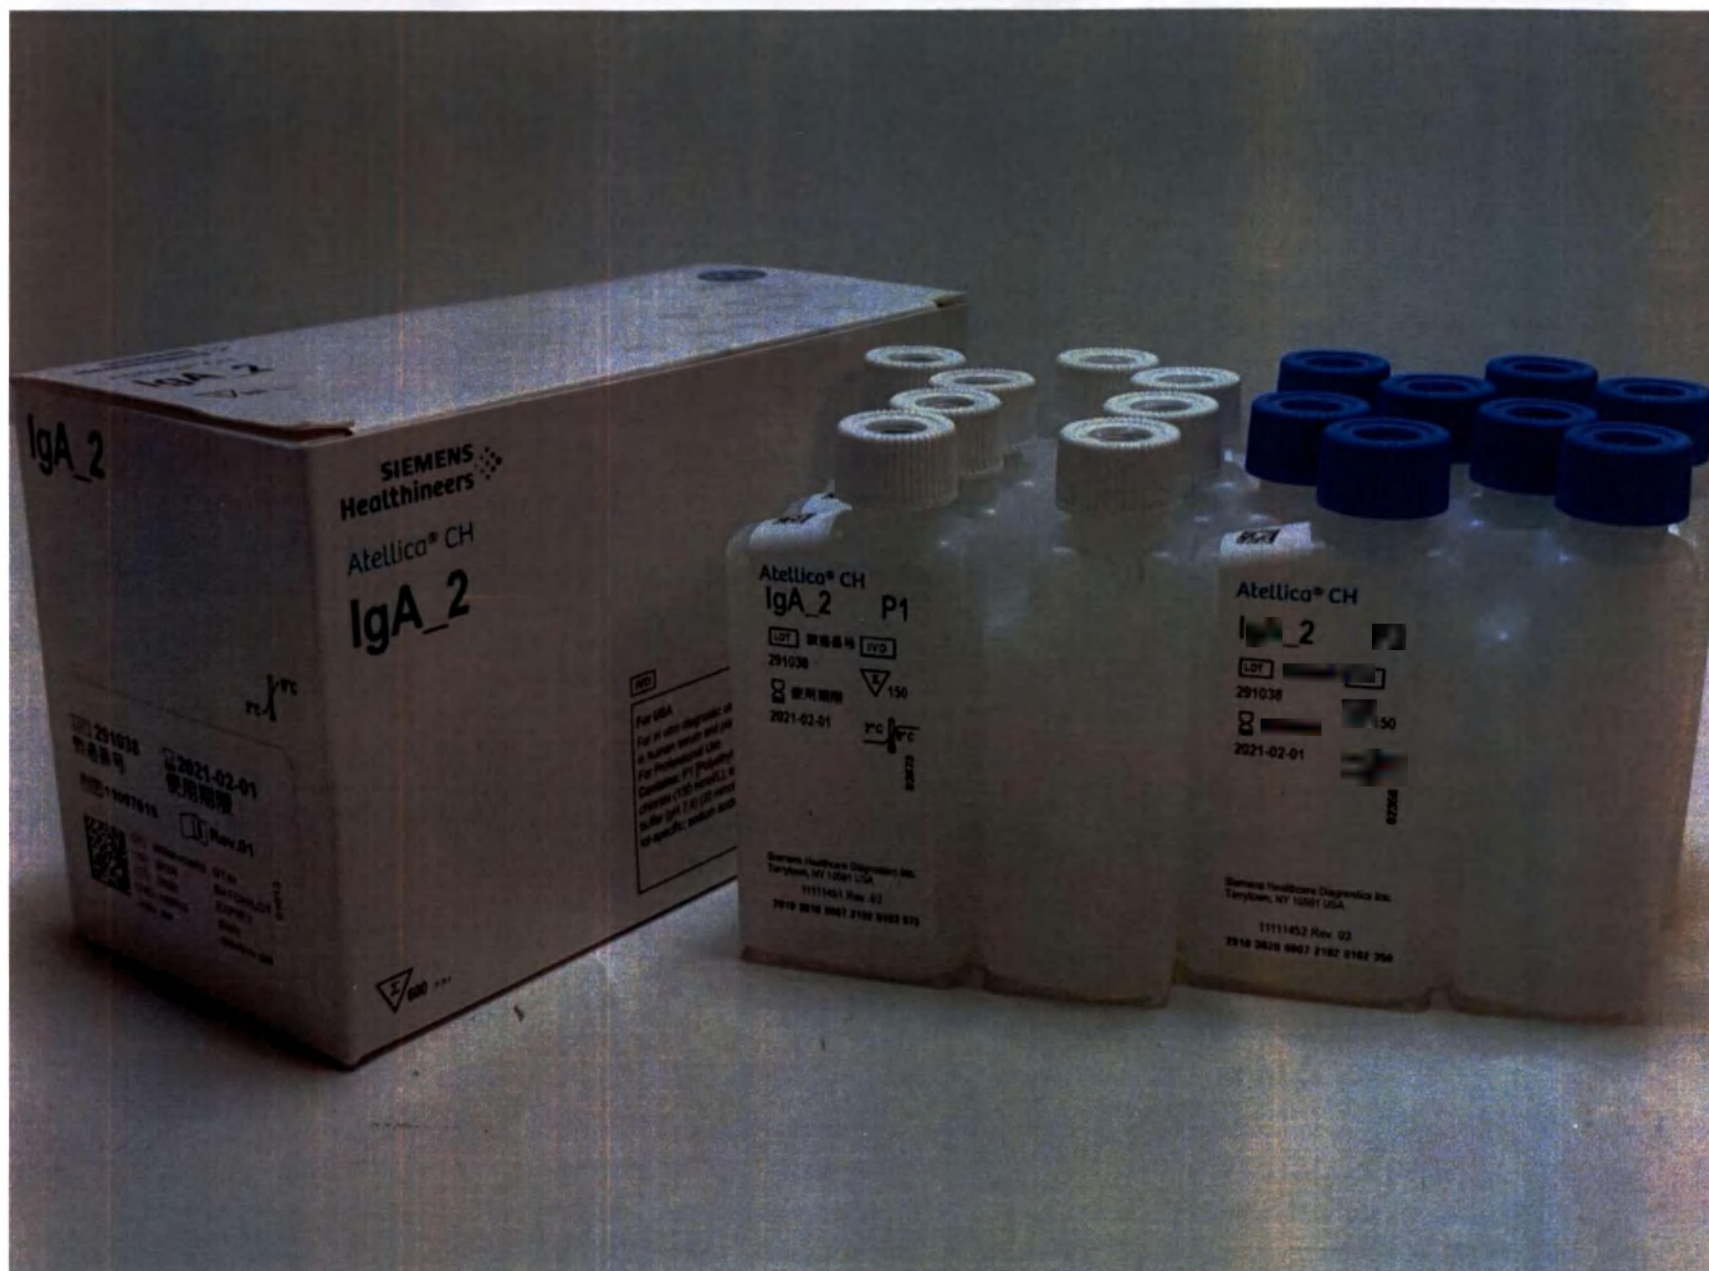


Рисунок 1. Набор реагентов для определения иммуноглобулина А (IgA) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Immunoglobulin A_2 (Atellica CH IgA_2)): общий вид изделия

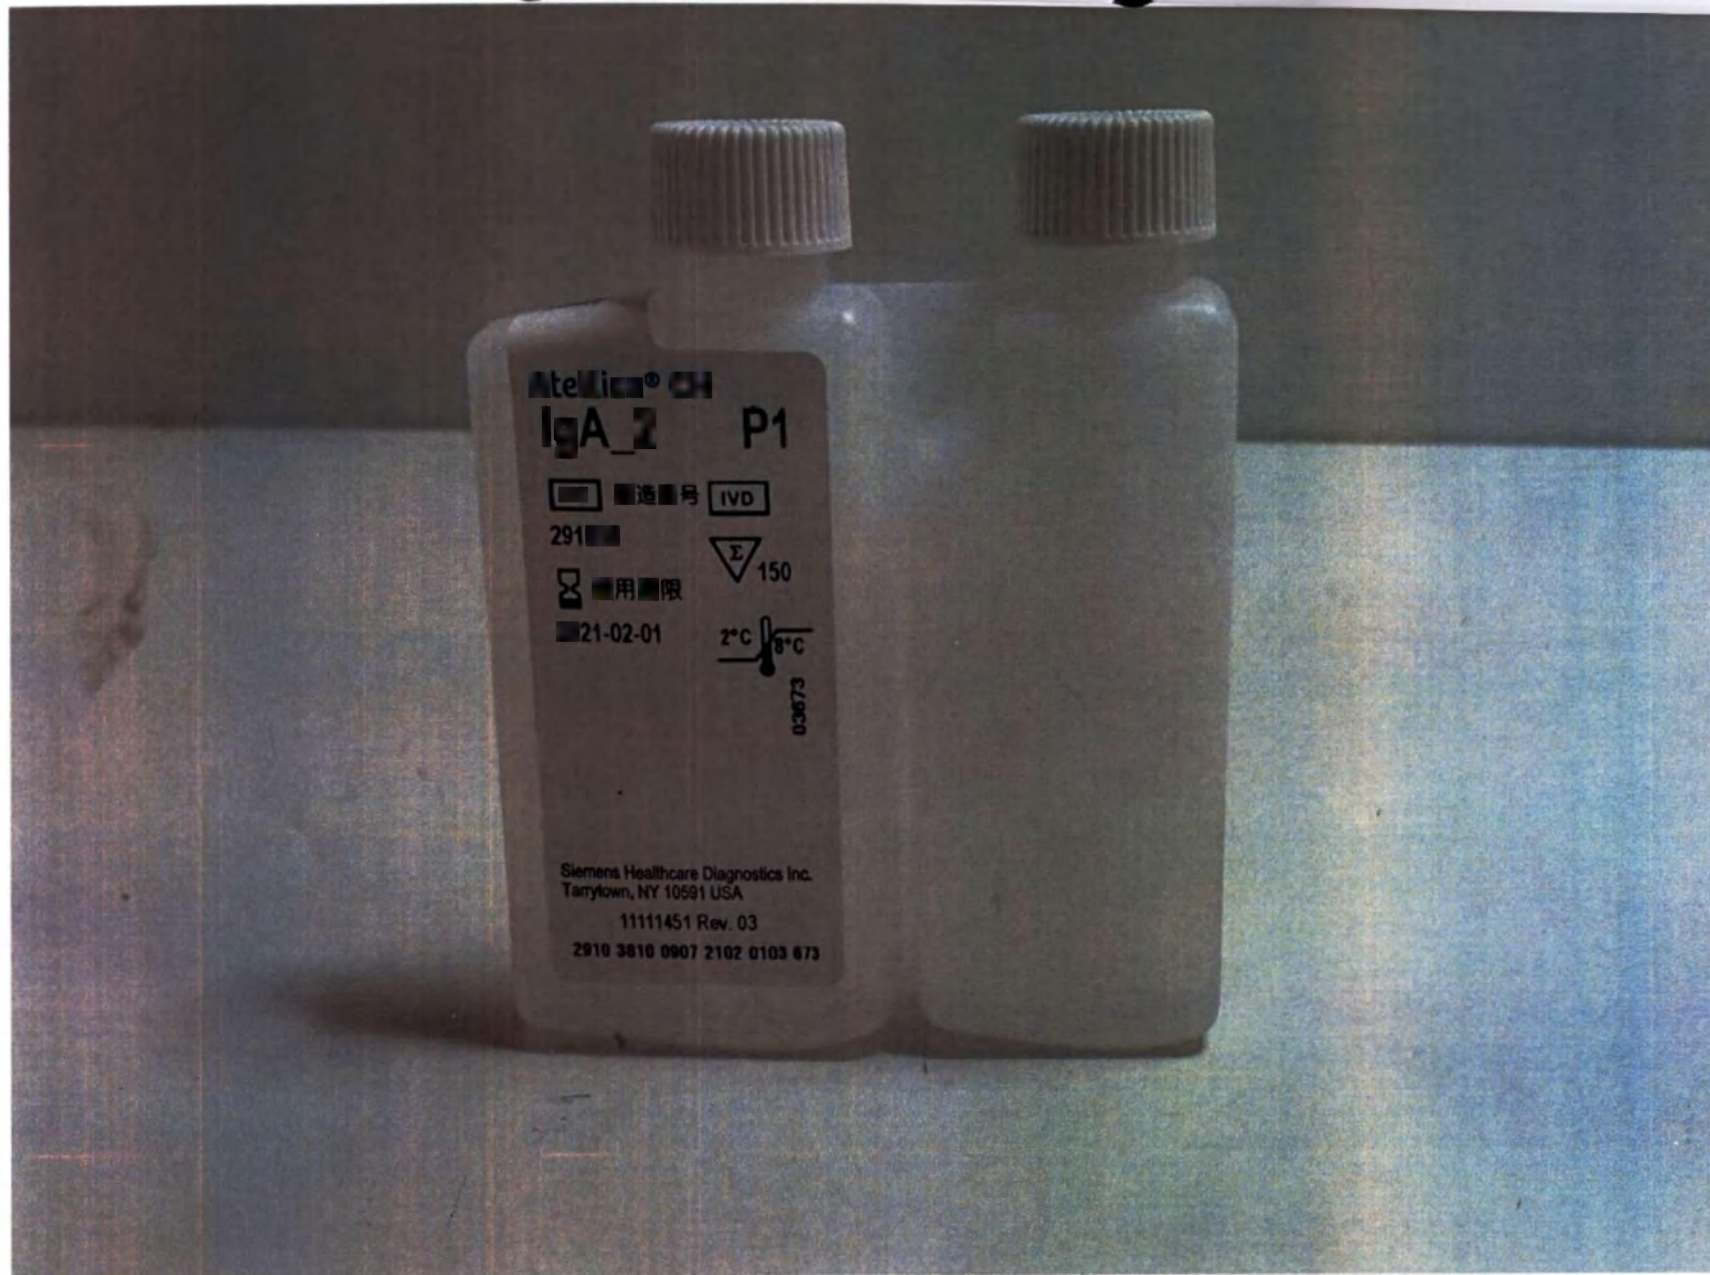


Рисунок 2. Набор реагентов для определения иммуноглобулина А (IgA) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Immunoglobulin A_2 (Atellica CH IgA_2)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 1

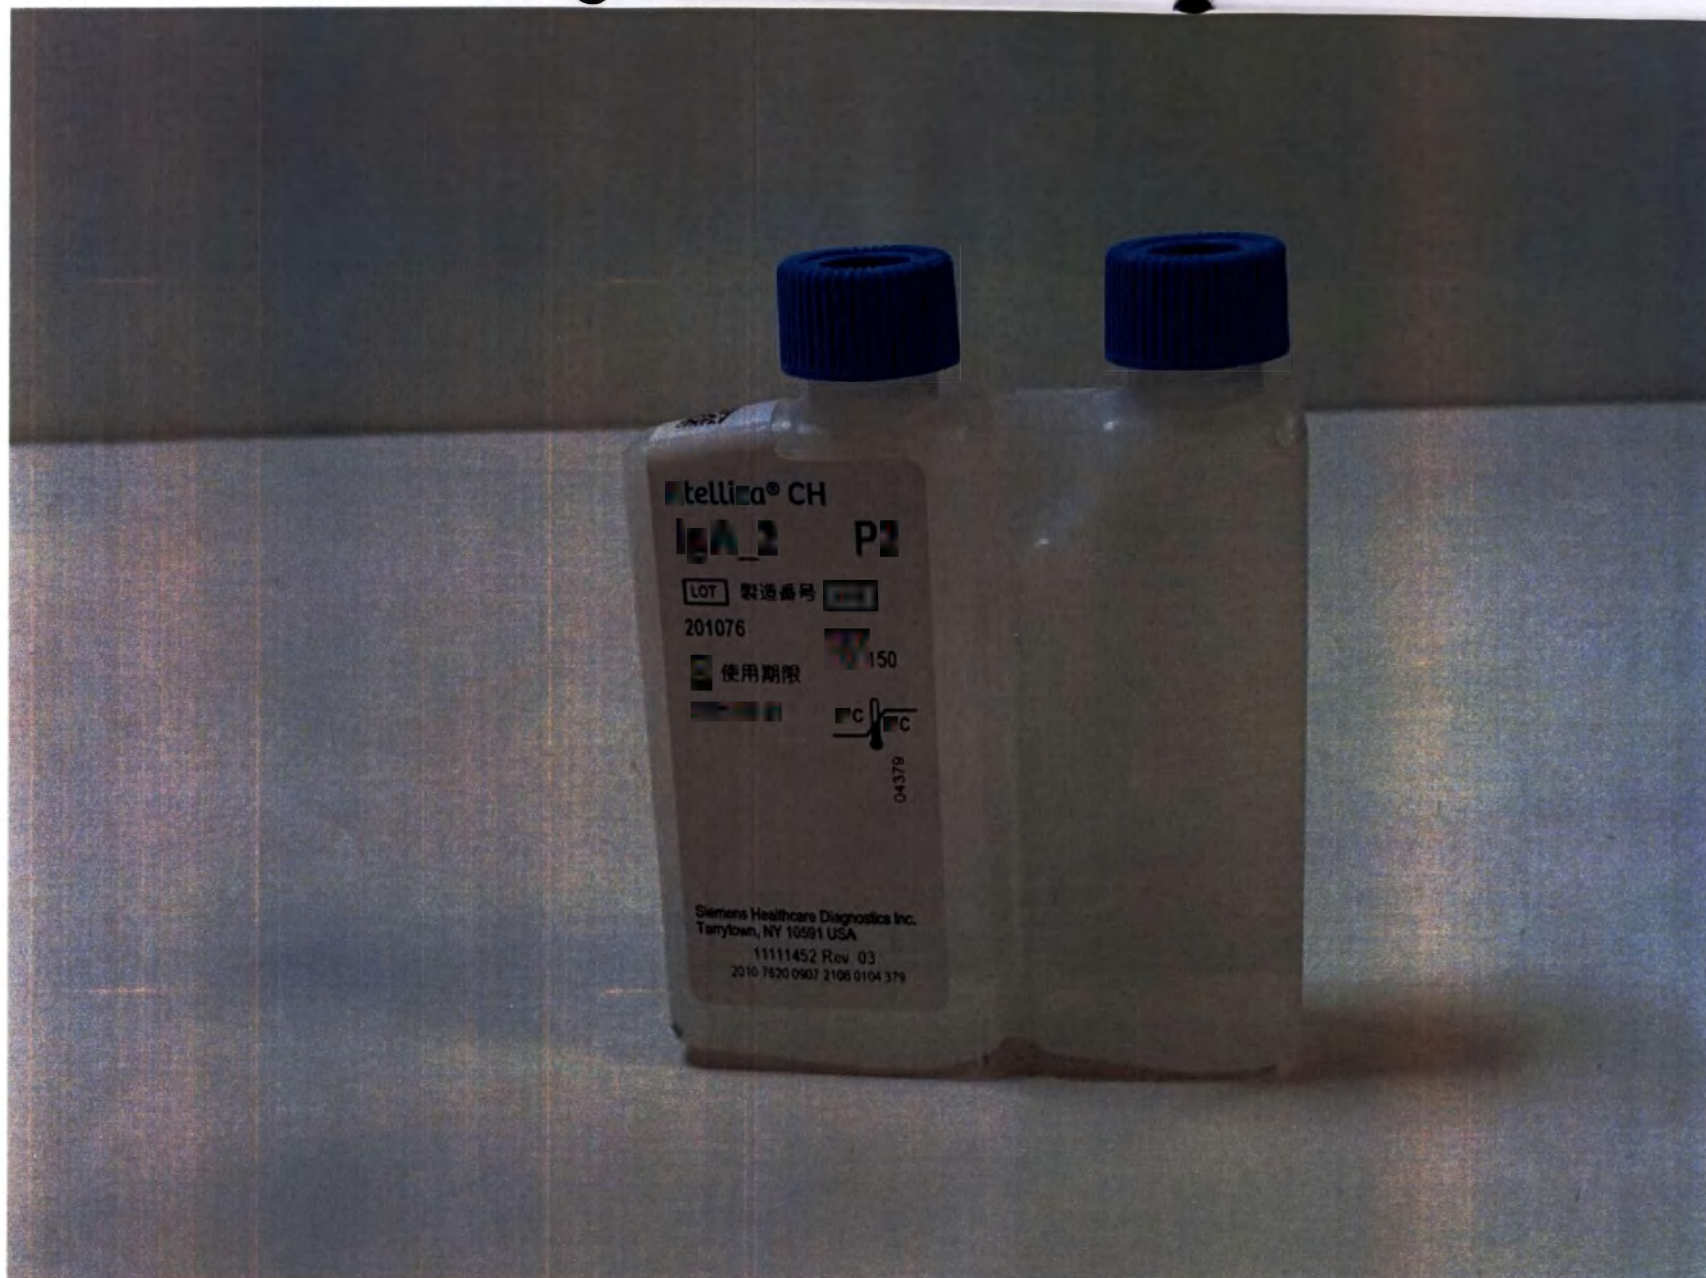


Рисунок 3 Набор реагентов для определения иммуноглобулина А (IgA) на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Immunoglobulin A_2 (Atellica CH IgA_2)): флаконы с реагентами, общий вид, упаковка 2.

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

