

Фотографические изображения

Реагенты в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4 cobas e analyzers)

кассеты в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и плазме
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4 cobas e
analyzers)

Elecsys HE4

cobas e analyzers

REF 07027478190

CONTENT

 100

COBAS, COBAS E and
ELECSYS are trademarks
of Roche.

R1	10.3 mL
R2	10.3 mL
M	5.8 mL



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

001

IVD   2-8 °C

 <http://e-labdoc.roche.com>

0644485301(1)




cobas[®]

...ты в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и
...е крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4
...as e analyzers)



титры в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и плазме иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4 cobas e analyzers)

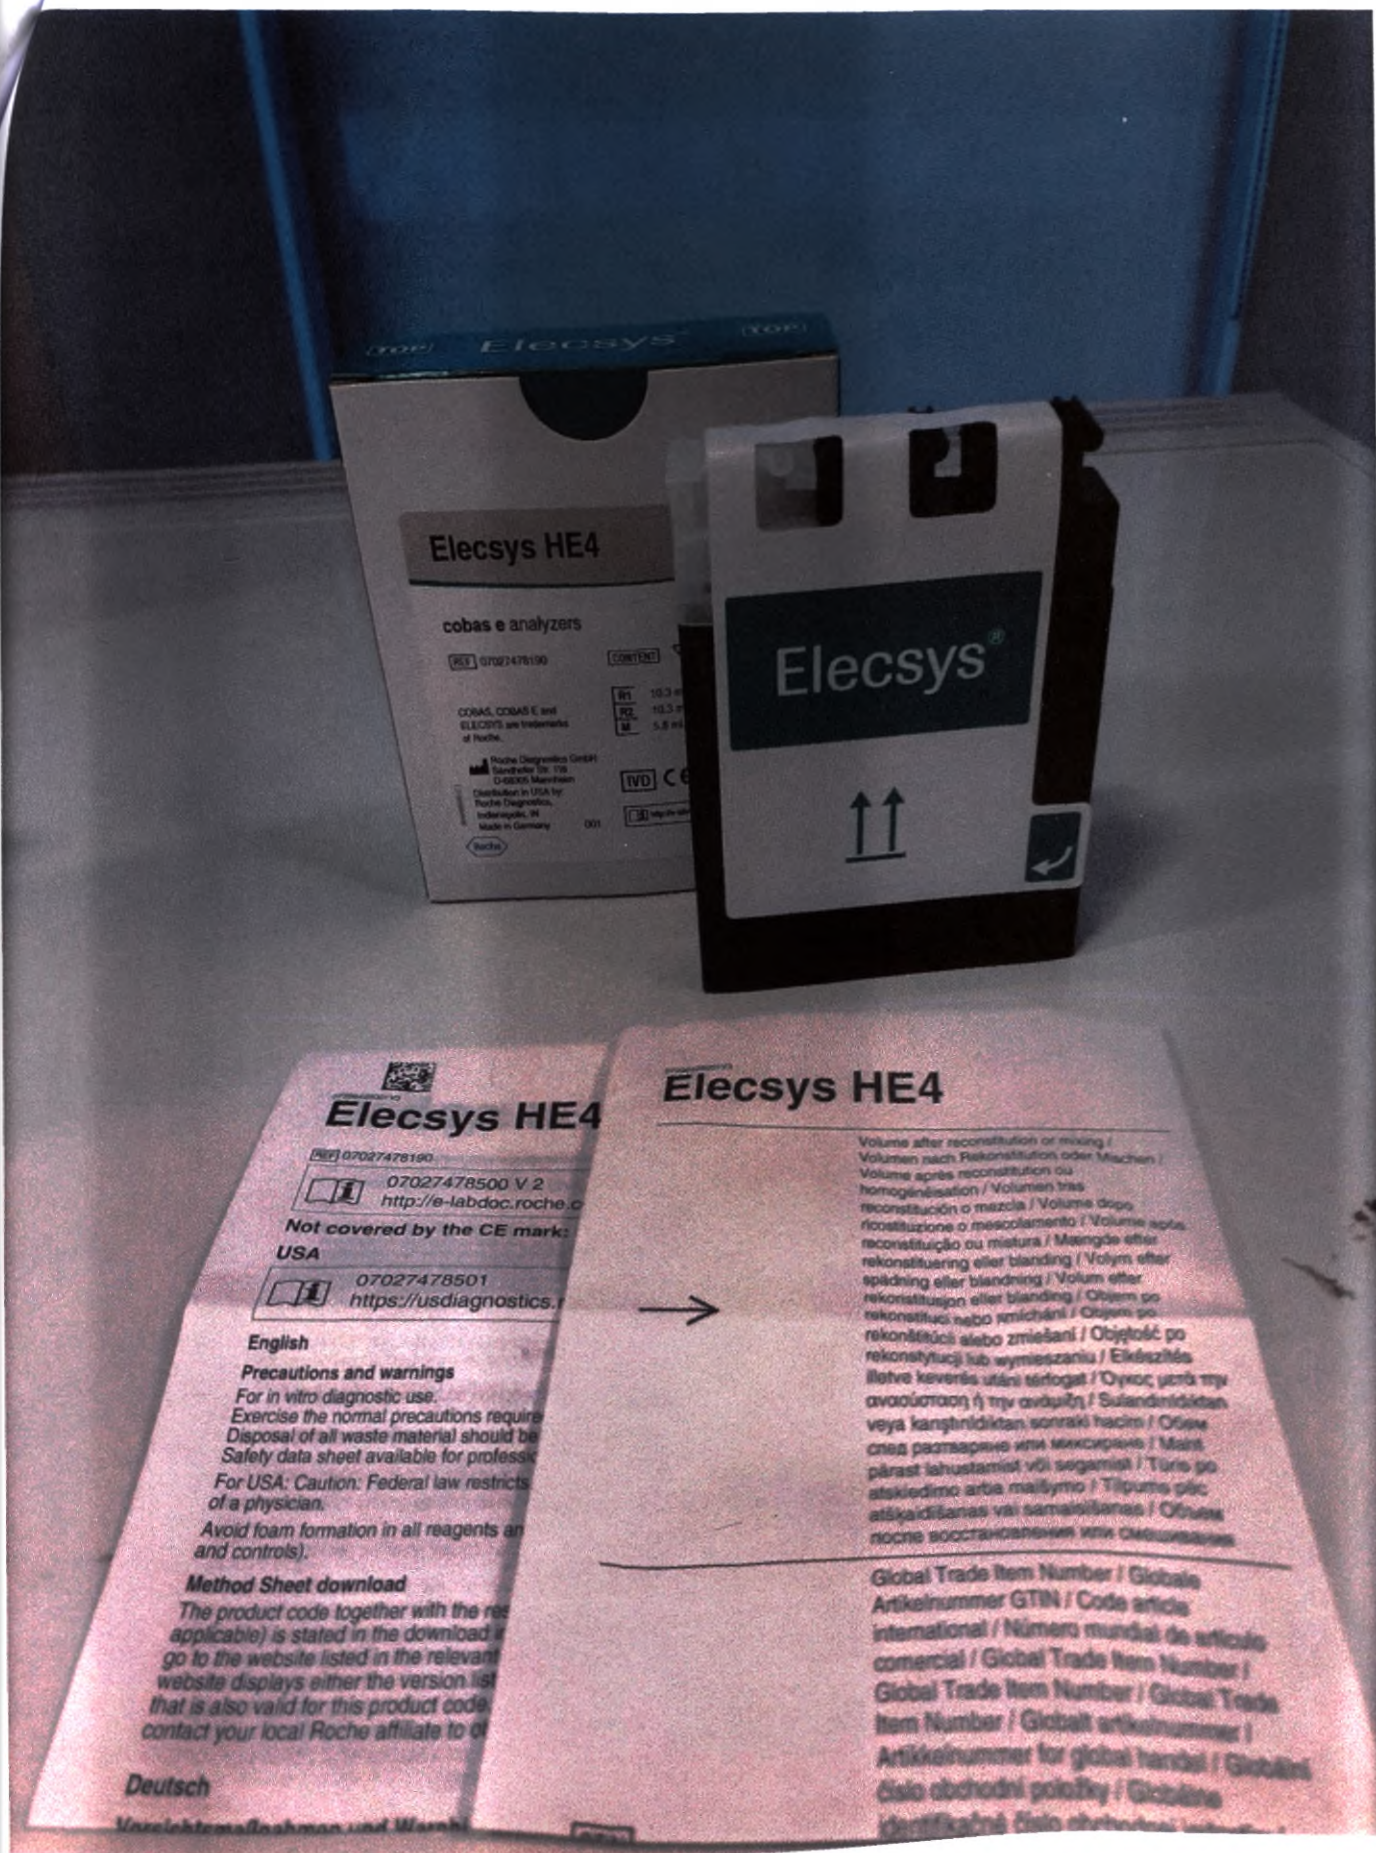

ты в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и плазме
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4 cobas e
yzers)

Elecsys HE4

REF 07027478190

For USA: CONTENT

- R1 Biotinylated monoclonal anti-HE4 antibody (mouse) 0.75 mg/L
- R2 Monoclonal anti-HE4 antibody (mouse) labeled with ruthenium complex 1.5 mg/L
- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL




Rx only

001



ты в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и плазме
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4 cobas e
zers)

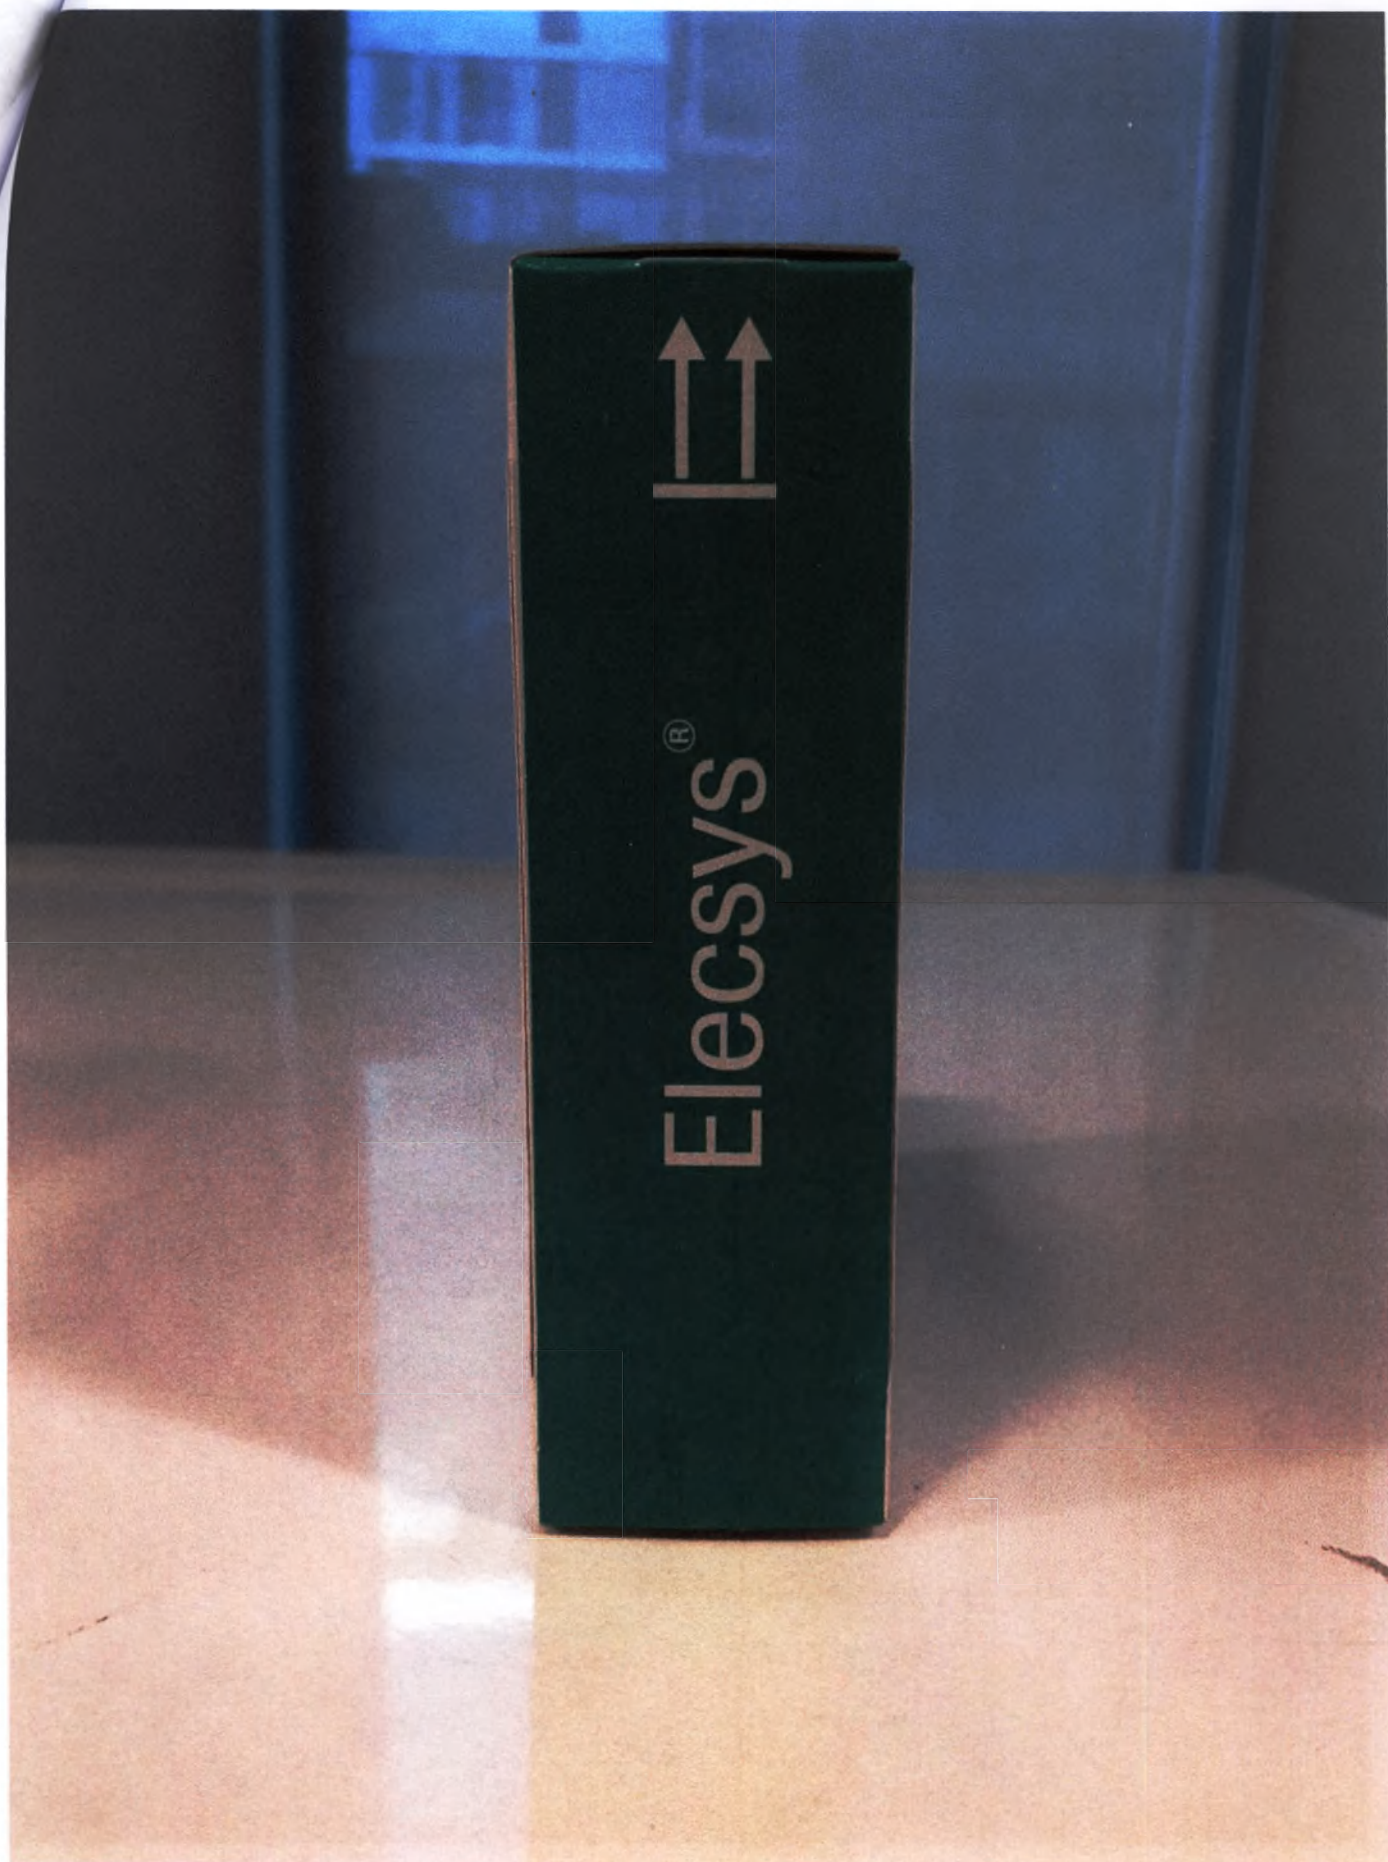

ты в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и плазме иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4 cobas e zers)

Регенты в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4 cobas e analyzers)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: Roche Diagnostics GmbH ("Roche Diagnostica GmbH", Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия)

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: rus@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 07027478190


ты в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и
е крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4
life analyzers)



ы в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в сыворотке и
е крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys HE4
e analyzers)



ы в кассете для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека (HE4) в
отке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических
е (Elecsys HE4 cobas e analyzers)

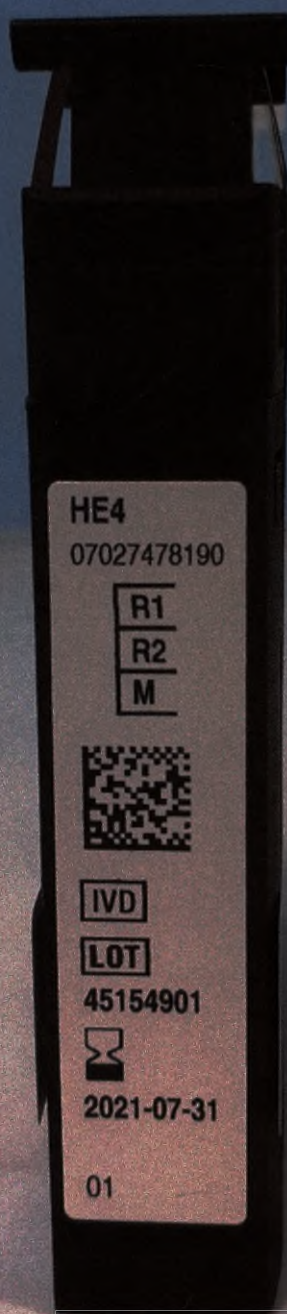



Этот пронумерованный документ
пронумеровано и
содержит печатью
ОИИ 1097746 (ОВ)

Гурьянова

10-0

по доверенности
от 11.02.2022 г.