

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МЕДЭЙЛ»



Л. Б. Бронникова

"10" сентября 2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Система рентгеновская стоматологическая X-Mind Unity,
производства DE GOTZEN S.R.L, Italy (де Гётцен С.Р.Л.),
Италия



Система рентгеновская стоматологическая X-Mind Unity

Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Информация о технике безопасности и использованию по назначению представлена в инструкции по эксплуатации.



Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

DE GOTZEN S.R.L, Italy (де
Гётцен С.Р.Л.), VIA ROMA 45
OLGIATE OLONA (VA) CAP
21057, Italy (Виа Рома 45
Ольджате-Олона (ВА) CAP
21057, Италия
Тел.: +39 0331 376760

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕДЭЙЛ»
Юридический адрес: Россия, 142400,
Московская область, Г.О. Богородский, г.
Ногинск, ул. Декабристов, д. 3в, кв. 59
+7 495 1501323

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 2 лист (ов)



Л.Б. Бронникова

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МЕДЭЙЛ»

_____ **Л. Б. Бронникова**

"12" августа 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Система рентгеновская стоматологическая X-Mind Unity,

производства
«де Гетцен - С.р.л.», Италия (de Götzen - S.r.l., ITALY)

Оглавление

1. Система рентгеновская стоматологическая X-Mind Unity	3
2. Блок управления рентгеновского излучения.....	5
3. Горизонтальная консоль (длина 40 см.).....	6
4. Горизонтальная консоль (длина 80 см.).....	7
5. Горизонтальная консоль (длина 110 см.).....	8
6. Кронштейн пантографический (ножницеобразный)	9
7. Излучатель рентгеновский в сборе	10
8. Датчик Sopix 2 Inside, производства SOPRO, место производства ZAC Athelia IV, Avenue des Genevriers 13705 LA CIOTAT CEDEX FRANCE (Франция).....	11
Датчик Sopix 2 Inside и держатель датчика	12
Чехлы одноразовые защитные	13
Программное обеспечение AIS на электронном носителе.....	14
9. Устройство для ограничения пучка (круглый длинный)	15
10. Устройство для ограничения пучка (круглый короткий).....	16
11. Устройство для ограничения пучка (квадратный длинный).....	17
12. Устройство для ограничения пучка (квадратный короткий).....	19
13. Панель настенного монтажа.....	20
14. Дистанционный включатель X-Mind Unity	21
15. Лампа X-Mind Unity	22
16. Кронштейн для мобильной установки рентгена	23
17. Кабель питания	28
18. Эксплуатационная документация в составе:	29
Руководство оператора X-Mind Unity	29
Руководство пользователя на программное обеспечение AIS.....	30
Инструкция пользователя.....	31


1. Система рентгеновская стоматологическая X-Mind Unity (Монтаж настенный)

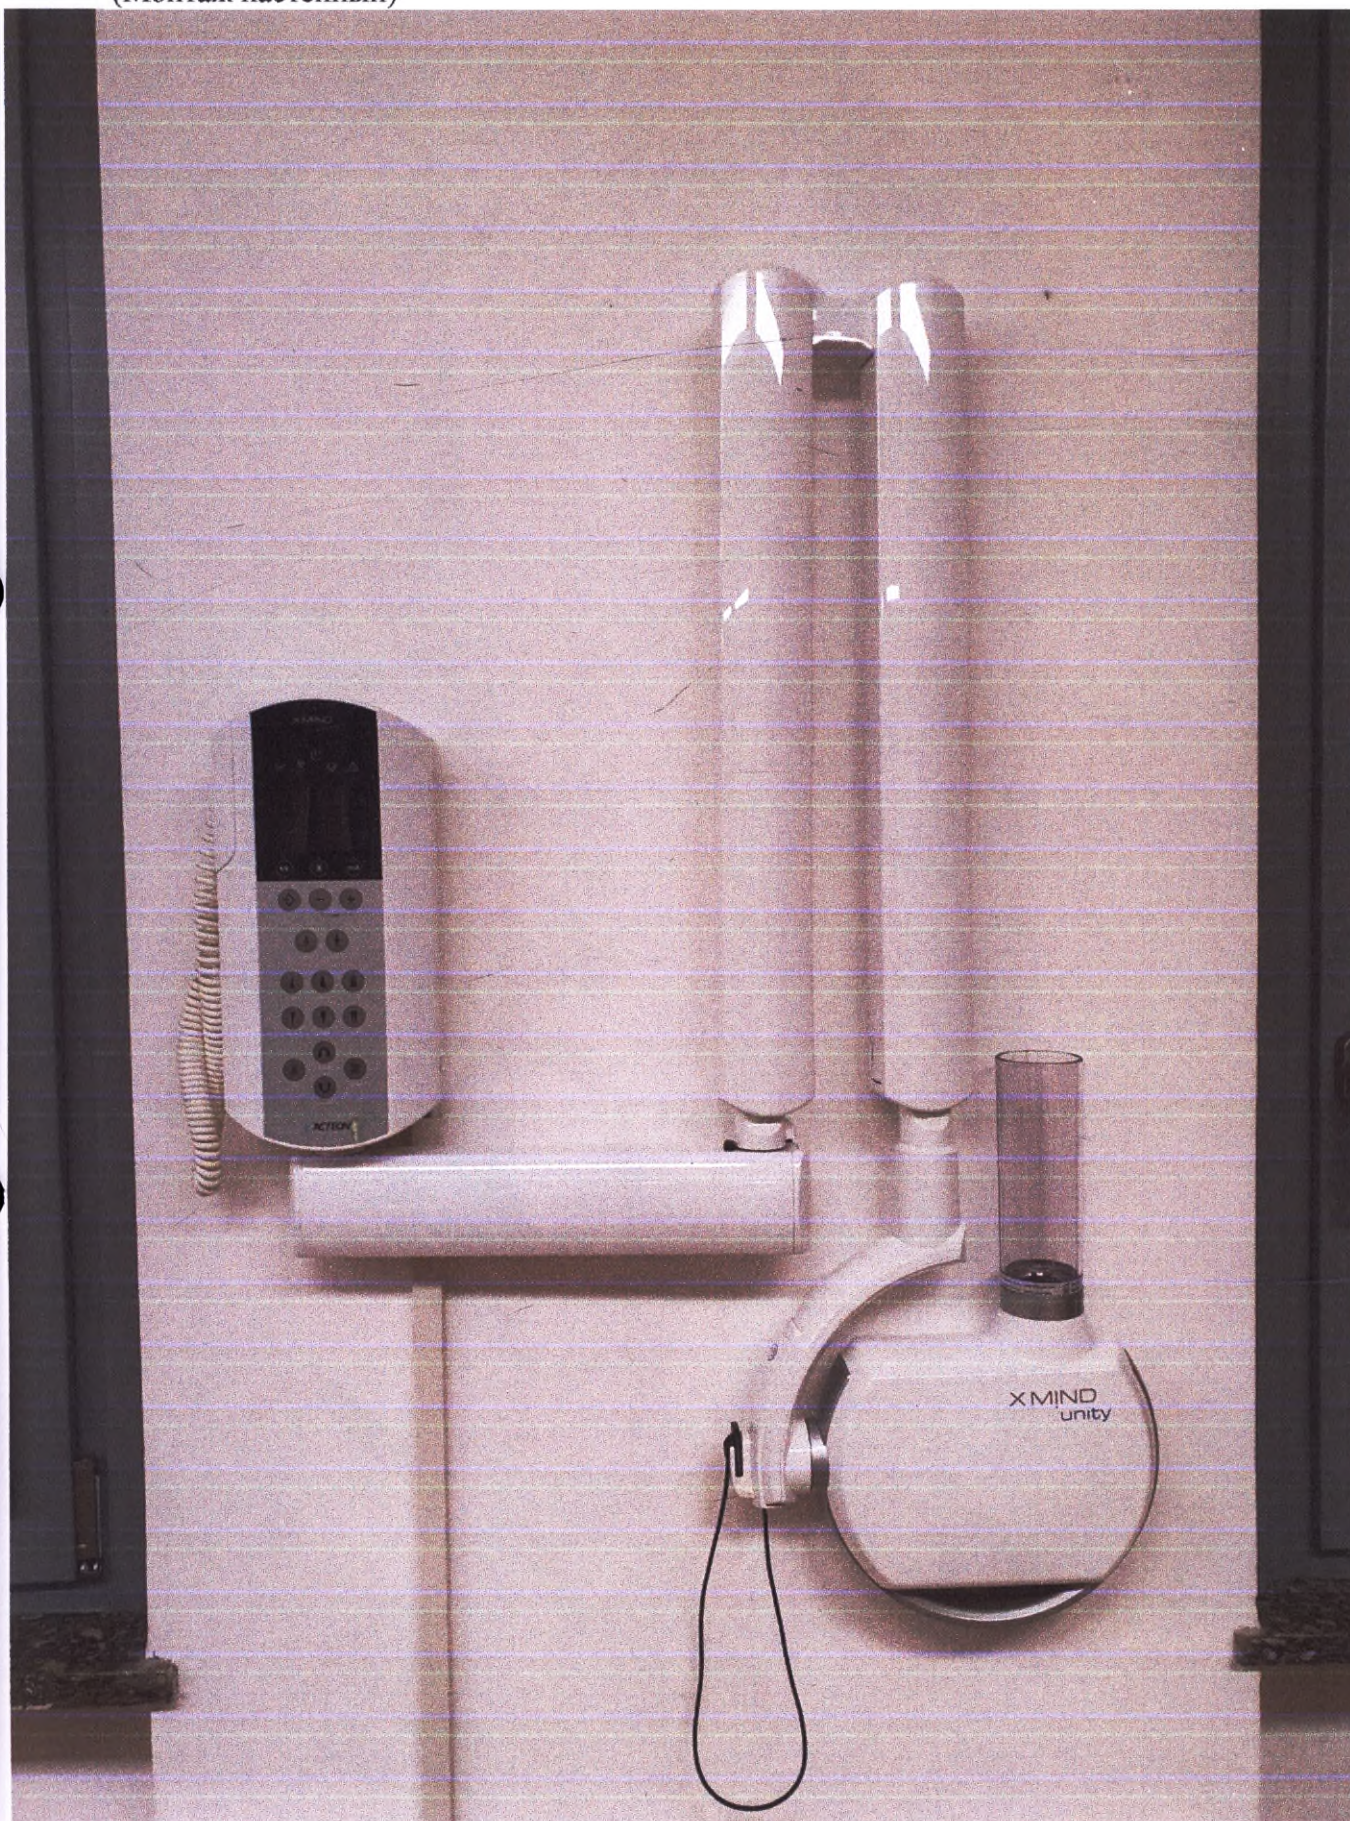


Вид сбоку



2. Блок управления рентгеновского излучения

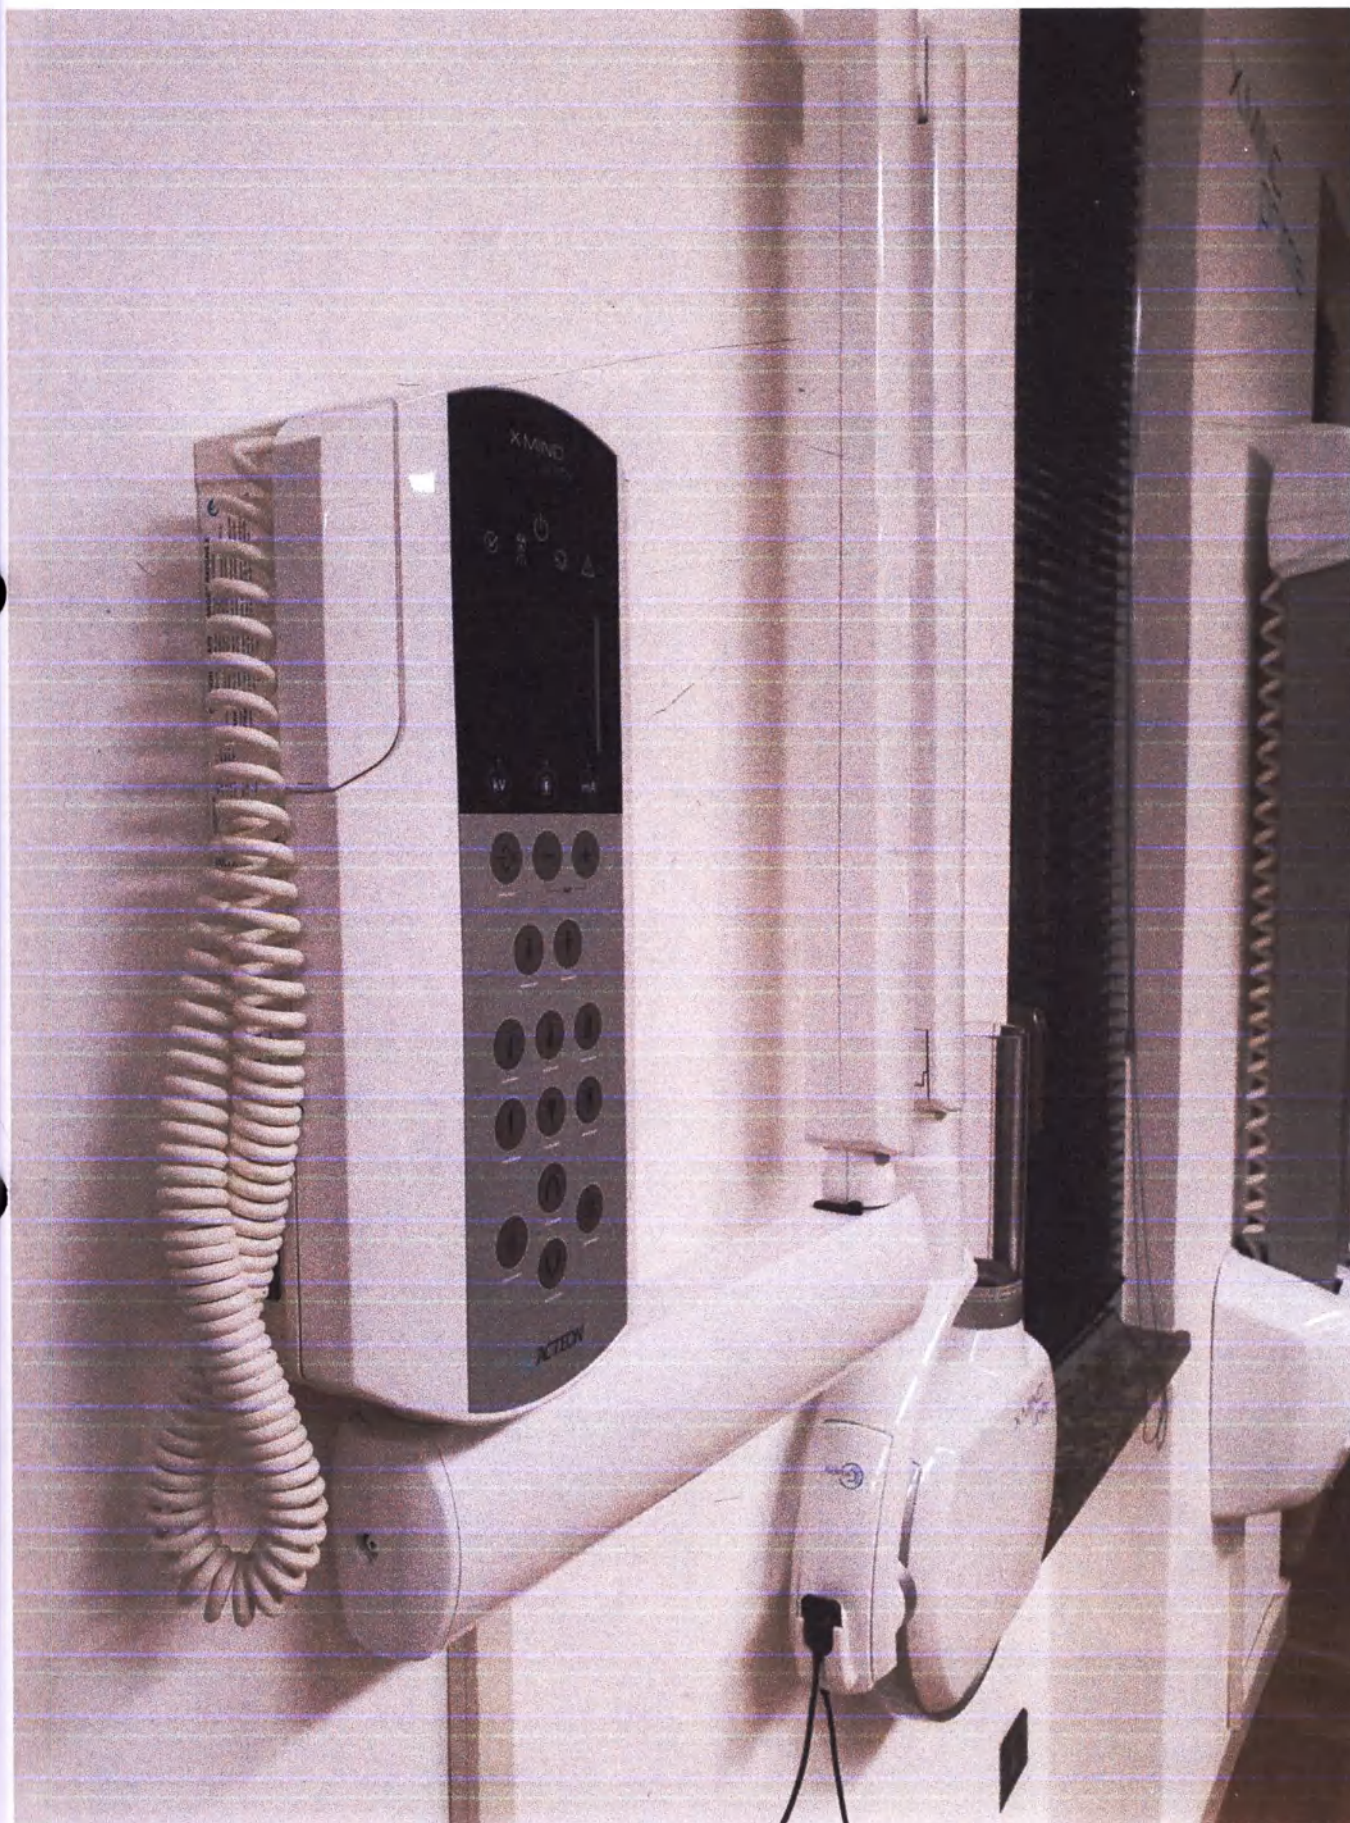

3. Горизонтальная консоль (длина 40 см.)

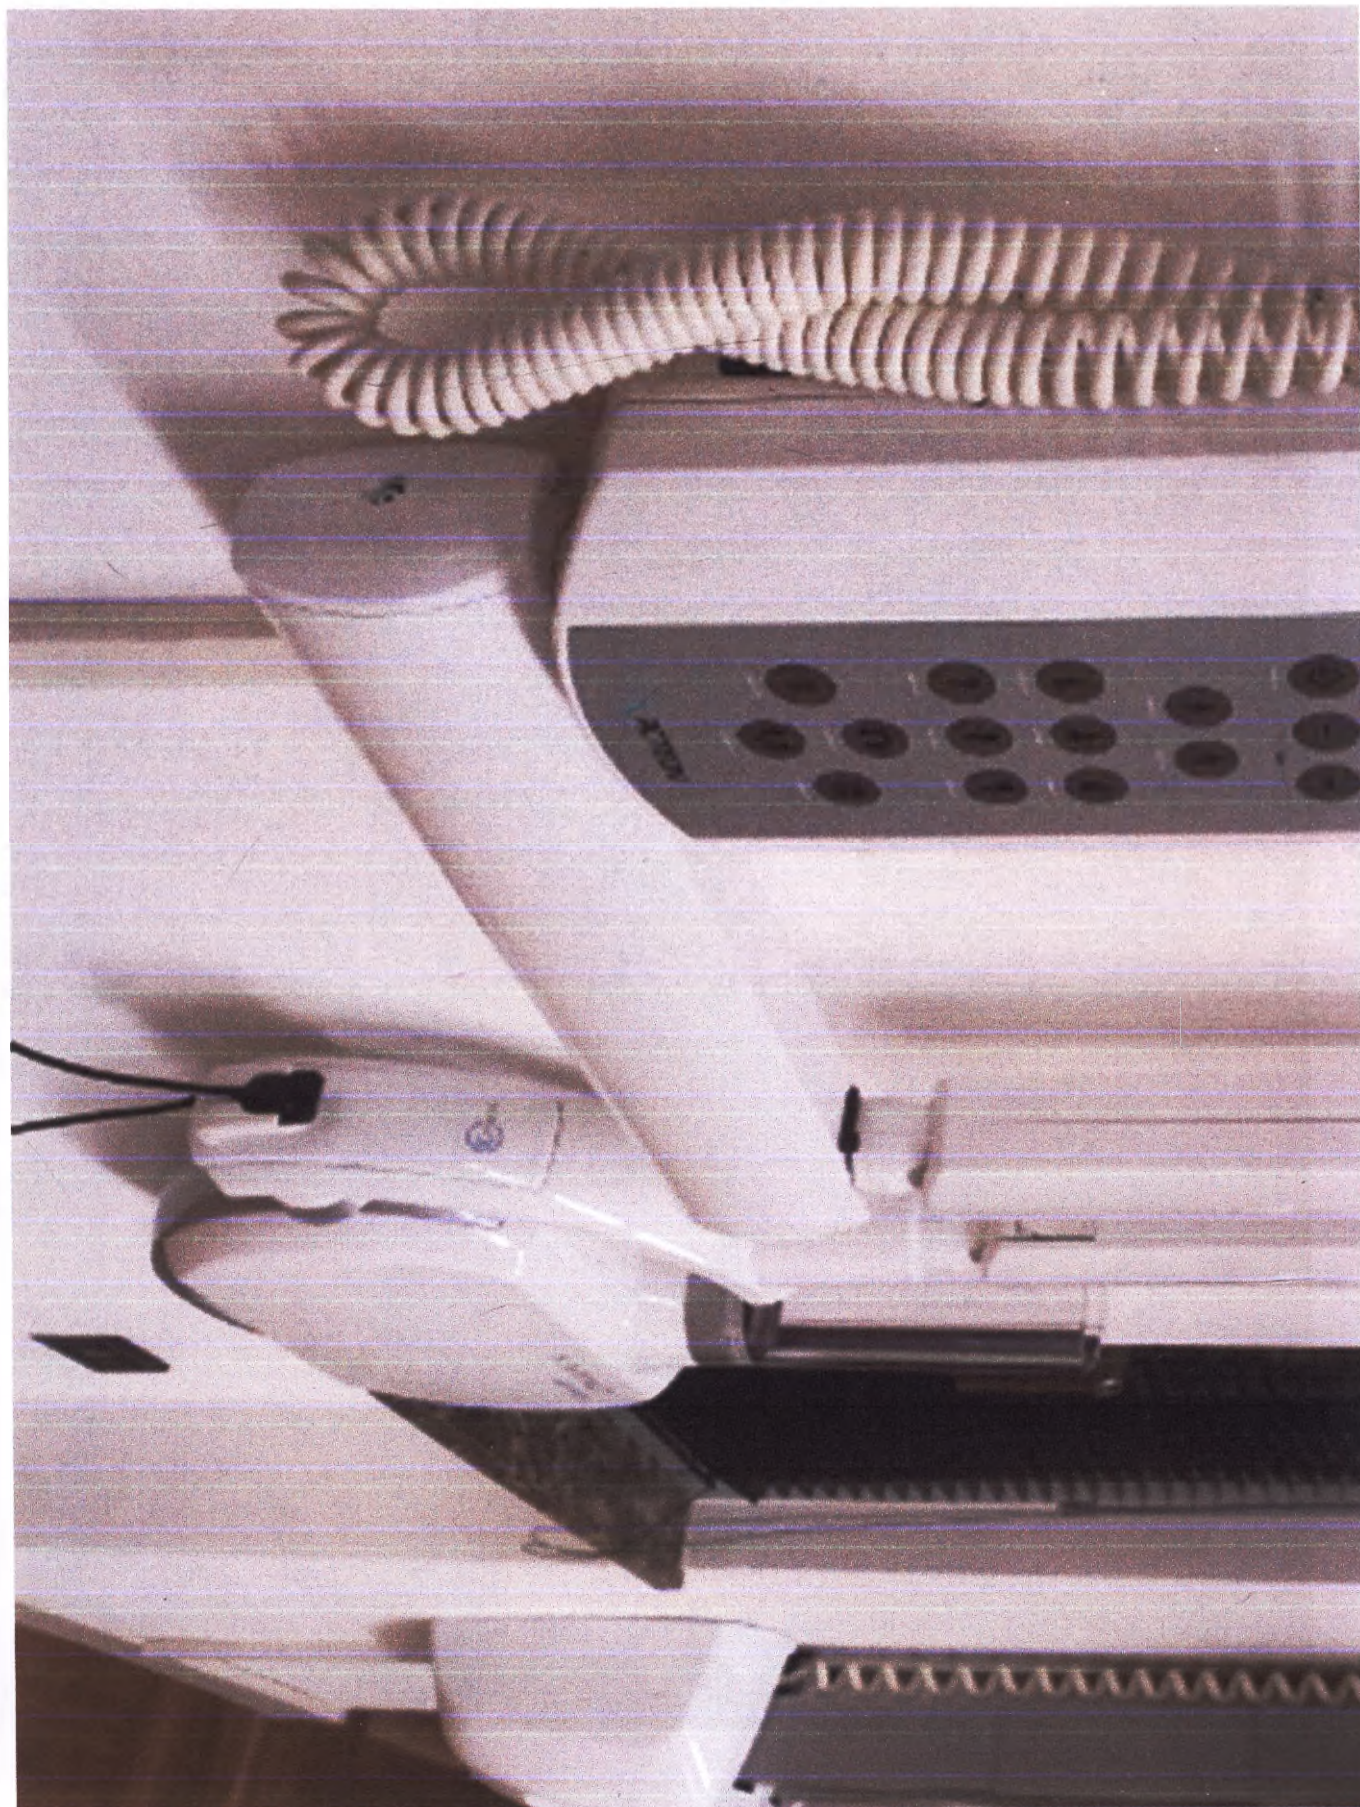


4. Горизонтальная консоль (длина 80 см.)



5. Горизонтальная консоль (длина 110 см.)




6. Кронштейн пантографический (ножницеобразный)

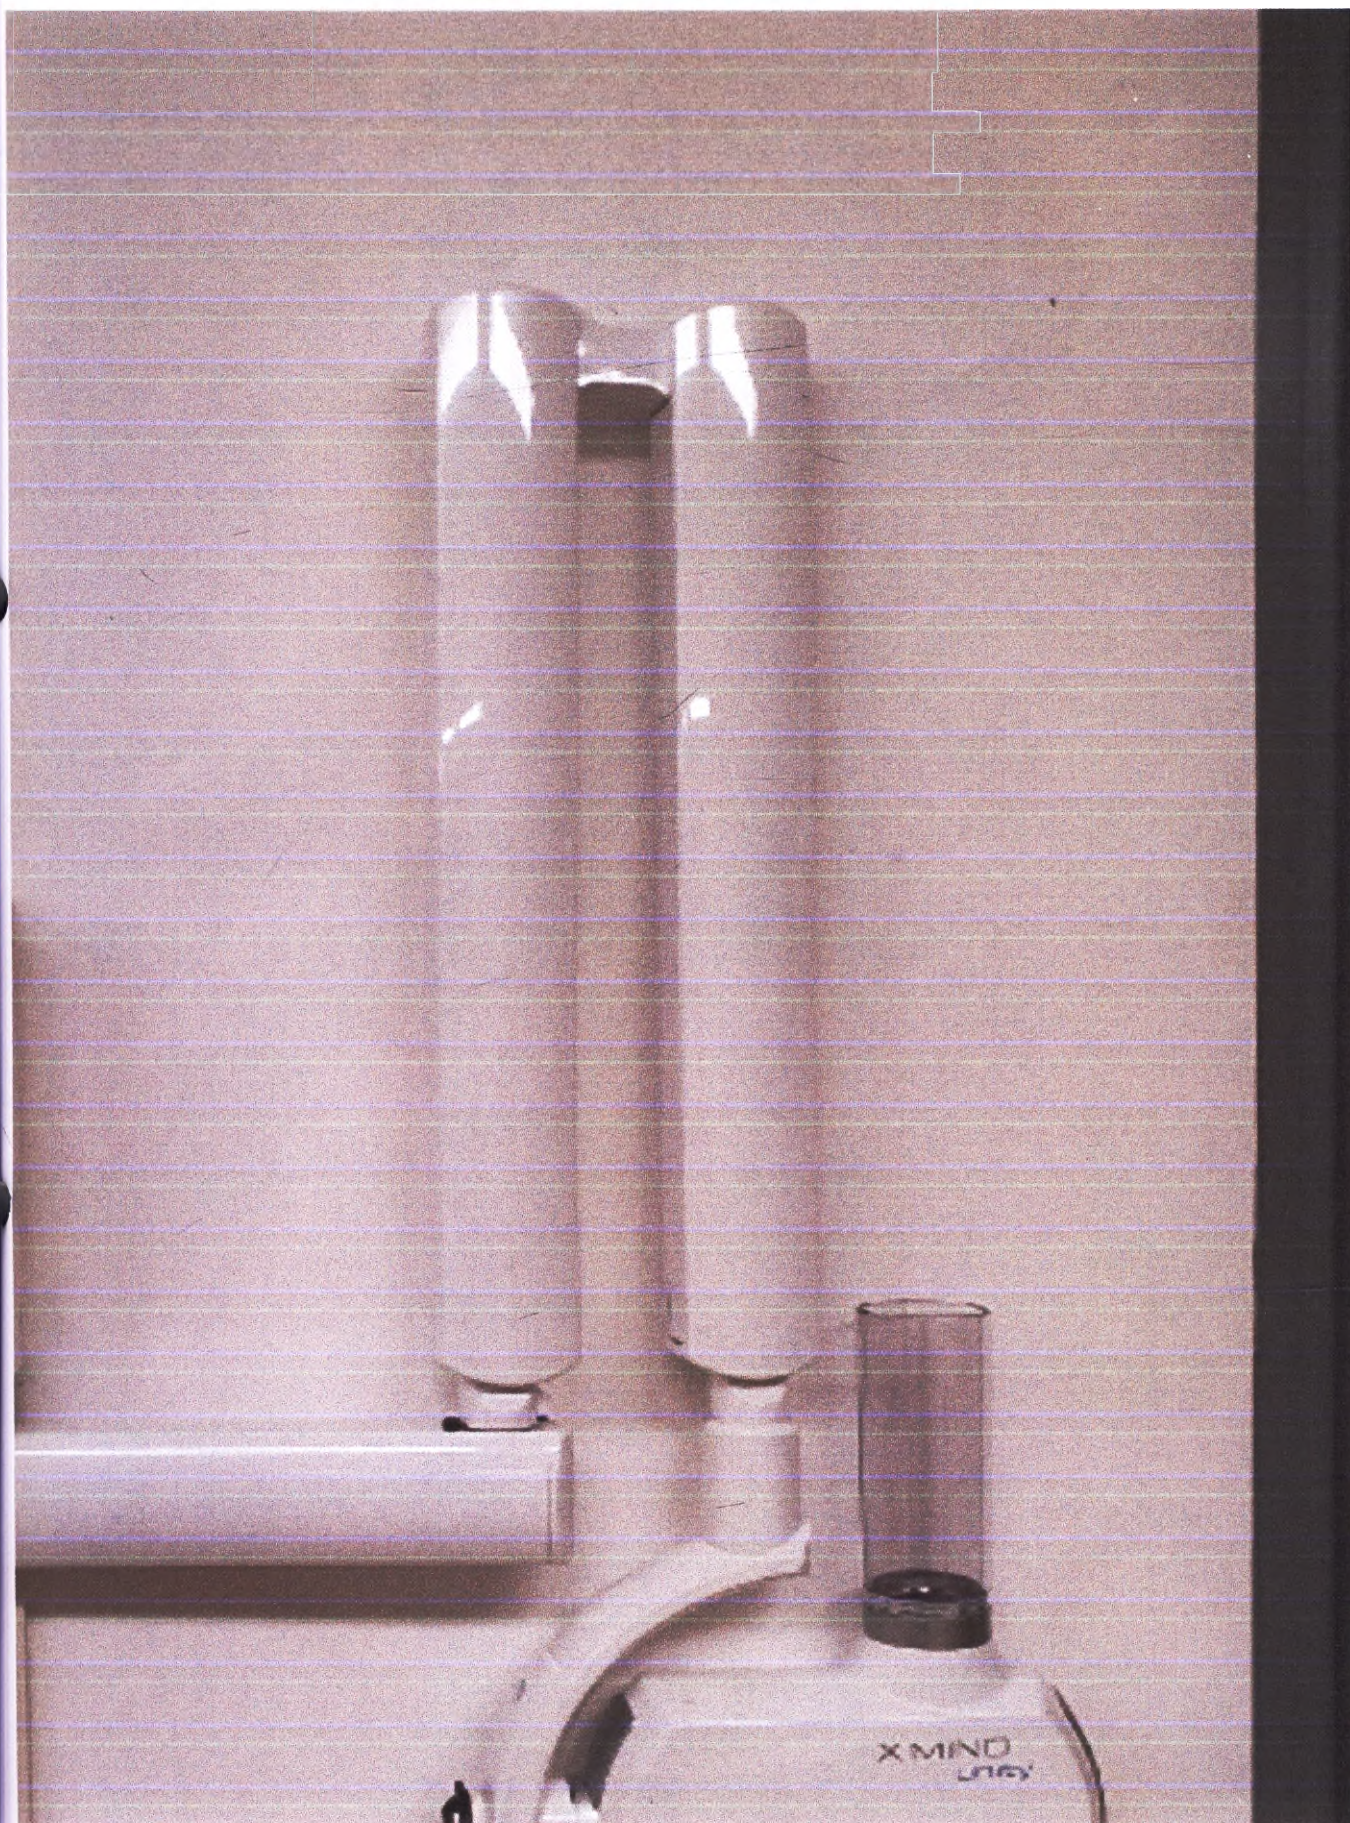


7. Излучатель рентгеновский в сборе




8. Датчик Sopix 2 Inside, производства SOPRO, место производства ZAC Athelia IV, Avenue des Genevriers 13705 LA CIOTAT CEDEX FRANCE (Франция)

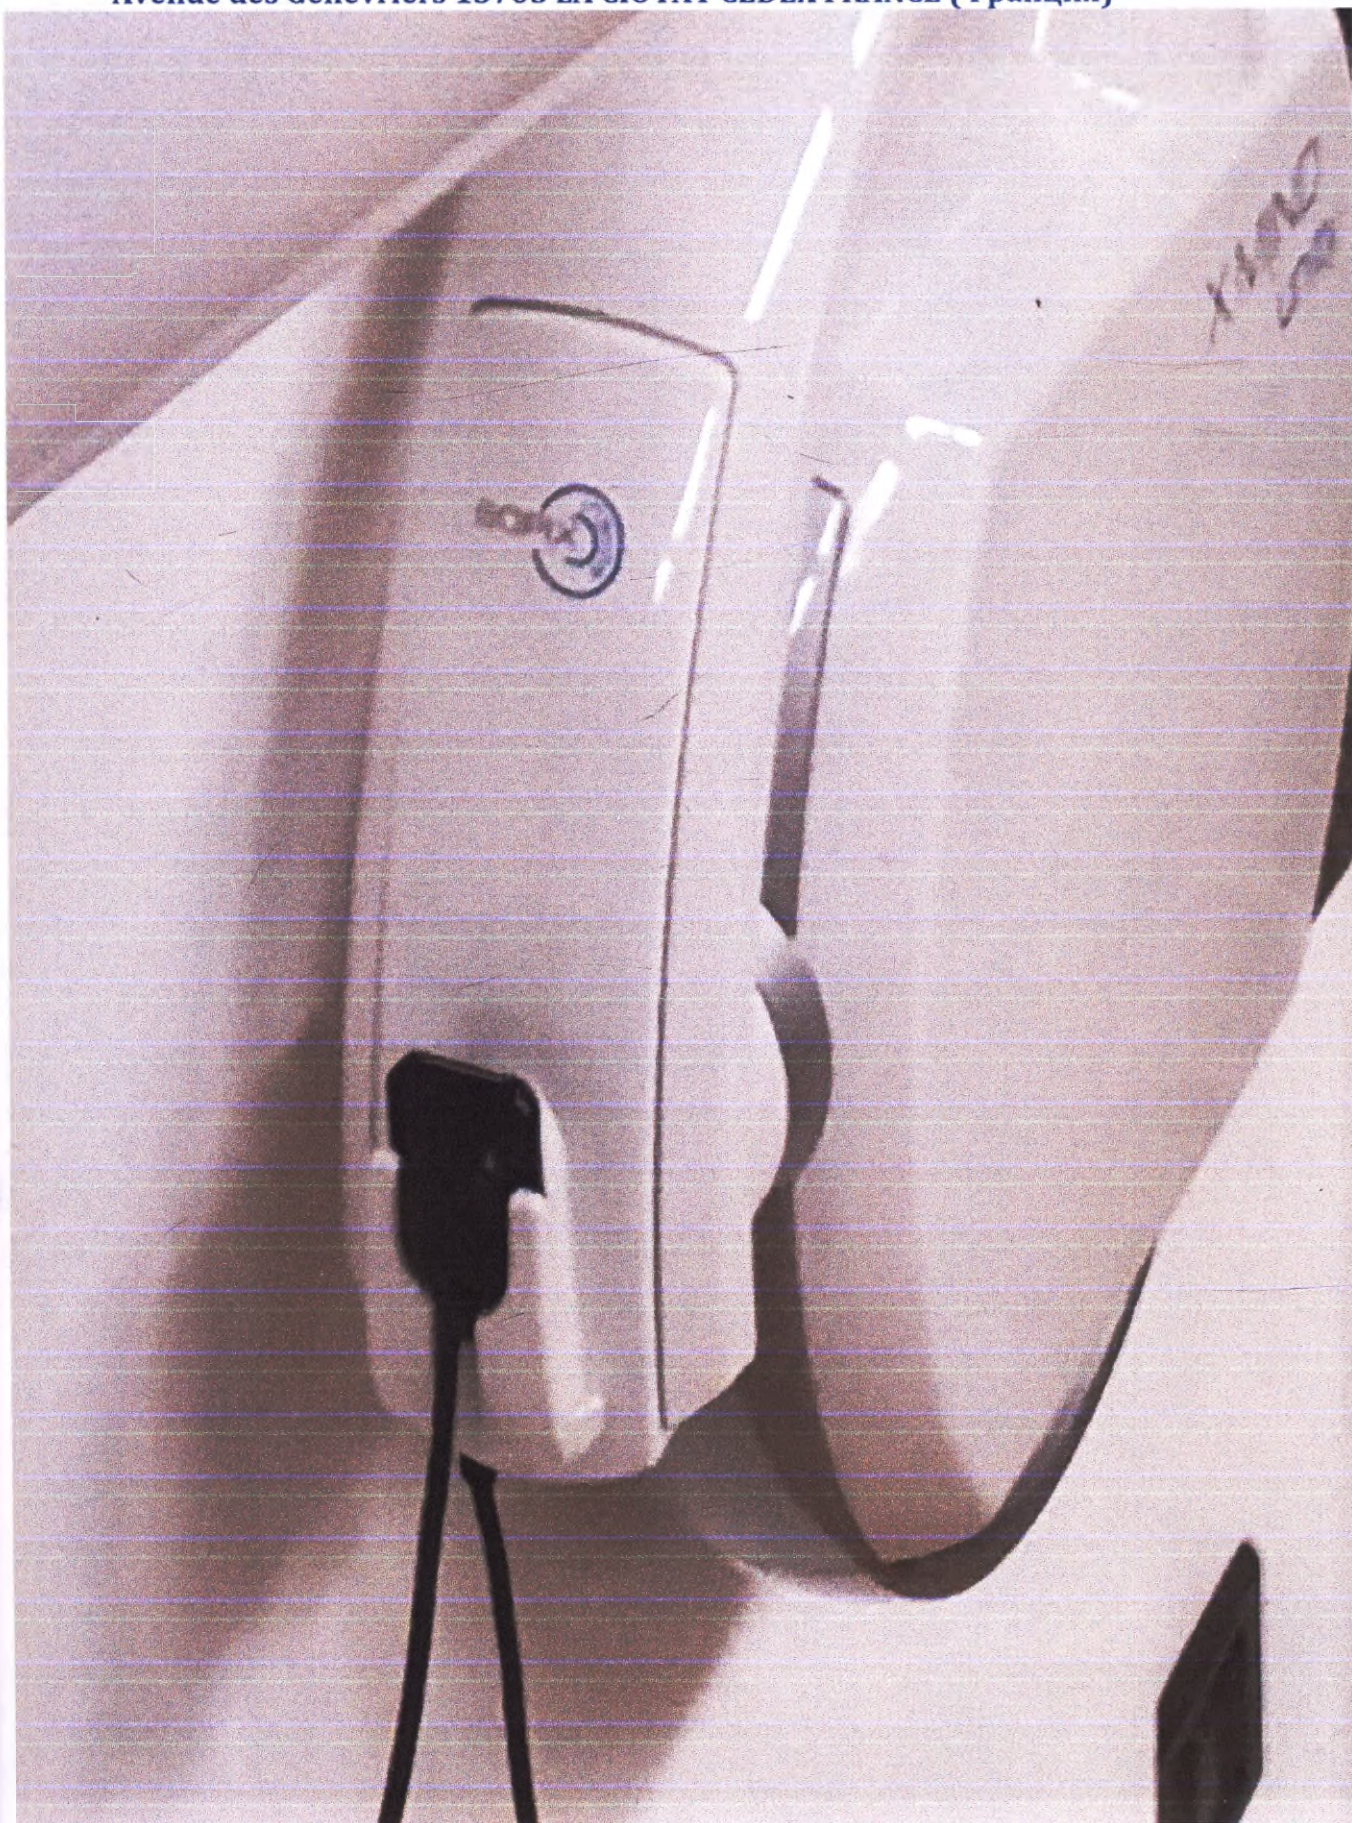

Датчик Sopix 2 Inside и держатель датчика

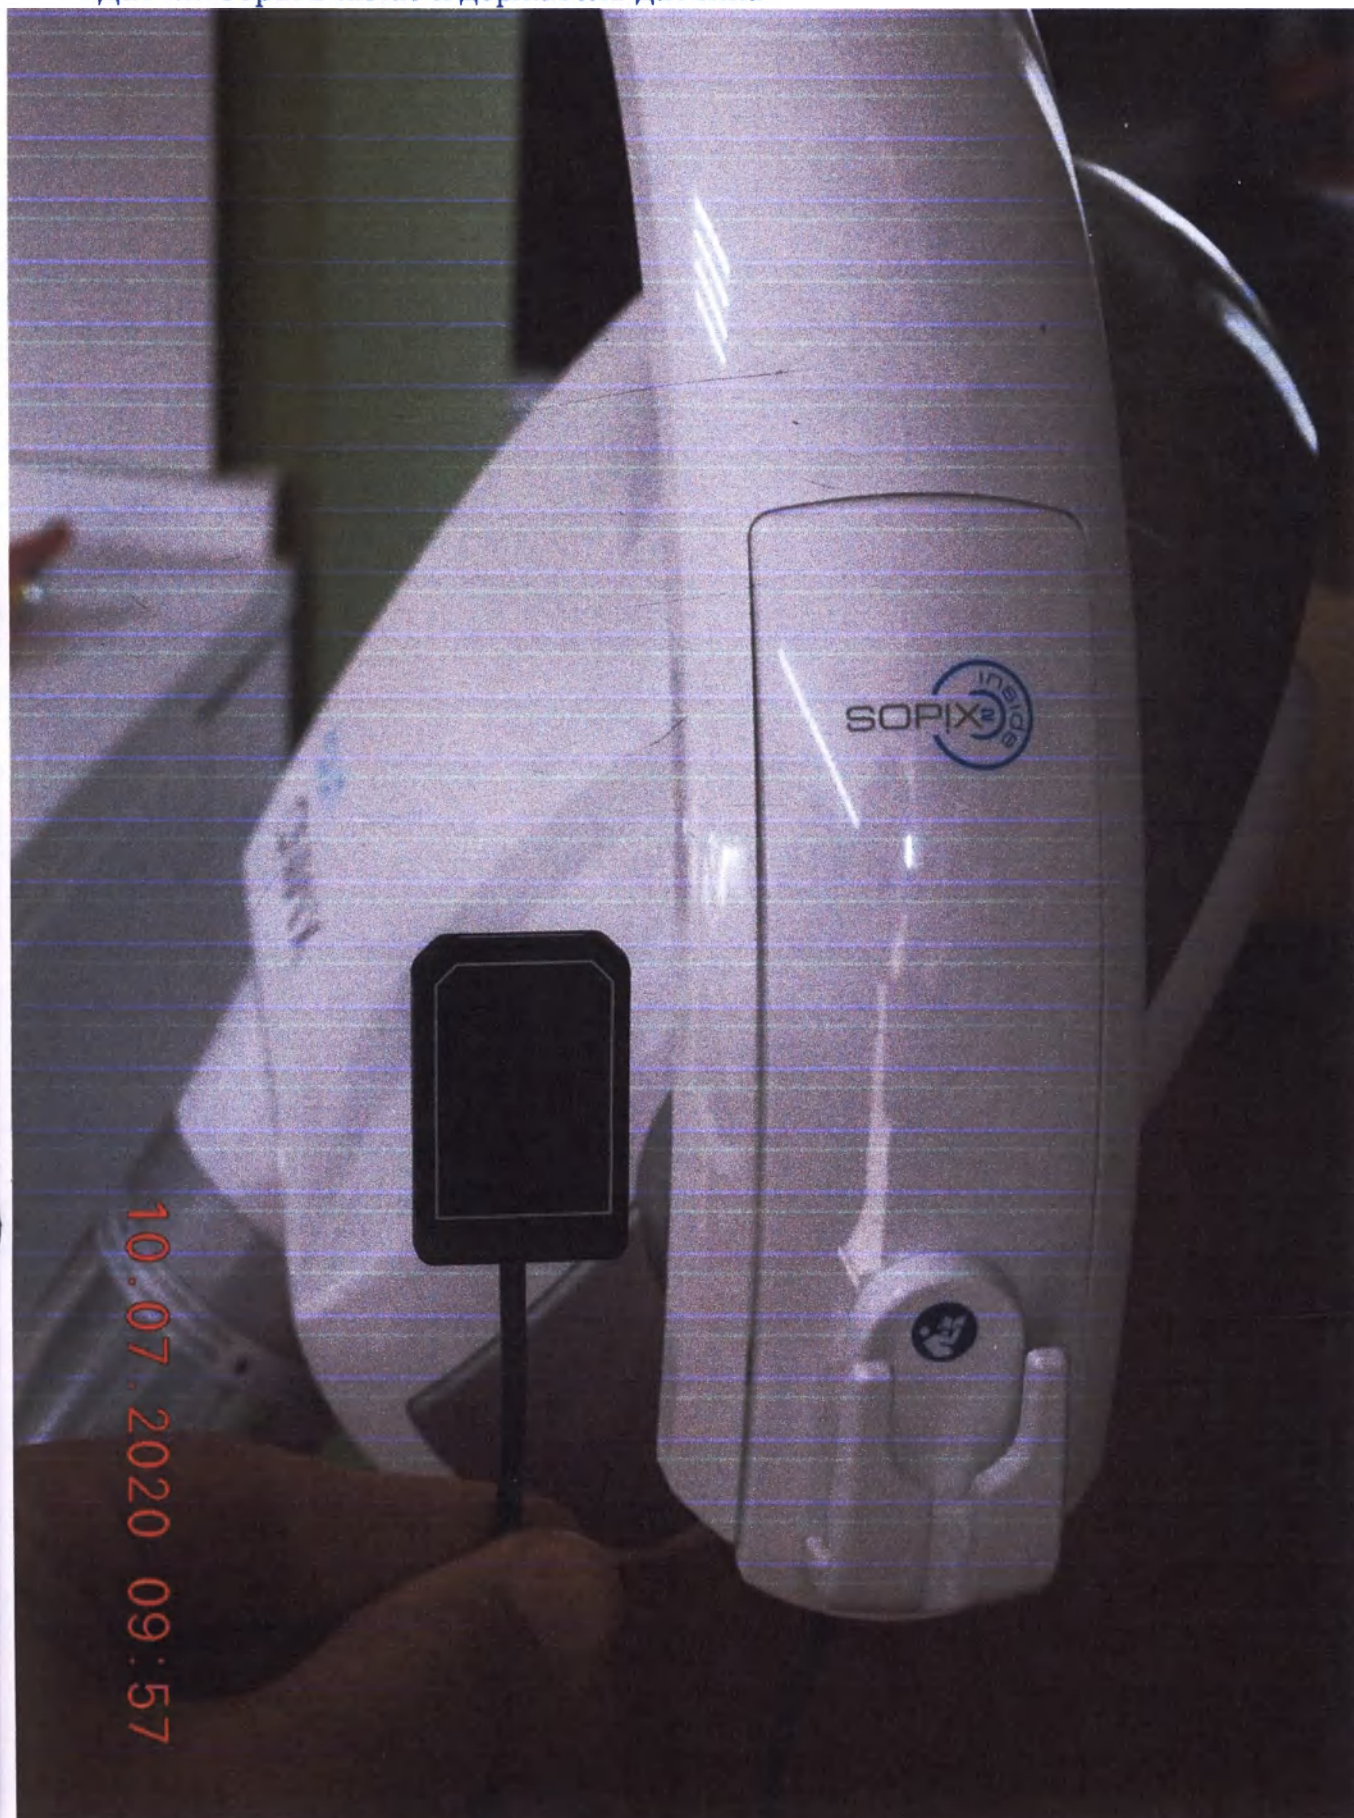

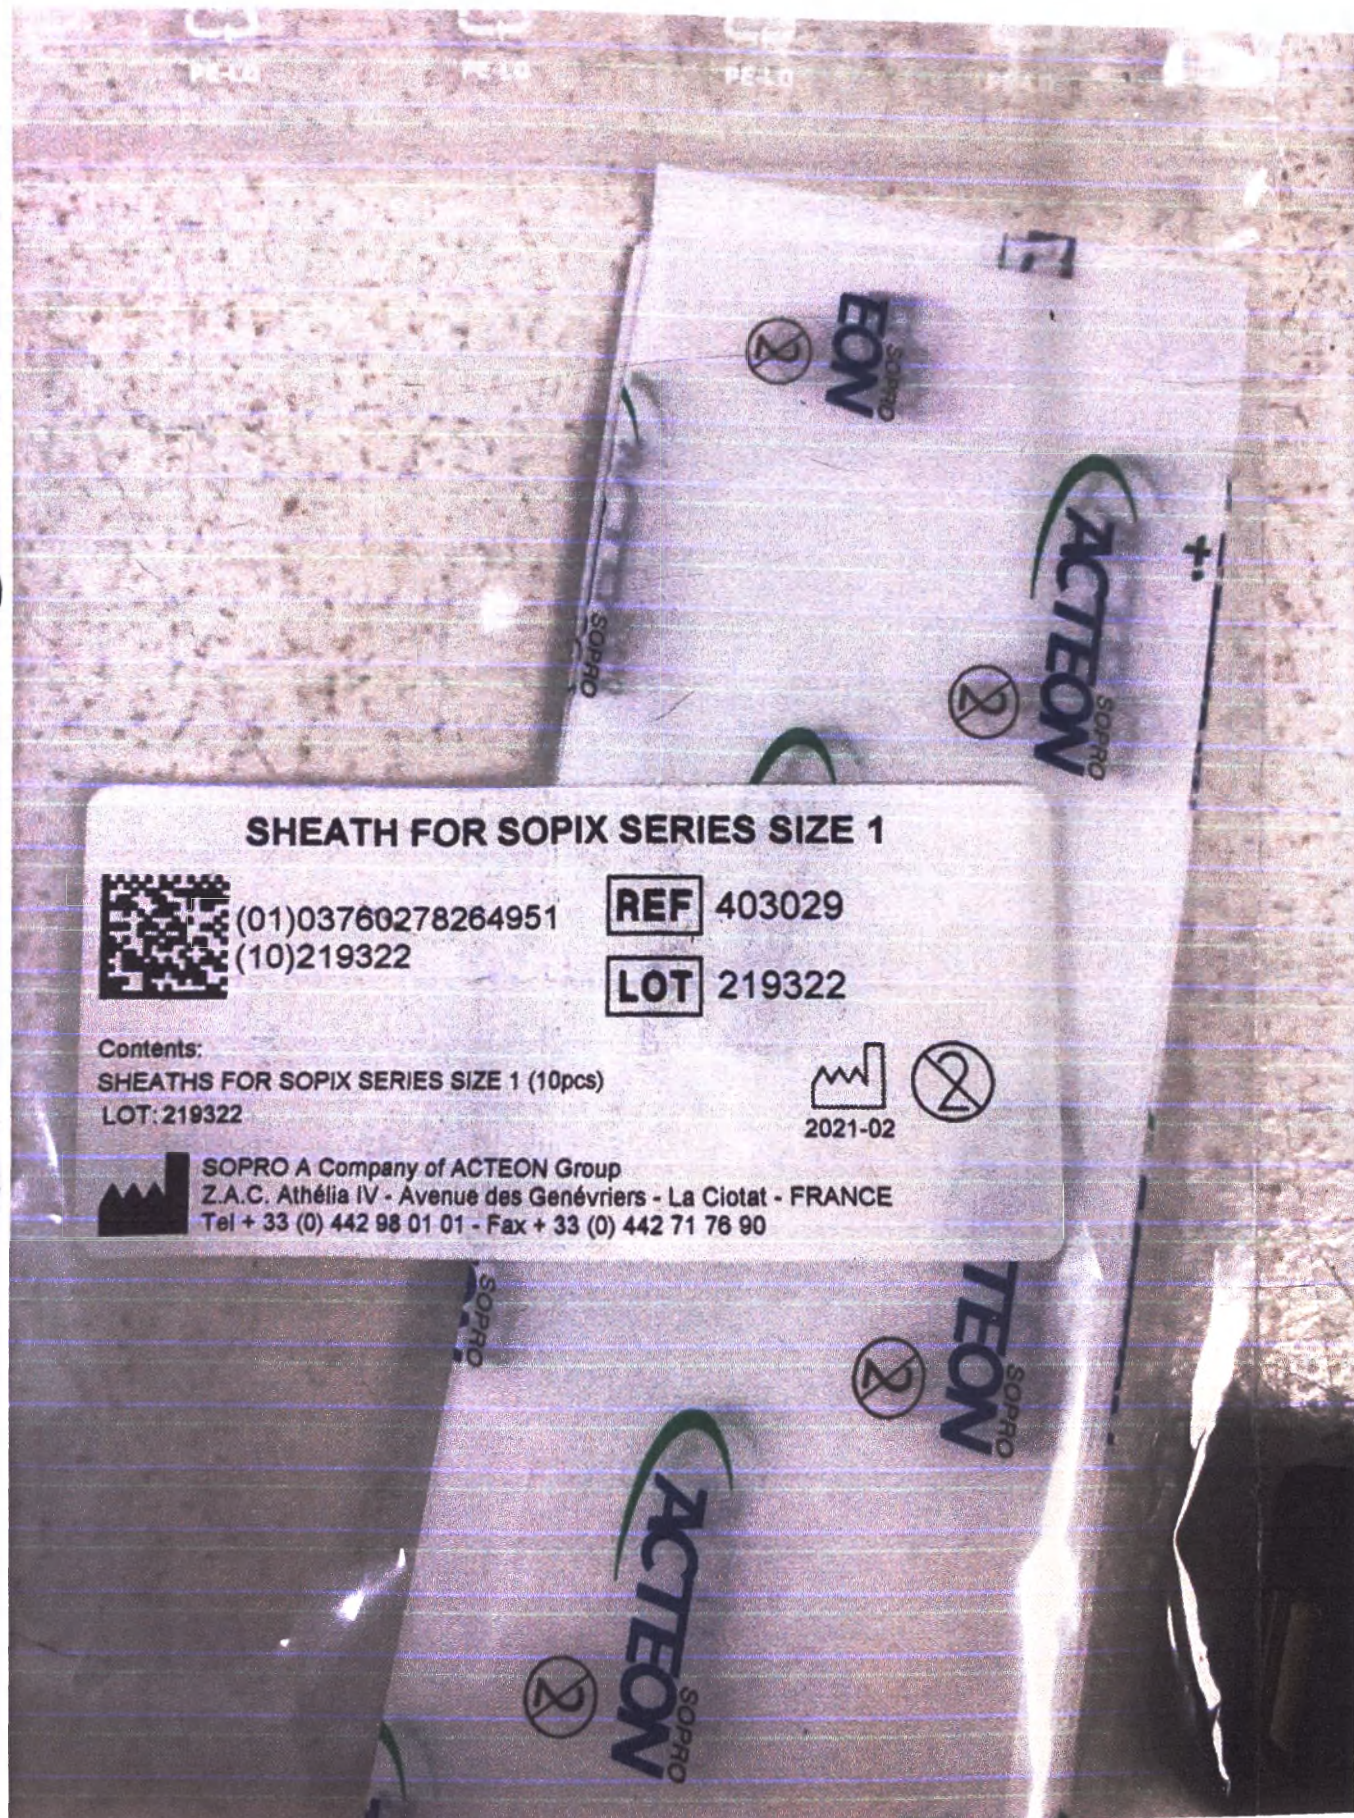

SHEATH FOR SOPIX SERIES SIZE 1



(01)03760278264951
(10)219322

REF 403029

LOT 219322

Contents:

SHEATHS FOR SOPIX SERIES SIZE 1 (10pcs)

LOT: 219322



2021-02



SOPRO A Company of ACTEON Group
Z.A.C. Athélia IV - Avenue des Genévriers - La Ciotat - FRANCE
Tel + 33 (0) 442 98 01 01 - Fax + 33 (0) 442 71 76 90



9. Устройство для ограничения пучка (круглый длинный)

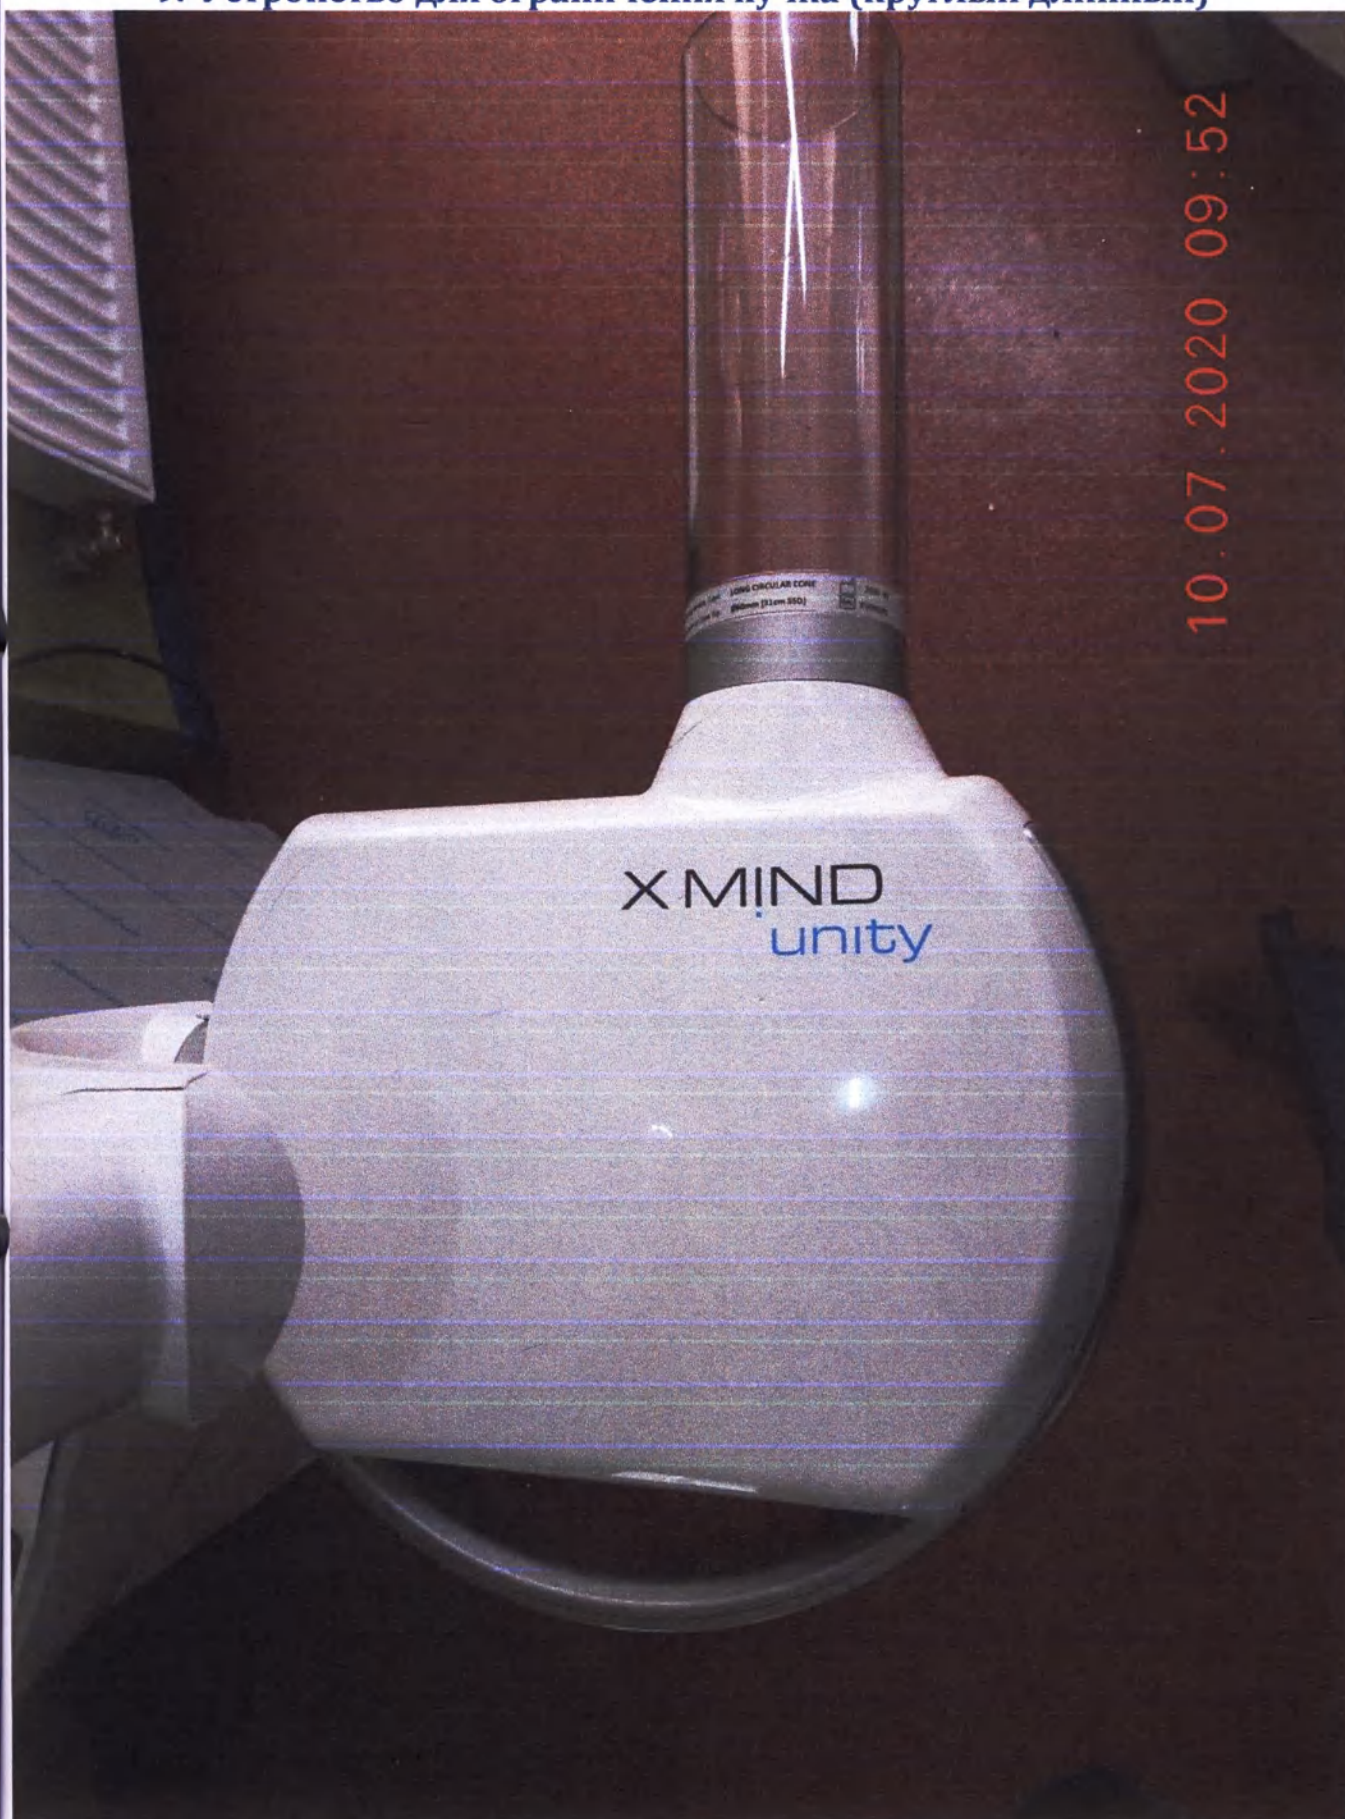



10.07.2020 09:52

10. Устройство для ограничения пучка (круглый короткий)



11. Устройство для ограничения пучка (квадратный длинный)


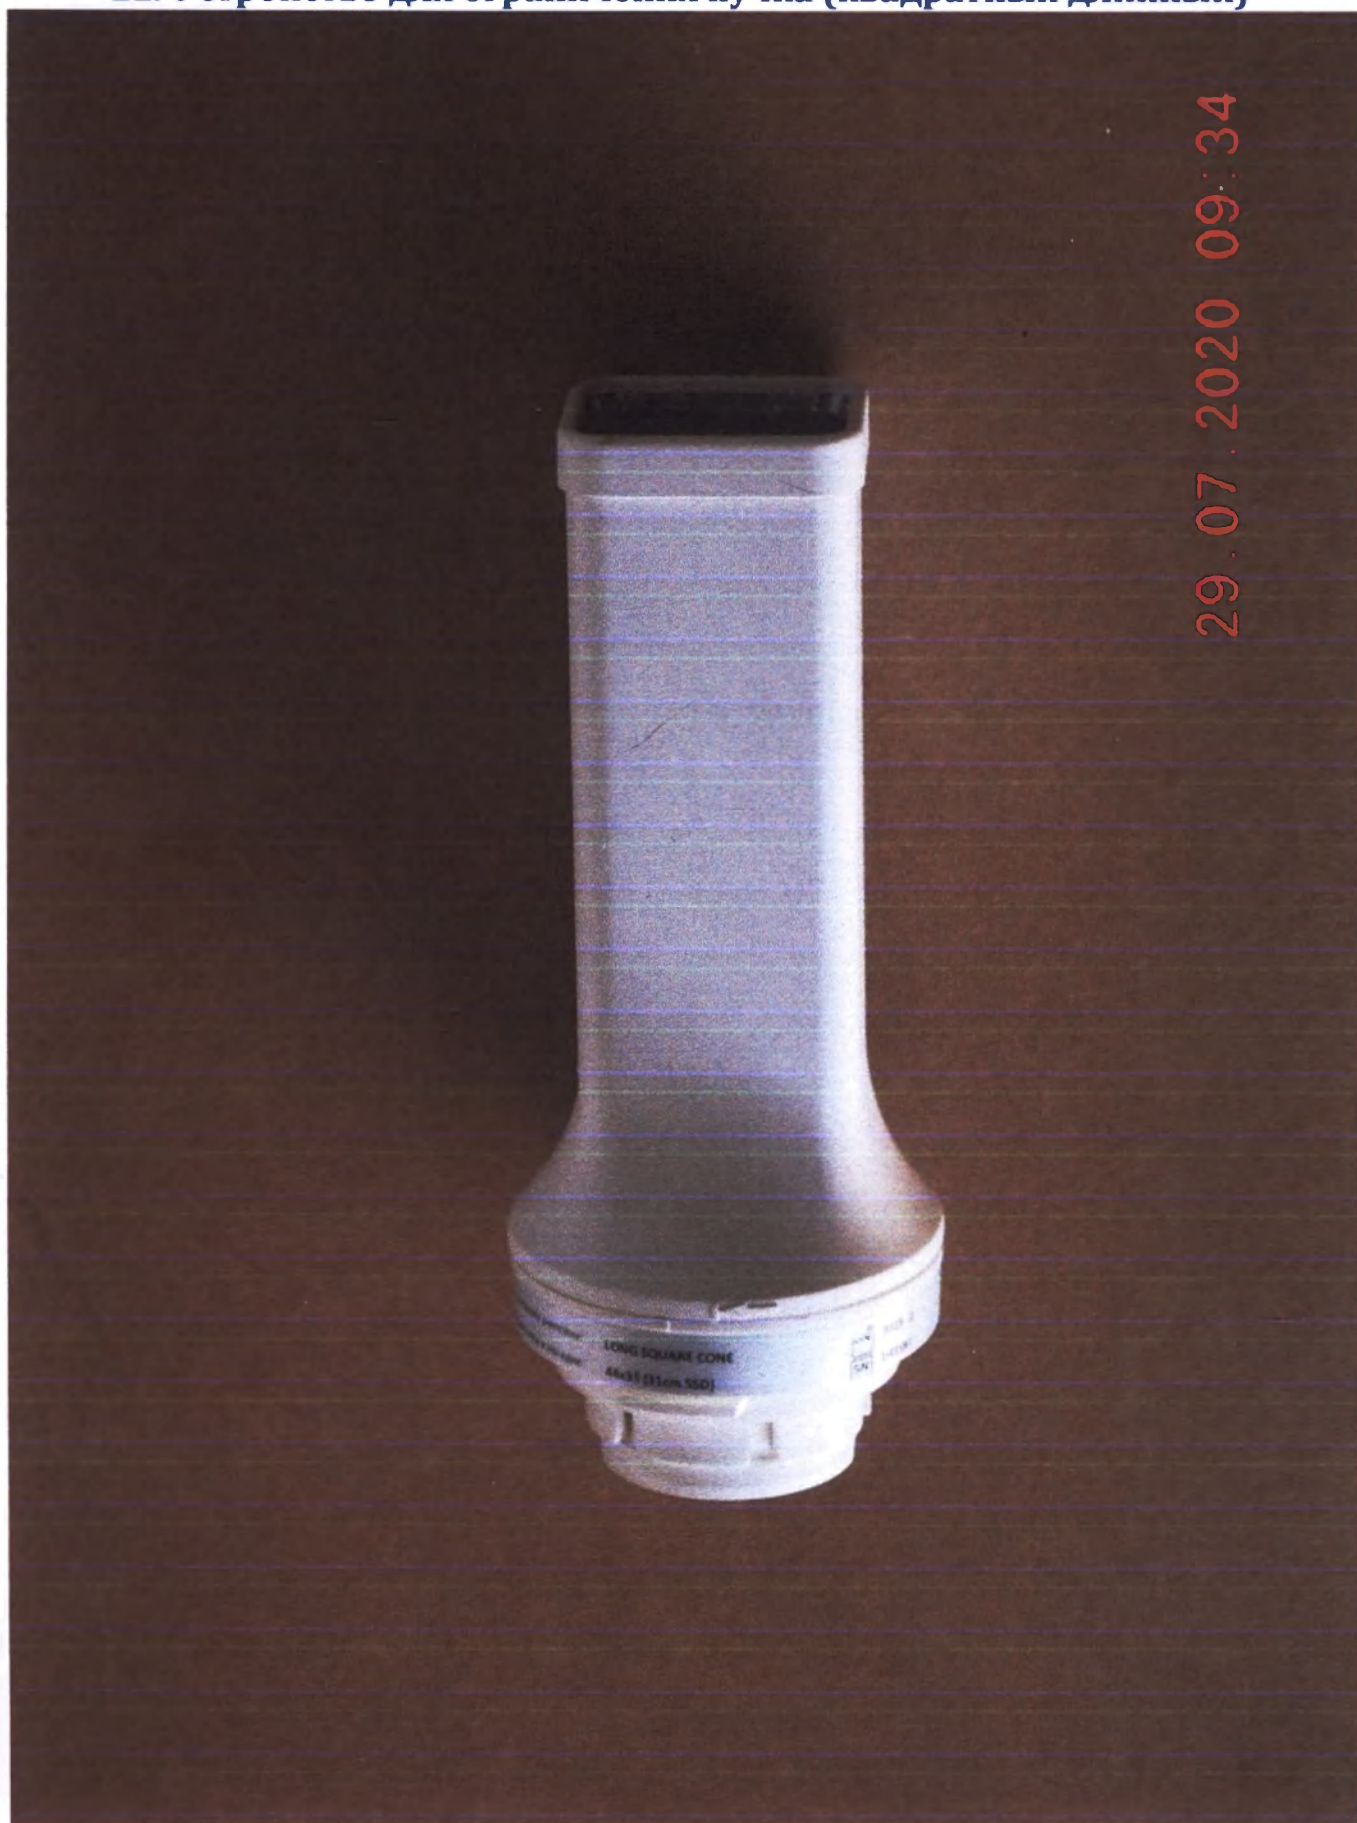


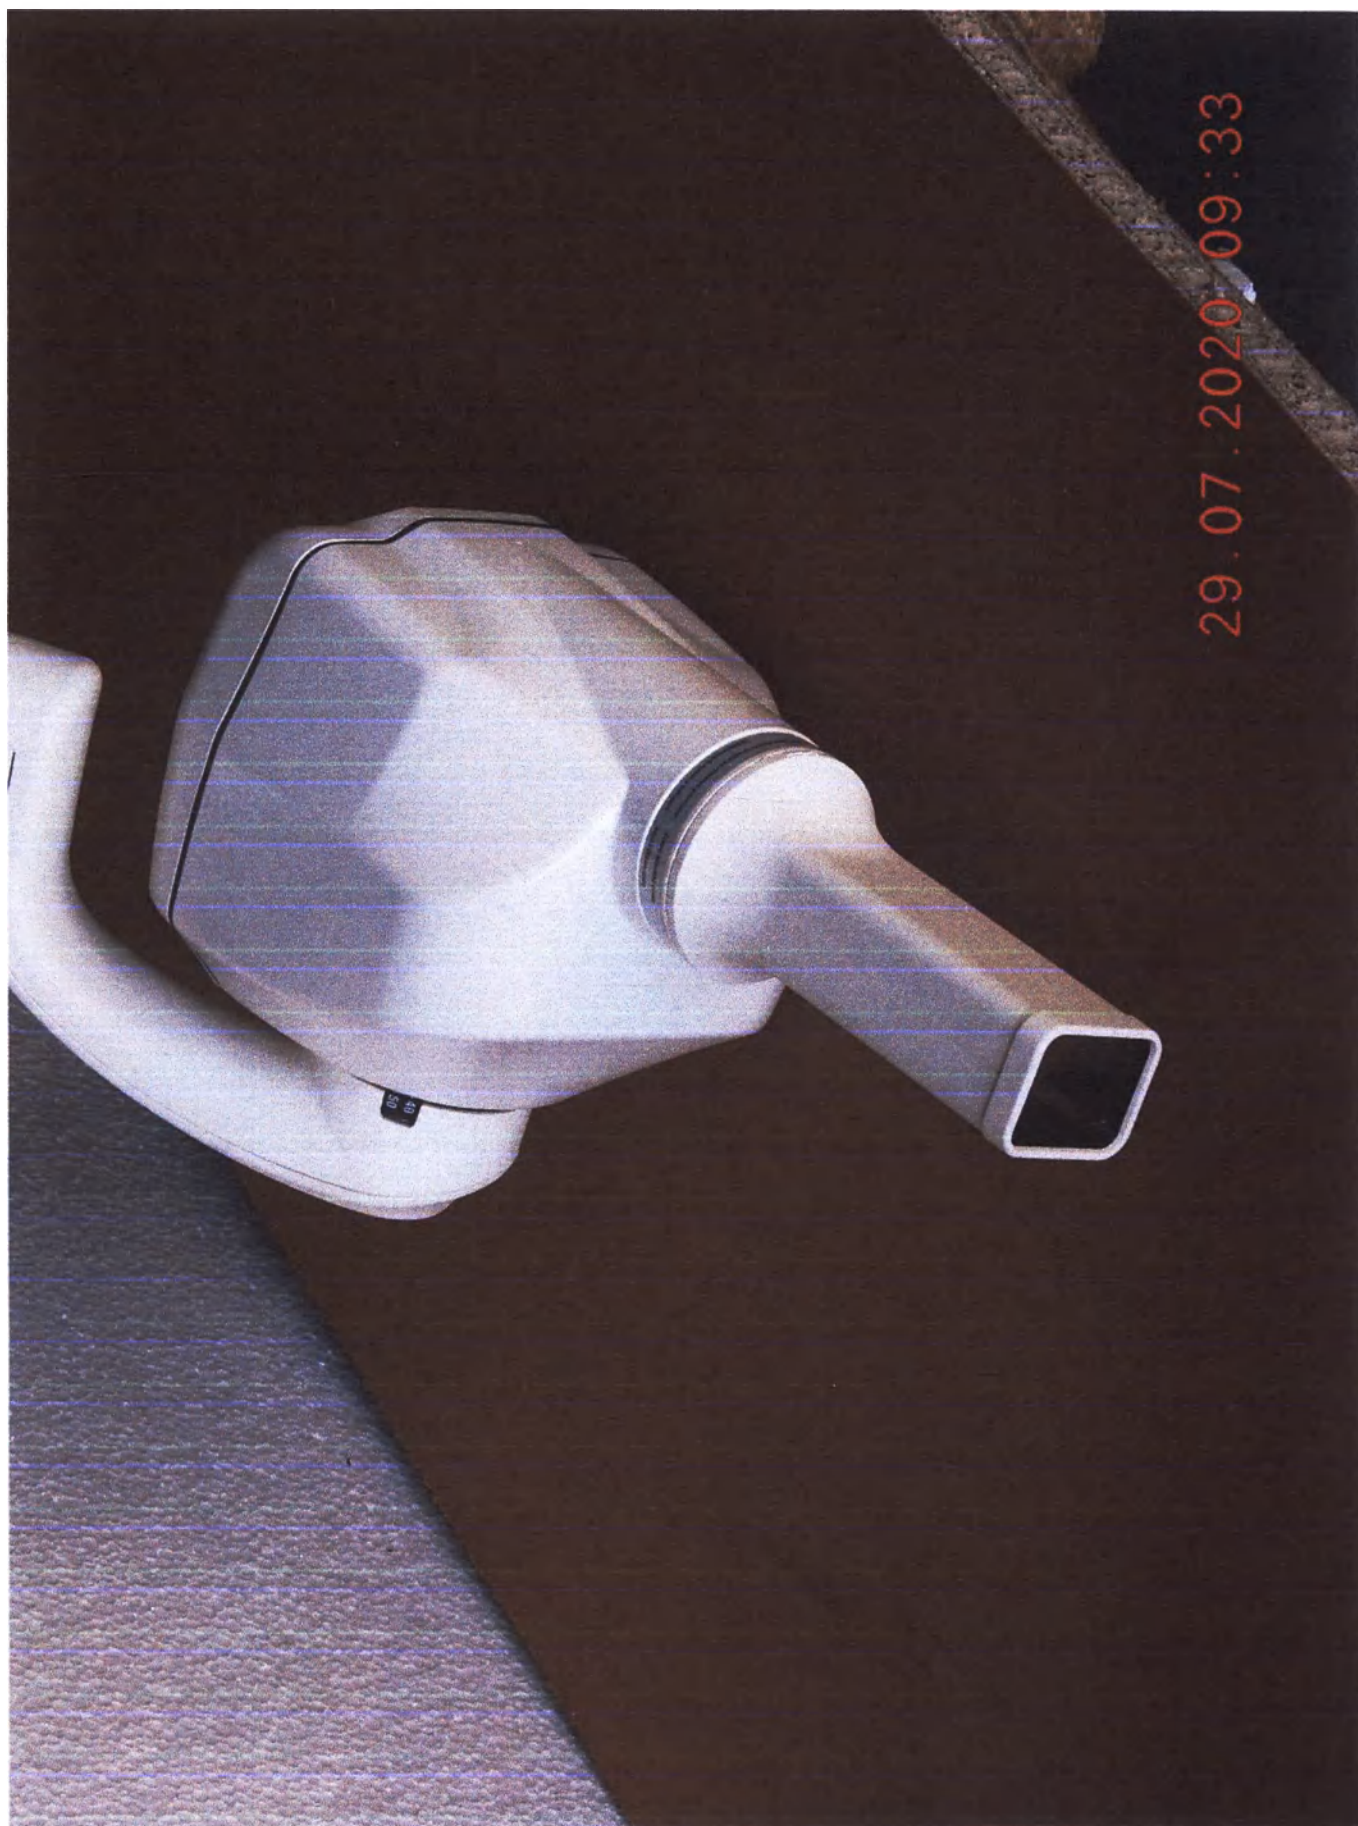


12. Устройство для ограничения пучка (квадратный короткий)



13. Панель настенного монтажа

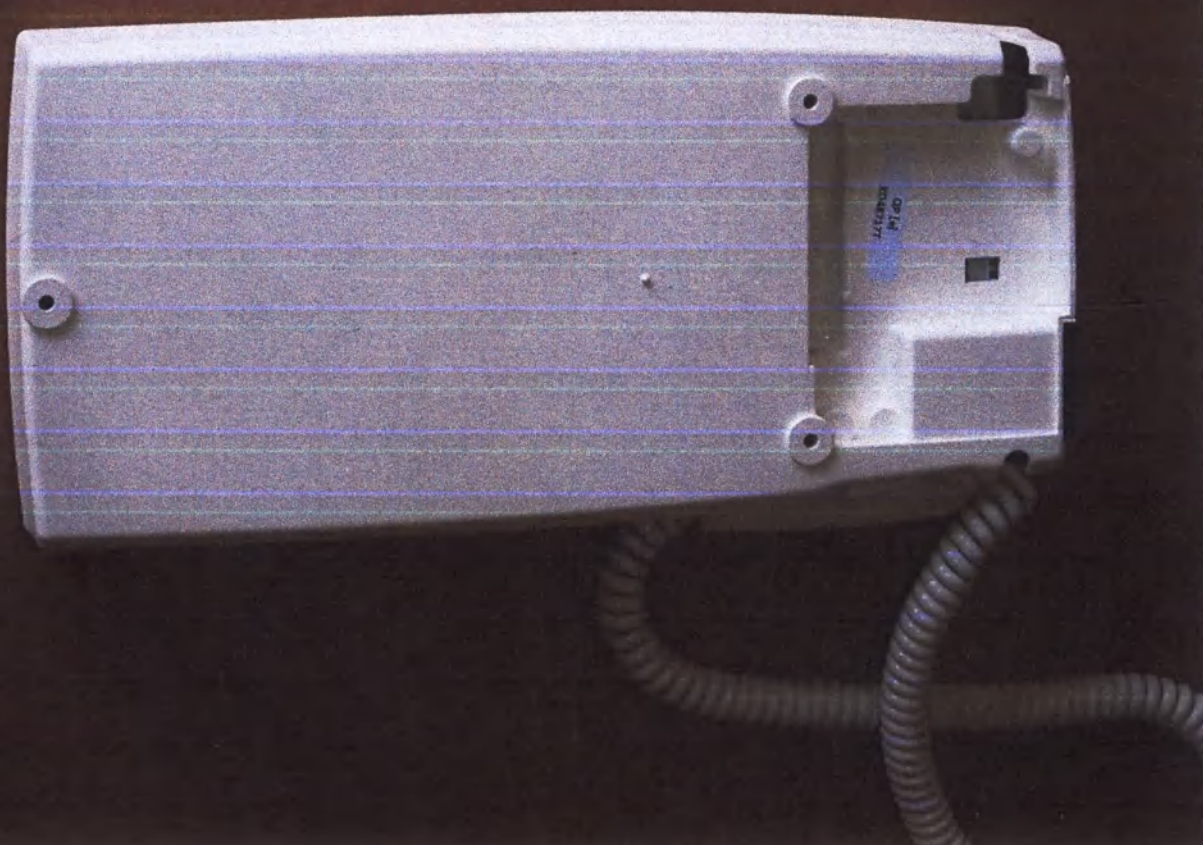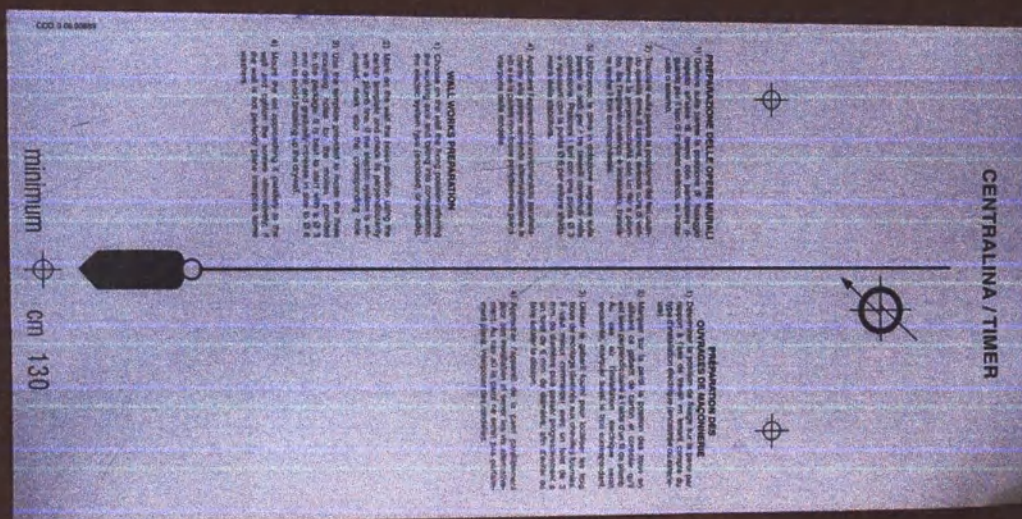


14. Дистанционный включатель X-Mind Unity

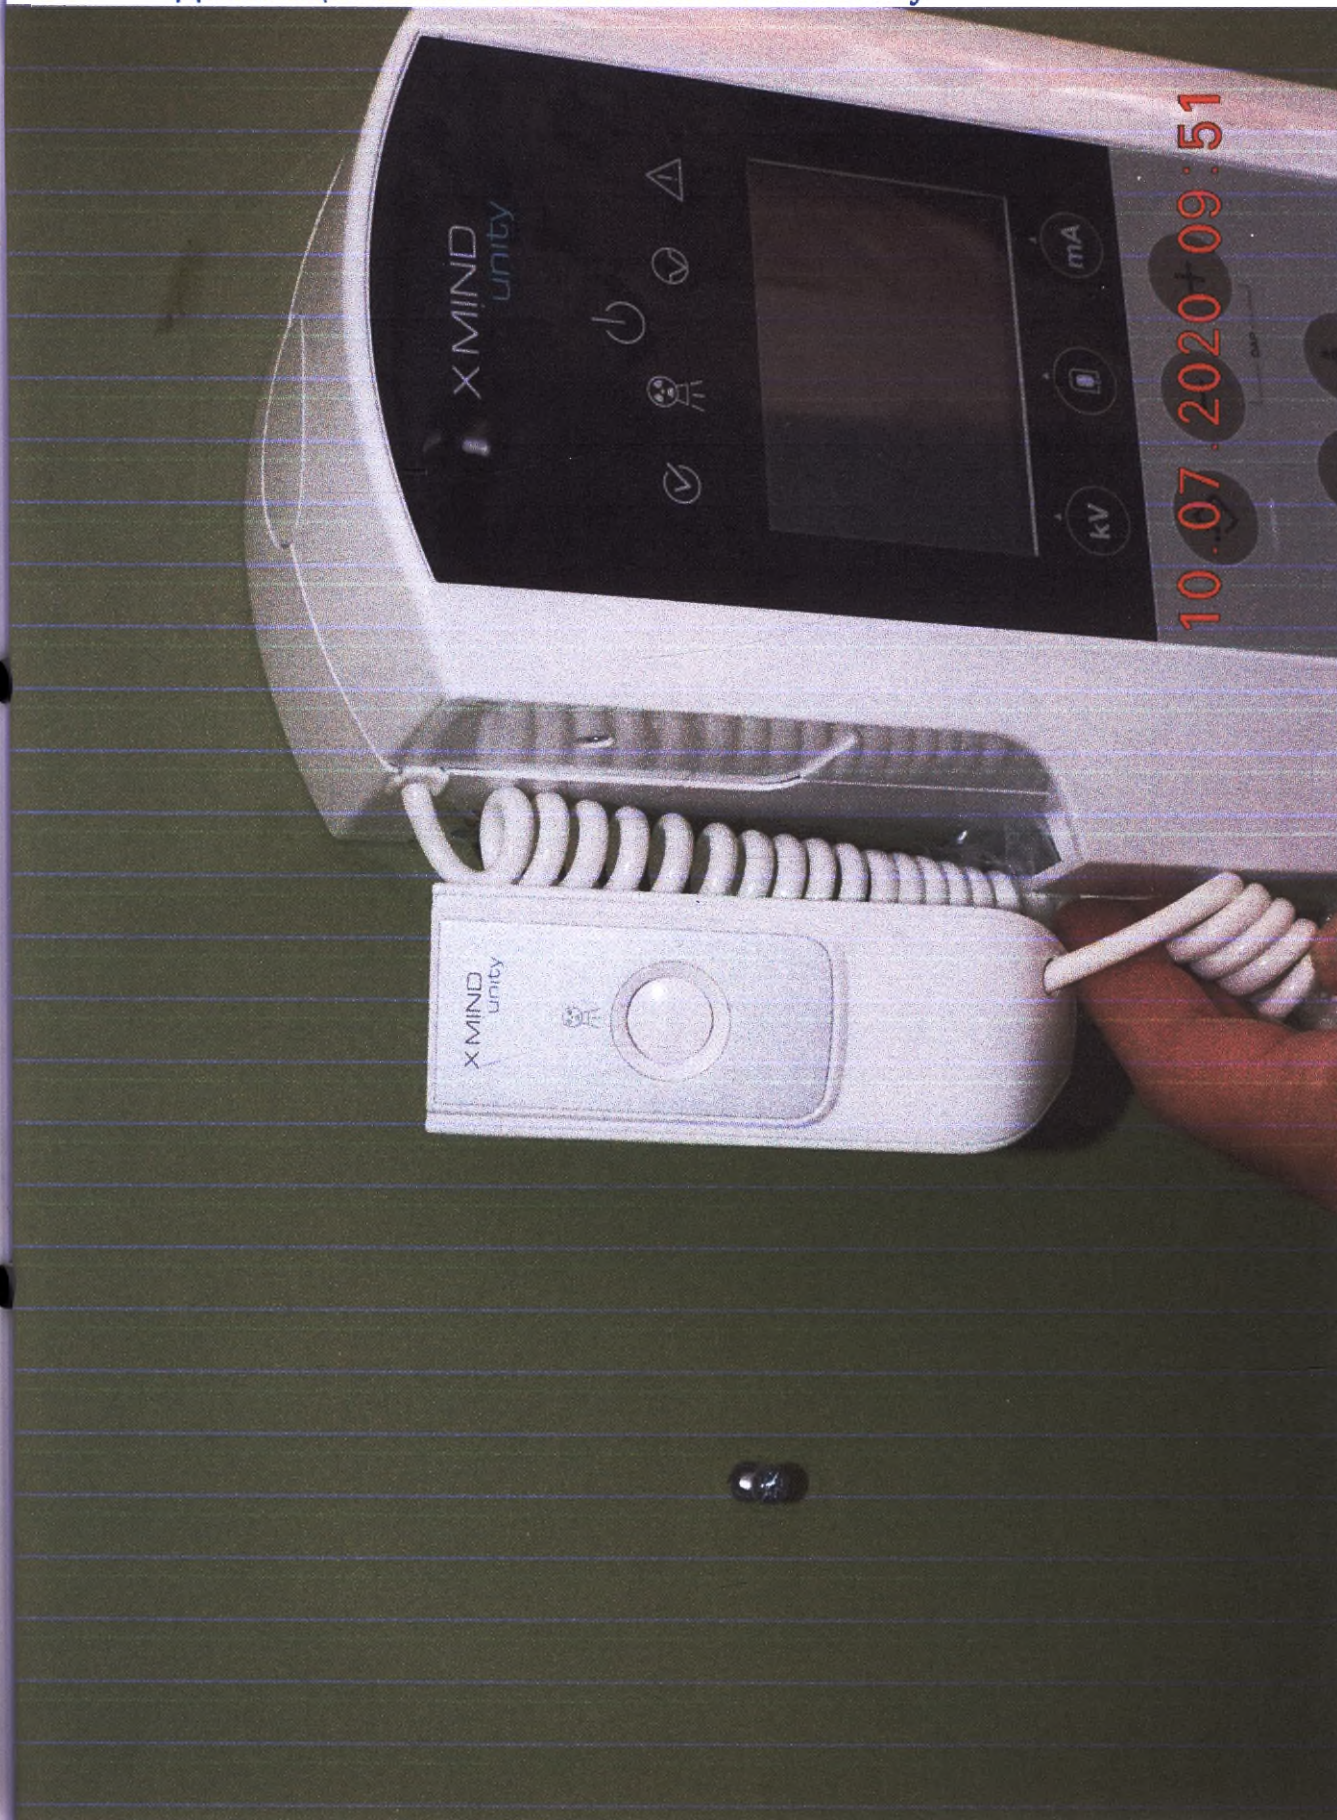


15. Лампа X-Mind Unity




16. Кронштейн для мобильной установки рентгена
В упаковке

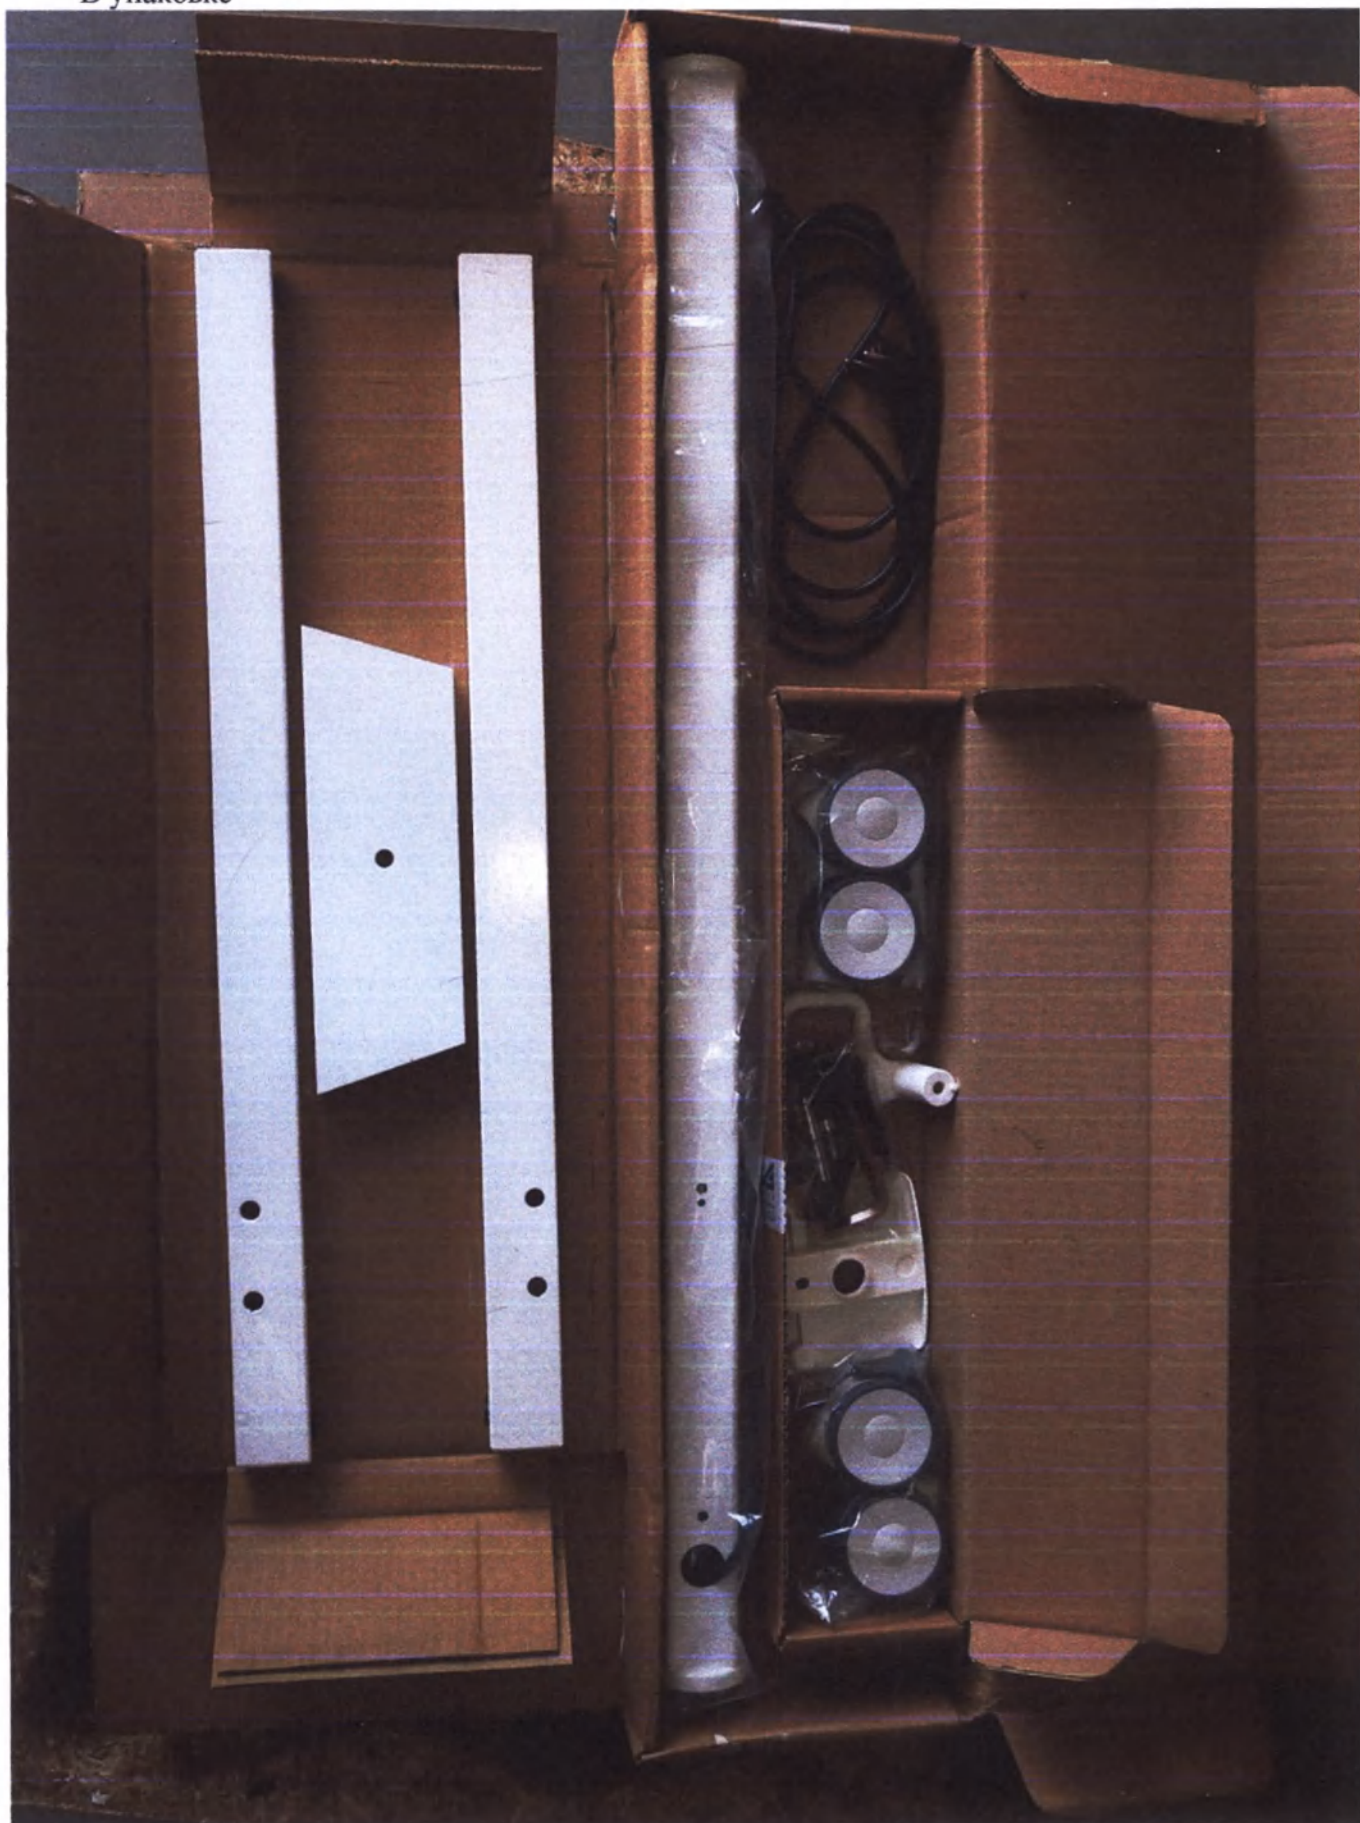




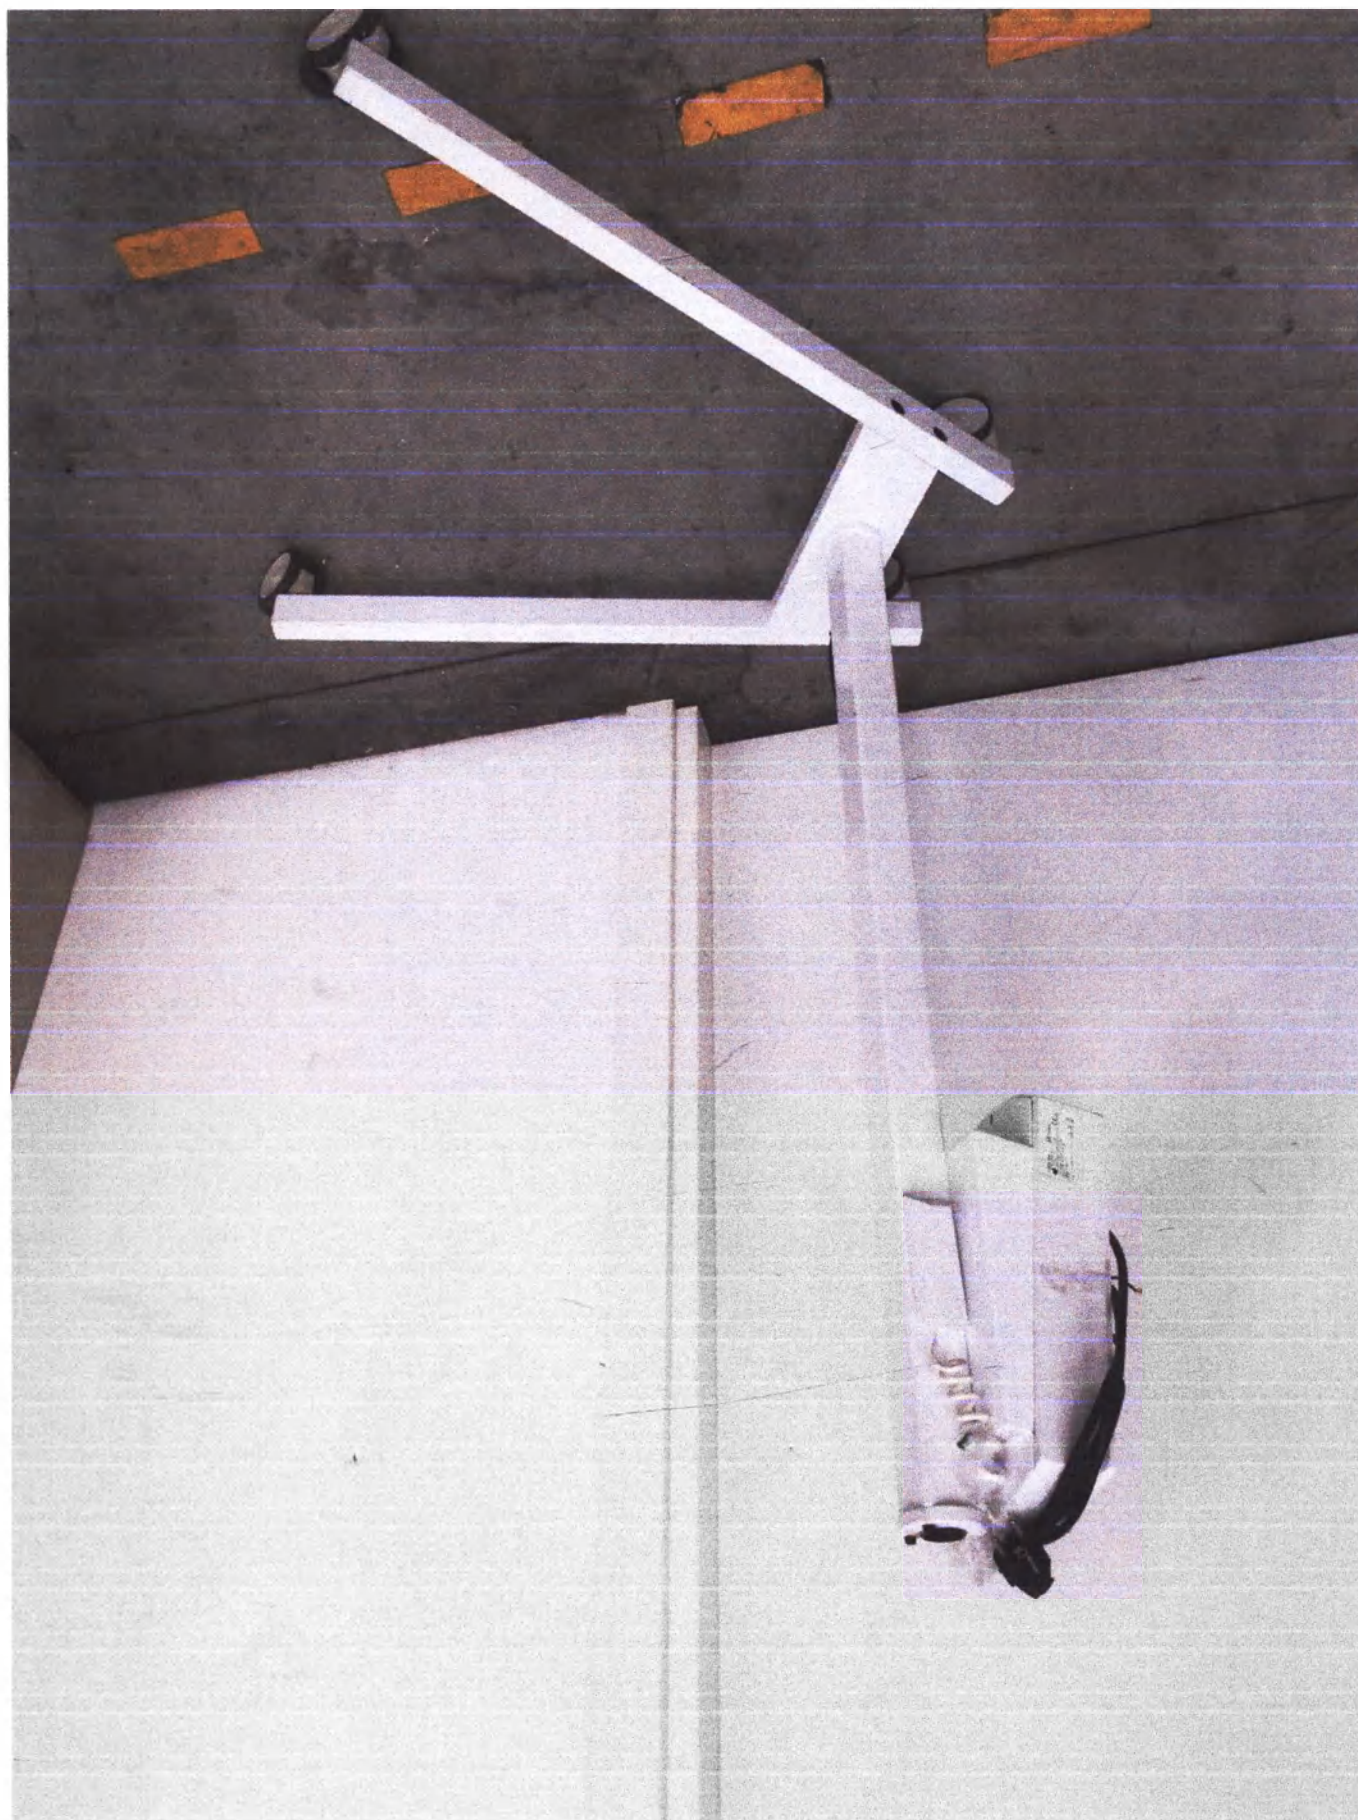

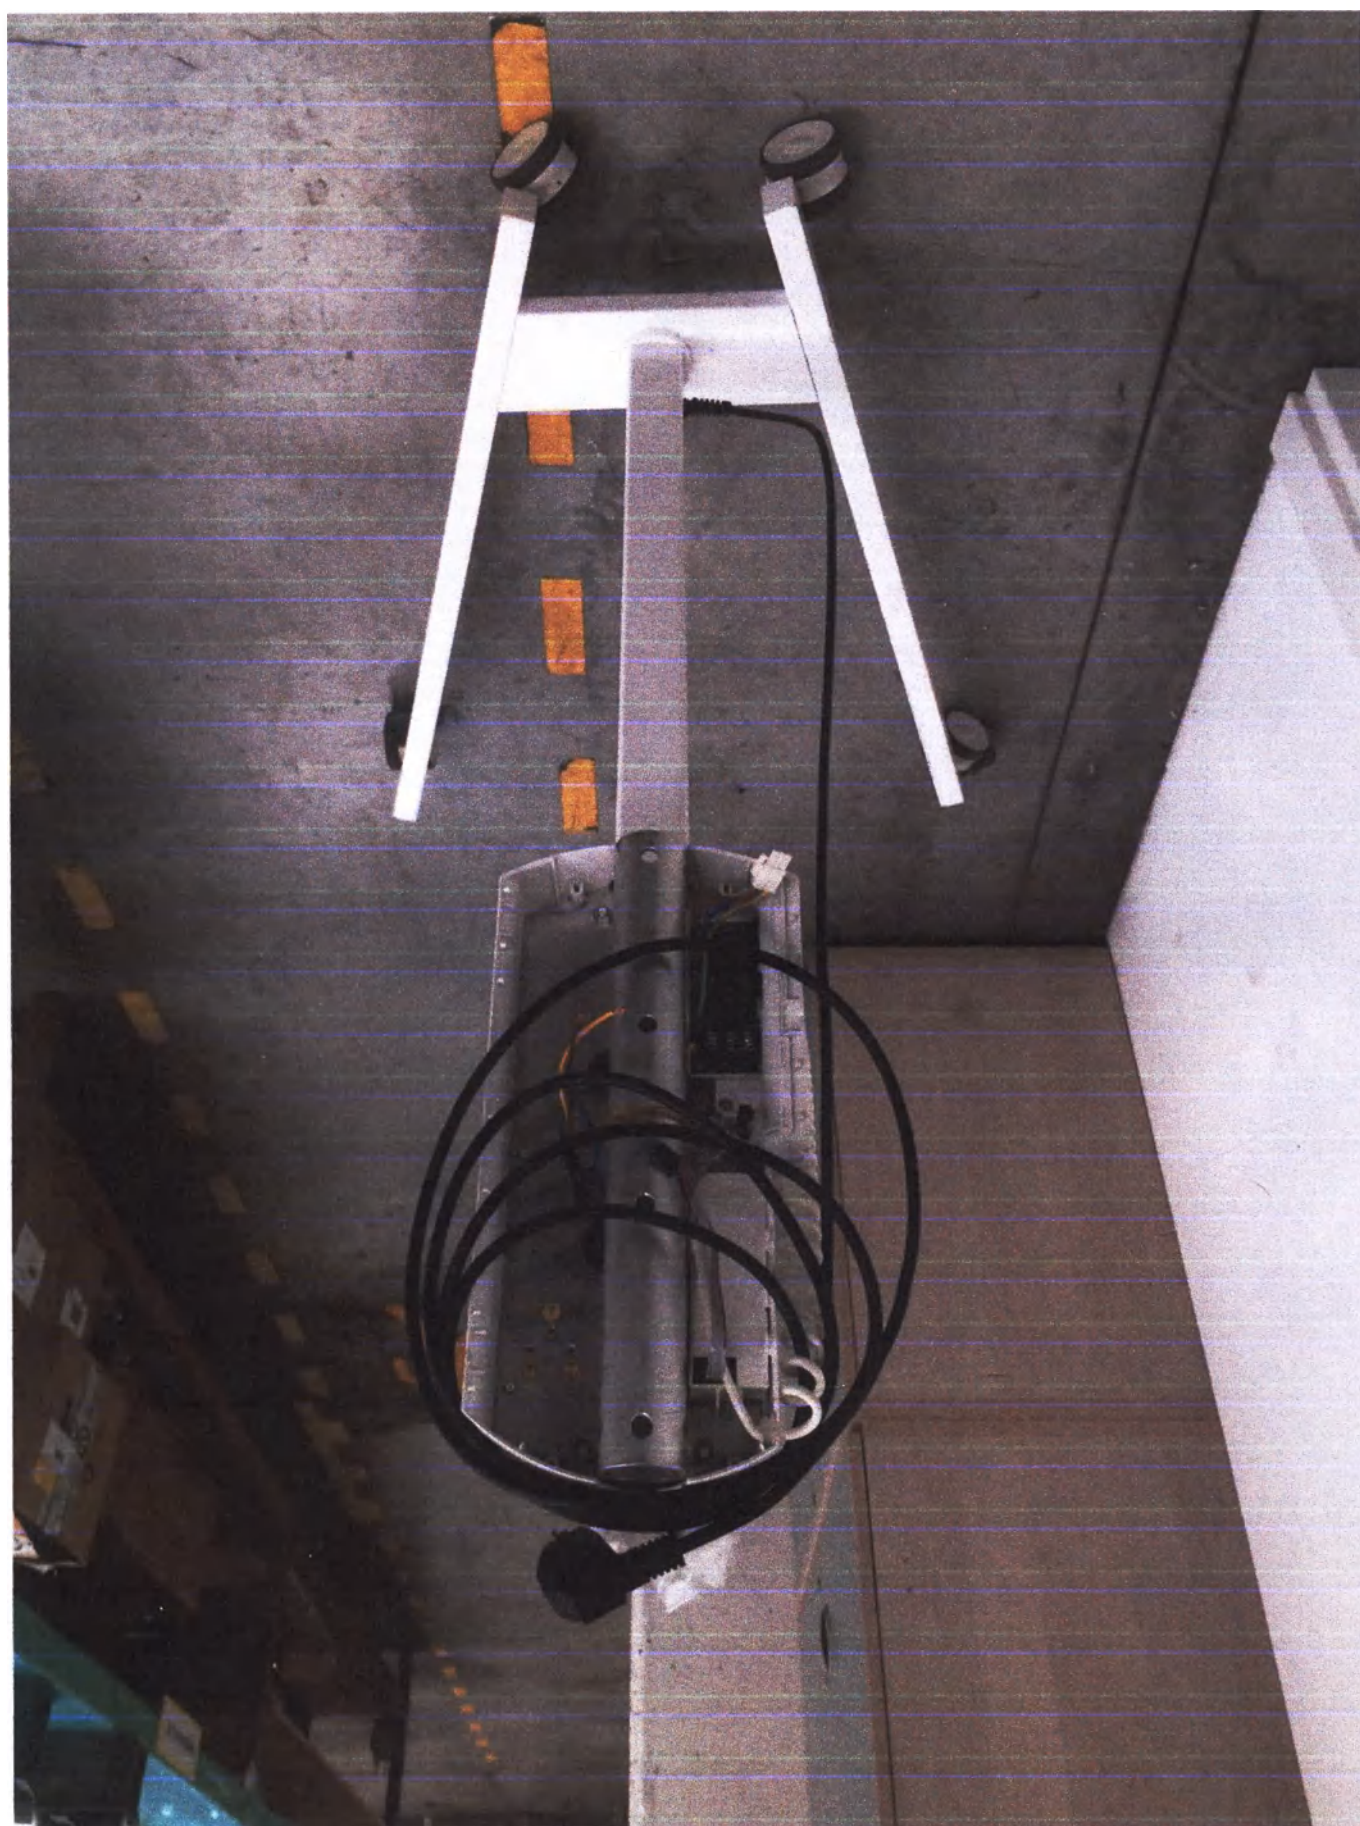



17. Кабель питания

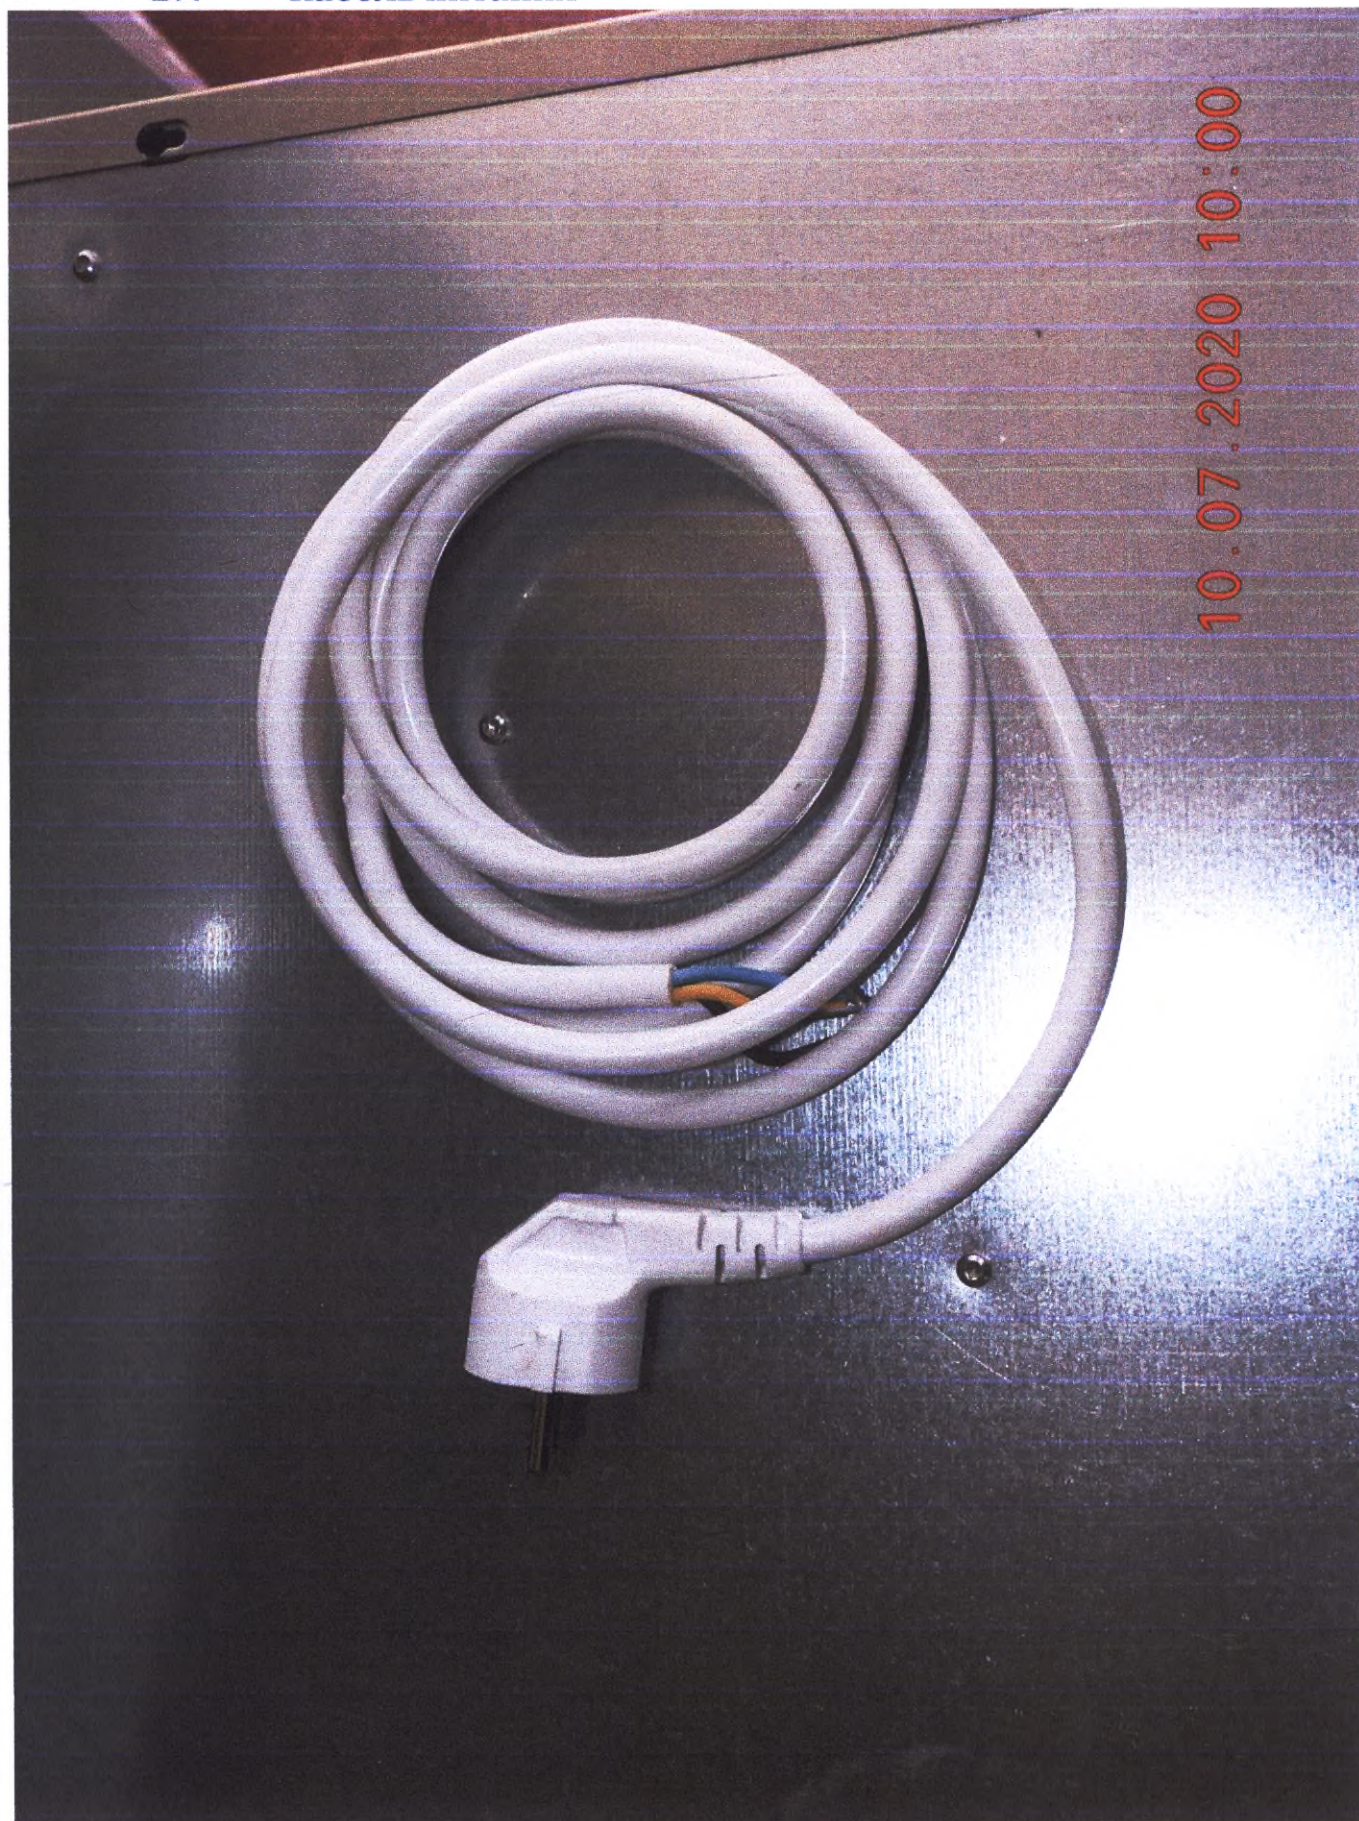

18. Эксплуатационная документация в составе:

Руководство оператора X-Mind Unity

X MIND
unity

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Руководство оператора • Рентгеновская система X-MIND unity •
(15) • 04/2019 • NUN0EN010M



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AIS



ACTEON
imaging suite

РУС



DE GÖTZEN S.r.l. a Socio Unico | A company of ACTEON Group
Attività di direzione e coordinamento di Financiere Acteon
Via Roma 45 | 21057 OLGiate OLONA (VA) | ITALY
Tel. +39 0331 376 760 | Fax +39 0331 376 763 | www.acteongroup.com
E-mail: degotzen@acteongroup.com | degotzen@pec.degotzen.net
Capitale sociale € 41.000 i.v. | R.E.A. 264586 | Reg. Imp. Varese 45040 | Cod. Mec. VA049950
P.I. (n° Intracomunitario) IT 02541660128 | C.F. 01321570127 | Reg. AEE IT09020060003254

www.acteongroup.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Датчик Sorix 2 Inside



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 31 лист (ов)



Л.Б. Бронникова