



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

«01» 2020 г.

Образцы маркировки на Контрольную сыворотку для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)

1. Образцы этикеток на флаконы «Контрольная сыворотка»

Наименование компонента	Этикетка
«Контрольная сыворотка», вариант комплектации 1	
«Контрольная сыворотка», аттестованная, уровень 1	
«Контрольная сыворотка», вариант комплектации 2	
«Контрольная сыворотка», аттестованная, уровень 2	
«Контрольная сыворотка», вариант комплектации 3	
«Контрольная сыворотка», неаттестованная, уровень 1	
«Контрольная сыворотка», вариант комплектации 4	
«Контрольная сыворотка», неаттестованная, уровень 1	

2. Образцы этикеток на коробке «Контрольная сыворотка»

2.1. Верхняя этикетка.

«Контрольная сыворотка», вариант комплектации 1	REF X-XXXX контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека Контрольная сыворотка аттестованная Состав: Уровень 1 (XX фл.) ТУ 21.20.23-113-23548172-2020 РУ №
«Контрольная сыворотка», вариант комплектации 2	REF X-XXXX контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека Контрольная сыворотка аттестованная Состав: Уровень 2 (XX фл.) ТУ 21.20.23-113-23548172-2020 РУ №
«Контрольная сыворотка», вариант комплектации 3	REF X-XXXX контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека Контрольная сыворотка неаттестованная Состав: Уровень 1 (XX фл.) ТУ 21.20.23-113-23548172-2020 РУ №

«Контрольная сыворотка»,
вариант комплектации 4



X-XXXX

контрольная сыворотка
для биохимических исследований
на основе сыворотки
крови человека

Контрольная сыворотка неаттестованная

Состав: Уровень 2 (XX фл.)

ТУ 21.20.23-113-23548172-2020
РУ №

2.2. Боковая этикетка.

«Контрольная сыворотка»,
вариант комплектации 1, 3



X-XXXX



XXXX



XXXX-XX



XXXX-XX

Контрольная сыворотка аттестованная



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения
Антитела к ВПЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют



X-XXXX



XXXX



XXXX-XX



XXXX-XX

Контрольная сыворотка неаттестованная



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Для профессионального применения
Антитела к ВПЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

1. АО «Вектор-Бест»
2. Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс.: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«27» сентября 2020 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго А.В.
2011 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«23» / 03 2020 г.



Приложение к паспорту № 517-20
Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
Для писем: 630117, г. Новосибирск, ш/я 492
Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44
www.vector-best.ru
vobitk@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 517-20 Контрольная сыворотка

Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека

ТУ 21.20.23-113-23548172-2020

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Использовать при температуре от 2 до 8 °С.
Запрещается транспортирование при температуре выше 26 °С не более 10 суток.

Номер серии 1
Дата изготовления 2020-02
Дата выдачи паспорта 2020-02-27
Срок годности до 2021-08

Состав	Внешний вид	Результаты контроля
Сыворотка, аттестованная, уровень 1	Лиофилизированная масса желтовато-кремового цвета, 10 фл.	Лиофилизированная масса желтовато-кремового цвета, 10 фл. (соответствует)
Норма	Результаты контроля	
Уровень сыворотки, уровень при температуре от	30	15 (соответствует)

ИНСТРУКЦИЯ по применению контрольной сыворотки для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Контрольная сыворотка предназначена для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека. Контрольная сыворотка используется для контроля качества работы лабораторных методов исследования. Контрольная сыворотка используется для контроля качества работы лабораторных методов исследования. Контрольная сыворотка используется для контроля качества работы лабораторных методов исследования.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«23» 03 2020 г.

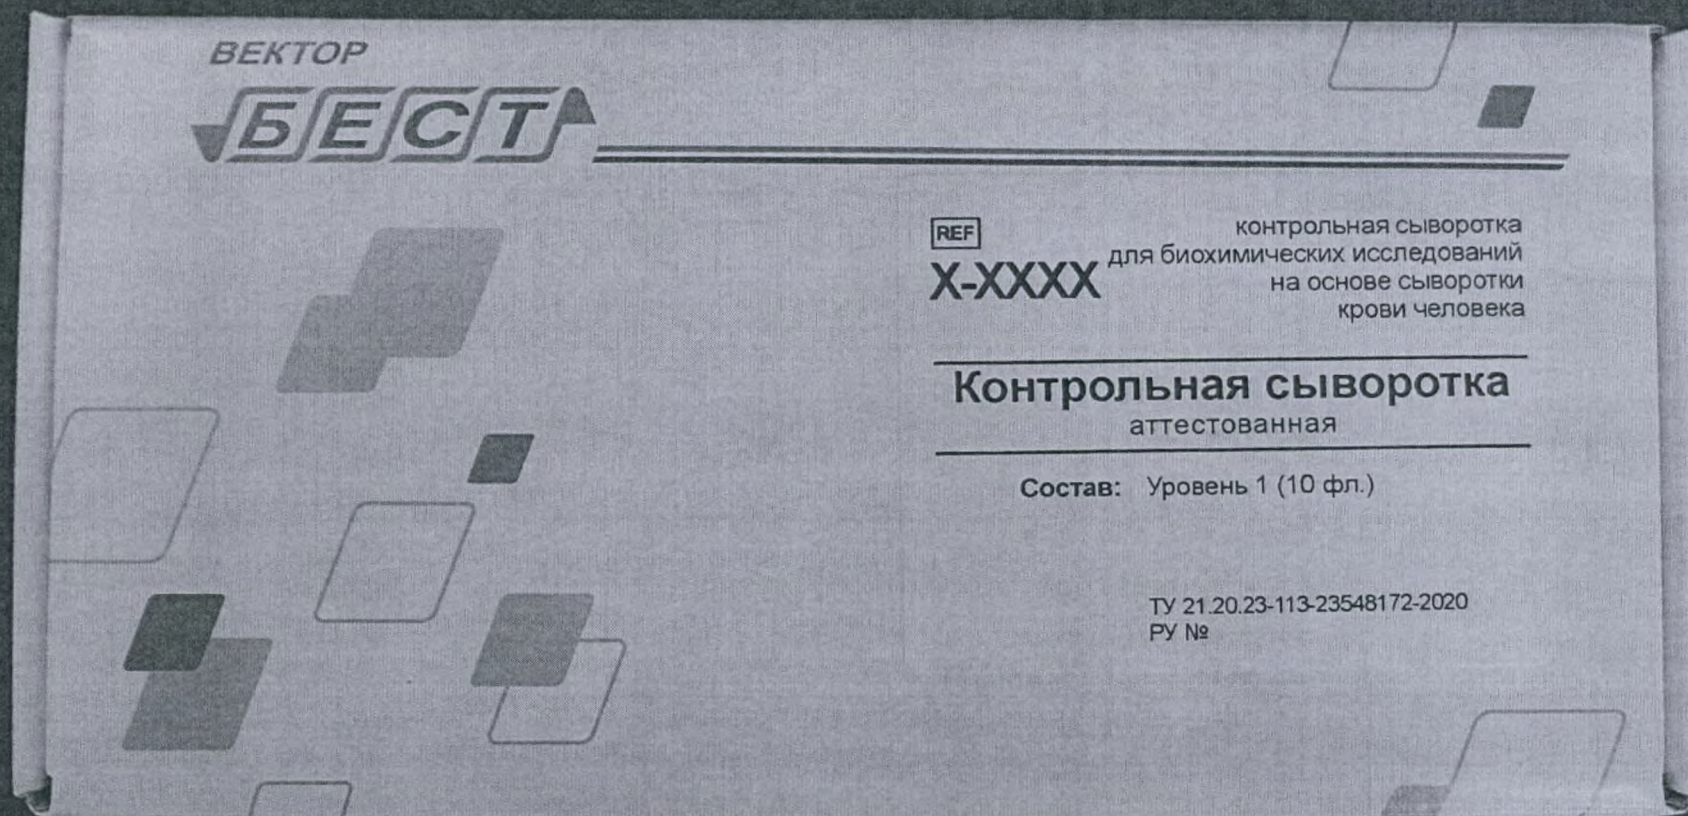

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка
для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека
(Контрольная сыворотка)» № 2 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

А.А. Ахметов
«23» / 02 / 2021

REF

X-XXXX

LOT

1



2020-02



2021-08

Контрольная сыворотка

аттестованная



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD




Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



2020 г.

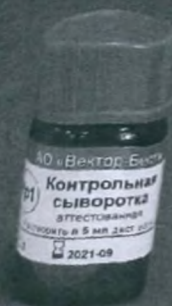


— биохимический анализатор, позволяющий проводить измерения на длинах волн 340, 405, 450-490, 500, 640-670, 680-690, 700-900 нм (с помощью

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«23» 03 2020 г.

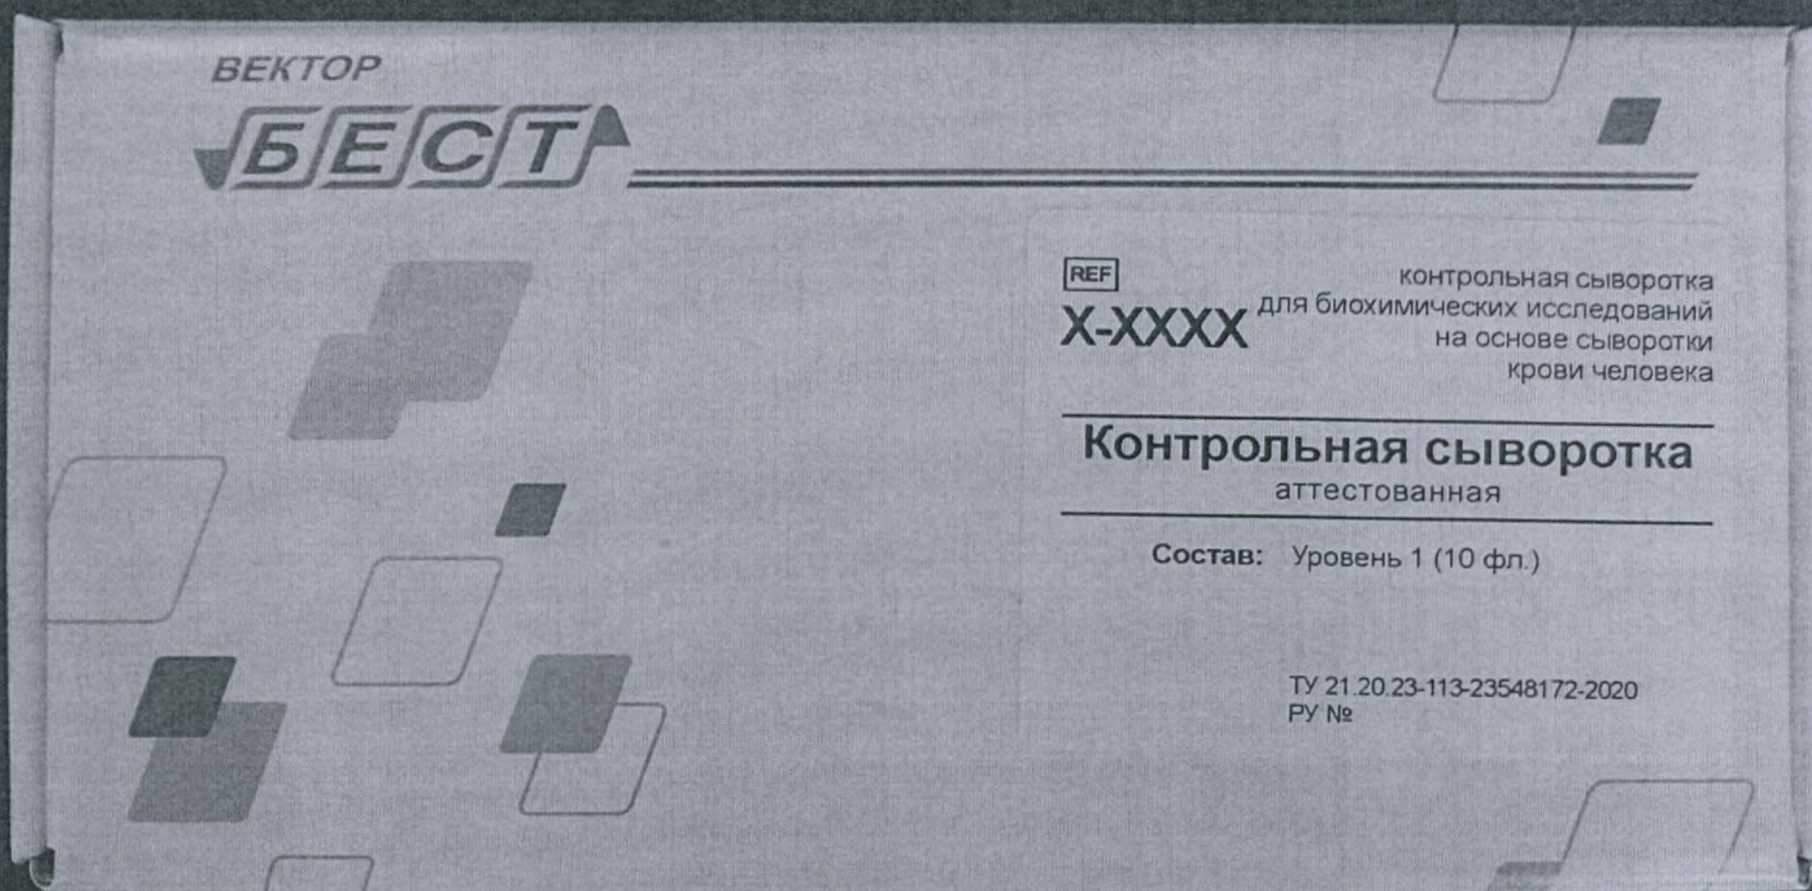

Графическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка
для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека
(Контрольная сыворотка)» № 2 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусеников М. И.
«23» 2020 г.



REF

X-XXXX

LOT

2




2020-03



2021-09

Контрольная сыворотка

аттестованная



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2020 г.

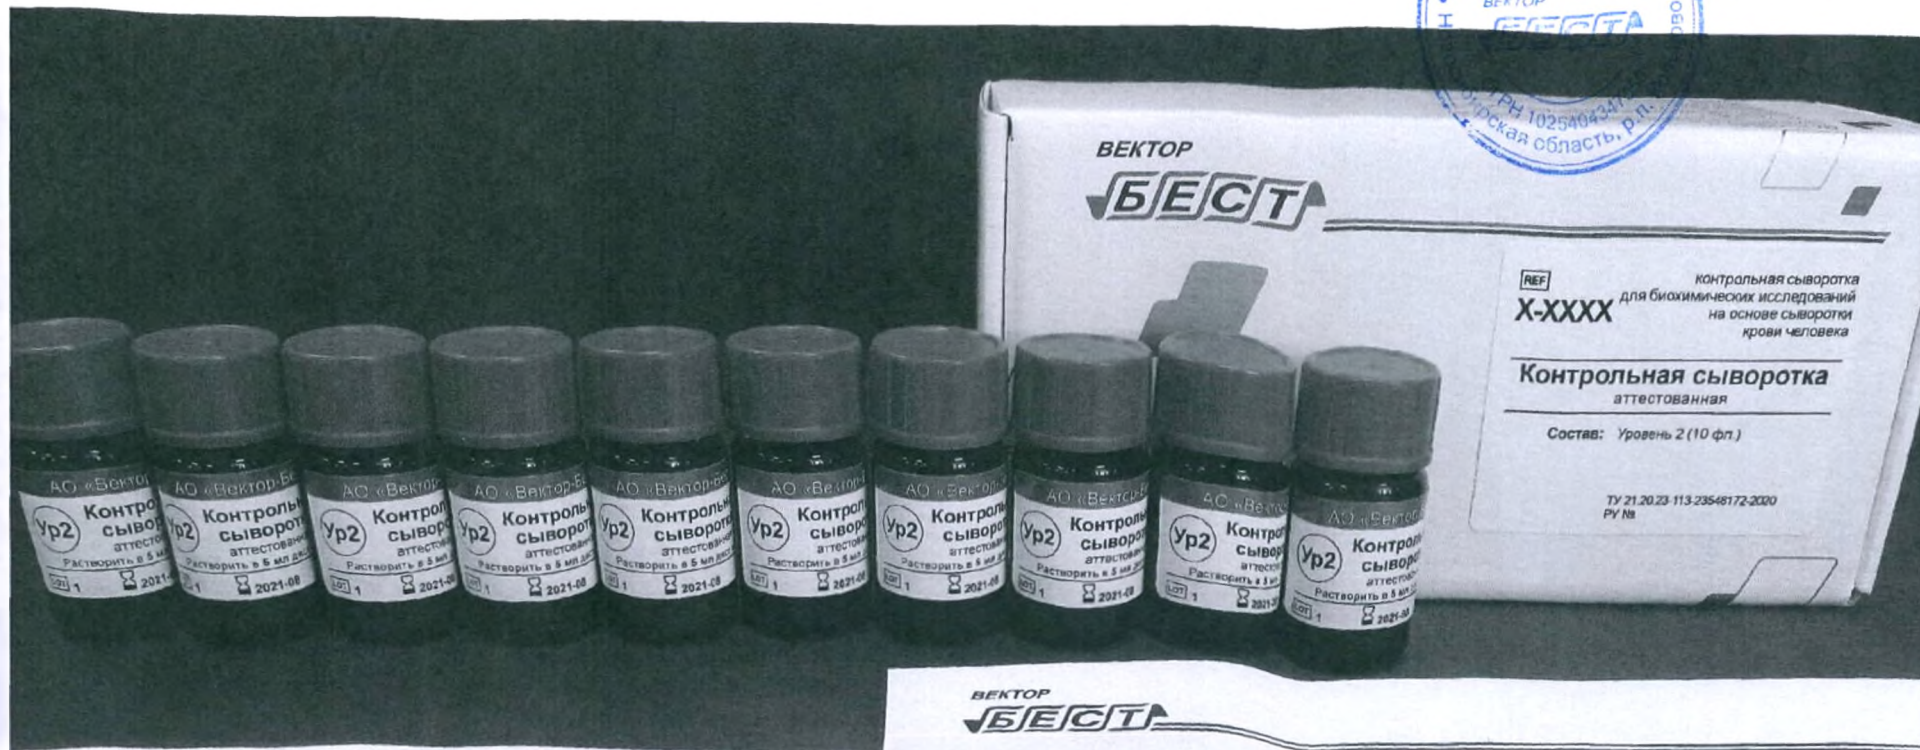

Приложение к паспорту № 529-20
Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека

Контрольная сыворотка аттестованная

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»

Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

Приемная: тел. (383)-227-60-30,
факс (383)-332-94-44

ПАСПОРТ № 529-20

Контрольная сыворотка

Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека

ТУ 21.20.23-113-23548172-2020

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
При транспортировании при
температуре до 26 °С не более 10 суток

Номер серии
Дата изготовления
Дата выдачи паспорта
Срок годности до

ИНСТРУКЦИЯ
контрольной сыворотки для биохимических исследова
на основе сыворотки крови человека
(Контрольная сыворотка)

НЕ
для биохимических
или крови человека
использовать — контрольная
внутрилабораторного

требования

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

биохимический
исследования на длинах волн
500, 540, 570, 590, 610, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750, 770, 790, 810, 830, 850, 870, 890, 910, 930, 950, 970, 990, 1000, 1020, 1040, 1060, 1080, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200, 1220, 1240, 1260, 1280, 1300, 1320, 1340, 1360, 1380, 1400, 1420, 1440, 1460, 1480, 1500, 1520, 1540, 1560, 1580, 1600, 1620, 1640, 1660, 1680, 1700, 1720, 1740, 1760, 1780, 1800, 1820, 1840, 1860, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, 2020, 2040, 2060, 2080, 2100, 2120, 2140, 2160, 2180, 2200, 2220, 2240, 2260, 2280, 2300, 2320, 2340, 2360, 2380, 2400, 2420, 2440, 2460, 2480, 2500, 2520, 2540, 2560, 2580, 2600, 2620, 2640, 2660, 2680, 2700, 2720, 2740, 2760, 2780, 2800, 2820, 2840, 2860, 2880, 2900, 2920, 2940, 2960, 2980, 3000, 3020, 3040, 3060, 3080, 3100, 3120, 3140, 3160, 3180, 3200, 3220, 3240, 3260, 3280, 3300, 3320, 3340, 3360, 3380, 3400, 3420, 3440, 3460, 3480, 3500, 3520, 3540, 3560, 3580, 3600, 3620, 3640, 3660, 3680, 3700, 3720, 3740, 3760, 3780, 3800, 3820, 3840, 3860, 3880, 3900, 3920, 3940, 3960, 3980, 4000, 4020, 4040, 4060, 4080, 4100, 4120, 4140, 4160, 4180, 4200, 4220, 4240, 4260, 4280, 4300, 4320, 4340, 4360, 4380, 4400, 4420, 4440, 4460, 4480, 4500, 4520, 4540, 4560, 4580, 4600, 4620, 4640, 4660, 4680, 4700, 4720, 4740, 4760, 4780, 4800, 4820, 4840, 4860, 4880, 4900, 4920, 4940, 4960, 4980, 5000, 5020, 5040, 5060, 5080, 5100, 5120, 5140, 5160, 5180, 5200, 5220, 5240, 5260, 5280, 5300, 5320, 5340, 5360, 5380, 5400, 5420, 5440, 5460, 5480, 5500, 5520, 5540, 5560, 5580, 5600, 5620, 5640, 5660, 5680, 5700, 5720, 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880, 5900, 5920, 5940, 5960, 5980, 6000, 6020, 6040, 6060, 6080, 6100, 6120, 6140, 6160, 6180, 6200, 6220, 6240, 6260, 6280, 6300, 6320, 6340, 6360, 6380, 6400, 6420, 6440, 6460, 6480, 6500, 6520, 6540, 6560, 6580, 6600, 6620, 6640, 6660, 6680, 6700, 6720, 6740, 6760, 6780, 6800, 6820, 6840, 6860, 6880, 6900, 6920, 6940, 6960, 6980, 7000, 7020, 7040, 7060, 7080, 7100, 7120, 7140, 7160, 7180, 7200, 7220, 7240, 7260, 7280, 7300, 7320, 7340, 7360, 7380, 7400, 7420, 7440, 7460, 7480, 7500, 7520, 7540, 7560, 7580, 7600, 7620, 7640, 7660, 7680, 7700, 7720, 7740, 7760, 7780, 7800, 7820, 7840, 7860, 7880, 7900, 7920, 7940, 7960, 7980, 8000, 8020, 8040, 8060, 8080, 8100, 8120, 8140, 8160, 8180, 8200, 8220, 8240, 8260, 8280, 8300, 8320, 8340, 8360, 8380, 8400, 8420, 8440, 8460, 8480, 8500, 8520, 8540, 8560, 8580, 8600, 8620, 8640, 8660, 8680, 8700, 8720, 8740, 8760, 8780, 8800, 8820, 8840, 8860, 8880, 8900, 8920, 8940, 8960, 8980, 9000, 9020, 9040, 9060, 9080, 9100, 9120, 9140, 9160, 9180, 9200, 9220, 9240, 9260, 9280, 9300, 9320, 9340, 9360, 9380, 9400, 9420, 9440, 9460, 9480, 9500, 9520, 9540, 9560, 9580, 9600, 9620, 9640, 9660, 9680, 9700, 9720, 9740, 9760, 9780, 9800, 9820, 9840, 9860, 9880, 9900, 9920, 9940, 9960, 9980, 10000

Состав	Внешний вид	Результаты контроля
--------	-------------	---------------------

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 2, серия 1)


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



«28»

03

2020 г.

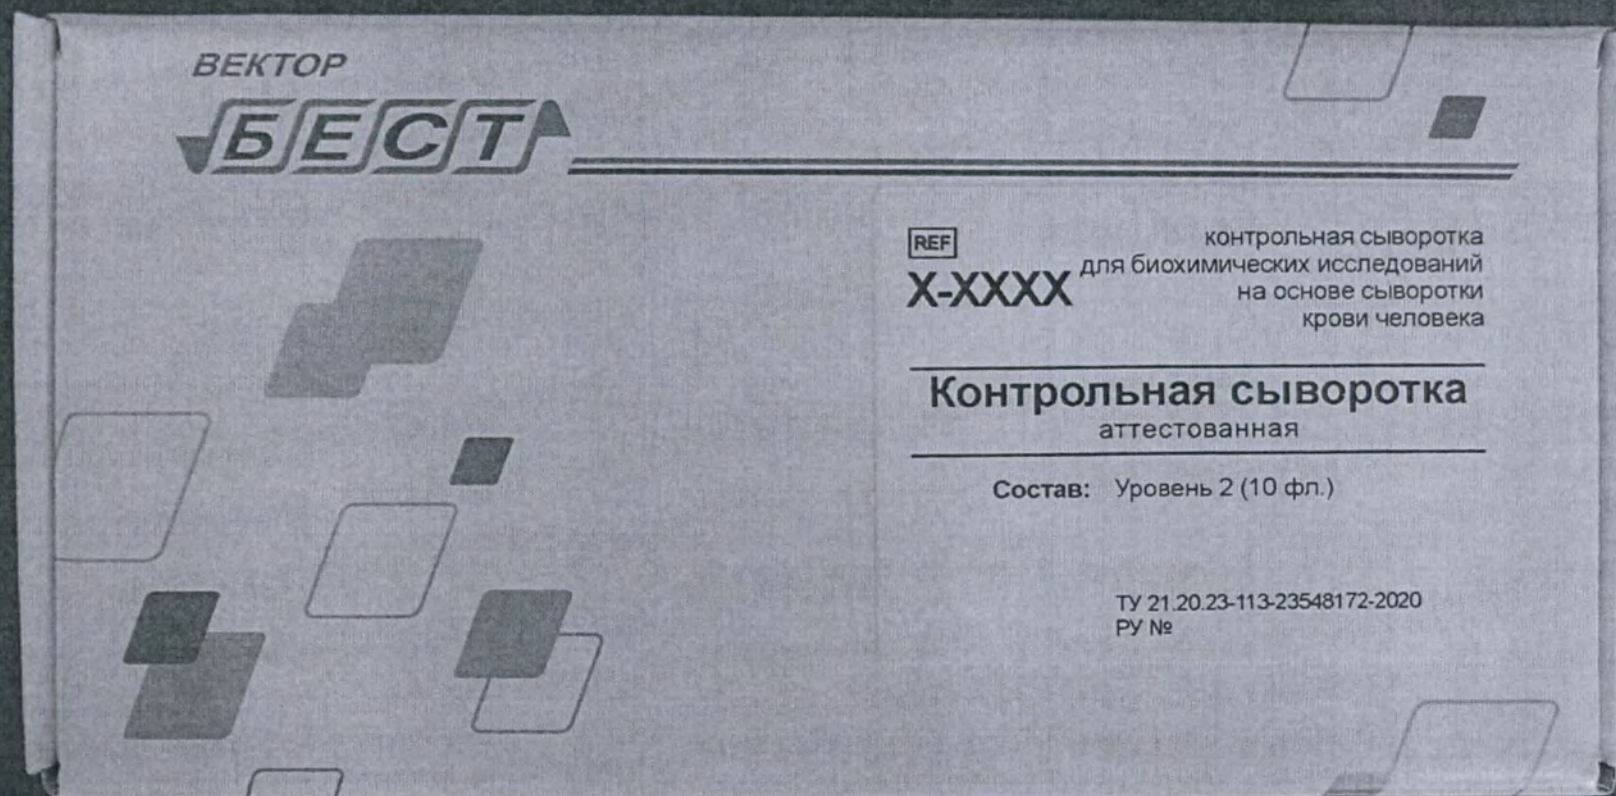

Графическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка
для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека
(Контрольная сыворотка)» № 2 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



REF

X-XXXX

LOT

1




2020-02



2021-08

Контрольная сыворотка

аттестованная



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»






Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусайнов М.Д. 2020 г.

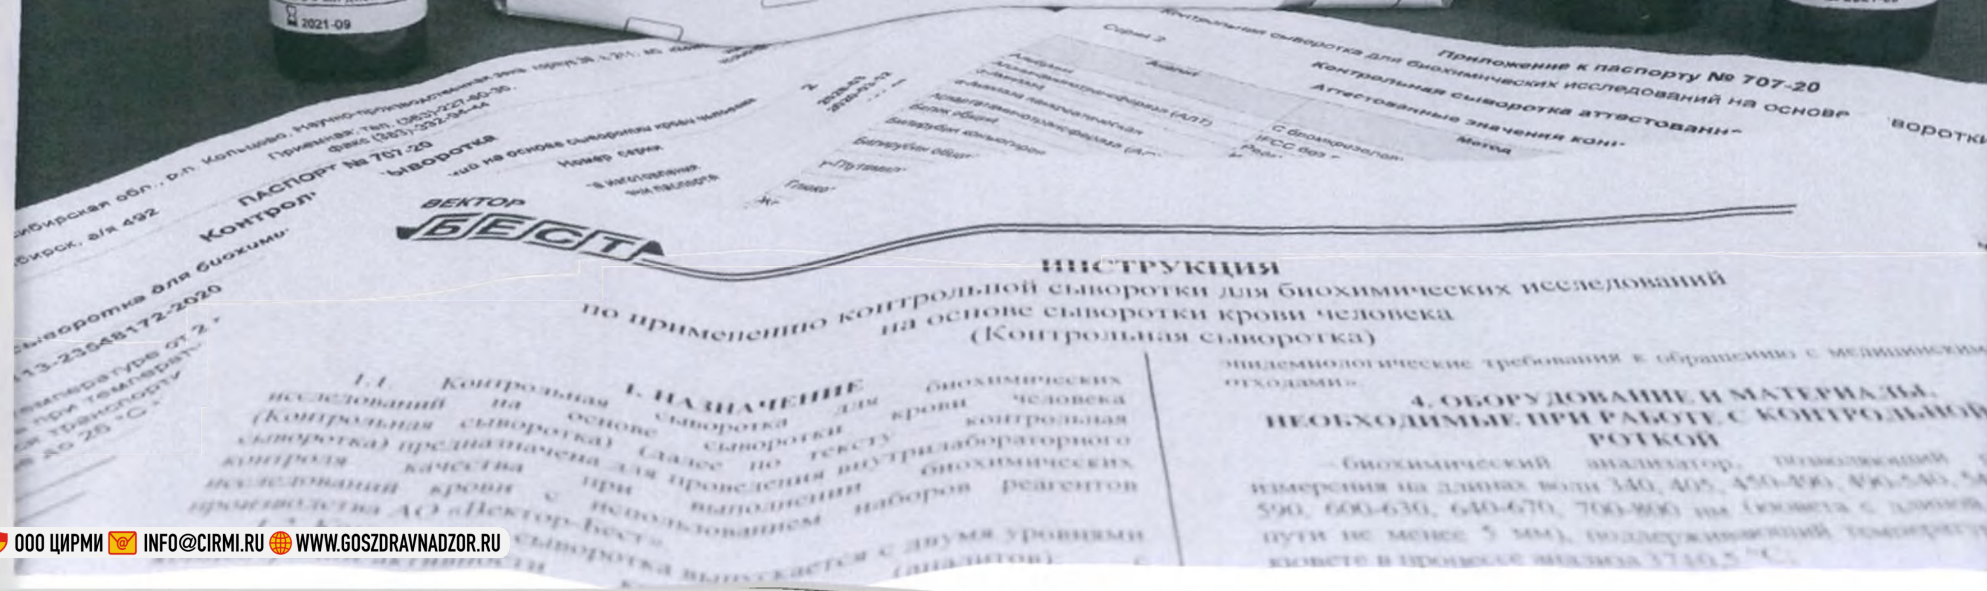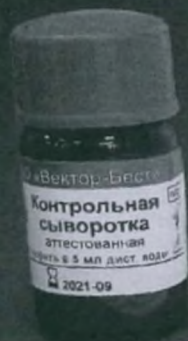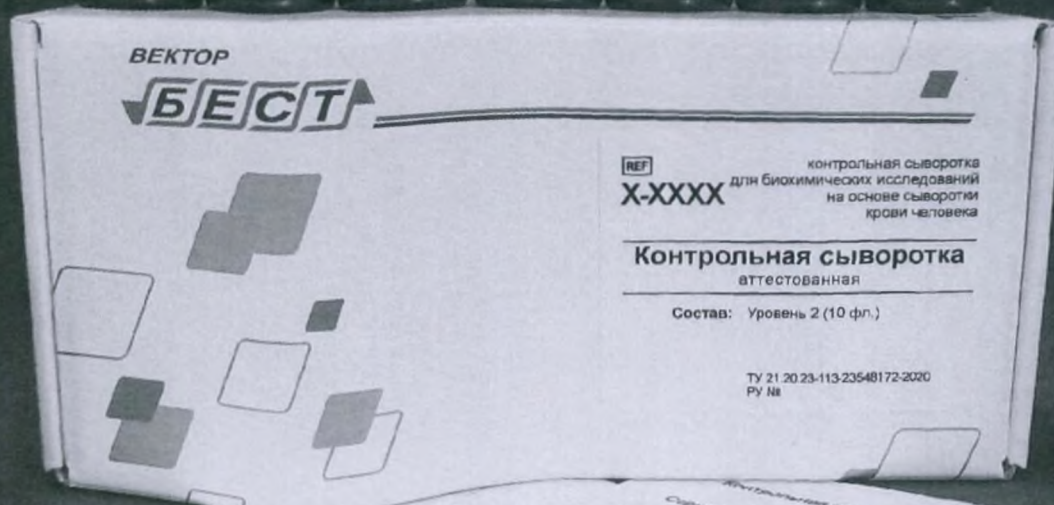


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



«23» 03 2020 г.

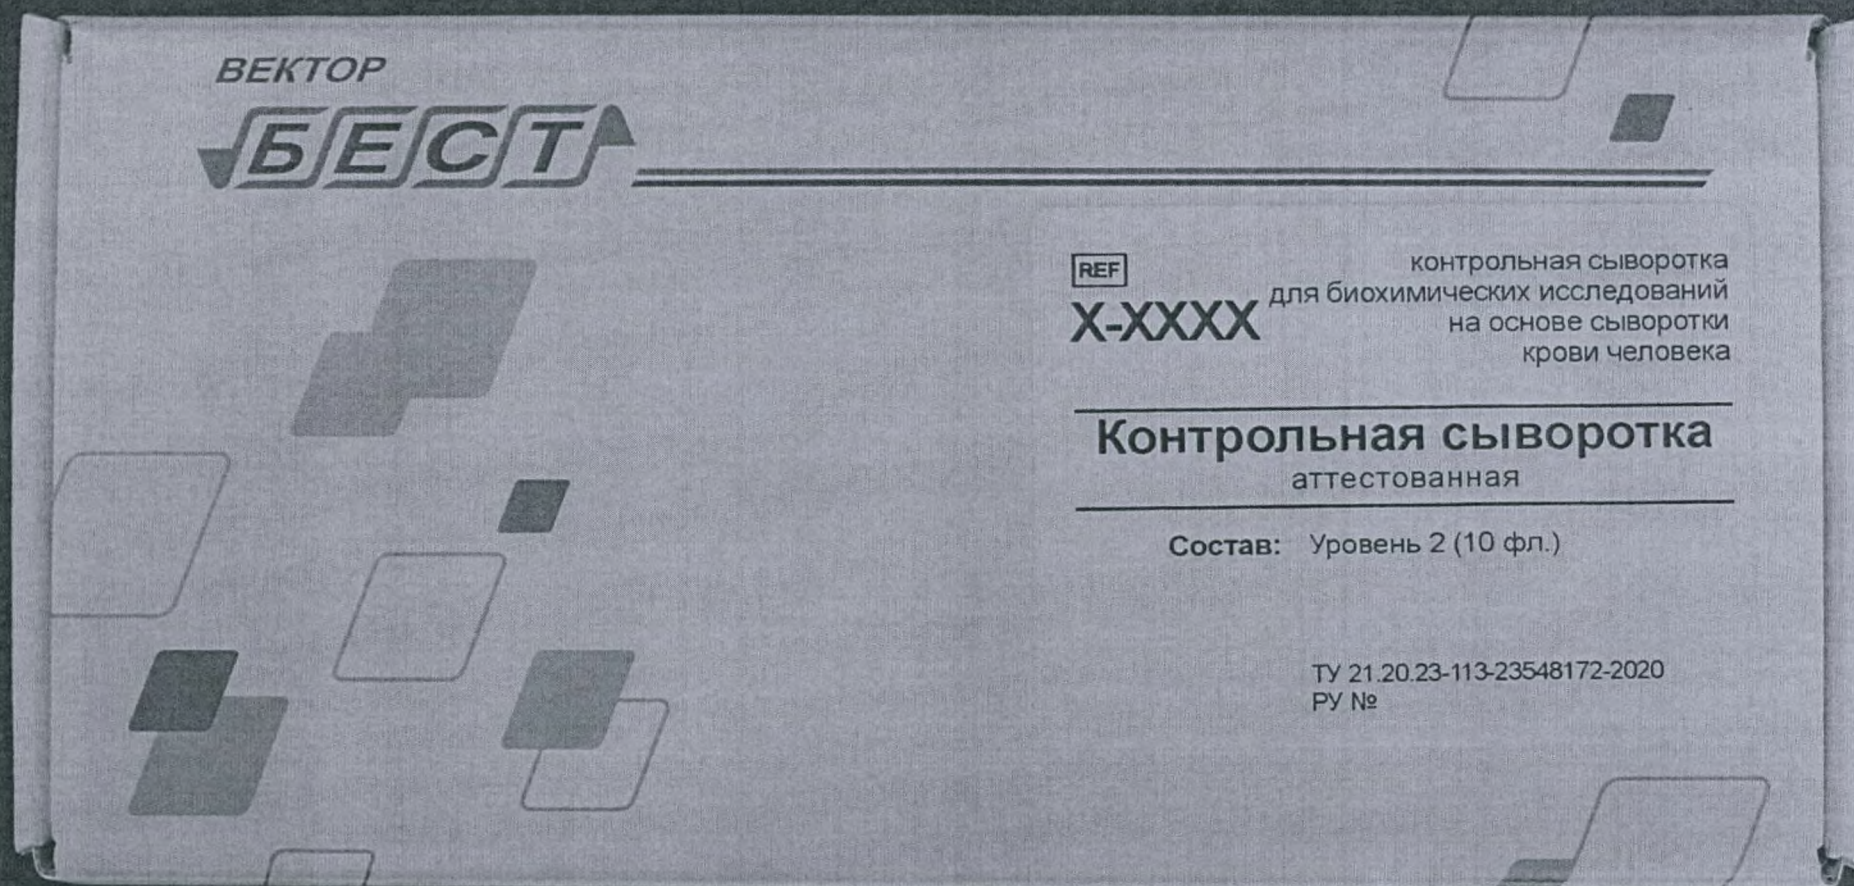

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 2 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусанов М.Д.

03

2020 г.

REF

X-XXXX

LOT

2



2020-03



2021-09

Контрольная сыворотка

аттестованная



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Контрольная сыворотка
для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека
(Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусайнов М.Д.
«23» 03 2020 г.



по применению контрольной сыворотки для биохимических исследований
на основе сыворотки крови человека
(Контрольная сыворотка)

492 Приемная: тел. (383)-227-60-30,
факс (383)-332-94-44

Контрольная сыворотка

ИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

1

2020-02

2020-02-13

2021-08

Результаты контроля

Лиофилизированная масса желтовато-кремового цвета, 10 фл. (соответствует)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

минологическите требования к образуването с меднозлатосини
ами.

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С КОНТРОЛЬНОЙ СЫВ-
РОТКОЙ

[illegible]

- переносит медико-биологические диагностические
- вода дистиллированная
- деминерализованный раститель.
- набор реагентов производства
- дения азиатским институтом трансферона
- панкреатической, азиатского
- ил трансферона, креатинина, мочевин
- ной фосфатазы, холинэстеразы
- убина общего, билирубина
- 1, иммуноглобулина
- иммуноглобулина G, калия
- меди, мочевины, мочевого


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.



23 03 2020

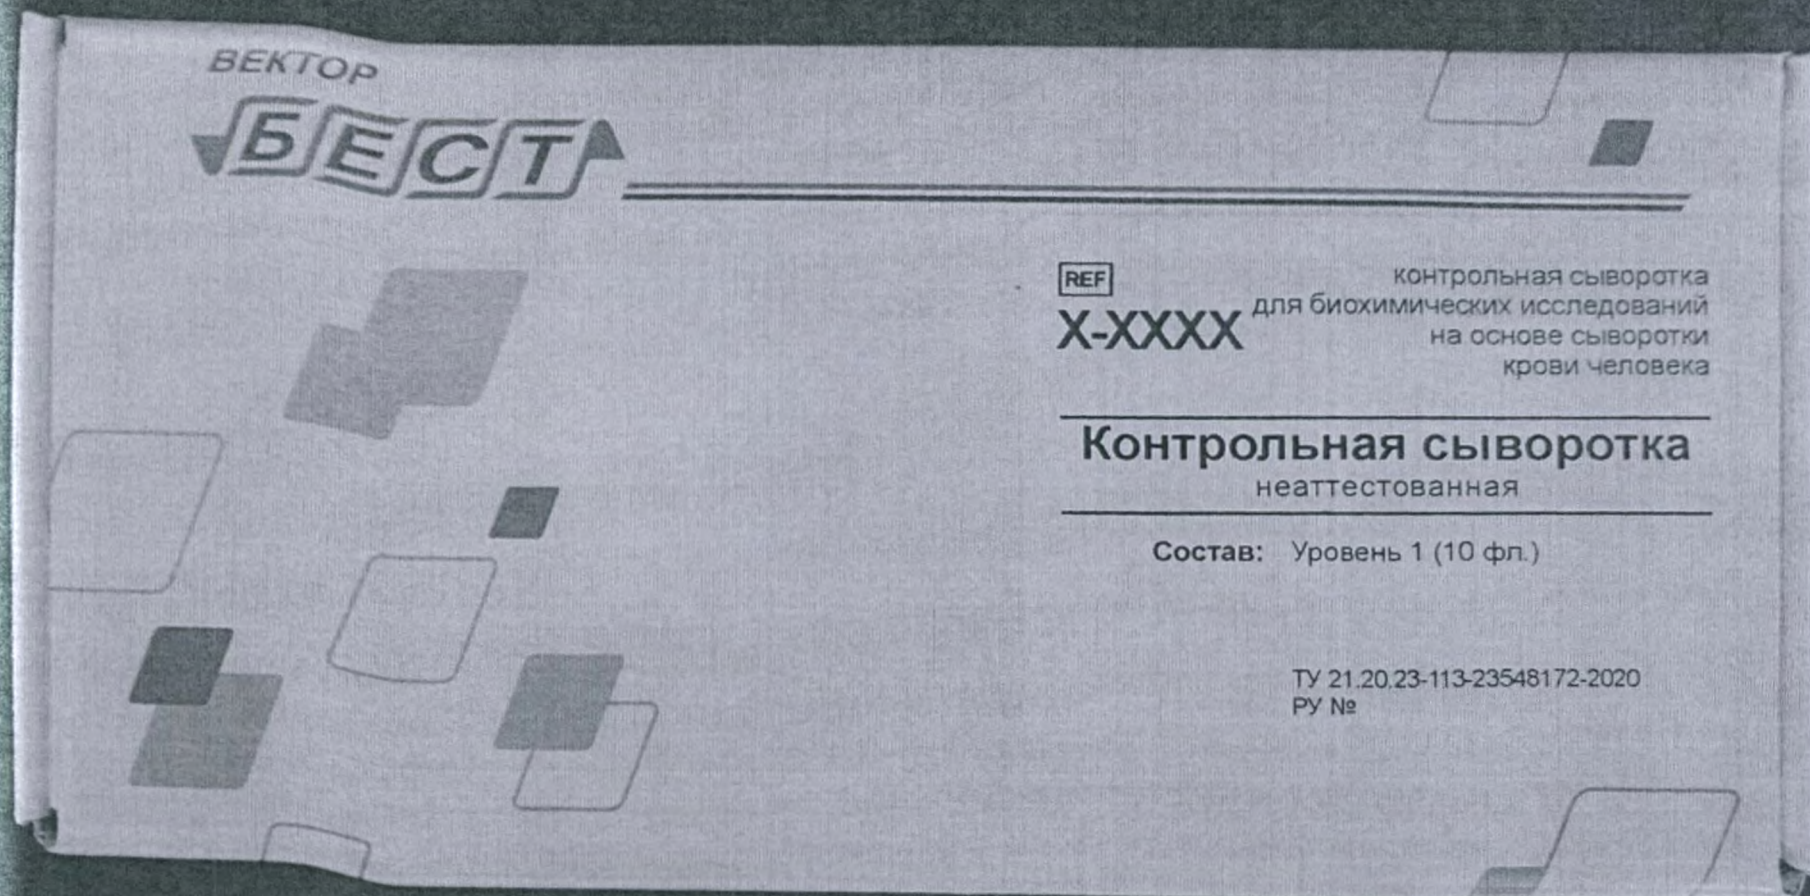

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 2 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«23» 03 2020 г.

REF

X-XXXX

LOT

1




2020-02



2021-08

Контрольная сыворотка

неаттестованная



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«23» 103 2020 г.

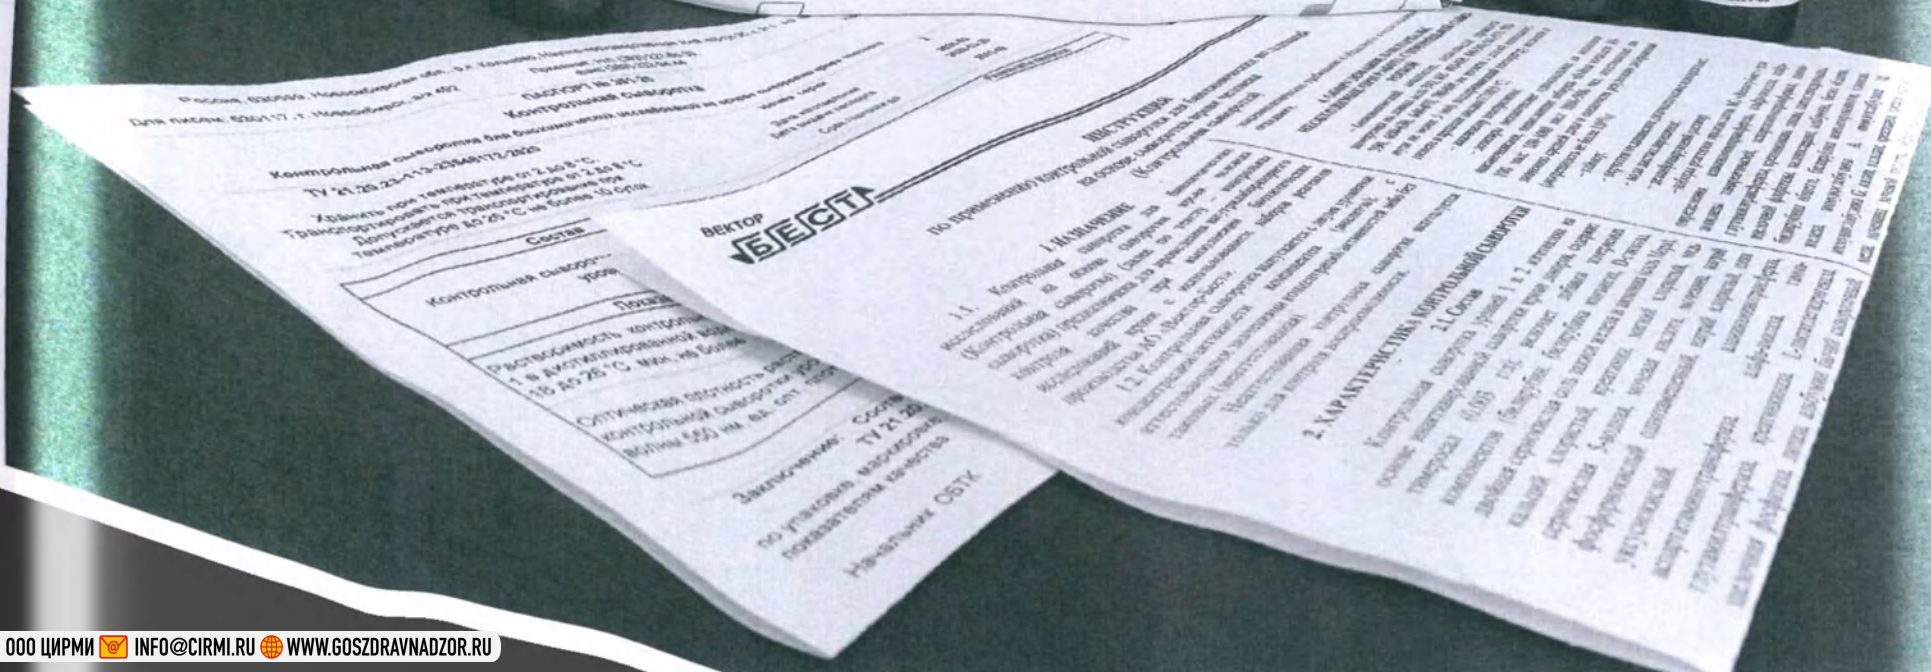


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«23» 03 2020

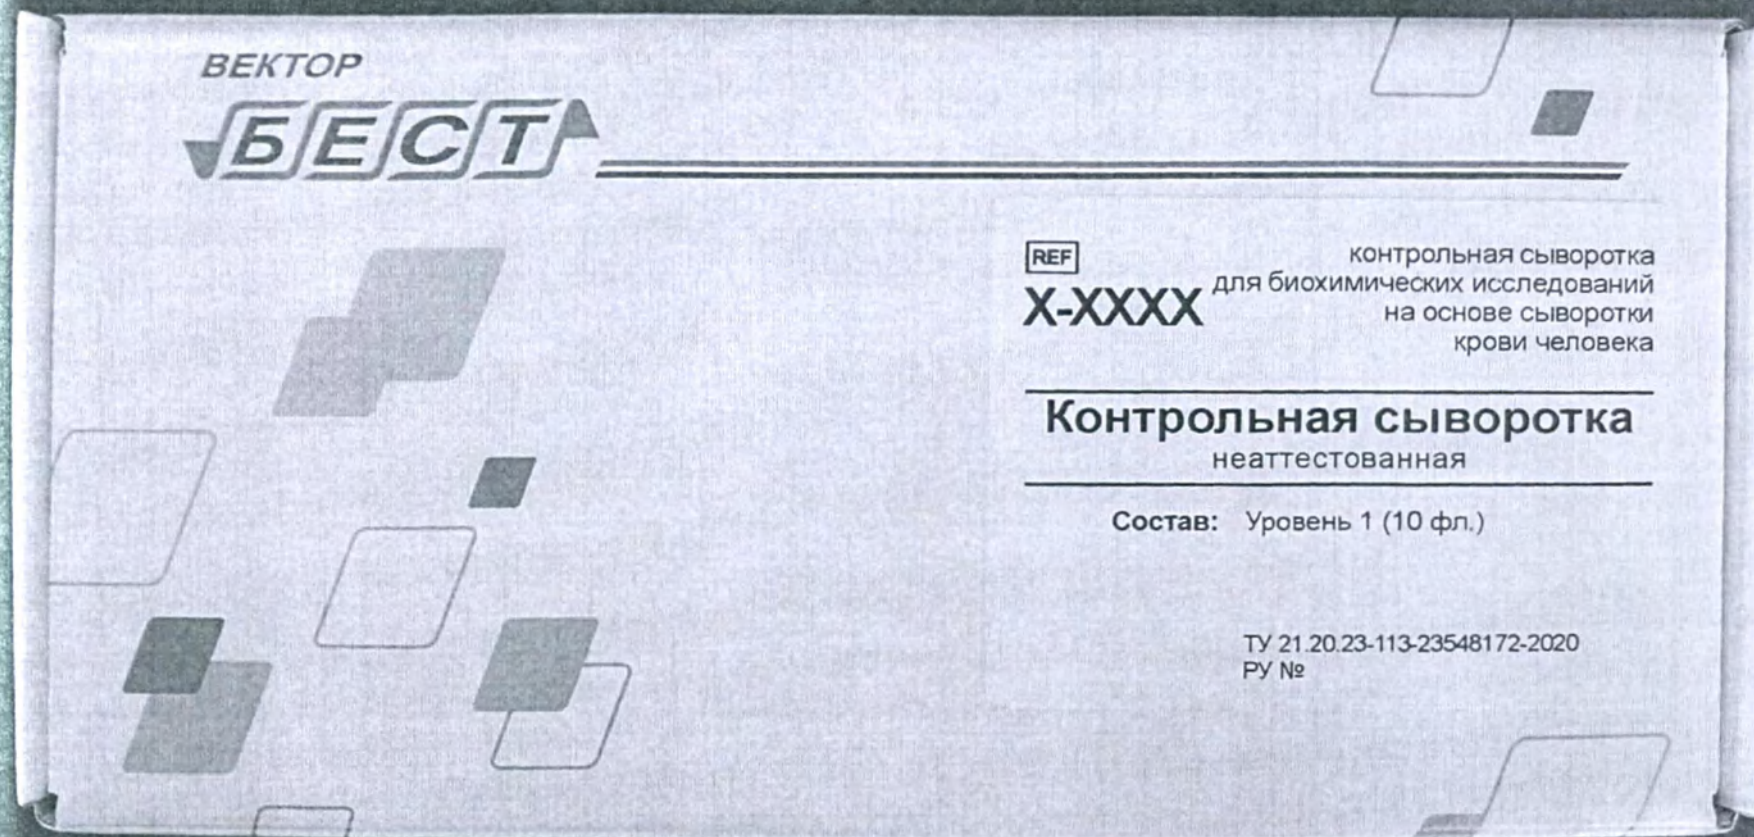

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка
для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека
(Контрольная сыворотка)» № 2 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



«23» 2020 г.

REF

X-XXXX

LOT

2





2020-02



2021-08

Контрольная сыворотка

неаттестованная



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«23» 03 2020 г.

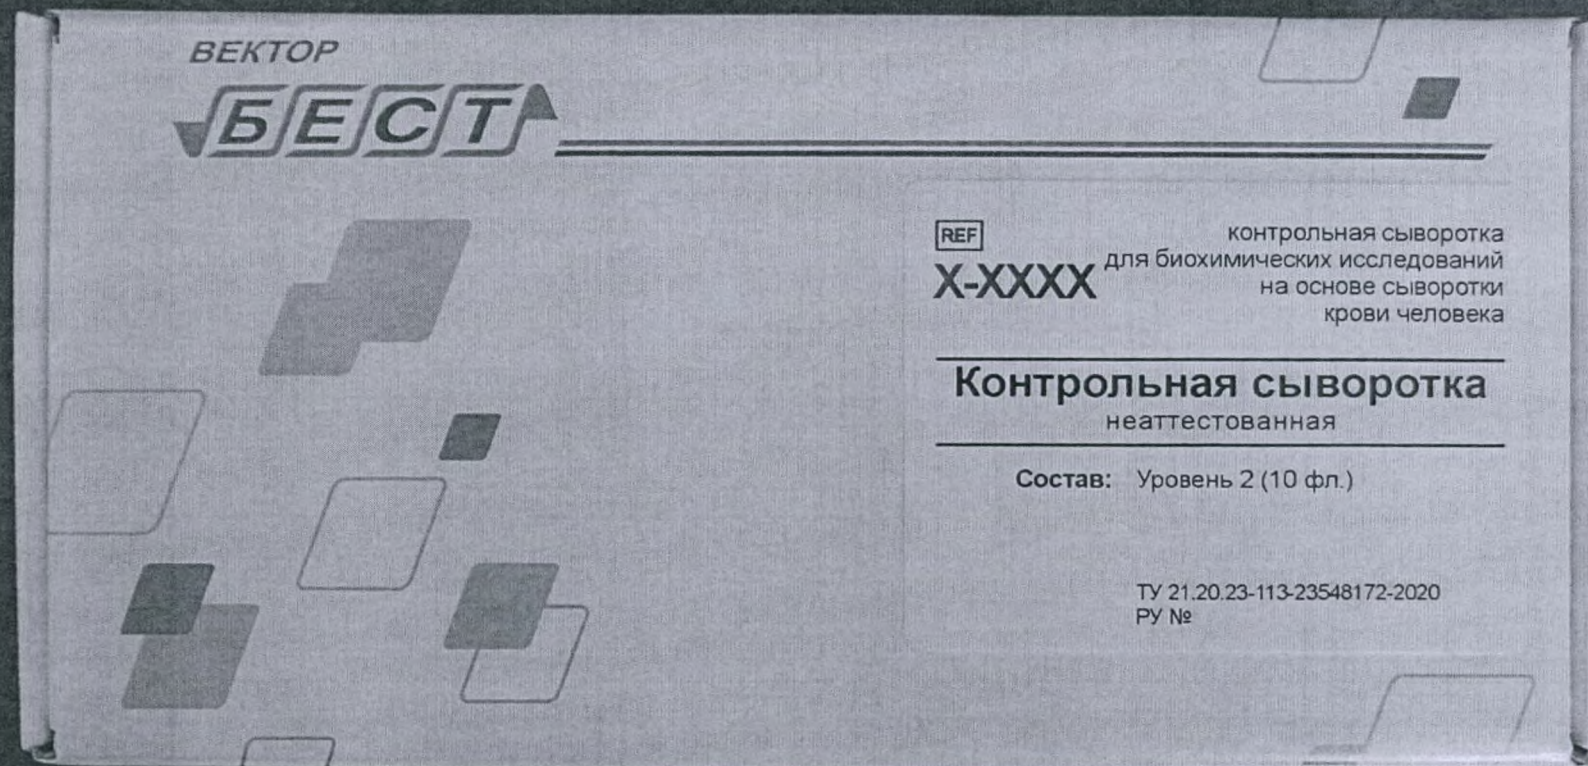

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка
для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека
(Контрольная сыворотка)» № 2 (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

«13»  Хусайнов М.Д.
2020 г.

REF

X-XXXX

LOT

1



2020-02



2021-08

Контрольная сыворотка

неаттестованная



IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 4, серия 1)


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Графическое изображение общего вида медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«03» 03 2021

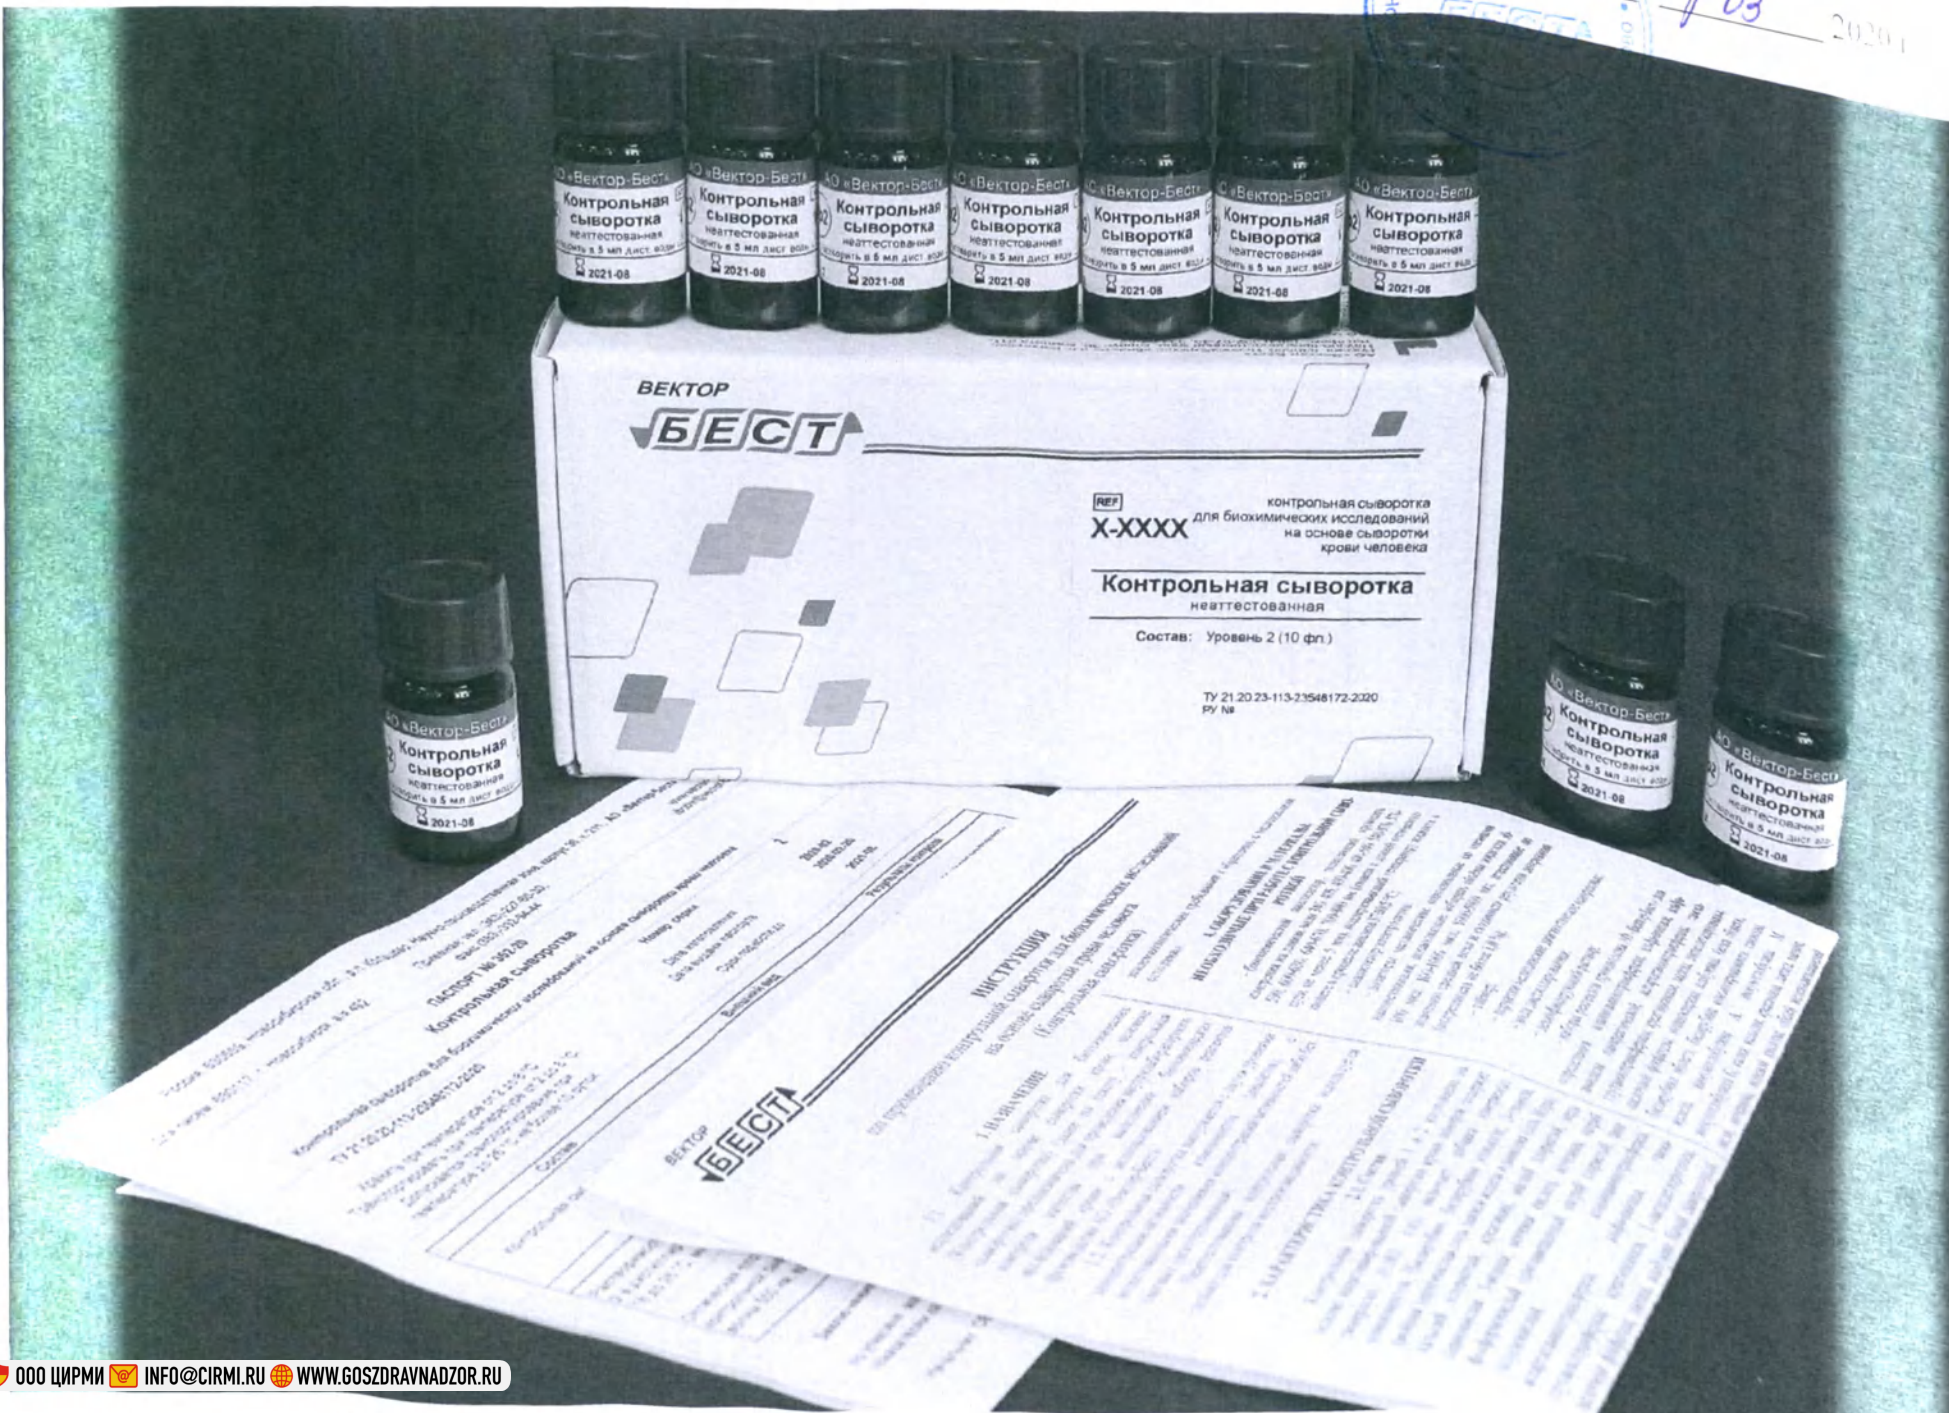

ВЕКТОР БЕСТ

контрольная сыворотка
для биохимических исследований
на основе сыворотки
крови человека

Контрольная сыворотка
неаттестованная

Состав: Уровень 2 (10 фл.)

ТУ 21.20.23-113-21546172-2020
РУ №

АО «Вектор-Бест»
Контрольная сыворотка
неаттестованная
содержит в 5 мл дист. воды
2021-08

АО «Вектор-Бест»
Контрольная сыворотка
неаттестованная
содержит в 5 мл дист. воды
2021-08

АО «Вектор-Бест»
Контрольная сыворотка
неаттестованная
содержит в 5 мл дист. воды
2021-08

Сертификат соответствия
ТУ 21.20.23-113-21546172-2020
Контрольная сыворотка

Инструкция
по применению контрольной сыворотки для биохимических исследований


1. Назначение
2. Состав
3. Упаковка

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



«13» 03 2020 г.

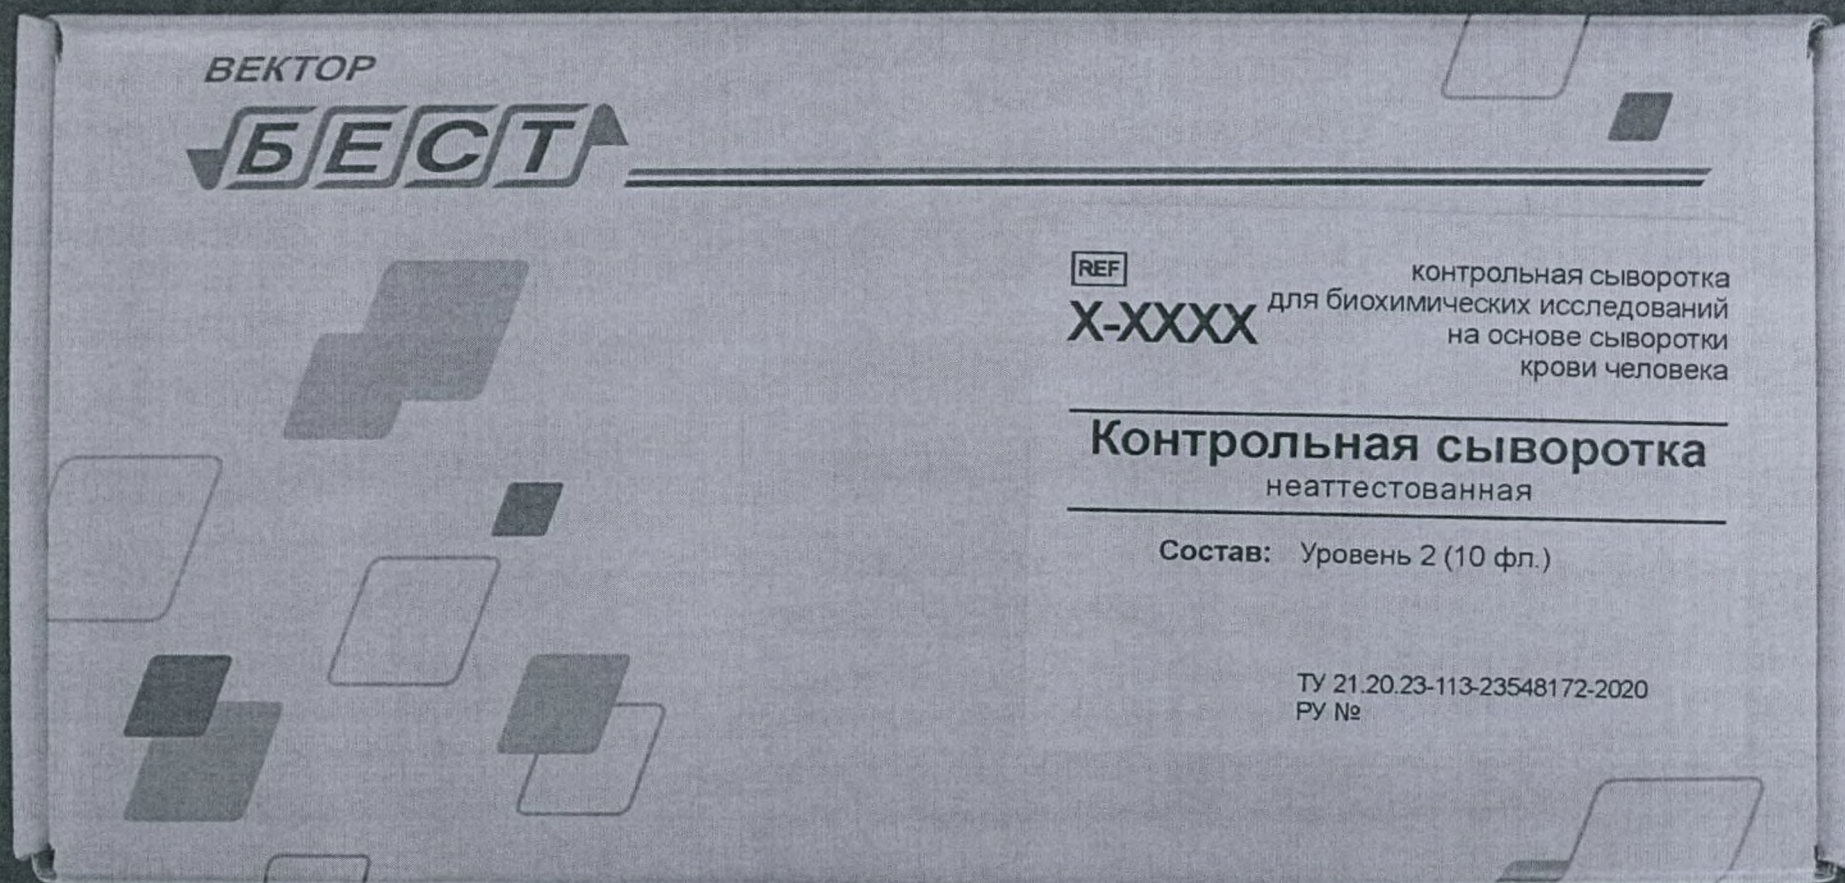

БЕКТОР

БЕСТ

REF

X-XXXX

контрольная сыворотка
для биохимических исследований
на основе сыворотки
крови человека

Контрольная сыворотка
неаттестованная

Состав: Уровень 2 (10 фл.)

ТУ 21.20.23-113-23548172-2020
РУ №

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 2 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


«23» 103 2020 г.

REF

X-XXXX

LOT

2




2020-02



2021-08

Контрольная сыворотка
неаттестованная



IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Контрольная сыворотка для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека (Контрольная сыворотка)» № 1 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

