

ано

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Результат-Аудит»





Г. В.Родина

«28 декабря 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Материал хирургический шовный стерильный Сарио, нерассасывающийся с иглами
атравматическими, в вариантах исполнения**

Материал хирургический шовный стерильный Cario нерассасывающийся, монофиламентный из полипропилена, с одной прямой колюще-режущей иглой и одной изогнутой колющей иглой 1/2 окружности 26,2 мм, номинальная длина 36 дюймов (90 см.), размер 0 (метрический размер 3.5), 12 шт./уп.

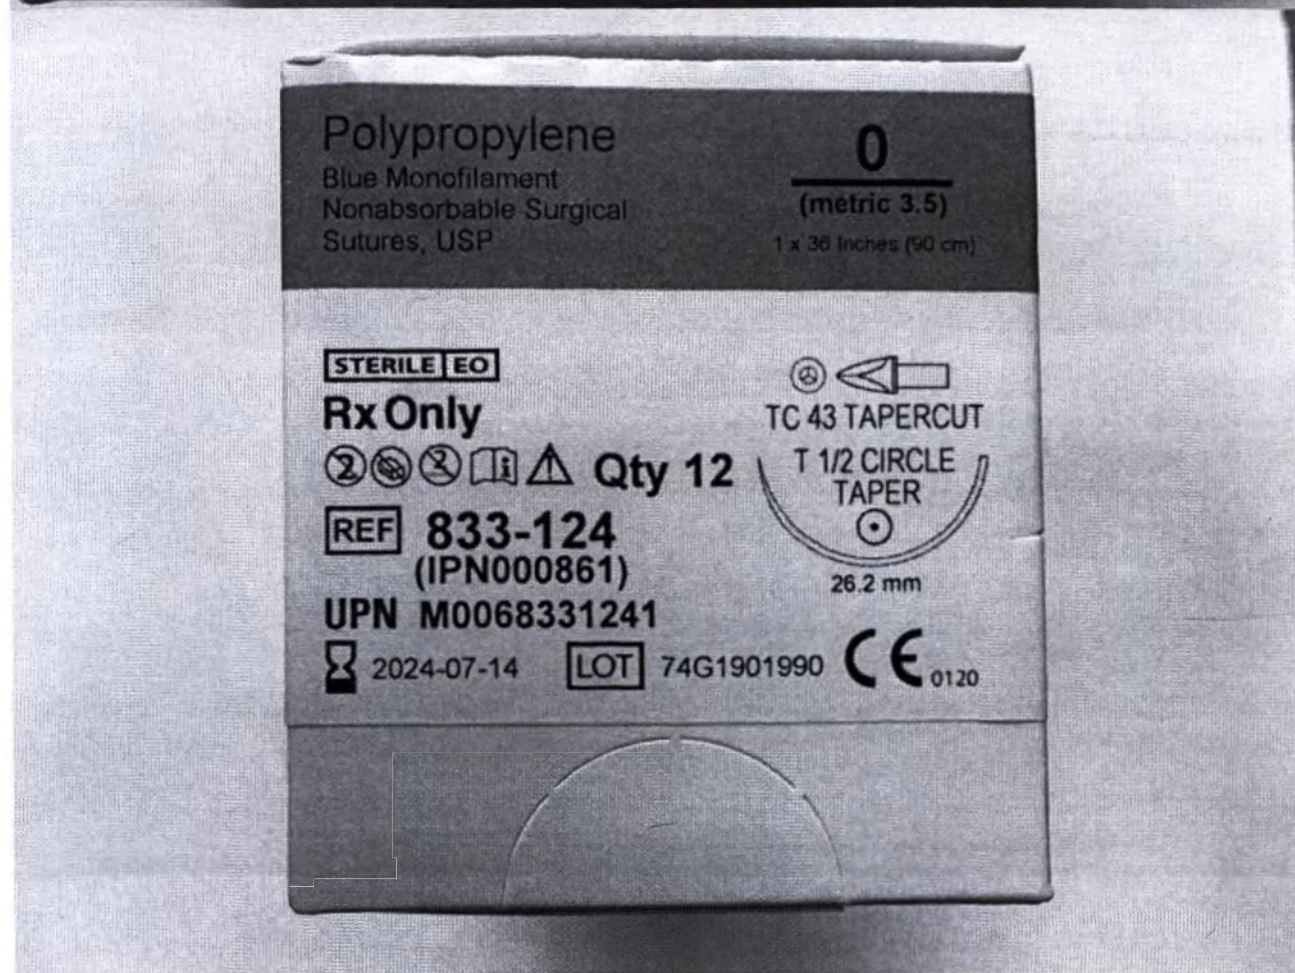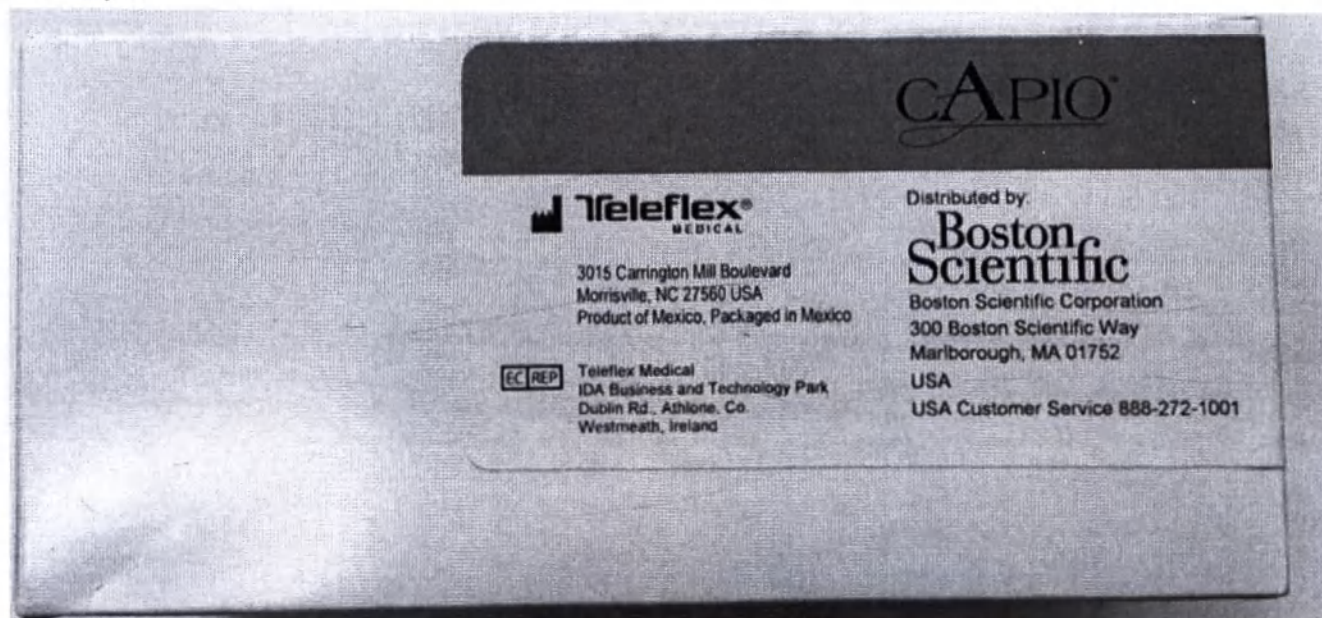

TAPEX MEDICAL

UPN M0068331240

REF 833-124

Blue Monofilament
Nonabsorbable Surgical Suture USP

Polypropylene

1 x 36 inches (90 cm)

TC 43 TAPEOUT

1 1/2 CIRCLE

TAPER

202 mm

2024-07-14 LOT 74G1901990

CE

Rx Only

MA

REF 833-124
(P0000861)

LOT 74G1901990

2024-07-14

163575-0817

(01) 3 4026704 60389 4

(17) 240714 (10) 74G1901990




California Prop 65

WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov



(01) 3 4026704 60389 4



Poliipropileno

Monofilamento azul

Suturas qu rurgicas no absorv veis

Poliipropileno

Monofilamento azul

Suturas cir rgicas n o absorv veis

CAPIO

1 x 36 Inches (90 cm)

0

(metric 3.5)

Polypropylene

Blue Monofilament

Nonabsorbable Surgical Suture, USP

REF 833-124

Rx Only

STERILE EO

UPN M0068331240

TC 43 TAPERCUT

T 1/2 CIRCLE
TAPER

28.2 mm

Teleflex[®]
MEDICAL




0120





2024-07-14



LOT

74G1901890

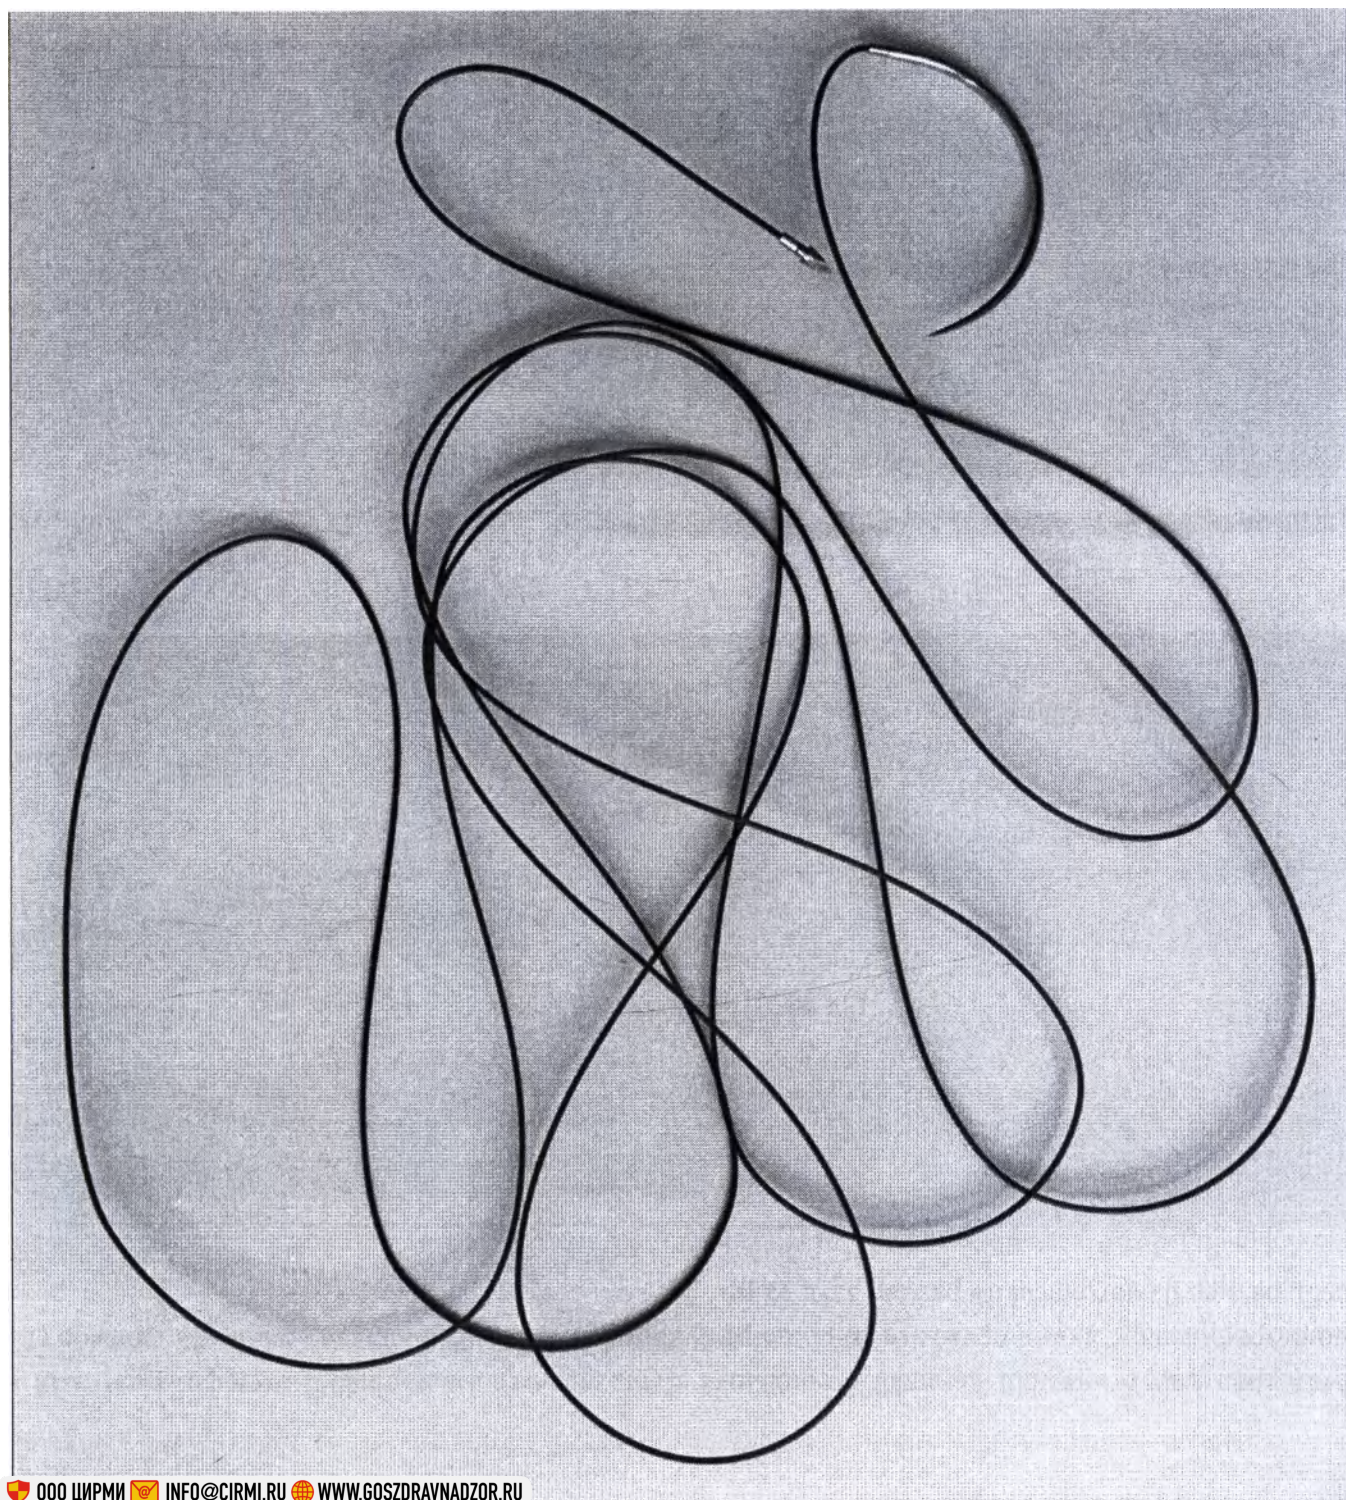



Материал хирургический шовный стерильный Capio нерассасывающийся, монофиламентный из полипропилена, с двумя прямыми колюще-режущими иглами, номинальная длина 48 дюймов (122 см.), размер 0 (метрический размер 3.5), 12 шт./уп.

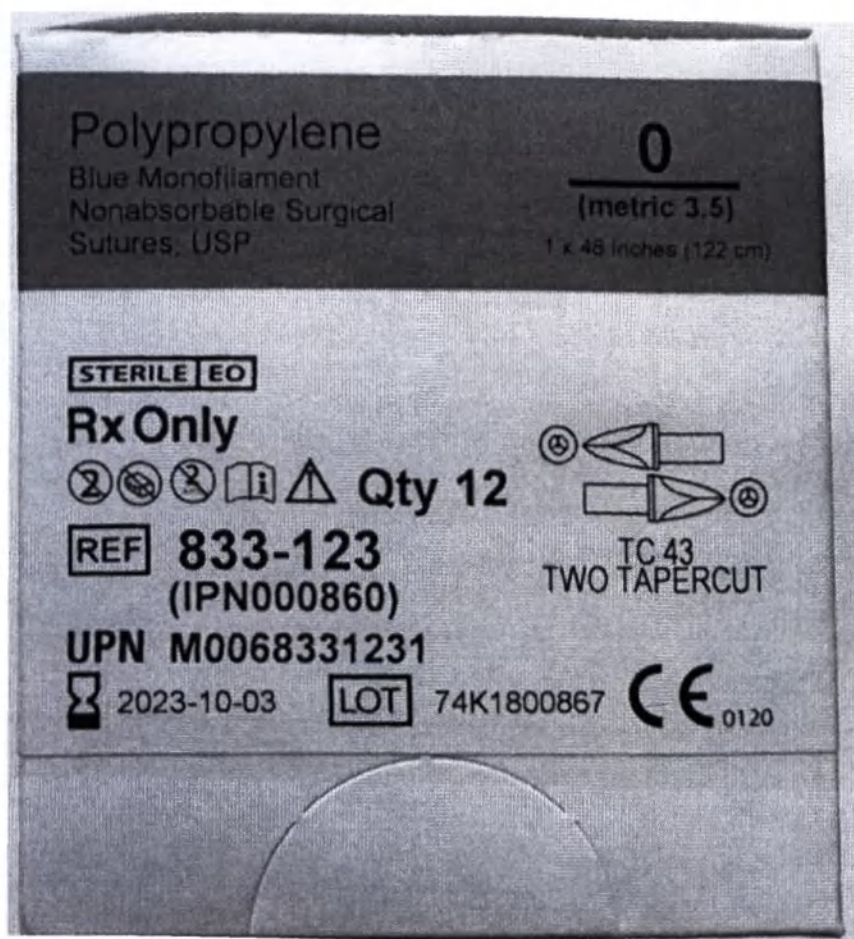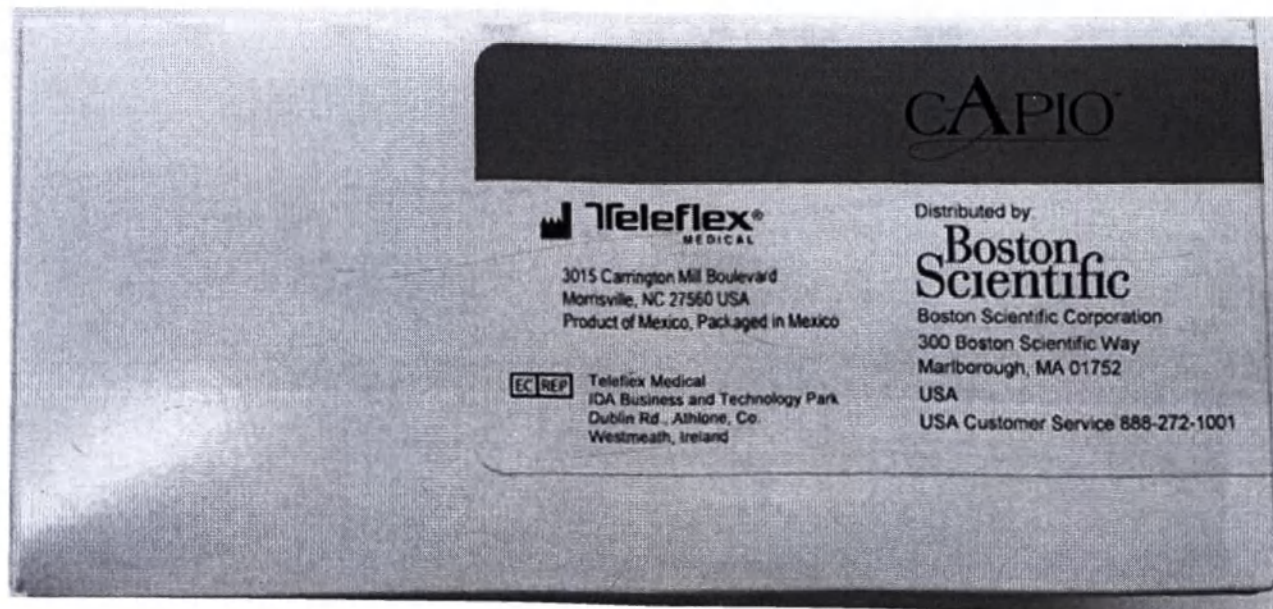

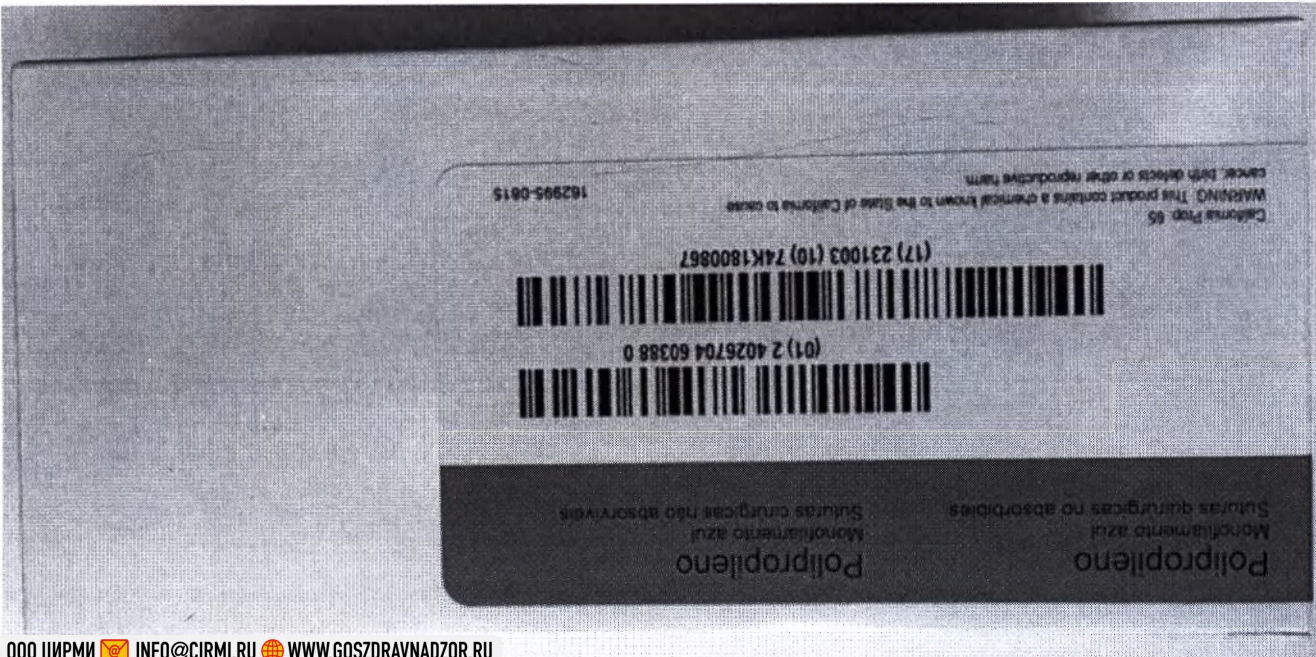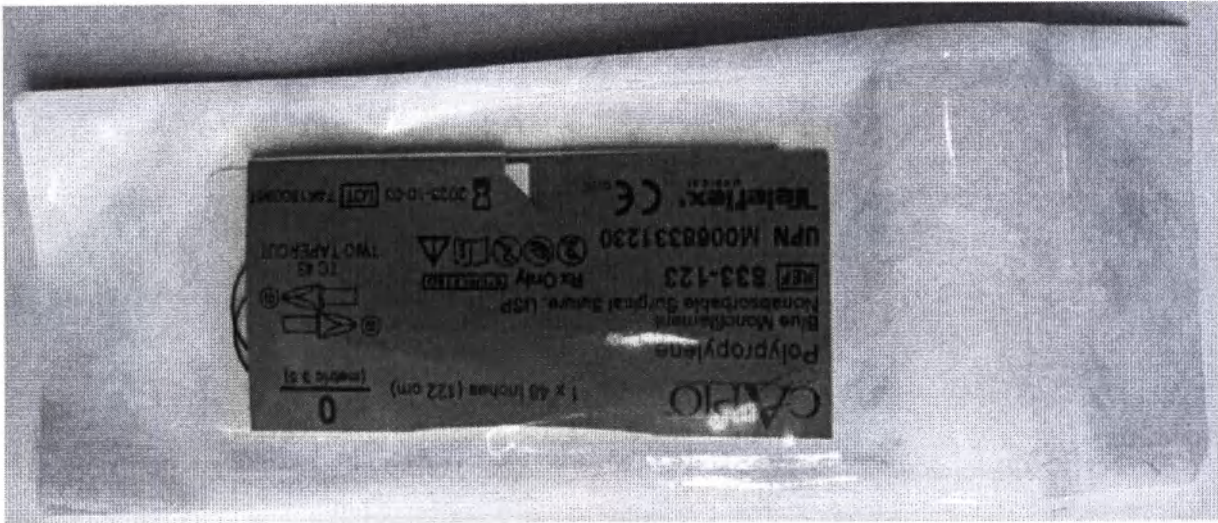



Материал хирургический шовный стерильный Cario нерассасывающийся, многофиламентный плетеный из полиэстера, пропитанный ПТФЭ, с двумя прямыми колюще-режущими иглами, номинальная длина 48 дюймов (122 см.), размер 0 (метрический размер 3.5), 12 шт./уп.

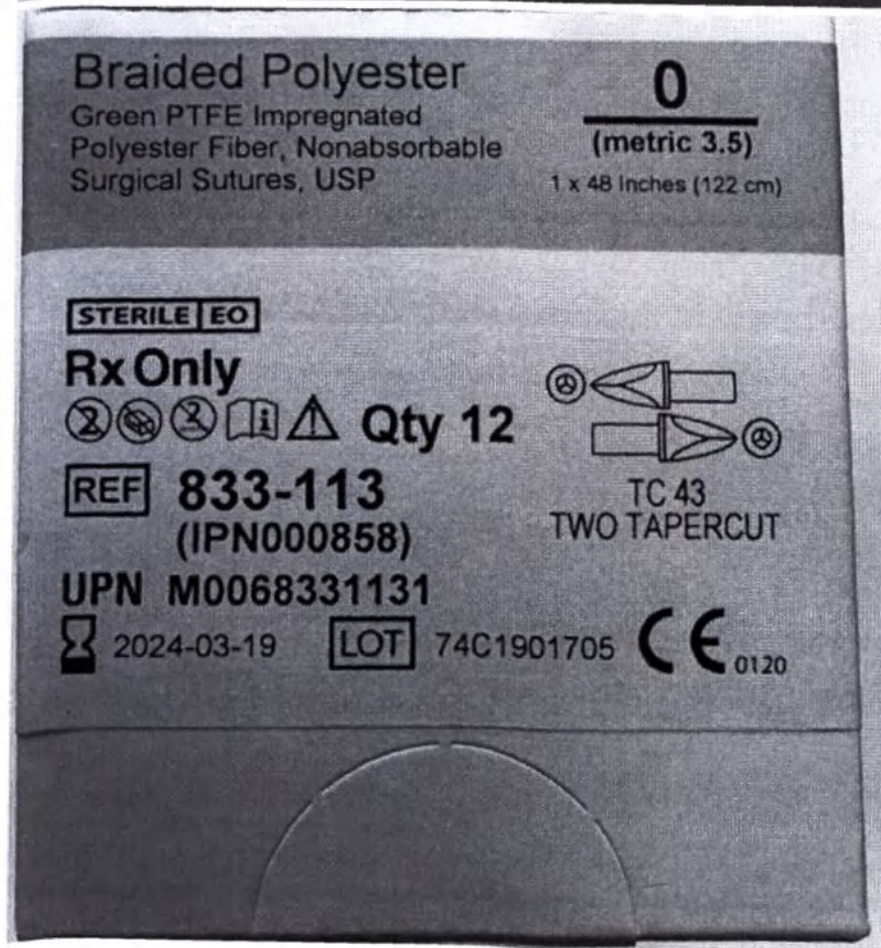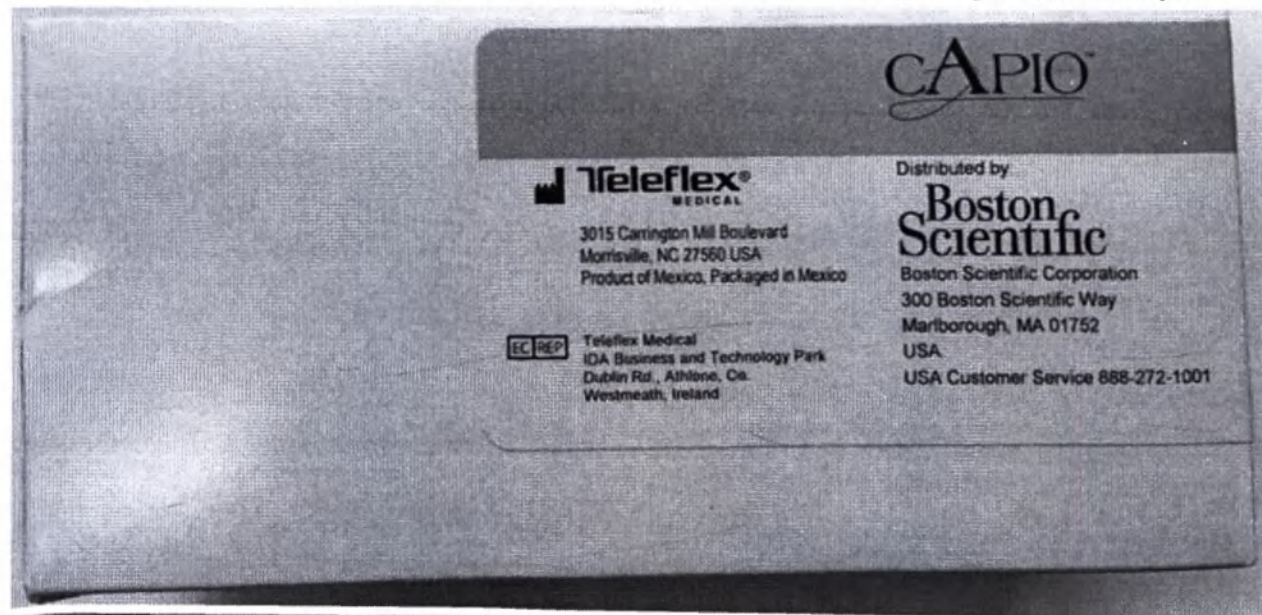

Poliéster trenzado

Fibra poliéster impregnada con PTFE
(politetrafluoroetileno) de color verde
Suturas quirúrgicas no absorbibles

Poliéster entrançado

Fibra de poliéster impregnada com
PTFE verde
Suturas cirúrgicas não absorvíveis



(01) 3 4026704 60386 3



(17) 240319 (10) 74C1901705



California Prop. 65

WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.

www.P65Warnings.ca.gov

163568-0817

CAPIO

1 x 48 Inches (122 cm) $\frac{0}{\text{(metric 3.5)}}$

Braided Polyester

Green PTFE Impregnated Polyester Fiber

Nonabsorbable Surgical Suture, USP

REF 833-113

UPN M0068331130

Teleflex MEDICAL

CE 0120

Rx Only **STERILE EO**

TC 43 TWO TAPERCUT

2024-03-19 LOT 74C1901705

CAPIO

1 x 48 Inches (122 cm) $\frac{0}{\text{(metric 3.5)}}$

Braided Polyester

Green PTFE Impregnated Polyester Fiber

Nonabsorbable Surgical Suture, USP

REF 833-113

UPN M0068331130


Teleflex MEDICAL

CE 0120



Rx Only **STERILE EO**

TC 43 TWO TAPERCUT

2024-03-19 LOT 74C1901705

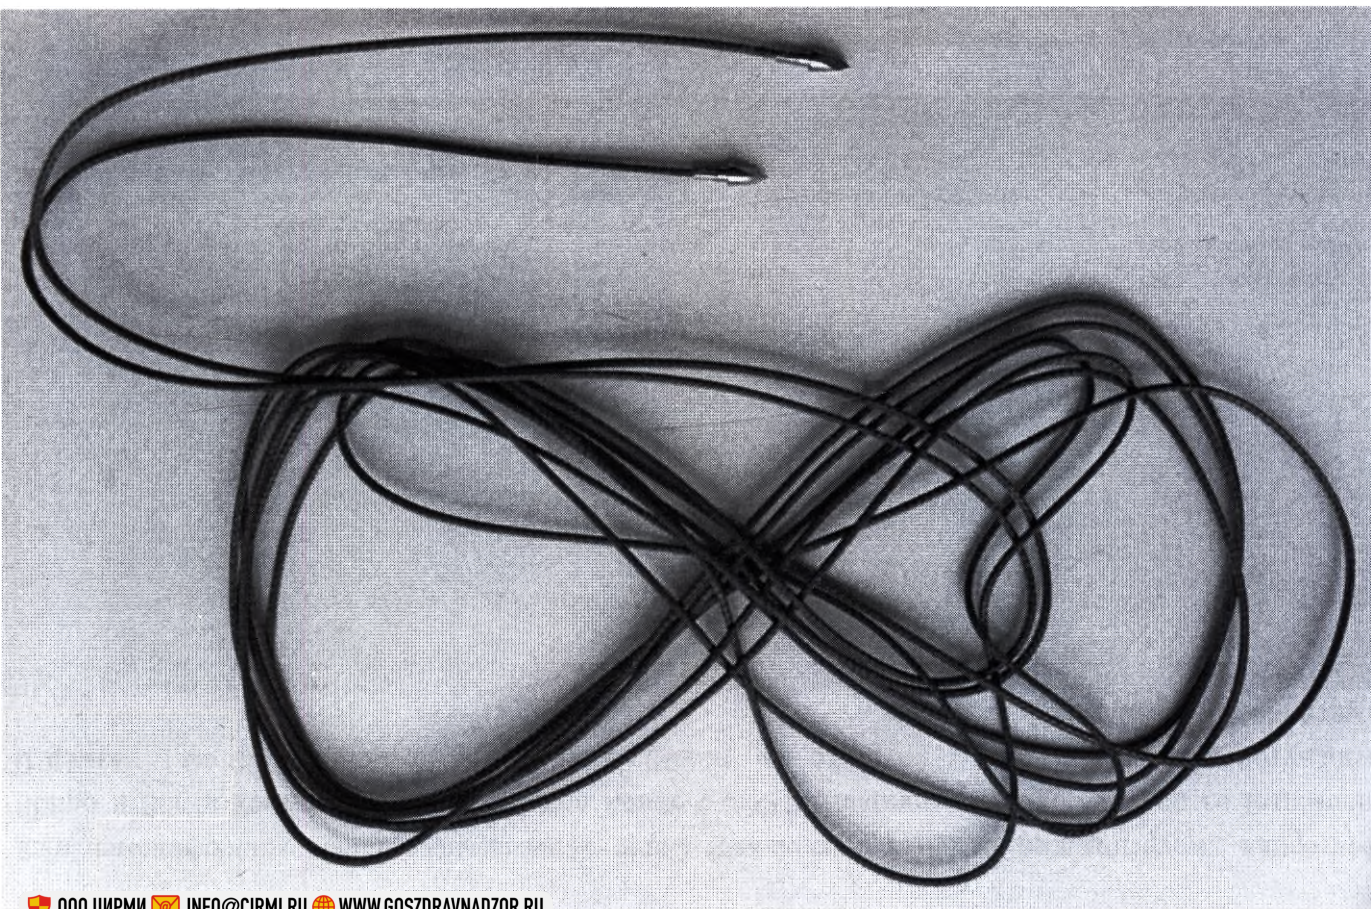

Материал хирургический шовный стерильный Capio нерассасывающийся, многофиламентный плетеный из полиэстера, пропитанный ПТФЭ, с одной прямой колюще-режущей иглой и одной изогнутой колющей иглой 1/2 круга 26 мм, номинальная длина 36 дюймов (90 см.), размер 0 (метрический размер 3.5), 12 шт./уп.

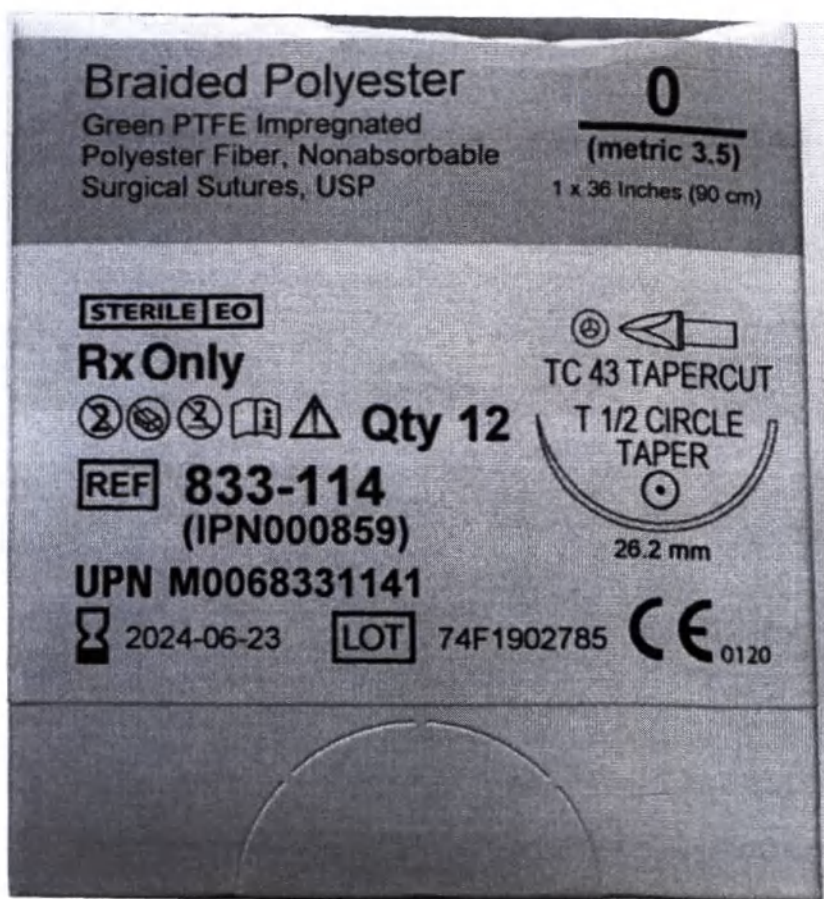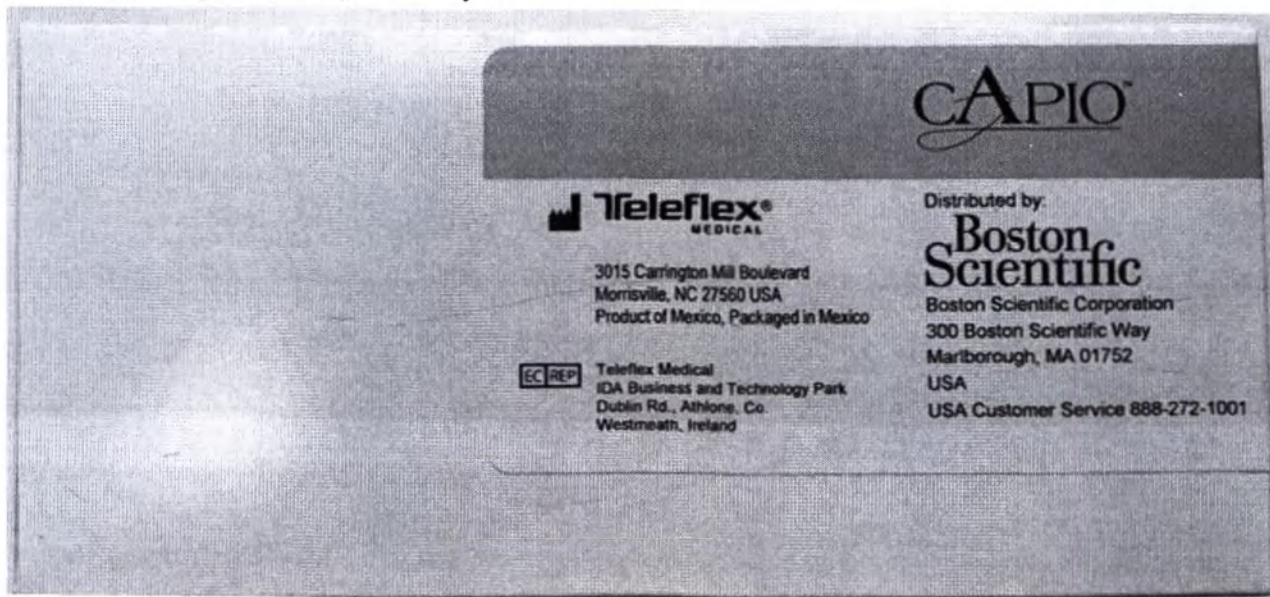

Poliéster trenzado

Fibra poliéster impregnada con PTFE
(politetrafluoroetileno) de color verde
Suturas quirúrgicas no absorbibles

Poliéster entrançado

Fibra de poliéster impregnada com
PTFE verde
Suturas cirúrgicas não absorvíveis



(01) 3 4026704 60387 0



(17) 240623 (10) 74F1902785



California Prop.65

WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.

www.P65Warnings.ca.gov

163570-0817

(01) 3 4026704 60387 0 (17) 240623 (10) 74F1902785

REF 833-114
(IPN000668)

LOT 74F1902785

2024-06-23



163571-0817

CAPIO

1 x 36 Inches (90 cm)

0

(metric 3.8)

Braided Polyester

Green PTFE Impregnated Polyester Fiber
Nonabsorbable Surgical Suture, USP

REF 833-114

Rx Only **VERBATIM**

UPN M0068331140

Teleflex MEDICAL



0120



2024-06-23

LOT

74F1902785

TC 43 TAPERCUT

T 1/2 CIRCLE

TAPER

26.2 mm

CAPIO™

1 x 36 Inches (90 cm)

0

(metric 3.5)

Braided Polyester

Green PTFE Impregnated Polyester Fiber
Nonabsorbable Surgical Suture, USP

REF 833-114

Rx Only **STERILE EO**

TC 43 TAPERCUT

T 1/2 CIRCLE
TAPER

UPN M0068331140



26.2 mm

Teleflex®
MEDICAL




0120



2024-06-23

LOT

74F1902785

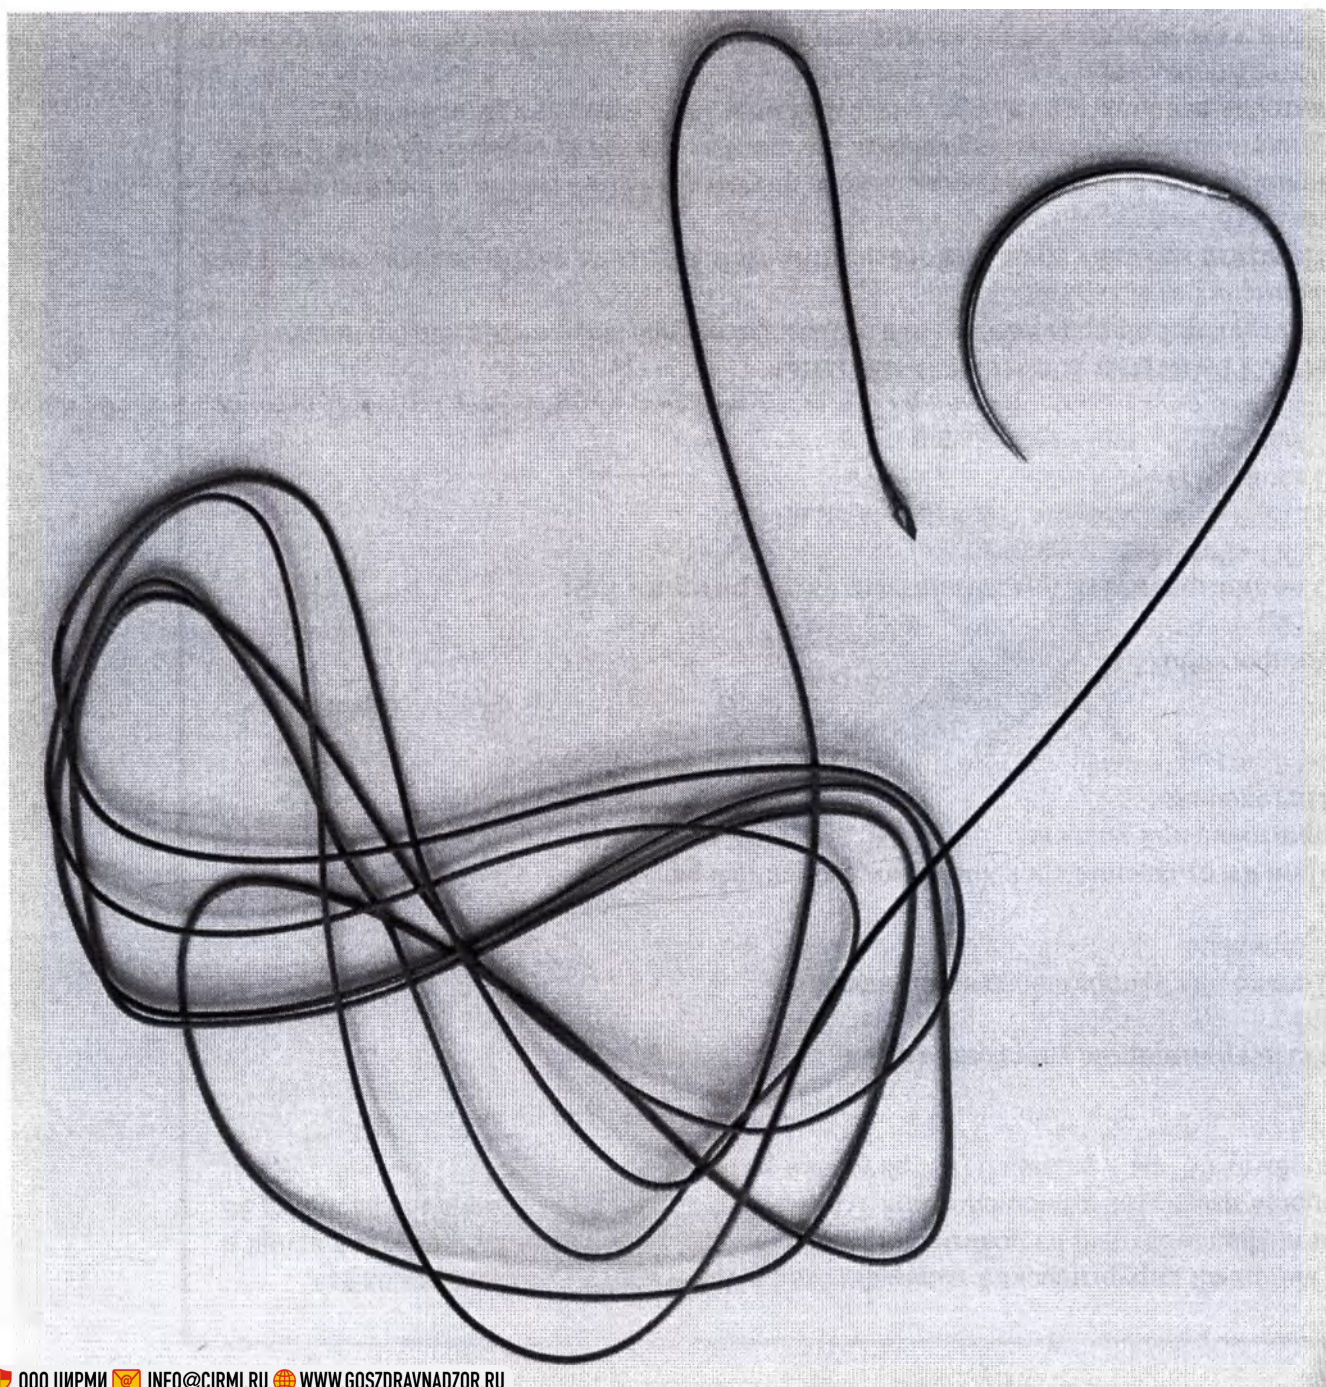

Материал хирургический шовный стерильный Сарио нерассасывающийся, монофиламентный из полипропилена, с одной прямой колюще-режущей иглой и одной изогнутой колющей иглой 1/2 окружности 26,2 мм, номинальная длина 36 дюймов (90 см.), размер 0 (метрический размер 3.5)

Регистрационное удостоверение

От:

№

Только для одноразового использования

Стерильно

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

Не токсично



Апирогенно



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Результат-Аудит»,

127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А

Тел: 8 (495) 455-11-16

Email: resultataudit@gmail.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по

применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу

поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте

Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Материал хирургический шовный стерильный Сарио нерассасывающийся, монофиламентный из полипропилена, с двумя прямыми колюще-режущими иглами, номинальная длина 48 дюймов (122 см.), размер 0 (метрический размер 3.5)

Регистрационное удостоверение

От:

№

Только для одноразового использования

Стерильно

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

Не токсично

Апирогенно



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Результат-Аудит»,

127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А

Тел: 8 (495) 455-11-16

Email: resultataudit@gmail.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по

применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу

поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте

Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Материал хирургический шовный стерильный Cario нерассасывающийся, многофиламентный плетеный из полиэстера, пропитанный ПТФЭ, с двумя прямыми коллоидно-режущими иглами, номинальная длина 48 дюймов (122 см.), размер 0 (метрический размер 3.5)

Регистрационное удостоверение

От:

№

Только для одноразового использования

Стерильно

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

Не токсично

Апирогенно



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Результат-Аудит»,

127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А

Тел: 8 (495) 455-11-16

Email: resultataudit@gmail.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по

применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу

поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте

Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Материал хирургический шовный стерильный Сario нерассасывающийся, многофиламентный плетеный из полиэстера, пропитанный ПТФЭ, с одной прямой колюще-режущей иглой и одной изогнутой колющей иглой 1/2 круга 26 мм, номинальная длина 36 дюймов (90 см.), размер 0 (метрический размер 3.5)

Регистрационное удостоверение

От:

№

Только для одноразового использования

Стерильно

Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке

Не токсично



Апирогенно



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Результат-Аудит»,

127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А

Тел: 8 (495) 455-11-16

Email: resultataudit@gmail.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по

применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу

поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте

Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Прошнуровано и прон

19 лист *ав*

Генеральный Директор

ООО "Результат-Аудит"

Г.В. Родина

