

Фотографические изображения

Реагенты в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e analyzers)

реагенты в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e
analyzers)

Elecsys S100

cobas e analyzers

CONTENT



REF 08817324190

R1	9.9 mL
R2	9.9 mL
M	5.8 mL



COBAS, COBAS E and
ELECSYS are trademarks
of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

0844485301(1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

01

IVD

CE

 2-8 °C




dialog.roche.com



cobas®

Реагенты в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e analyzers)

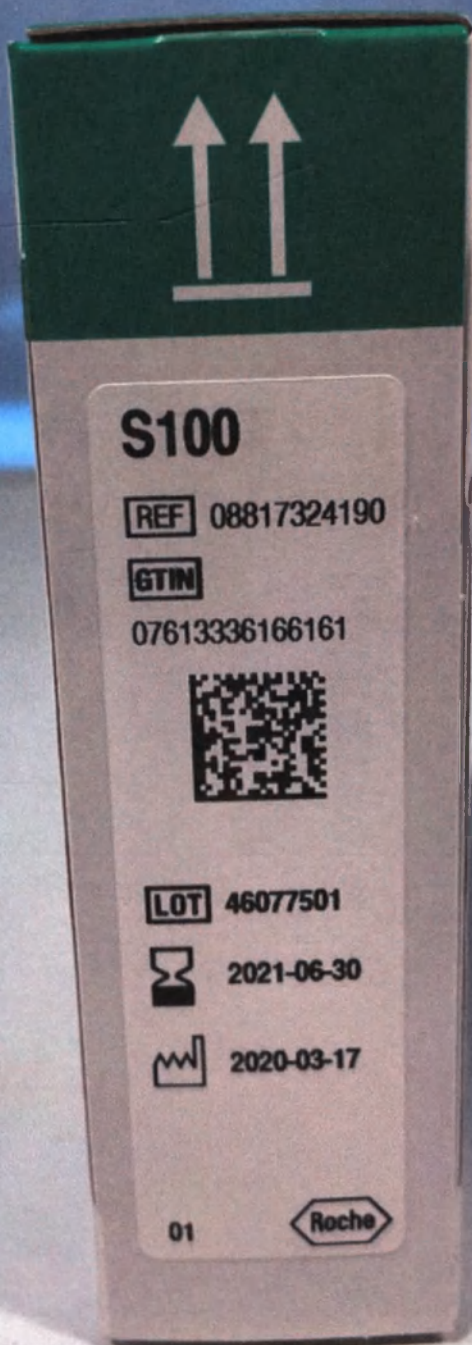

енты в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным
одом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e analyzers)

Elecsys S100

REF 08817324190


For USA: **CONTENT**

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Biotinylated monoclonal anti-S100 antibody
(mouse) 1.0 mg/L
- R2** Monoclonal anti-S100 antibody (mouse) labeled with
ruthenium complex 1.0 mg/L



Rx only

01



реактивы в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e analyzers)



Регистры в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e analyzers)


Регистры в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e analyzers)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке

Производитель: Roche Diagnostics GmbH ("Рош Диагностика GmbH"), Sandhofer Strasse 119, 68306 Mannheim, Germany, Германия
Название предназначено только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-69, факс: +7 495 229-62-64 E-mail: productregistration_ru@roche.com

Кат. номер 03817324190

Реагенты в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e analyzers)

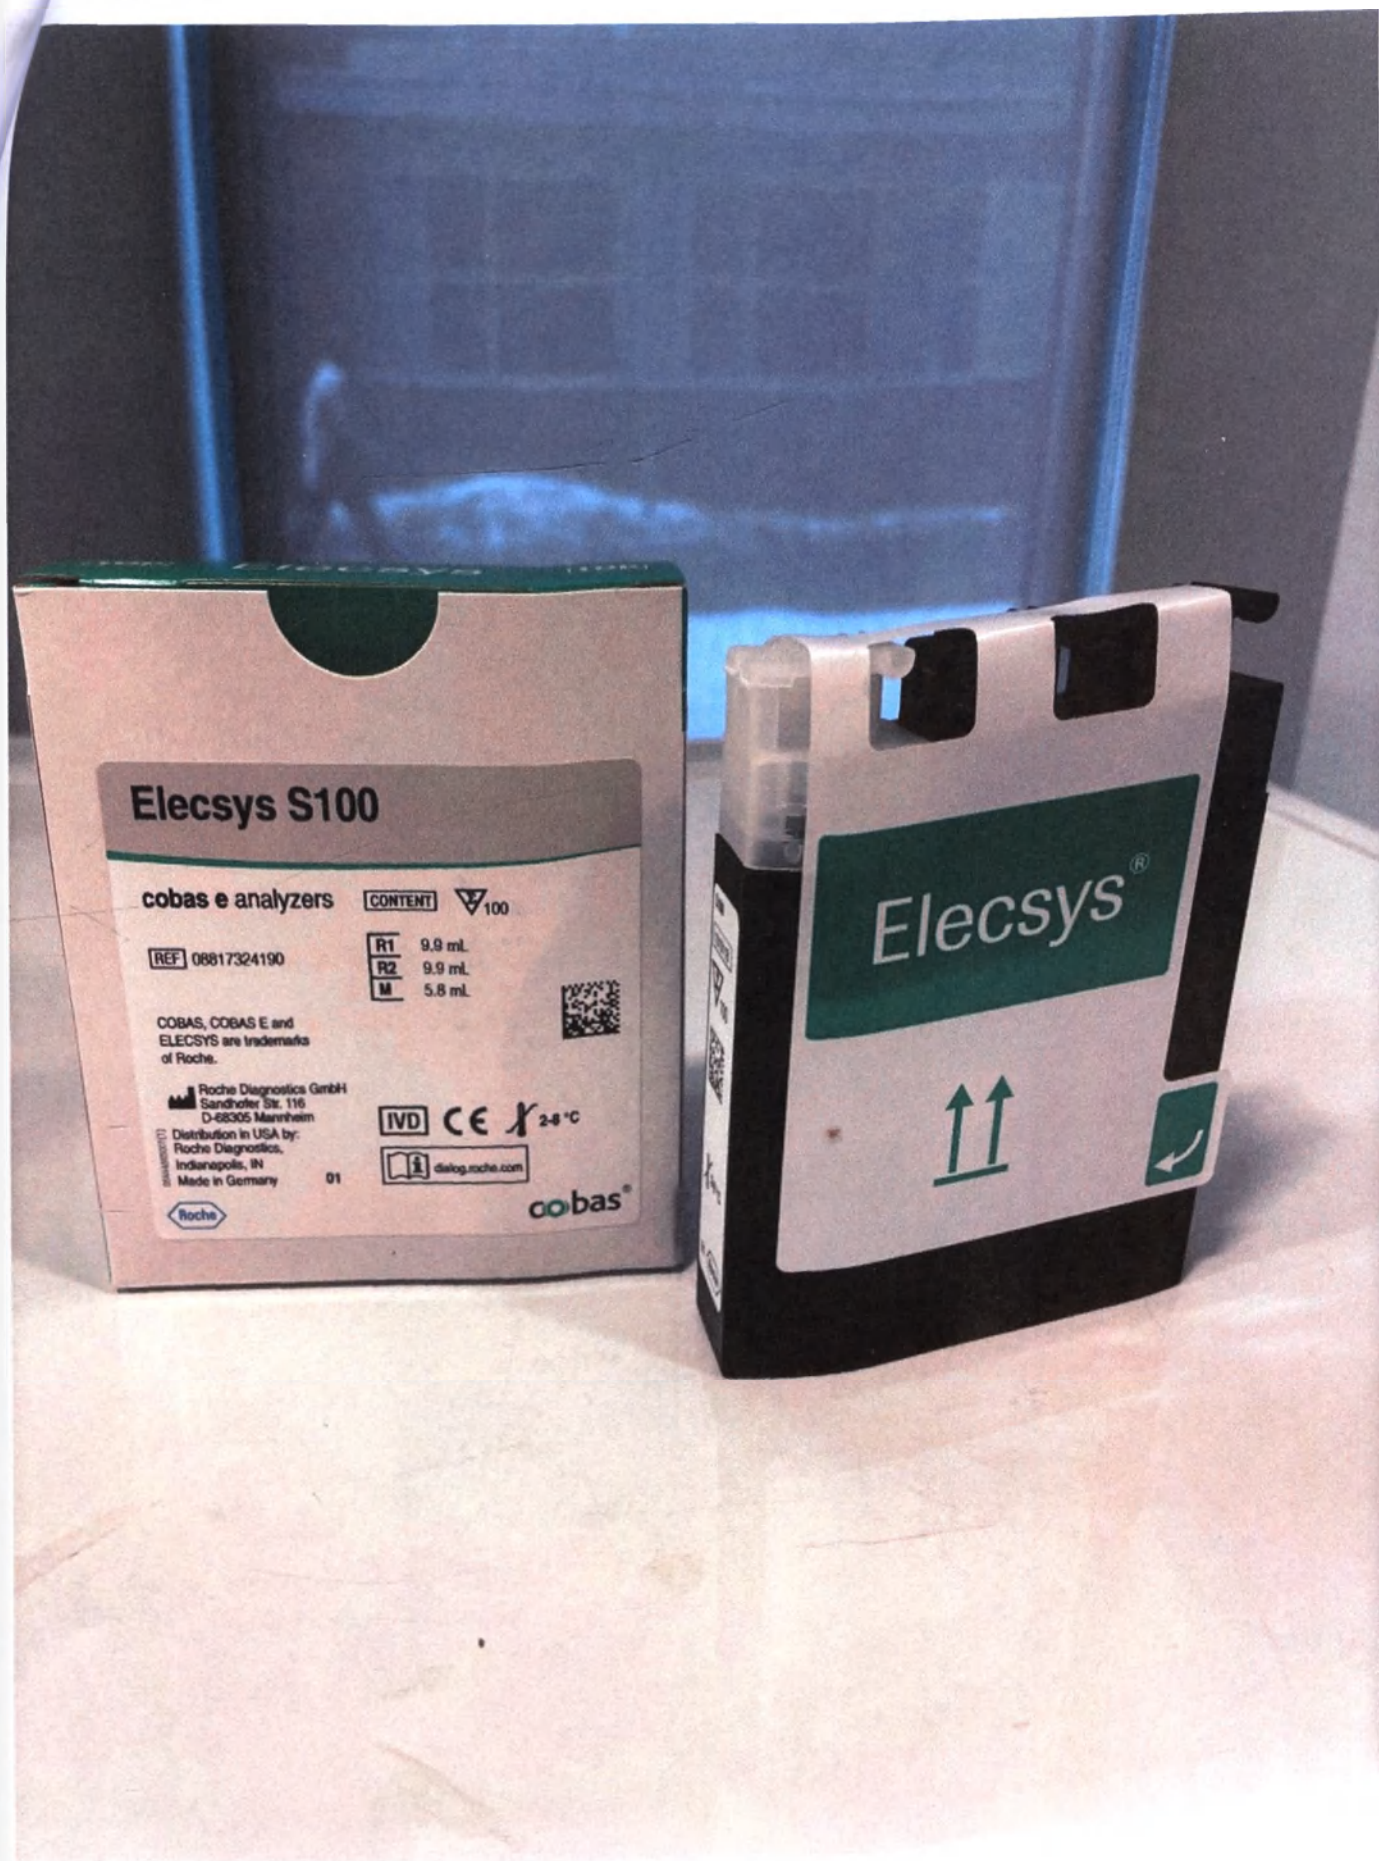

Реагенты в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100
cobas e analyzers)



Реагенты в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100 cobas e analyzers)



Реагенты в кассете для количественного определения S100 в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys S100
cobas e analyzers)



Всего прошнуровано
прешнуровано и
скреплено



Воронина Г.А.
по доверенности
от 04.02.2021