


### **Фотографические изображения**

**Набор реагентов и калибраторов для качественного определения IgM антител к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Rubella IgM cobas e analyzers/RUBIGM)»**

реагентов и калибраторов для качественного определения IgM антител к вирусу краснухи в сыворотке  
 из крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Rubella  
 A cobas e analyzers/RUBIGM)

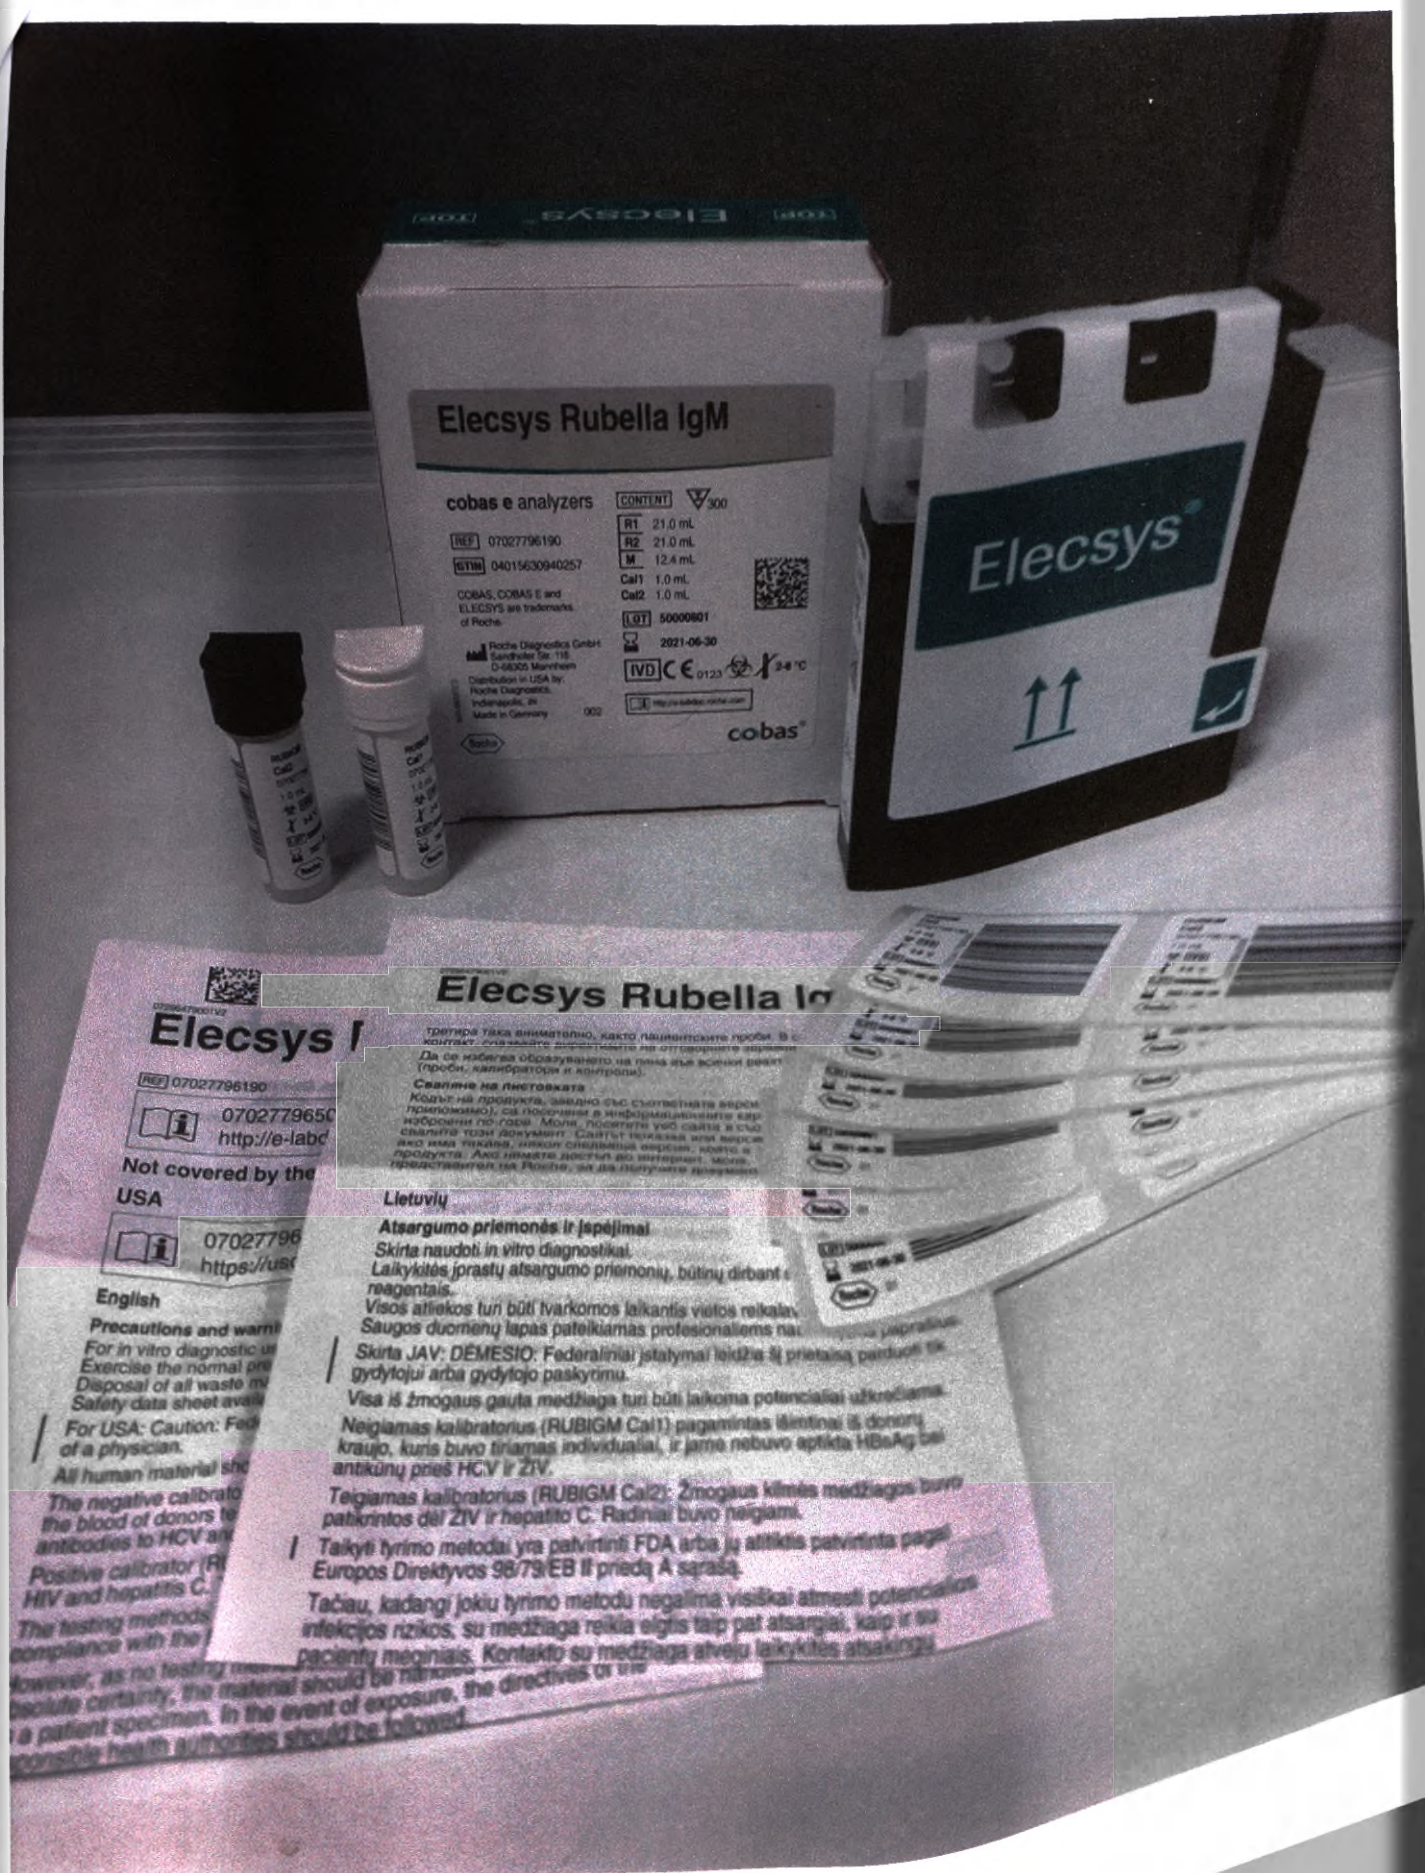

реагентов и калибраторов для качественного определения IgM антител к вирусу краснухи в сыворотке  
плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Rubella  
IgM cobas e analyzers/RUBIGM)

# Elecsys Rubella IgM

**cobas e analyzers**

**CONTENT**

 300

**REF** 07027796190


**GTIN** 04015630940257

COBAS, COBAS E and  
ELECSYS are trademarks  
of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany

00446530010



002

**R1** 21.0 mL

**R2** 21.0 mL

**M** 12.4 mL

**Cal1** 1.0 mL

**Cal2** 1.0 mL

**LOT** 50000801



2021-06-30

**IVD**

**CE**

0123




2-8 °C



<http://e-labdoc.roche.com>

**cobas**<sup>®</sup>

реагентов и калибраторов для качественного определения IgM антител к вирусу краснухи в сыворотке и  
зме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Rubella IgM  
bas e analyzers/RUBIGM)

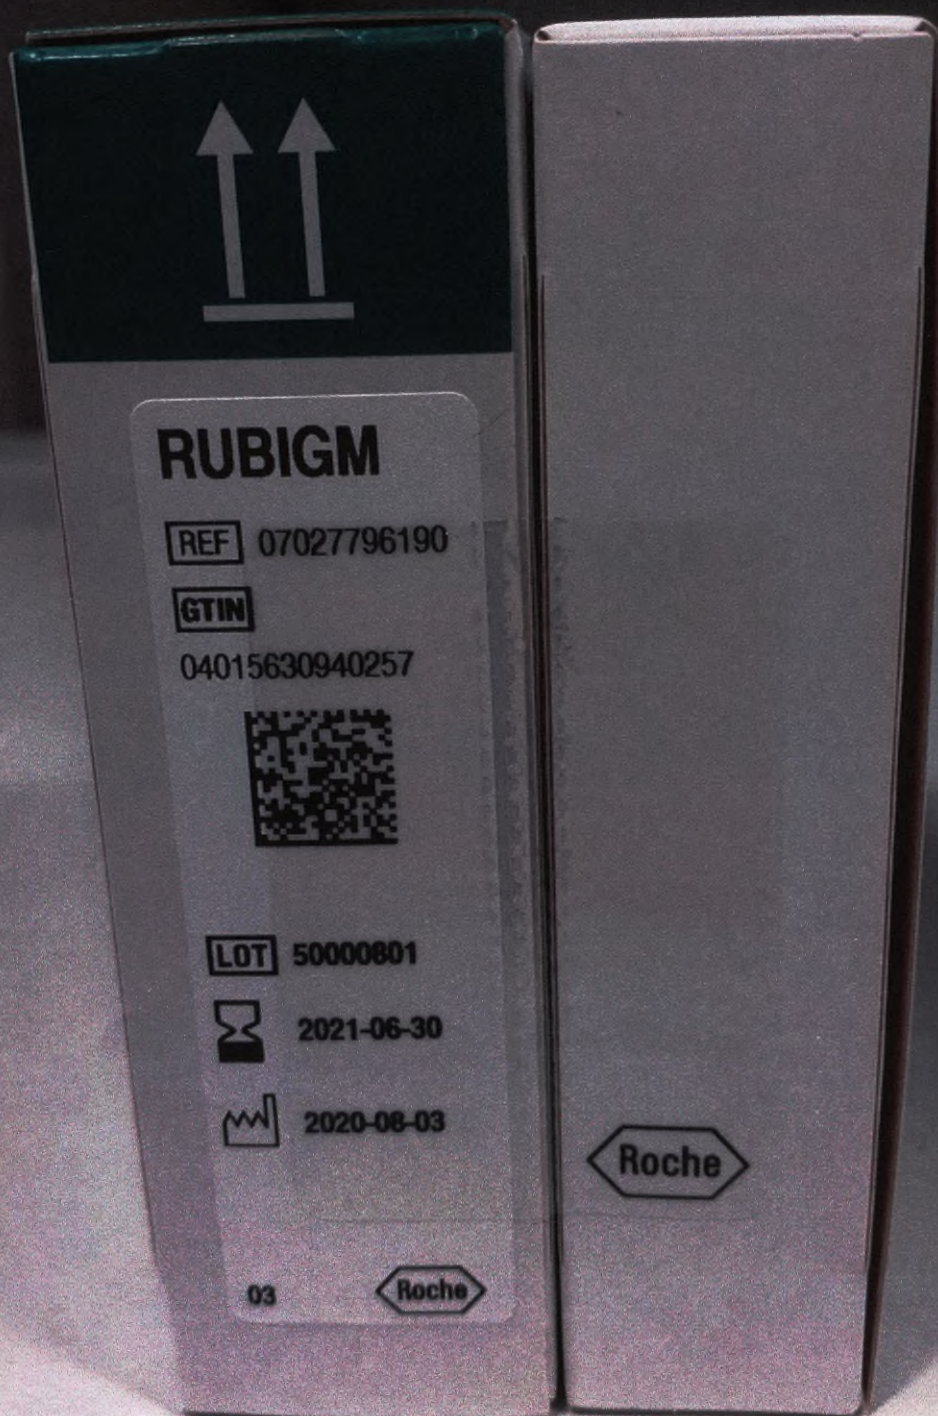

реагентов и калибраторов для качественного определения IgM антител к вирусу краснухи в сыворотке и  
зме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Rubella IgM  
cobas e analyzers/RUBIGM)

# Elecsys Rubella IgM

REF 07027796190

For USA: **CONTENT**

- R1** Biotinylated monoclonal anti-human-IgM antibody (mouse) > 500 µg/L, Rubella-like particles (RLP) approximately 0.1 U/mL
- R2** Anti-Rubella antibodies labeled with ruthenium complex > 400 ng/mL
- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- Cal1** Human serum, non reactive for anti-Rubella IgM
- Cal2** Anti-Rubella IgM approximately 700 U/mL (Roche units) in buffer




Rx only

003



реагентов и калибраторов для качественного определения IgM антител к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических анализаторов (Elecsys Rubella IgM cobas e analyzers/RUBIGM)

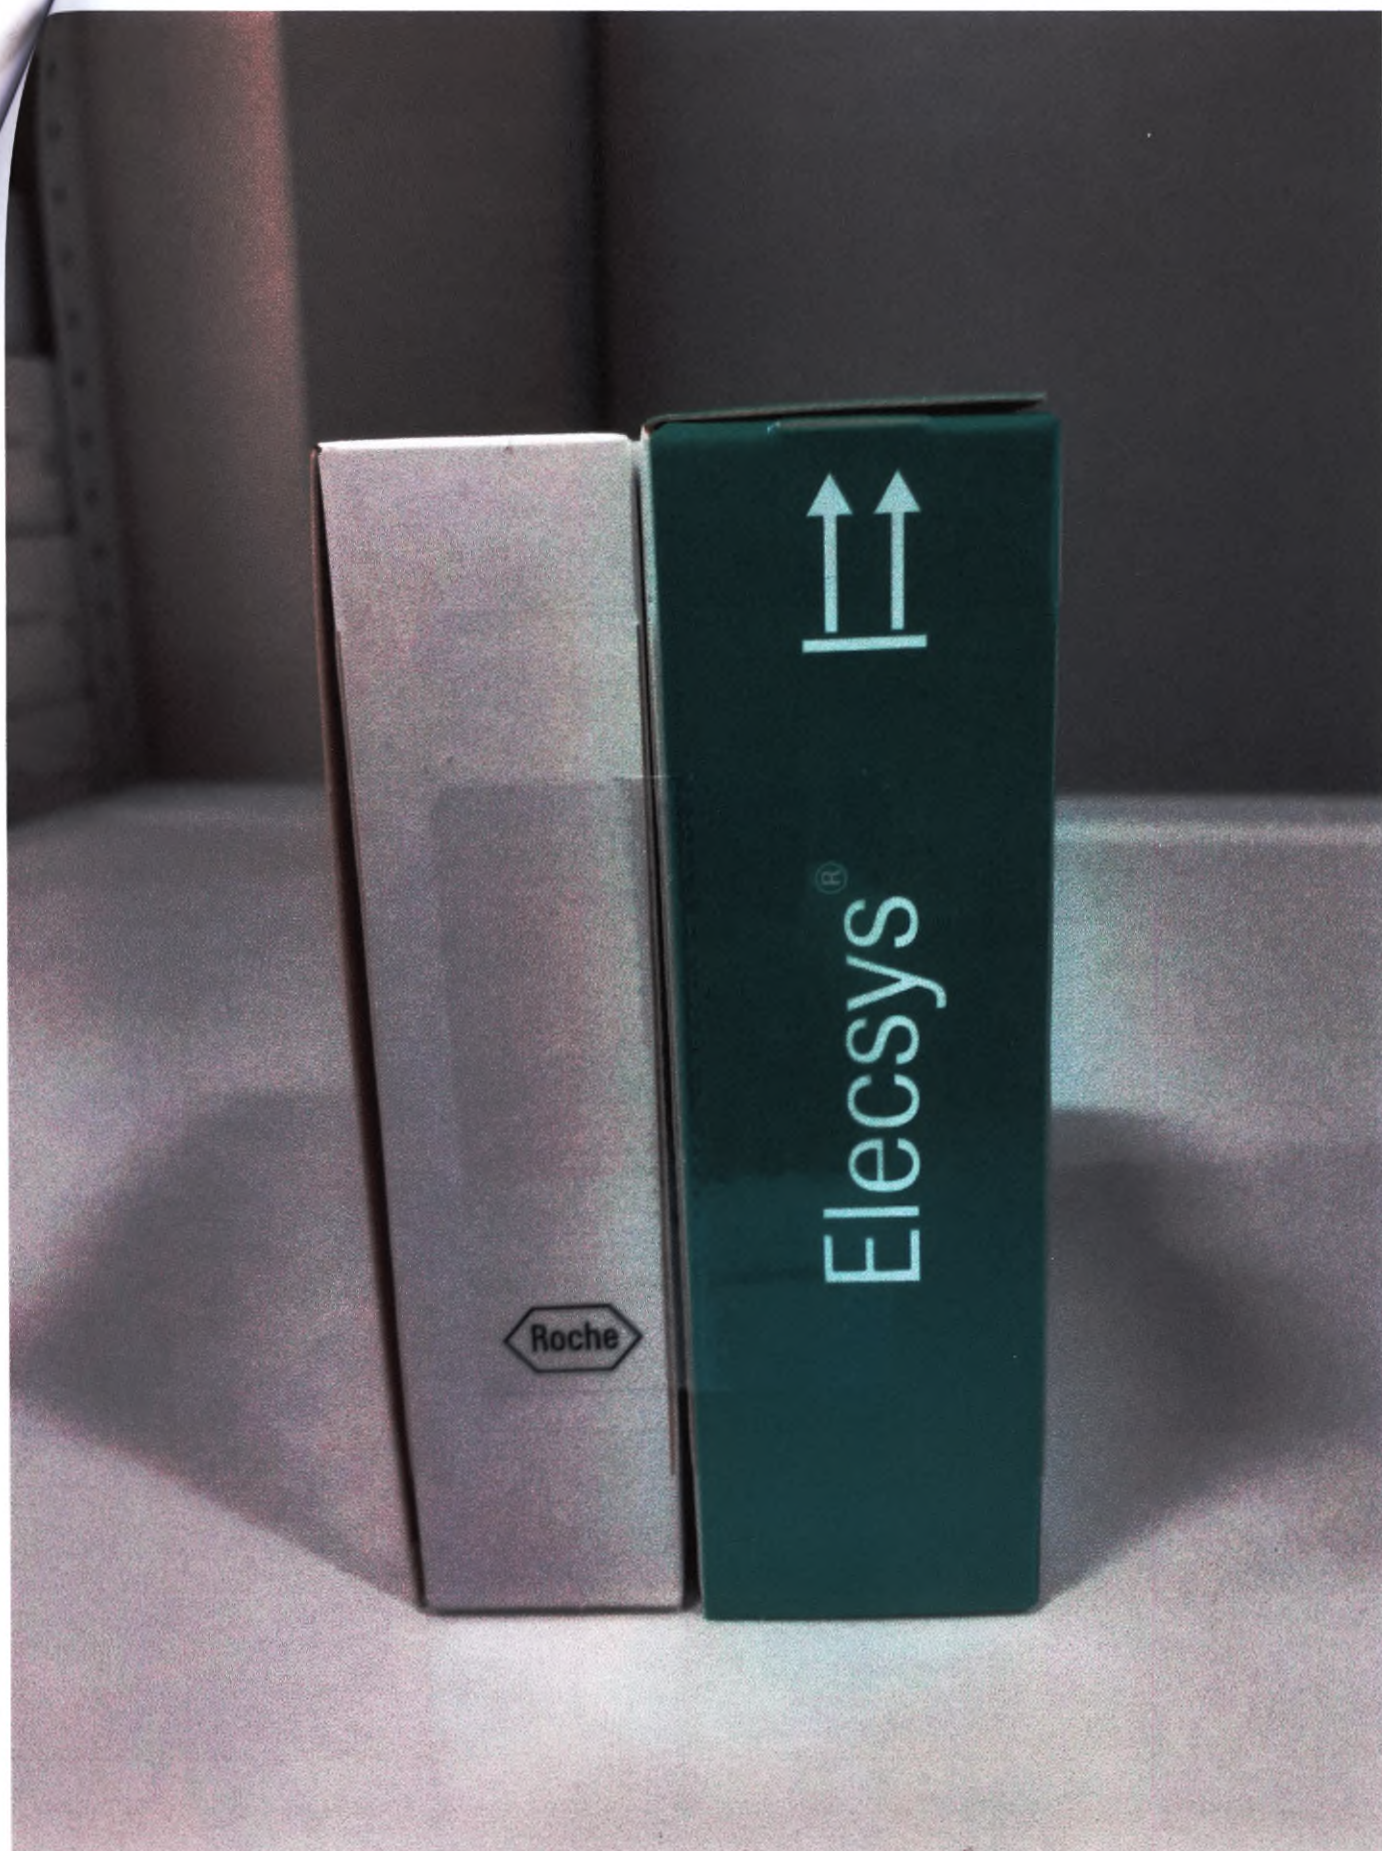

реагентов и калибраторов для качественного определения IgM антител к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Rubella IgM cobas e analyzers/RUBIGM)

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения IgM антител к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Rubella IgM cobas e analyzers/RUBIGM), в составе:

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) (RUBIGM): M, R1, R2 – 1 шт.
2. Калибратор 1 (RUBIGM Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 1 шт.
3. Калибратор 2 (RUBIGM Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 1 шт.
4. Этикетки для флаконов – 12 шт.
5. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмБХ"),

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»

(ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2

Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com

Кат.номер 07027796190





**RUBIGM**

07027796190

R1

R2

M



IVD


LOT


50000801



2021-06-30

01

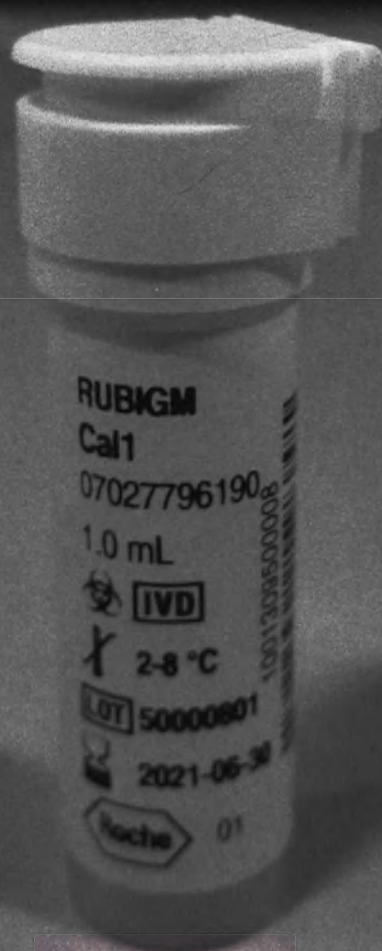

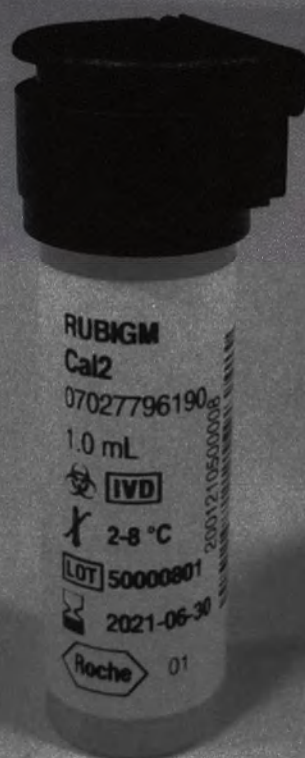





**Elecsys Rubella IgM**

Съществено на изтока

«Самое главное, что мы должны сделать, это обеспечить, чтобы наши дети не были лишены возможности учиться и развиваться. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить им будущее, которое будет таким же ярким и успешным, как и наше собственное».

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

1. **Identify the problem.** The first step in the problem-solving process is to identify the problem. This involves understanding the situation, gathering information, and determining the specific issue that needs to be addressed.

naidzīti ar šādiem pasākumiem:

ingentes nacionales (RUBICAM Card). Zmogenus kamts medlagos buvo  
kaijo buvo medla ysa patvirtinti FDA arba ysa patvirtinti pagal

Самостоятельно подготовьте доклад на тему: «Влияние культуры на развитие личности».

[illegible]

1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 26

Сектор

по да би се добила информација о стању делатности у овом подручју, извршен је интервју са једним од њихових представника.

Сила влияния федерального закона ограничивается только рамками протекции данного вида, только в том или в его отношении.

стационарные инфлюорансы

Судебная палата (RUBIN GAZ) Материалы, полученные из  
жизельный клинатор (RUBIN GAZ) Материалы, полученные из  
человека, тестированы на вынос (RUBIN GAZ) Материалы, полученные из  
отделений.

Для тестирования, используемые анализы, были одобрены Министерством США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) или упомянуты в соответствующей директиве ЕС 98/79/EC. Приложение II, Спектр А.

**COBAS**

Там же, кстати, сообщают, что в течение исследования на территории заповедника не было отмечено ни одного случая заболевания человека, ни одного случая заболевания животных.

Копия для сохранения документов

получившие документ, не имеют права на получение информации, содержащейся в нем, и не могут использовать ее в своих интересах. Если же документ, содержащий информацию, не является документом, то информация, содержащаяся в нем, не является информацией, содержащейся в документе.

Roche Diagnostics uses the following symbols and signs in addition to those listed in the ISO 15223-1 standard (for USA, see <http://www.roche.com>):

Erweiterung zur ISO 15223-1 werden von Roche Diagnostics folgende Symbole und Zeichen verwendet (für USA: Definition der verwendeten Symbole, siehe <https://diagnostics.roche.com/> / Roche Diagnostics online). Die Symbole der folgenden Normen sind in der Normen ISO 15223-1 (USA: Normen) angegeben.

symboles utilisés) / Roche Diagnostica emploie les symboles suivants et signes adéquatement à los indicadores en la norma ISO 15223-1 (para los símbolos usados) / Roche Diagnostica utiliza los siguientes símbolos y signos adecuadamente a los indicadores en la definición de la norma ISO 15223-1 (para los símbolos usados) / Oltre a quelli indicati nella definizione di ISO 15223-1, Roche Diagnostica utilizza i seguenti simboli e segni adeguatamente a quelli indicati nella definizione di ISO 15223-1 (per i simboli usati).

[illegible][illegible]

15223-1: matrikulační známky pro USA, pro definici ISO  
Diagnostics používá kromě symbolů a máva uvedených v normě ISO  
norme / ISO diagnostics rovněž oím for definition av bulské symboly / Roční  
kom je listel opp / ISO standard 15223-1 for USA, se  
převládá / Roční Diagnostics bruker følgende symboler og tegn / Matrikulační známky

[illegible][illegible]

**Roché Diagnostics** - **Roche Diagnostics**

[illegible]

© Roche Diagnostics papadimitri naudia sinus symbolus i zandus.  
i kanyty standite ISO 15223-1 (skit JAV: nauqlyary symboly  
syndromy iskalyte https://usa.diagnostics.com/; B) gonychasy x  
syndromy iskalyte i skity ISO 15223-1. Roche Diagnostics primenat  
naudia sinus symbolus i zandus (naudia sinus symbolus i zandus)

на основании полученных результатов:

Всеголи нумеровано  
и седицу свано и  
крепле запечатано  
и поштом  
Датум  
Руска  
Москва

Веконференција

по доверености  
от 04.02.2021