



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения общей тироксин связывающей способности сыворотки или плазмы крови человека иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах Alinity i "Тироксин связывающая способность Калибраторы (Alinity i T-Uptake Calibrators)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



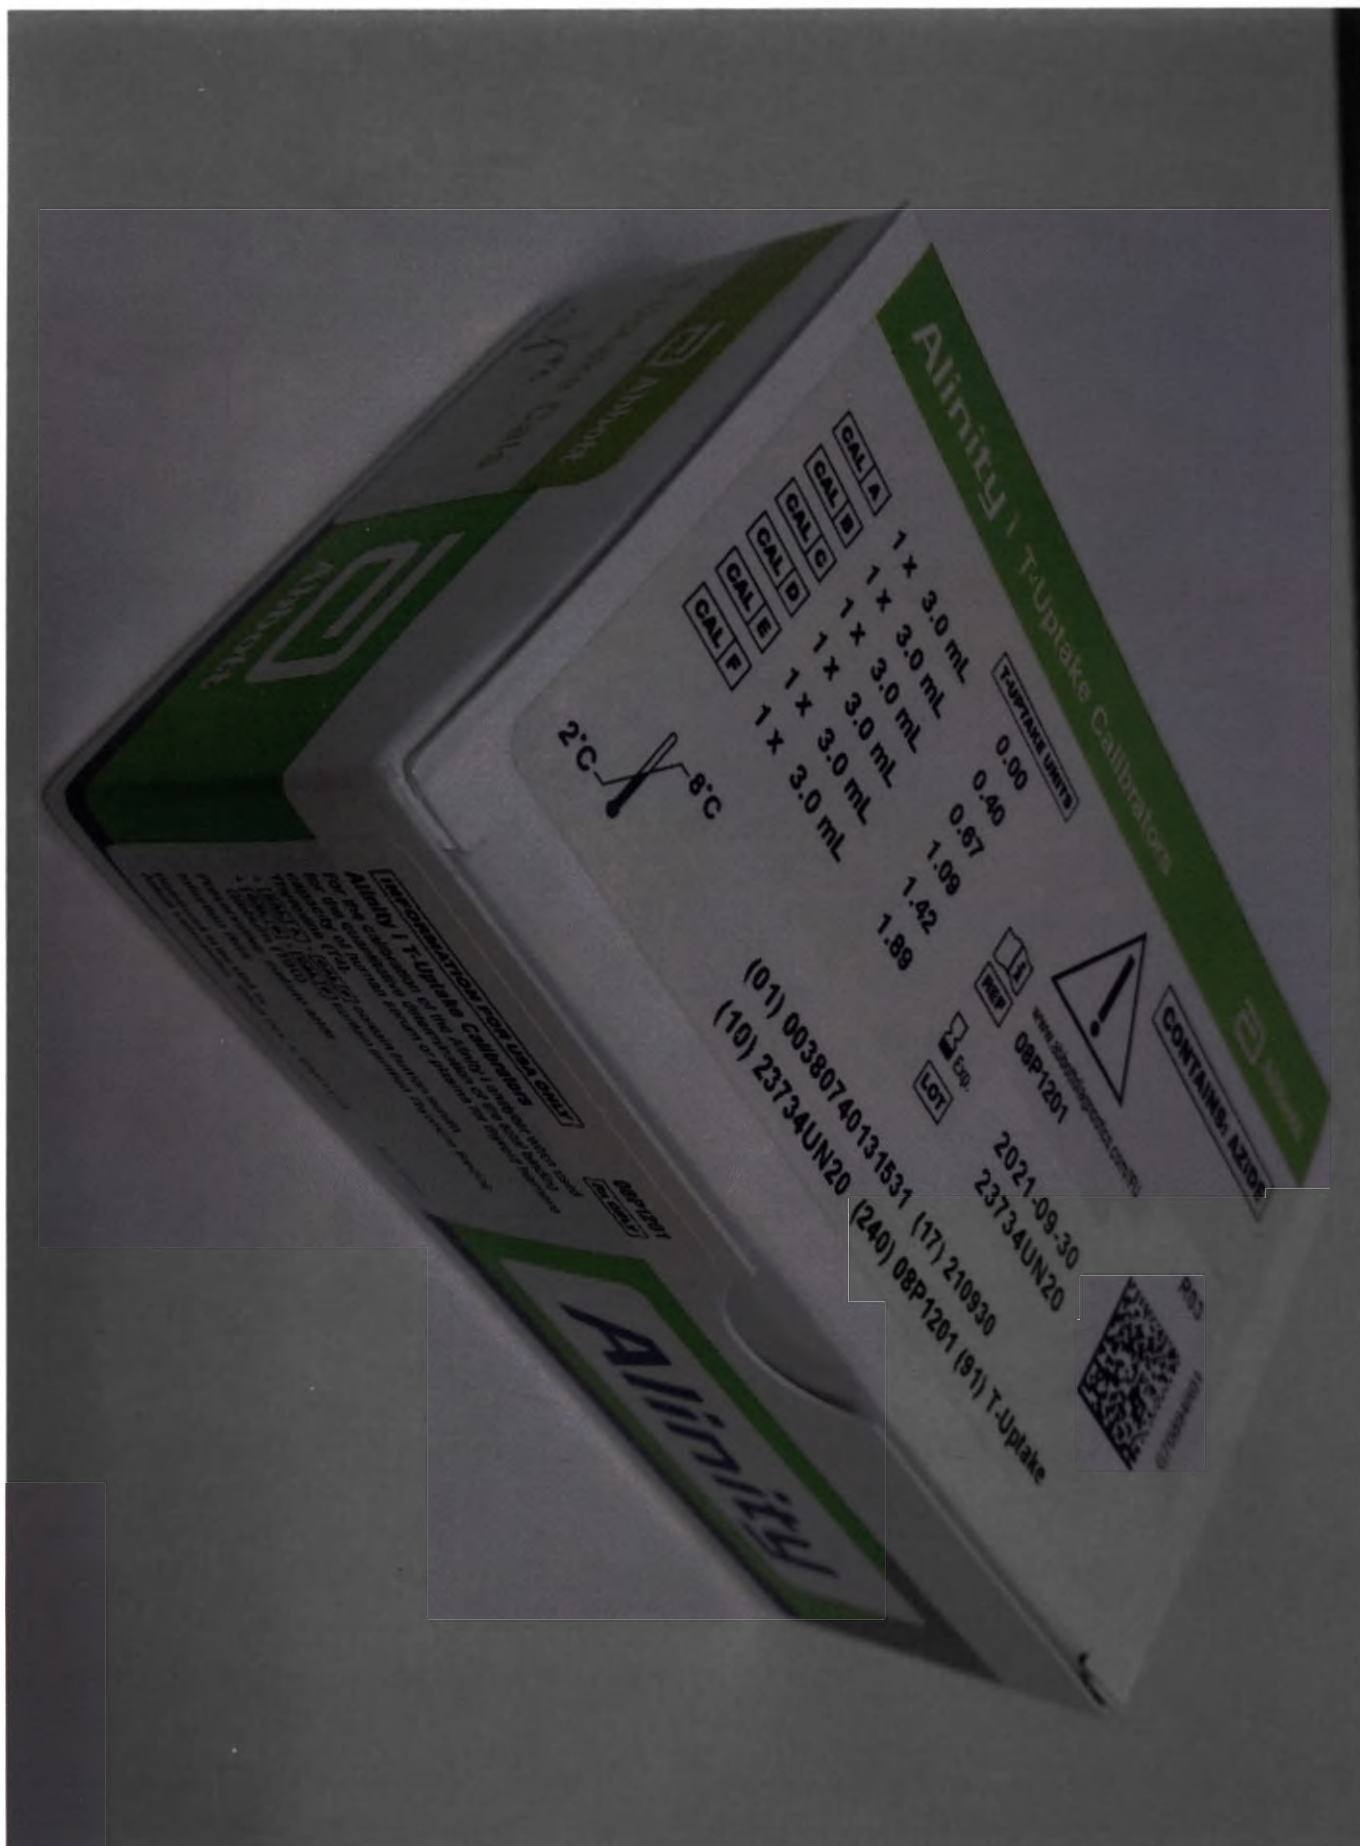

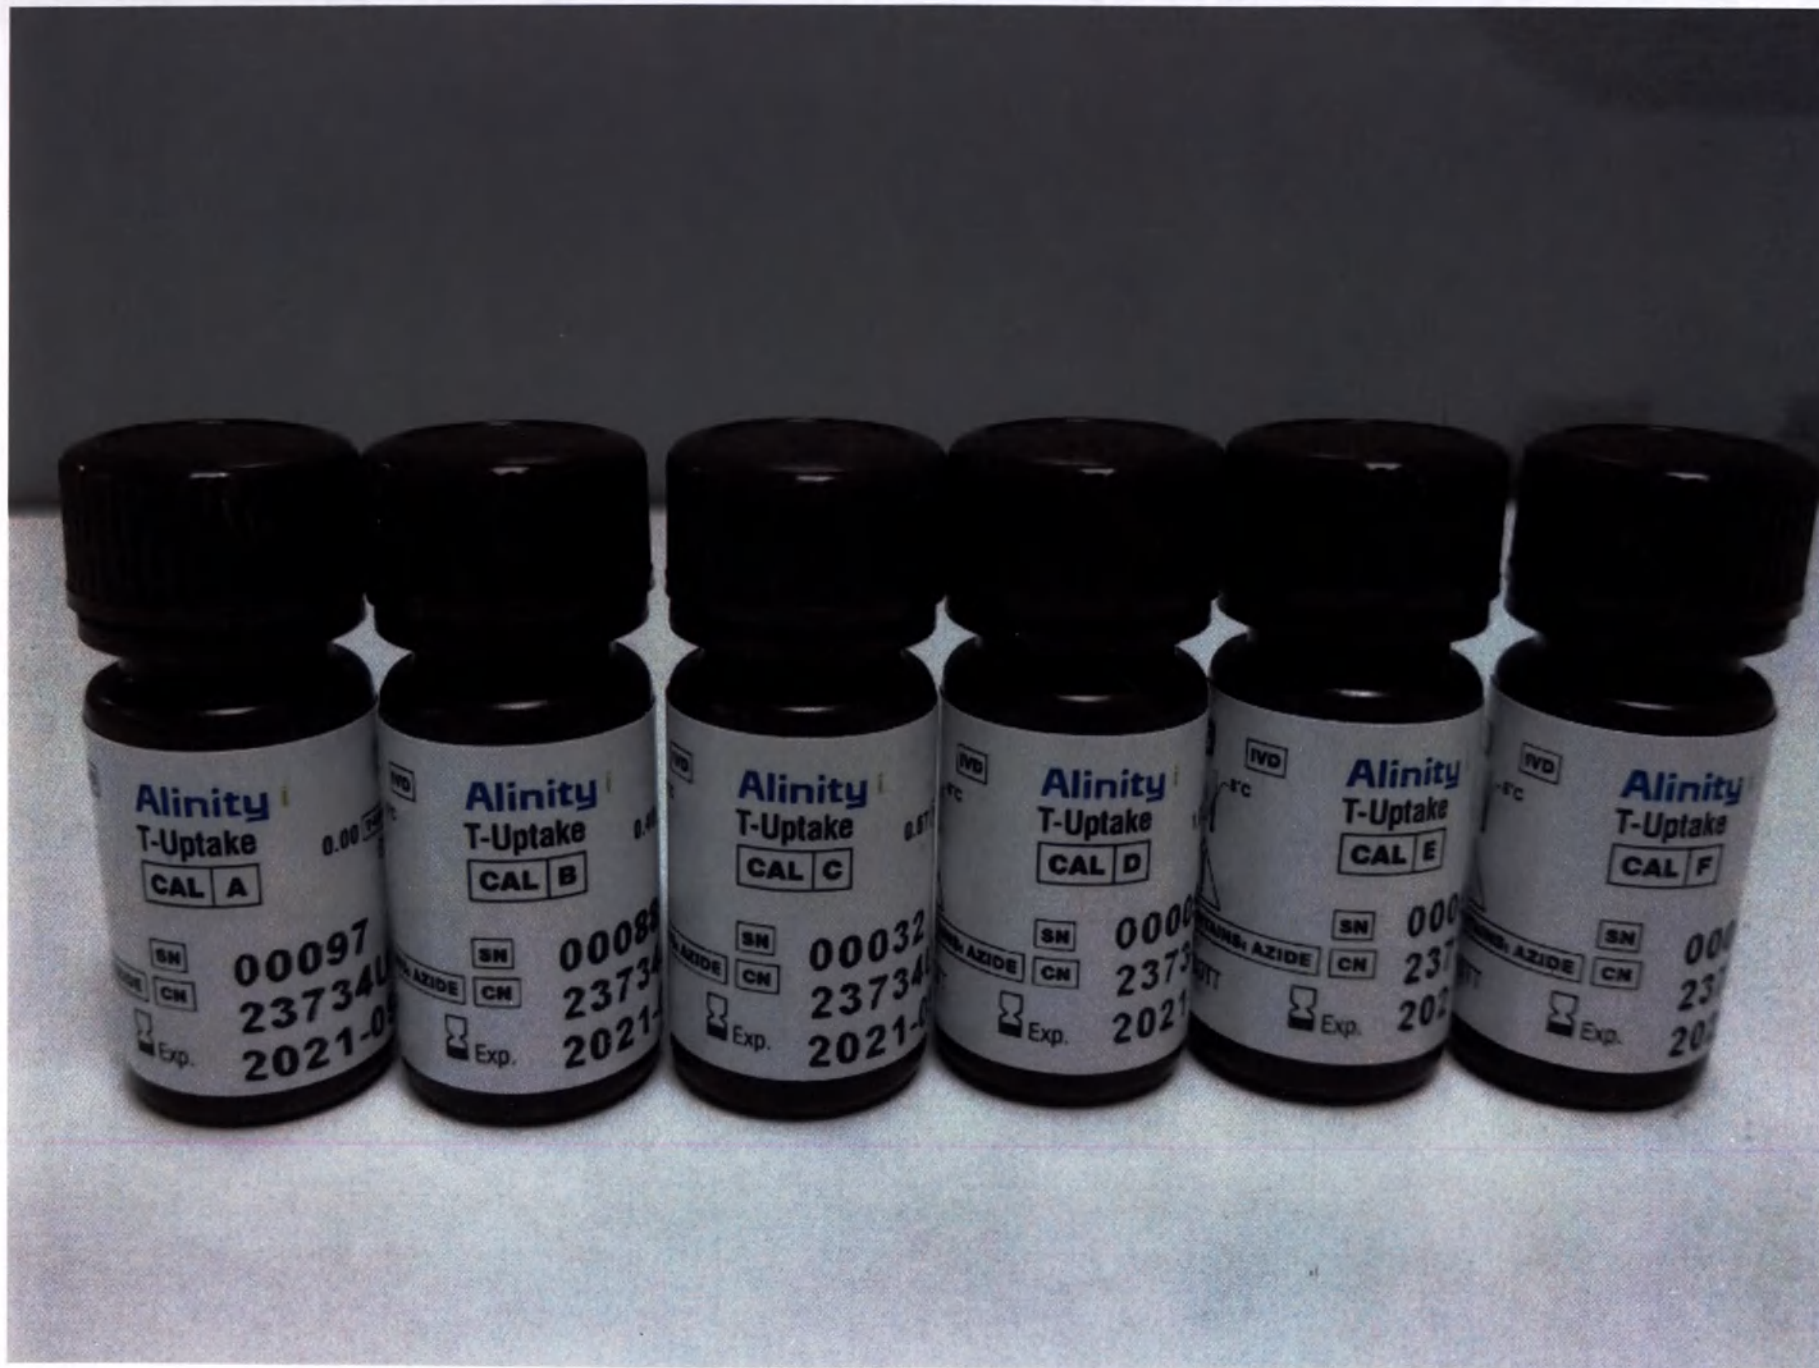

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 ЛИСТОВ



Макет маркировки на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения общей тироксин связывающей способности сыворотки или плазмы крови человека иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах Alinity i "Тироксин связывающая способность Калибраторы (Alinity i T-Uptake Calibrators)"

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Тироксин связывающая способность Калибраторы (Alinity i T-Uptake Calibrators), Кат № 08P1201



08P1201



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения общей тироксин связывающей способности сыворотки или плазмы крови человека иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах Alinity i "Тироксин связывающая способность Калибраторы (Alinity i T-Uptake Calibrators)"

в составе:

- Калибратор А (Alinity i T-Uptake CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл;
- Калибратор В (Alinity i T-Uptake CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл;
- Калибратор С (Alinity i T-Uptake CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл;
- Калибратор D (Alinity i T-Uptake CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл;
- Калибратор E (Alinity i T-Uptake CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл;
- Калибратор F (Alinity i T-Uptake CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл;

Инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Finisklin Business Park, Sligo, Ireland (Ирландия)

Место производства: Fisher Diagnostics, A Division of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike, Middletown, Virginia, 22645, USA

Страна происхождения: США

РУ № ____/____ от ____/____ / Инструкция по применению на русском языке:
www.corelaboratory.abbott/IFU

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Тироксин связывающая способность

Калибраторы (Alinity i T-Uptake Calibrators), Кат № 08P1201


Alinity i T-Uptake Calibrators



Alinity i T-Uptake Calibrators

 Abbott

T-Uptake Cals



PRODUCED FOR ABBOTT BY
Fisher Diagnostics,
A Div. of Fisher Scientific Company, LLC
A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8366 Valley Pike Middletown VA 22645 USA


PRODUCT OF USA

+353-71-9171712

G7 0894R01

08P1201
www.aboveelectronics.com/FU

08P1201



CONTAINS: AZIDE

T-UP TAKE UNITS


CAL A	1 x 3.0 mL	0.00
CAL B	1 x 3.0 mL	0.40
CAL C	1 x 3.0 mL	0.67
CAL D	1 x 3.0 mL	1.09
CAL E	1 x 3.0 mL	1.42
CAL F	1 x 3.0 mL	1.89




Макет маркировки компонентов медицинского изделия Тироксин связывающая способность

Калибраторы (Alinity i T-Uptake Calibrators), Кат № 08P1201


- Калибратор А (Alinity i T-Uptake CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл

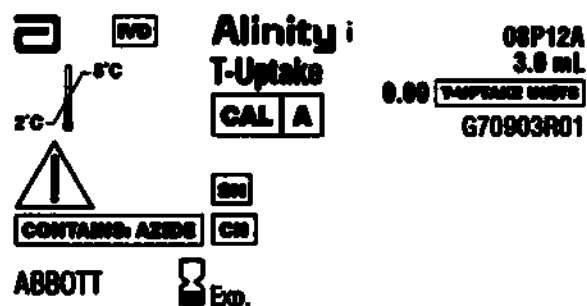


- Калибратор В (Alinity i T-Uptake CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл

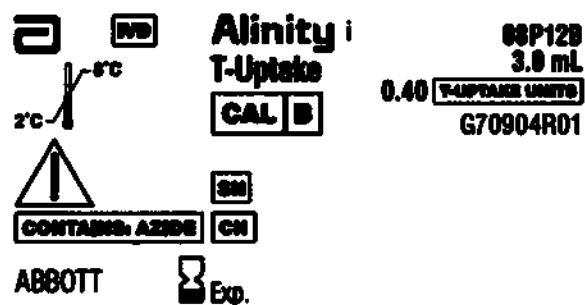


- Калибратор С (Alinity i T-Uptake CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл

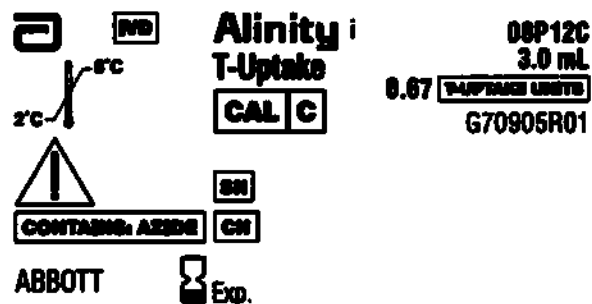


- Калибратор D (Alinity i T-Uptake CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл

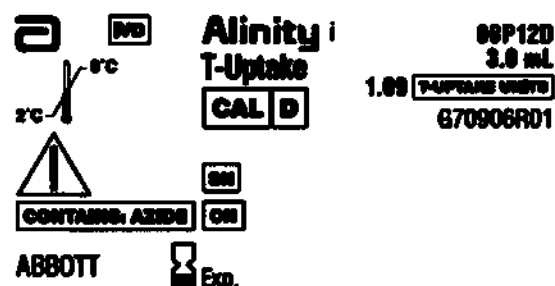

Калибратор E (Alinity i T-Uptake CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл

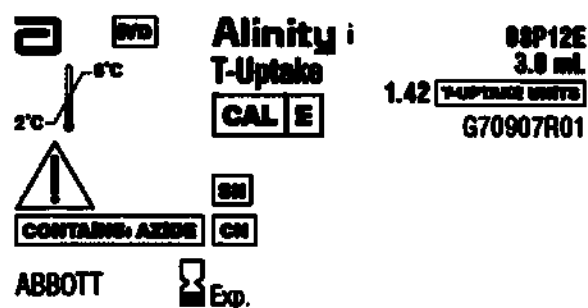

Калибратор F (Alinity i T-Uptake CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл

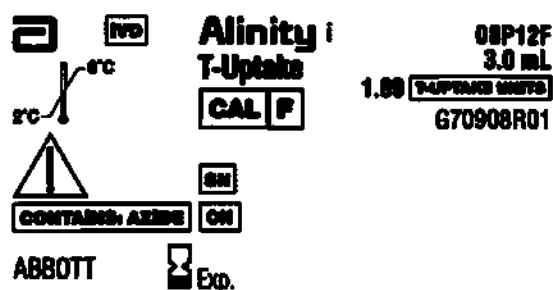

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

и скреплено печатью

5 ЛИСТОВ

Подпись _____

