

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Медтест"



Р.Г. Котченко

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия
" Индикаторы химические для контроля процессов
стерилизации, обеззараживания "СТЕРИМАГ" СТЕРИМАГ
по ТУ 32.50.50-017-53262326-2018"**

[illegible]

ПАР

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



CTBPT0001-F-10/m 120°C/45min, 132°C/20min

CYZP0001-П-10/м 120°С/49мм

'СТИРЭФЛ-П 22/м 132°C/20mm'

НАРУЖНЫЕ

Партнерства и сотрудничество
Сентябрь 2014670219
07. 2002

ENACE no TDCP ISO 11140

4

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-П-19/в 120° С/45мин, 132° С/20мин"

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



STUTTGART-4-19/44

-СТИРЕН-П-21/м 120°C/45мин-

CTEPOCAL-B-23/10 132°C/20min

500 wt 1000 wt 2000 wt

ВНУТРЕННИЕ

Получено в эксплуатацию 03.01.19
01.2023

Класс по ГОСТ 180 11140

4



[illegible]

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



СЕРГЕЕВ И ДР.

CEN 12878:2004-0-20/04

^aСРЕДНЕЕ - П - 22/м 19,2°C/200мм"

НАРУЖНЫЕ

81, 2022

Класс по ГОСТ ISO 11140



Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-П-21/в 120° С/45мин"



МЕДТЕСТ

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

...по ОКУД
по ОКТО



Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-П-22/н 132° С/20мин"



МЕДТЕСТ

ЖУРНАЛ

контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

The image shows a template for a 'MEATEST' card, which is used for recording test results. The card is divided into several sections:

- Top Section:** Contains the text 'MEATEST' in large, bold letters, followed by 'KART-REZULTAT' in smaller letters.
- Form Fields:** Below the title, there are four rectangular boxes for recording data: '1.1', '1.2', '1.3', and '1.4'.
- Table:** A large table with 10 columns and 10 rows. The columns are labeled: '№' (Number), 'Судовая' (Ship), 'Дата отбора проб' (Date of sampling), 'Дата анализа' (Date of analysis), and 'Результат анализа' (Result of analysis). The table is currently empty.
- Bottom Section:** Contains two lines for additional information: 'ПРИЛОЖЕНИЕ' (Appendix) and 'ОБЪЯСНЕНИЕ' (Explanation).

ФОРМЫ ПО ОКУД



Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-П-23/в 132° С/20мин"



MEATEST
2000 ELECTROPHORESIS SYSTEM





ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

по данным по ОКУД
сформированы по ОКПО

1998



PAR

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ

"CTEINBAG"-D-24 134°C/4

"CRYSTALL" D-25 130°C/8min

^aCTK2104AF-II-26 134°C/7min.

*CTRI99AF-2-30 171°C/15min

*CEP716AR-0-31 121°C/20min

Парчамаўтэ магістральскаму
Гудан дэ.

050219
02 7802

Класс по ГОСТ ISO 11140

17. 08.2014

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-II-25 134° С/5мин";



ЖУРНАЛ контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



СТЕРИМАГ-II-24
СТЕРИМАГ-II-25 134°С/5мин
СТЕРИМАГ-II-26 134°С/7мин
СТЕРИМАГ-II-30 121°С/3 мин
СТЕРИМАГ-II-31 121°С/20мин



02. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

4

Фотографическое изображение

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-11-2014" С/70000

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

no caso

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ

Figure 1 consists of four rows of TEM images, each showing the morphology of PS-PI block copolymer aggregates. The first column lists the copolymer composition and temperature for each row. The second column shows the corresponding TEM image. The images are labeled (a) through (d).

- (a) PS-PI-0.24 114°C / Asachi: Shows a well-defined hexagonal lattice of aggregates.
- (b) PS-PI-0.29 136°C / Sema: Shows a less ordered arrangement of aggregates.
- (c) PS-PI-0.28 134°C / Te: Shows a more disordered arrangement of aggregates.
- (d) PS-PI-0.30 121°C / Sema: Shows a highly disordered arrangement of aggregates.

Scale bars are provided for each image: 500 nm for (a), 1000 nm for (b), and 2000 nm for (c) and (d).

Портландцемент, маркированный
ГОСТ 30513-97

200119
01.702

Класс по ГОСТ ISO 11140

△




ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

«Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многосерийный «СТЕРИМАГ-П-27 134°С10мин»
ТУ 32.50.50-017-2018 «Индикатор химический для контроля процессов стерилизации, обозначения «СТЕРИМАГ» Р/У № _____ от _____
1000 шт
партия 060219, годен до 02.2023.

Класс по ГОСТ ISO 11140



Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-П-28 134° С/18мин"

МЕДТЕСТ
МЕДИЦИНСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)



ИНСТРУКЦИЯ ПИ
Индикаторы химического
стерилизации, обозначающие СТЕРИМ
Индикаторы многопереносные д
МСД-9

Настоящая инструкция распространяется
процессов стерилизации, обозначающ
53262326-2018 в следующих исполнени
– Индикатор химический для к
многопереносный "СТЕРИМА
– Индикатор химический для
многопереносный "СТЕРИМА



МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Индикатор химический — контроля процессов паровой стерилизации
материала — «СТЕРИМАГ-П-28 134°С/15 мин»
ТУ 32-80-50-017-2016 в 10 единиц массы — произведено
стерилизацией, с балластом — «СТЕРИМАГ» в РУ № _____ от _____
1000 шт
гашения 050219 гашения до 02 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

Фотографическое изображение

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-П-29 134° С/20мин"

ИНСТРУКЦИЯ П
Индикаторы химические
стерилизации, обеззараживания СТЕРИ
Индикаторы многопереносные д
МСНР
Настоящая инструкция распространяет
процессов стерилизации, обеззаражи
53262326-2018 в следующих исполнен
— Индикатор химический для
— Индикатор химический «СТЕРИМА

ИНСТРУКЦИЯ П
Индикаторы химические
стерилизации, обеззараживания СЕРИ
Индикаторы многопереносные д
МСНР
Настоящая инструкция распространяет
процессов стерилизации, обеззаражи
53262326-2018 в следующих исполне
— Индикатор химический для
— Индикатор химический "СТЕРИМА

— Индикатор химический для процессов стерилизации, обозначенный "СТЕРИМА

— Индикатор

ЖУРНАЛ контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

1 органы по ОКУД
по ОКПО

Класс по ГОСТ 180 11140










ТУ 32 50 93-017-2018 «Испытание: проверка для контроля процессов
стерилизации, обозначенных «СТЕРИМАГ» на РУ № _____
1000 шт
листинг 080219, годовая до 02.02.2023

Фотографическое изображение

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАТ -11-30 121° С/15мин'

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАТ -11-30 121° С/15мин"

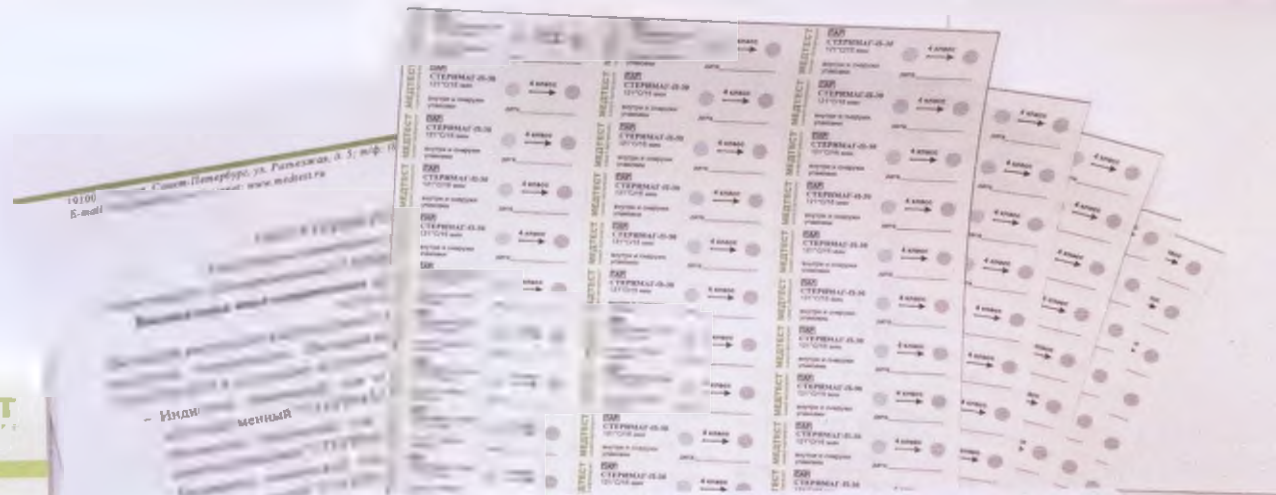

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

по ОКУД
по ОКПО

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАР

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



“C”型非接触式温度传感器-Π-24 134°C/400mm
“C”型非接触式温度传感器-Π-25 134°C/250mm
“C”型非接触式温度传感器-Π-26 134°C/75mm
C型非接触式温度传感器-Π-30 121°C/1
“C”型非接触式温度传感器-Π-31 121°C/20mm

500	1000	2000
	✓	

Parten-Duizend vóór de
Gedrukt

190113
01. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

4

Фотографическое изображение
Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-П-31 121° С/20мин"



МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

Инструкция
Индикаторы химические для
стерилизации, обозначенные СТЕРИМАГ
Индикаторы многоперемежные для
МСР 942

Настоящая инструкция распространяется на
процесс стерилизации, обозначивший
53262326-2018 и следующих исполнителей:

- Индикатор химический для кон-
многоперемежный "СТЕРИМАГ"
- Индикатор химический для кон-
многоперемежный "СТЕРИМАГ"

МЕДТЕСТ
ОБЪЕКТ - ПЕТЕРБУРГ



1000 шт
срок годности 09.02.19, годен до 02.2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

4

[illegible]

1. Вопросы к тексту



Индикатор химический для контроля процессов паровой

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

ИНСТРУКЦИЯ ПК
Индикаторы химические
стерилизации, обеззараживания СТЕРИМ
Индикаторы многоперемежные д
МСНР!

Настоящая инструкция распространяется
процессов стерилизации, обеззараж
53262326-2018 в следующих исполне
– Индикатор химический для
многоперемежный "СТЕРИМА
– Индикатор химический для
многоперемежный "СТЕРИМ

The image shows a large, multi-page document, likely a technical manual or a set of forms, laid out on a table. The document is oriented vertically and consists of many pages, some of which are visible and others are partially obscured. The visible pages contain text, diagrams, and tables. The text is in Cyrillic, suggesting it is a Russian document. The diagrams include flowcharts and tables with columns and rows. The tables have headers and data entries. The flowcharts show a sequence of steps or processes. The overall appearance is that of a professional or technical document from the mid-20th century.

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



1000 шт
ИЗДАНИЕ 110219, ГОДИН ДО 02 2023


Класс по ГОСТ ISO 11140



Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, многоперечный "СТЕРИМАГ-П-35 121° С/35мин, 126° С/20мин, 134° С/7мин



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

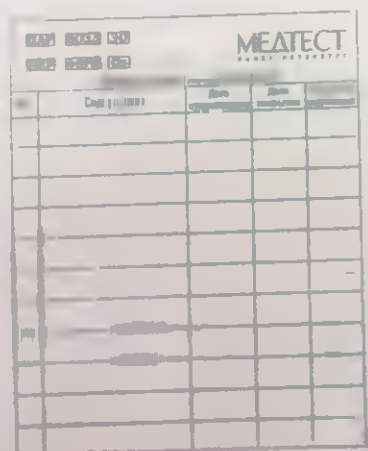

формы по ОКУД
и по ОКПО



«Инициатор полимеризации для контроля процессов полимеризации стирольных смесей «СТЕРМАГ-П-35 121С/35 мин., 128С/20 мин., 134С/7 мин.»
ТУ 32 50-50-017 2018 «Инициатор полимеризации для контроля процессов стирольных смесей «СТЕРМАГ» РУ № _____ от _____
1000 шт
серия 120219, годен до 02 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140



Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, обеззараживания, многопеременный "СТЕРИМАГ-П-36 120° С+137° С (все режимы)"

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

покрыты по ОКУД

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)
 56. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 57. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 58. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 59. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 60. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 61. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 62. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 63. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 64. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 65. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 66. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 67. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 68. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 69. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 70. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 71. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 72. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 73. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 74. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 75. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 76. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 77. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)
 78. *Chlorophyll acx* (Chl *acx*)
 79. *Chlorophyll acy* (Chl *acy*)
 80. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 81. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 82. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 83. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)
 84. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 85. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 86. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 87. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 88. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 89. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 90. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 91. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 92. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 93. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 94. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 95. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 96. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 97. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 98. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 99. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 100. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 101. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 102. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 103. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 104. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 105. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)
 106. *Chlorophyll acx* (Chl *acx*)
 107. *Chlorophyll acy* (Chl *acy*)
 108. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 109. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 110. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 111. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)
 112. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 113. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 114. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 115. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 116. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 117. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 118. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 119. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 120. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 121. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 122. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 123. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 124. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 125. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 126. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 127. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 128. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 129. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 130. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 131. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 132. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 133. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)
 134. *Chlor*

1. Россия, Санкт-Петербург, ул. Паровозная, д. 3; м/п:
2. mail@medinst.ru, Internet: www.medinst.ru

Инструкция по применению
Индикатора химической
стерилизации, обеззараживания СТЕРУ
Индикаторы многоперечисленные
МСП
Настоящая инструкция распространяется
процессов стерилизации, обеззара
53262326-2018 в следующих исполн
- Индикатор химический для
термический СТЕРИМ

[illegible]

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ




50-017-2016 «Индикаторы _____ для контроля процесса
стерилизации, с/б/заказ № _____ «СТЕРИМАГ» РУ № _____ от _____
1000 шт
партия 170219 год изд. до 02.2023

Класс по ГОСТ 150 11140

4

1788 60 570+

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, обеззараживания, интегрирующий "С ГЕРИМАГ-5П 120° С=137° С (все режимы)"

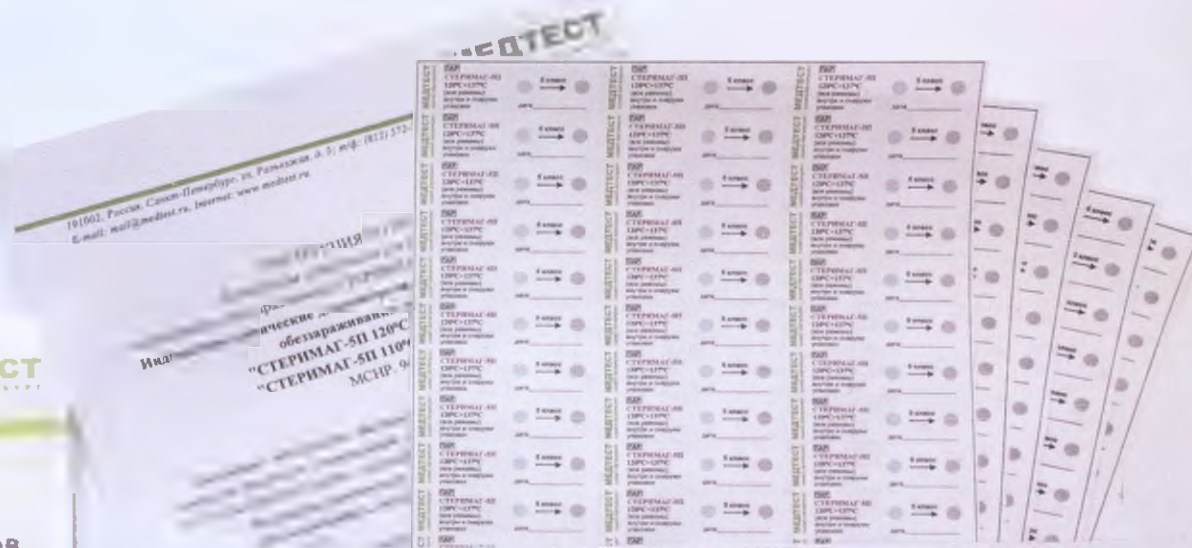

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Индикатор химический для контроля процессов
паровой стерилизации, обеззараживания,
интегрирующий «СТЕРИМАГ-5П 120°С-137°С (все режимы)»
ТУ 32 50-50-017-2010 «Индикаторы химические для контроля
стерилизации, обеззараживания «СТЕРИМАГ» в РУН» _____ от _____
1000 шт
партия 180218 серия до 02.2023


Класс по ГОСТ ISO 11140

5

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации, обеззараживания, интегрирующий "СТЕРИМАГ-5П 110° С+137° С (все режимы)"



ЖУРНАЛ контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

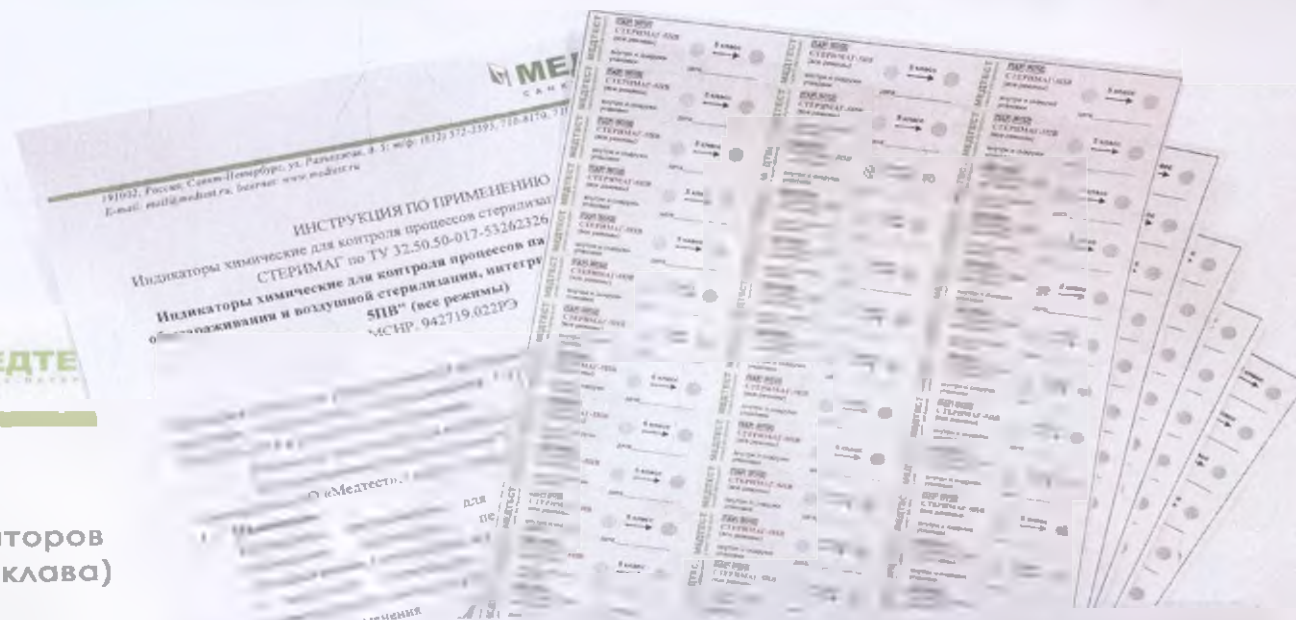

Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации, многопереходный "СТЕРИМАГ-В-01 160° С±200° С (все режимы)"



МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)



№ 10
04.10.2018

МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



«Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации
многопереходный "СТЕРИМАГ-В-01 160°С-200°С (все режимы)"
ТУ 32.50.60-017-2018 «Индикаторы химические для контроля процессов
стерилизации»
1000 шт
серия 210119 год изд. 01 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140



4



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

ВОЗД

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУШНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ^a "CYEP990A1"-B-CB/ш 180°C/60min".

"CHESTNUT" B-04/H 180°C/30min

-CTEP400J-S-06/H 150°C/45sec¹²

^aCTK1994AL-B-02/m 140°C/15C/min

^aCTEP996AF-B-10/m 200°C/30min.

Получено 12.01.2010 г.

230119
01. 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140

Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации, многоперемный "СТЕРИМАГ-В-03/в 160° С/150мин



медленного стерилизации, минимальное время $t_{180^\circ} = 180^\circ \text{ C}/30 \text{ мин}$.

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

по ОКУД
разделение по ОКПО

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

[возд]

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУШНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



"CTE2900G-B-02/M 150°C/40mm"
 "CTE2900G-B-04/M 150°C/30mm"
 "CTE2900G-B-06/M 150°C/45mm"
 "CTE2900G-B-02/M 160°C/150mm"
 "CTE2900G-B-10/M 200°C/30mm"

500 MW	1000 MW	2000 MW
	✓	

24 0 119
01. 2023

ПЕРУНИНАТА ПЕРИОДИЧНО
ГОДИШНО


24 8 11 9
01. 202

Класс по ГОСТ ISO 11140

4



Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации, многопеременный СТЕРИМАТ -В-05/в 180° С/30мин

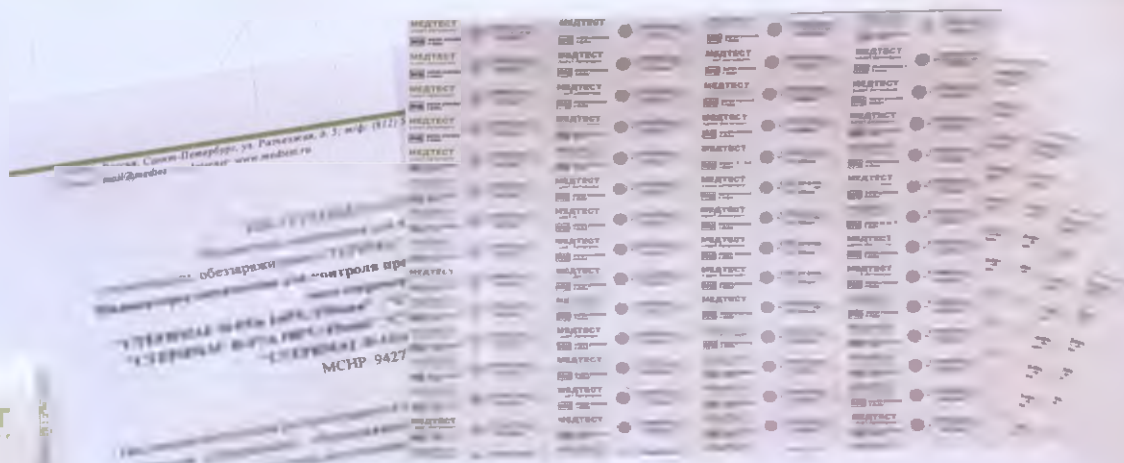

ЖУРНАЛ контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

[illegible]


на форми по ОКД
на уредбама по ОКН



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

reproduced with no other

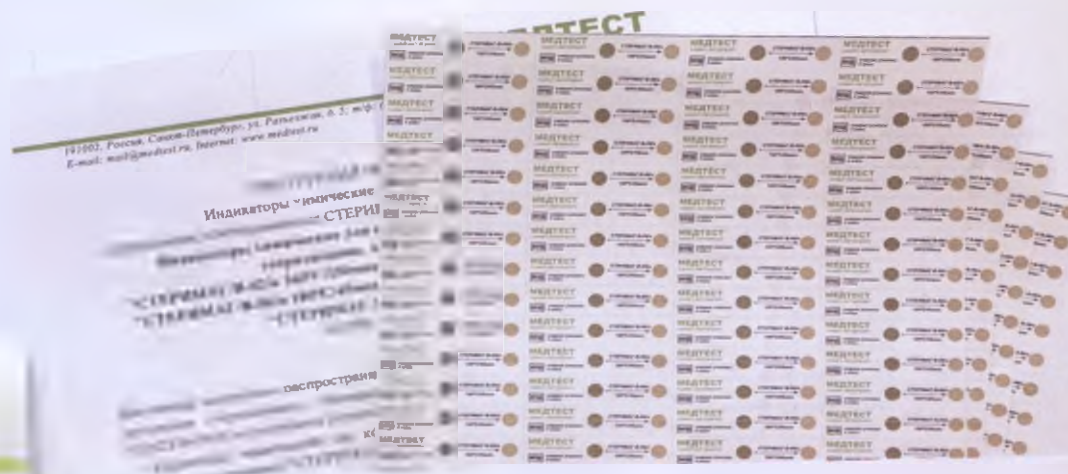

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУШНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



"СТАНДАРТ-В-08/88"

"СТЕРИЛИЗ-В-04/м 180°C/10min"

"CTEP790AF-B-08/m 190°C/4Baron"

"SECRET"-8-02/11

—CH₃COOH- γ -H-10/4 200°C/30min

Класс по ГОСТ ISO 11140

4

260119
01. 202

[illegible]

Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАТ -В-07/в 180° (180мин)

191002, Парма, Усаев-Строитель, ул. Первостроит, д. 3; моб.
E-mail: mail@medstat.ru, Internet: www.medstat.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО
Индикаторы химические
стерилизации, обеззараживания СЕРИЗ
Индикаторы химические для контроля
многочисленных
"СТЕРИМАГ-В-03/в 160°С/150мин"
"СТЕРИМАГ-В-07/в 180°С/45мин"
"СТЕРИМАГ-В-08/в 180°С/45мин"
МСИР

МЕДТЕСТ
ОБЪЕКТИВНОСТЬ

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

[illegible]

Под форматы ОКУД
Под приложения по ОКУД

Downloaded from <http://ajph.org/> by guest on June 11, 2016

МЕДТЕСТ®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОЗД

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУШНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



150°C / 50mmHg

СТАНДАРТ № 03/в 160°C/150mm²
СТАНДАРТ № 11/в 200°C/30mm²

Downloaded from www.worldscientific.com
by user on 06/11/16. For personal use only.

27 01 19
01 2023

Класс по ГОСТ ISO 11140





ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)



ВОЗД

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУШНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



CTEPMOBF-B-08/m 180°C/60min
CTEPMOBF-B-04/m
CTEPMOBF-B-06/1s 180°C/45min
CTEPMOBF-B-0°/- 180°C/15min
CTEPMOBF-B-10/m 200°C/30min

110219
07. 2023

Классификация по ГОСТ 190 11140

4

doi:10.1017/S0022292412001607

[illegible]

ВОЗД



Класс по ГОСТ ISO 11140

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУШНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ. МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ



100 mm 1000 mm 1000 mm

-CTP1000LJ-B-08/a 180°C/60mm²

«СТЕПАНОВ-В-04/2

“[1993] 2 All E.R. 929, 934 (Q.B.)”

708-960-0000

_____ mm × _____ mm / 30°C / 30mm

Page 1000
Page 1001

200219
02, 2002

Класс по ГОСТ 180 11140

4



Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации, многопеременный "СТЕРИМАГ-В-11/в 200° С/30 мин"



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100									
MEATECT SAFETY EQUIPMENT COMPONENTS 1. 1/2" x 1/2" x 1/2" 2. 1/2" x 1/2" x 1/2" 3. 1/2" x 1/2" x 1/2" 4. 1/2" x 1/2" x 1/2" 5. 1/2" x 1/2" x 1/2" 6. 1/2" x 1/2" x 1/2" 7. 1/2" x 1/2" x 1/2" 8. 1/2" x 1/2" x 1/2" 9. 1/2" x 1/2" x 1/2" 10. 1/2" x 1/2" x 1/2" 11. 1/2" x 1/2" x 1/2" 12. 1/2" x 1/2" x 1/2" 13. 1/2" x 1/2" x 1/2" 14. 1/2" x 1/2" x 1/2" 15. 1/2" x 1/2" x 1/2" 16. 1/2" x 1/2" x 1/2" 17. 1/2" x 1/2" x 1/2" 18. 1/2" x 1/2" x 1/2" 19. 1/2" x 1/2" x 1/2" 20. 1/2" x 1/2" x 1/2" 21. 1/2" x 1/2" x 1/2" 22. 1/2" x 1/2" x 1/2" 23. 1/2" x 1/2" x 1/2" 24. 1/2" x 1/2" x 1/2" 25. 1/2" x 1/2" x 1/2" 26. 1/2" x 1/2" x 1/2" 27. 1/2" x 1/2" x 1/2" 28. 1/2" x 1/2" x 1/2" 29. 1/2" x 1/2" x 1/2" 30. 1/2" x 1/2" x 1/2" 31. 1/2" x 1/2" x 1/2" 32. 1/2" x 1/2" x 1/2" 33. 1/2" x 1/2" x 1/2" 34. 1/2" x 1/2" x 1/2" 35. 1/2" x 1/2" x 1/2" 36. 1/2" x 1/2" x 1/2" 37. 1/2" x 1/2" x 1/2" 38. 1/2" x 1/2" x 1/2" 39. 1/2" x 1/2" x 1/2" 40. 1/2" x 1/2" x 1/2" 41. 1/2" x 1/2" x 1/2" 42. 1/2" x 1/2" x 1/2" 43. 1/2" x 1/2" x 1/2" 44. 1/2" x 1/2" x 1/2" 45. 1/2" x 1/2" x 1/2" 46. 1/2" x 1/2" x 1/2" 47. 1/2" x 1/2" x 1/2" 48. 1/2" x 1/2" x 1/2" 49. 1/2" x 1/2" x 1/2" 50. 1/2" x 1/2" x 1/2" 51. 1/2" x 1/2" x 1/2" 52. 1/2" x 1/2" x 1/2" 53. 1/2" x 1/2" x 1/2" 54. 1/2" x 1/2" x 1/2" 55. 1/2" x 1/2" x 1/2" 56. 1/2" x 1/2" x 1/2" 57. 1/2" x 1/2" x 1/2" 58. 1/2" x 1/2" x 1/2" 59. 1/2" x 1/2" x 1/2" 60. 1/2" x 1/2" x 1/2" 61. 1/2" x 1/2" x 1/2" 62. 1/2" x 1/2" x 1/2" 63. 1/2" x 1/2" x 1/2" 64. 1/2" x 1/2" x 1/2" 65. 1/2" x 1/2" x 1/2" 66. 1/2" x 1/2" x 1/2" 67. 1/2" x 1/2" x 1/2" 68. 1/2" x 1/2" x 1/2" 69. 1/2" x 1/2" x 1/2" 70. 1/2" x 1/2" x 1/2" 71. 1/2" x 1/2" x 1/2" 72. 1/2" x 1/2" x 1/2" 73. 1/2" x 1/2" x 1/2" 74. 1/2" x 1/2" x 1/2" 75. 1/2" x 1/2" x 1/2" 76. 1/2" x 1/2" x 1/2" 77. 1/2" x 1/2" x 1/2" 78. 1/2" x 1/2" x 1/2" 79. 1/2" x 1/2" x 1/2" 80. 1/2" x 1/2" x 1/2" 81. 1/2" x 1/2" x 1/2" 82. 1/2" x 1/2" x 1/2" 83. 1/2" x 1/2" x 1/2" 84. 1/2" x 1/2" x 1/2" 85. 1/2" x 1/2" x 1/2" 86. 1/2" x 1/2" x 1/2" 87. 1/2" x 1/2" x 1/2" 88. 1/2" x 1/2" x 1/2" 89. 1/2" x 1/2" x 1/2" 90. 1/2" x 1/2" x 1/2" 91. 1/2" x 1/2" x 1/2" 92. 1/2" x 1/2" x 1/2" 93. 1/2" x 1/2" x 1/2" 94. 1/2" x 1/2" x 1/2" 95. 1/2" x 1/2" x 1/2" 96. 1/2" x 1/2" x 1/2" 97. 1/2" x 1/2" x 1/2" 98. 1/2" x 1/2" x 1/2" 99. 1/2" x 1/2" x 1/2" 100. 1/2" x 1/2" x 1/2"																																																																																																			

1. (TWO) TWO TWO TWO TWO

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.



ВОЗД]

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДУШНОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, МНОГОПЕРЕМЕННЫЙ

^aCTE (ppm/°C) = 0.9/μm 180°C/60min.

~C7H4F6O2Cl~ B-06/w 180°C/30min

- (THERMAL) 07/01 120°C/40min

"СТРУКТУРА-В-03/м"

"СТЕРИЛИЗ-В-11/с 200°C/30min"

[illegible]

210218
02. 202

Класс по ГОСТ ИСО 11140



Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации, интегрирующий "СТЕРИМАГ-5В 160° С 30 мин С (СРМ-М)



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)


[illegible]

«Индикатор химический для контроля
явственно-кислотной среды (СЕРИЯ АГ-5В 100°C-200°C) (все диапазоны)
ТУ 32 50 50-17-2010 «Индикаторы химические для контроля процессов
стерилизации оборудования (СЕРИЯ АГ)» РУ № ... от _____
1000 шт.


Класс по ГОСТ ISO 11140

5

Вид отдельного индикатора, индикатора на листе и в рулоне

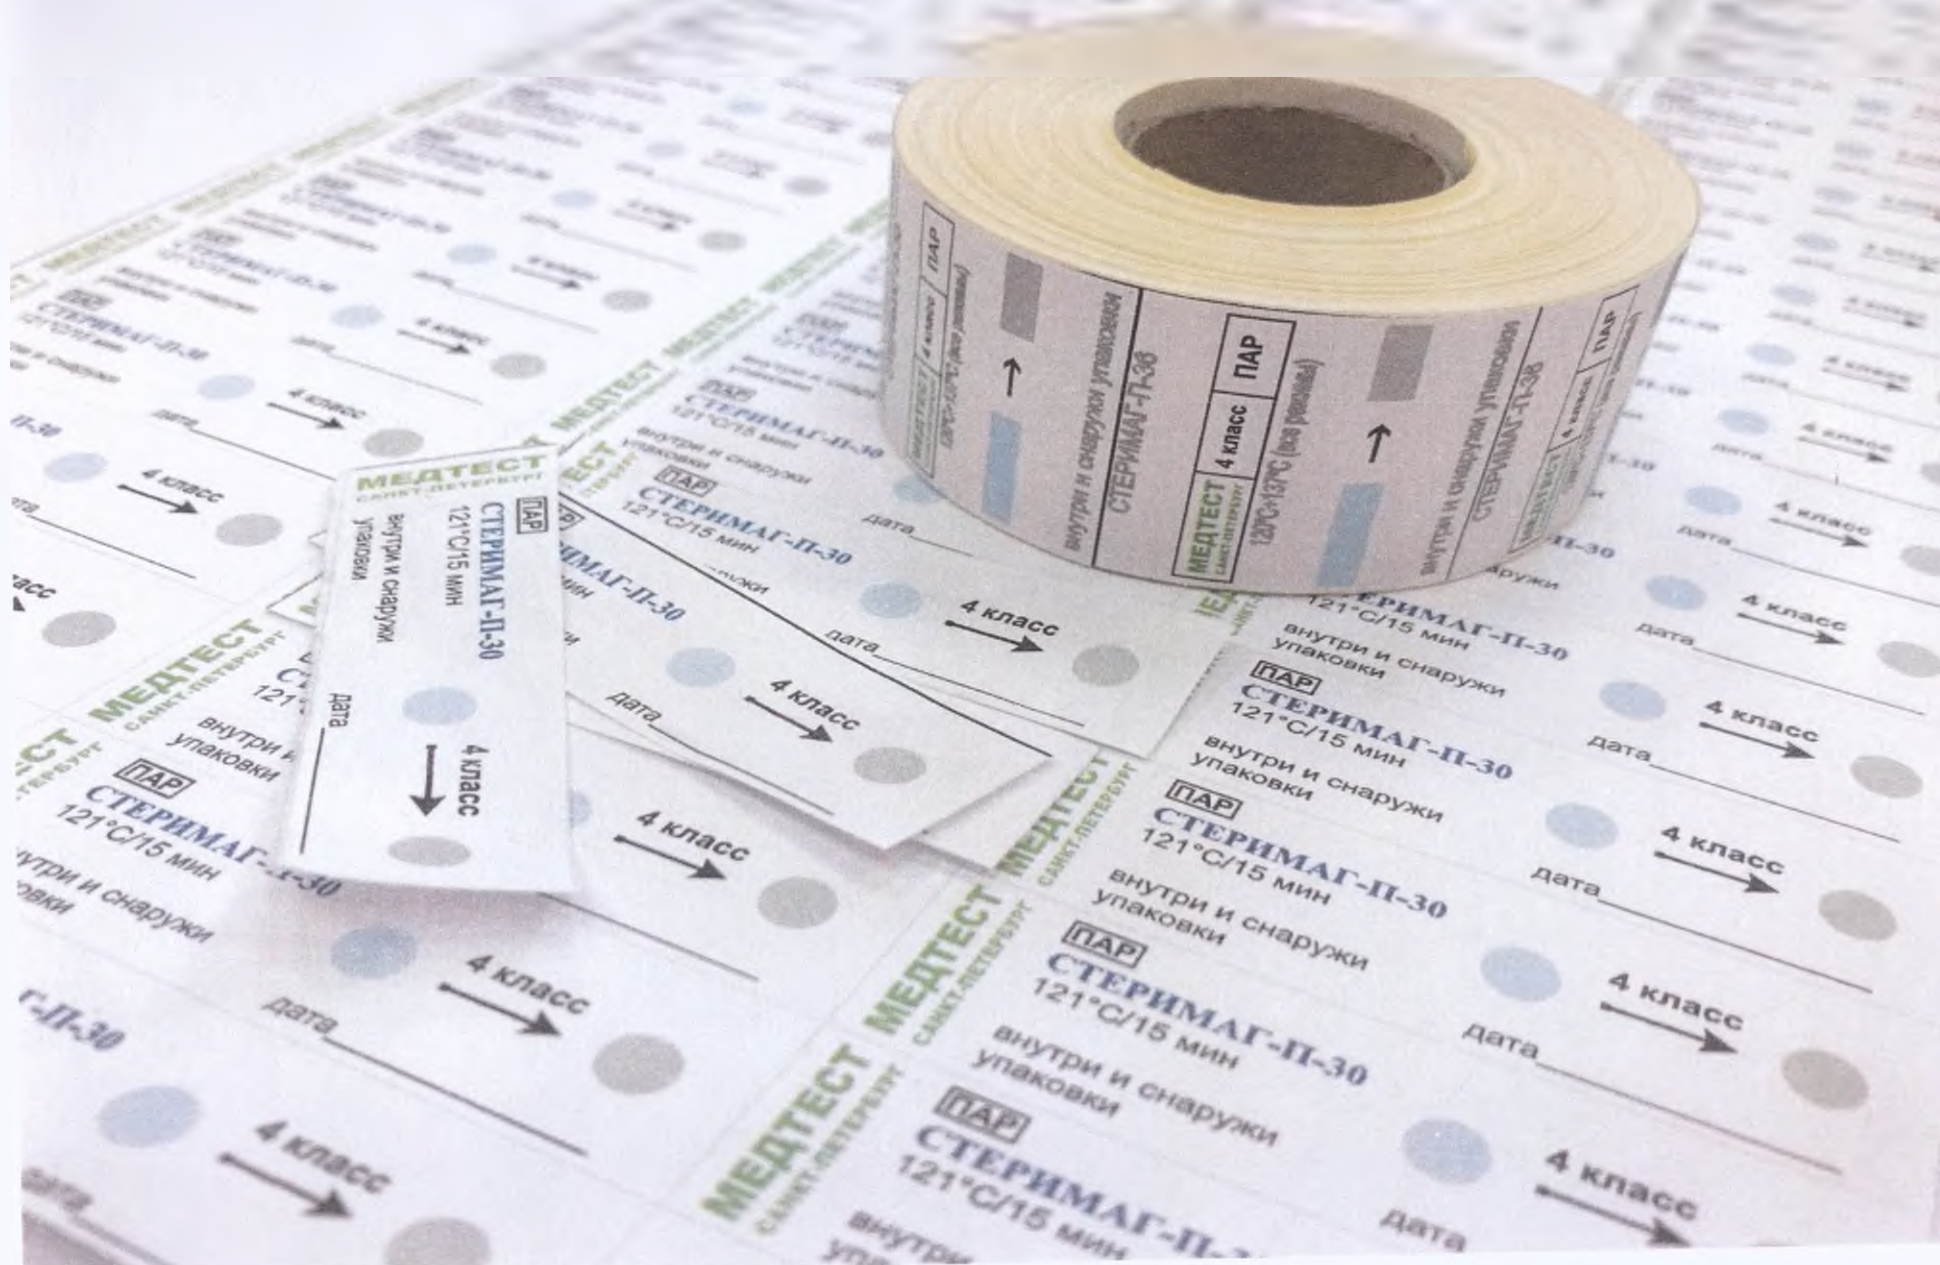

Индикатор химический для контроля полноты удаления воздуха из трубчатой загрузки "СТЕРИМАГ-Т-01 134°С/3,5 мин"

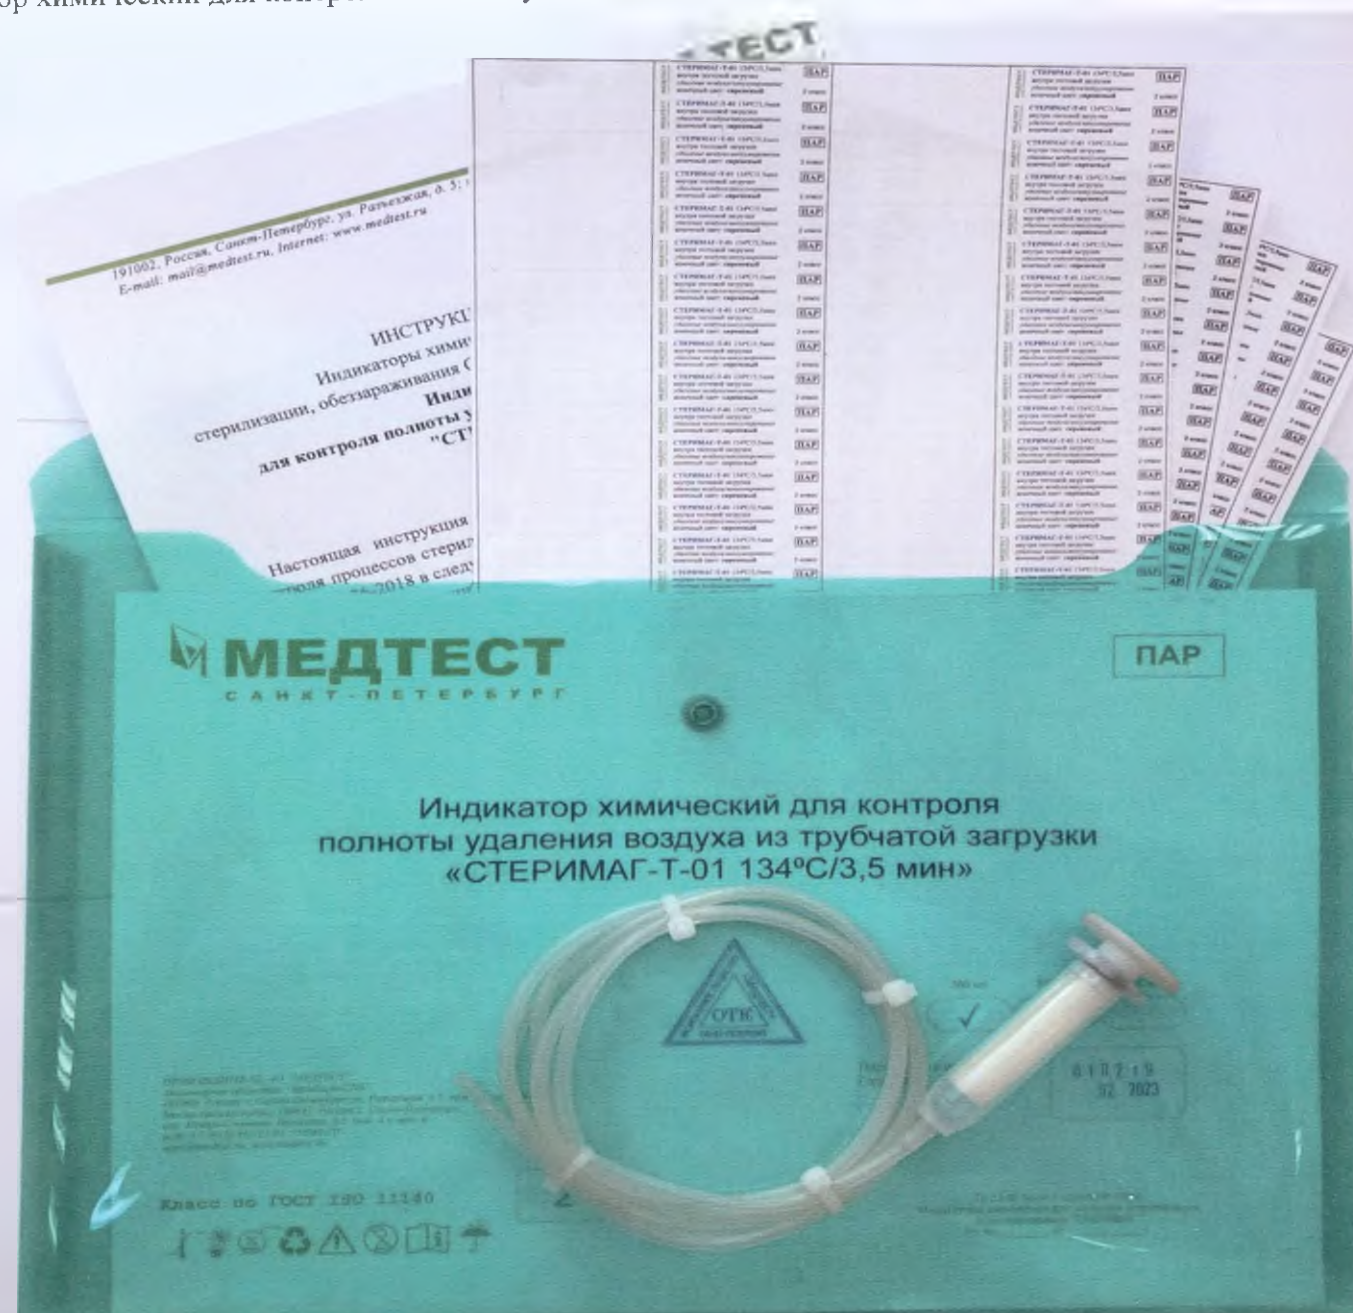


Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации "СТЕРИМАГ-ШП



Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации "СТЕРИМАГ-ШВ"




Индикатор химический для контроля процессов паровой и воздушной стерилизации "СТЕРИМАГ-ШПВ

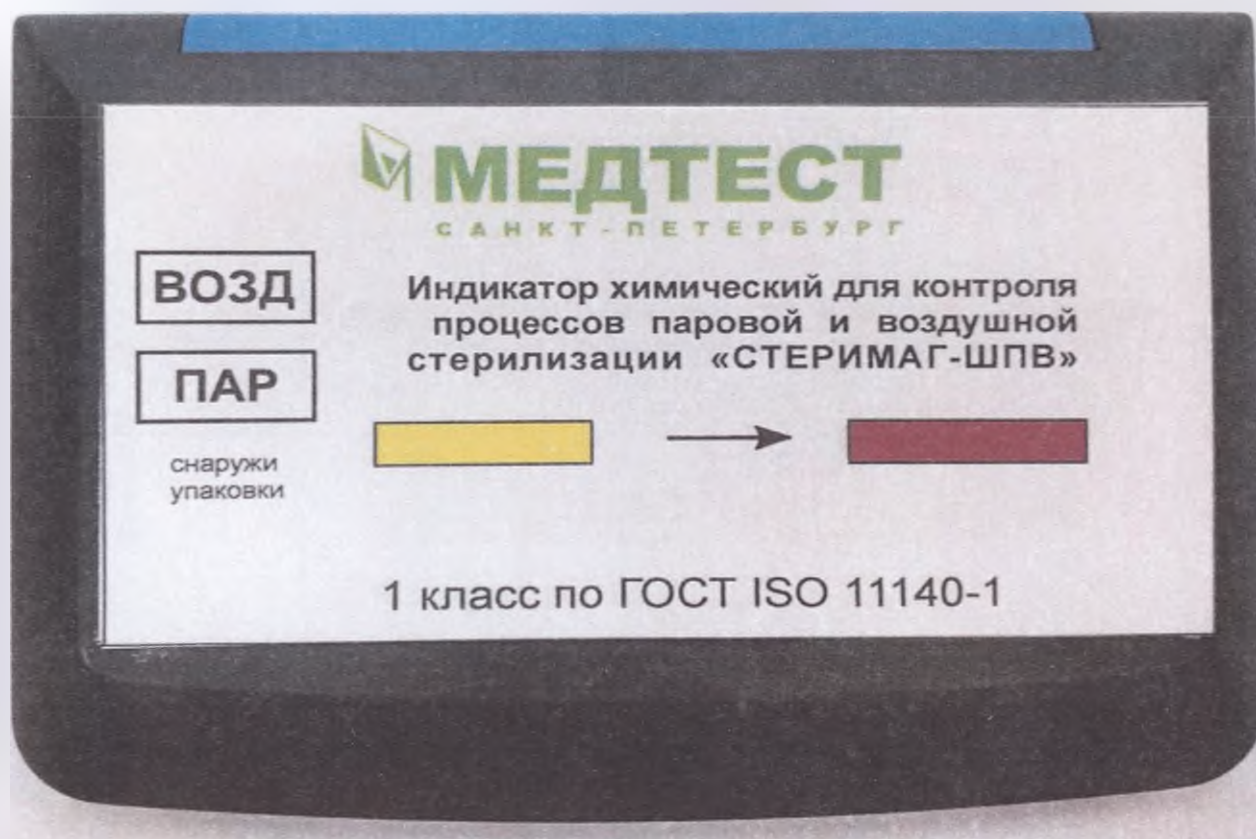

Вид индикатора химического для контроля процессов паровой стерилизации "СТЕРИМАГ-ШП" в потребительской упаковке

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации «СТЕРИМАГ-ШП» по ТУ 32.32.50-017-53262326-2018 «Индикаторы химические для контроля процессов стерилизации, обеззараживания "СТЕРИМАГ"			
Регистрационное удостоверение	РЗН _____	Количество в упаковке, шт.	1
Назначение	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса стерилизации		
	Акционерное общество «Медтест-СНП» (АО «Медтест-СНП») 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д.5 лит.А, пом.34Н-В т/ф: +7 (812) 572-23-95, mail@medtest.ru, www.medtest.ru Место производства: 196642, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Промзона, д.2, лит. А и лит. Б		
Методы стерилизации	ПАР		LOT 020119
Кодированное обозначение	СТЕРИМАГ-ШП		 01.2019
			 01.2020
Хранение и эксплуатация	     		


Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации "СТЕРИМАГ-МП"

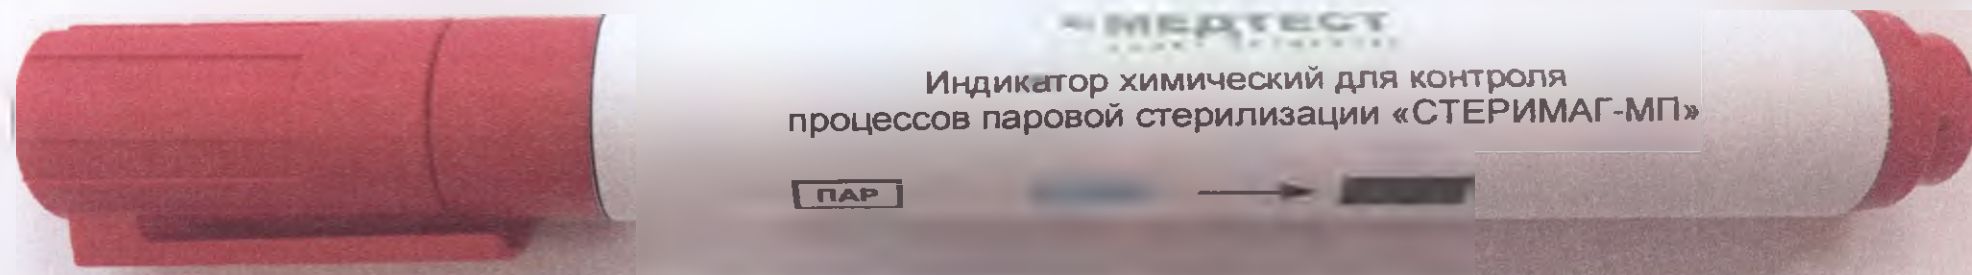


Индикатор химический для контроля
процессов паровой стерилизации «СТЕРИМАГ-МП»

ПАР


Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации "СТЕРИМАГ-МВ

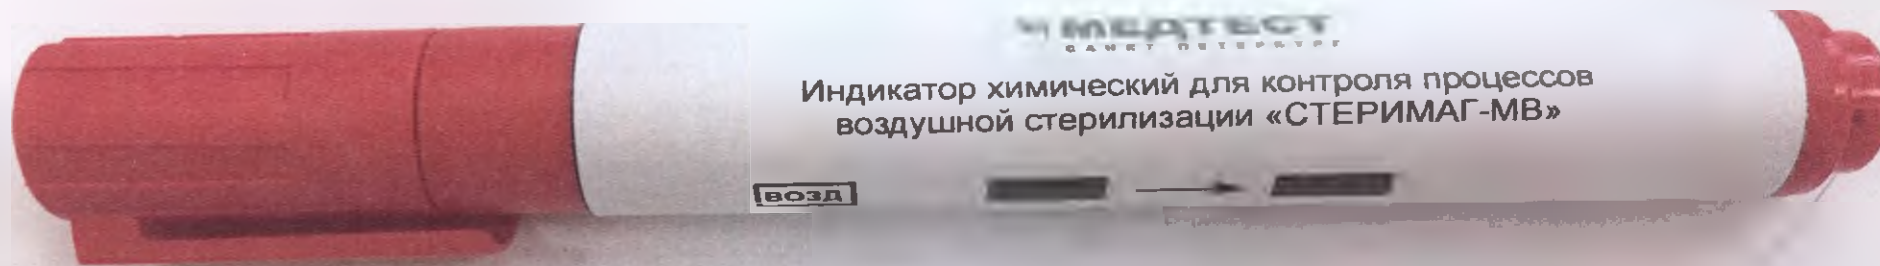

Индикатор химический для контроля процессов паровой и воздушной стерилизации "СТЕРИМАГ-МПВ

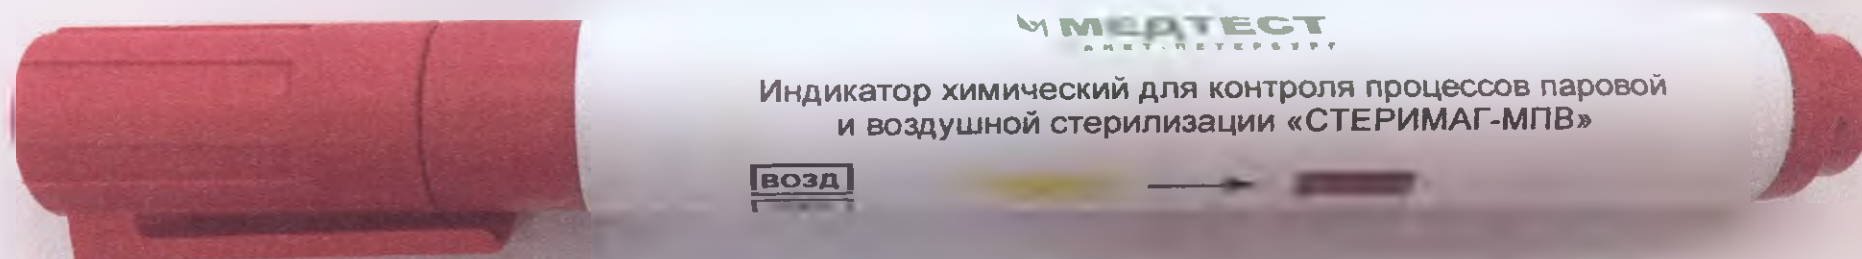

Вид индикатора химического для контроля процессов воздушной стерилизации "СТЕРИМАГ"-МВ в потребительской упаковке

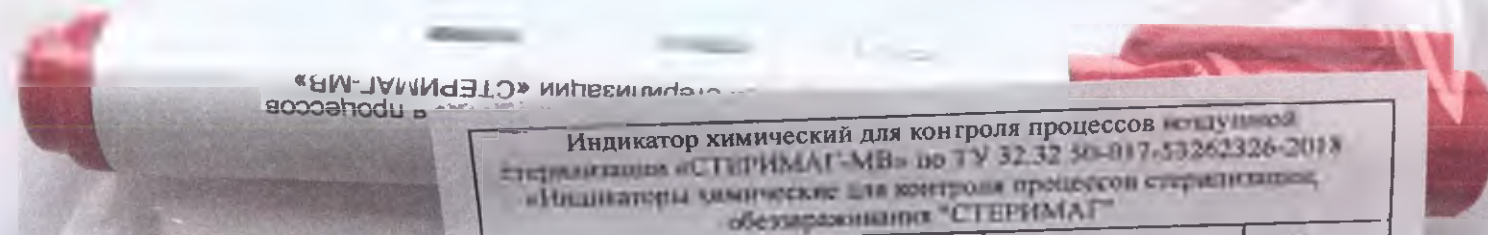

5; т/ф: (812) 572

[ПО ПРИМ

Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации «СТЕРИМАГ-МВ» по ТУ 32.32 50-817-53262326-2018 «Индикатор химический для контроля процессов стерилизации, обозначения "СТЕРИМАГ"»			
Регистрационное удостоверение	РЗН / от	Количество в упаковке, шт.	1
Назначение	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса стерилизации		
	Акционерное общество «Медтест-СПб» (АО «Медтест») 191002 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д.5, лит.А, пом.34П-В т/ф: +7 (812) 572-23-95, mail@medtest.ru, www.medtest.ru Место производства: 196642, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Промзона, д.2, лит. А и лит. Б		
Методы стерилизации	возд	LOT	010219
Кодированное обозначение	СТЕРИМАГ-МВ		02.2019
			02.2022
Хранение и эксплуатация	     		

Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации "СТЕРИМАГ-Ф11"



Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации "СТЕРИМАТ-ФВ"


МЕДТЕСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Индикатор химический для контроля
процессов воздушной
стерилизации «СТЕРИМАТ-ФВ»



класс по ГОСТ ISO 11140-1

Индикатор химический для контроля процессов паровой и воздушной стерилизации «СТЕРИМЭД-ФИН»

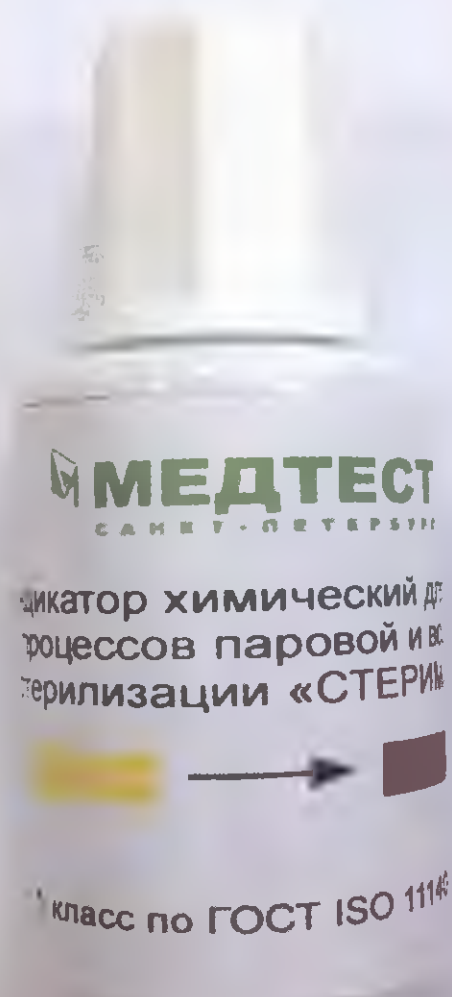

Вид индикатора химического для контроля процессов паровой и воздушной стерилизации "СТЕРИМАГ-ФПВ" в картонной упаковке

Индикатор химический для контроля процессов паровой и воздушной стерилизации «СТЕРИМАГ-ФПВ» № ТУ 32.32.50-017-53262326-2018 «Индикаторы химические для контроля процесса стерилизации, обозначения "СТЕРИМАГ"		
Регистрационное удостоверение	РЭН _____	Количество в упаковке 1
Назначение	Индикаторы предназначены для контроля эффективности визуального контроля обесцвечивания химических переменных процесса стерилизации	
	Адрес производства: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рокитная, д. 5, лит. А, пом. 34П-0 Место производства: 190642, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Промышленный д. 2, лит. А и лит. Б	
Методы стерилизации	☐ ДА ☐ НЕТ	LOT 010219
Кодированное обозначение	СТЕРИМАГ-ФПВ	
Хранение и эксплуатация	      	

5; т/ф: (81

ПО ПРИ

Фотографическое изображение
Вид потребительской упаковки индикаторов в листах

 **МЕДТЕСТ®**
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Индикатор химический для контроля процессов
паровой стерилизации, обеззараживания,
интегрирующий «СТЕРИМАГ-5П 120°C-137°C (все режимы)»
ТУ 32.50.50-017-2018 «Индикаторы химические для контроля
стерилизации, обеззараживания «СТЕРИМАГ»» РУ № ____ от ____
1000 шт
партия 160219, годен до 02.2023

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО «МЕДТЕСТ»
общество с ограниченной ответственностью
191002 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гавришова, д. 2, лит. А, пом. 34Н-Н
196642, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Петро-Гавришова, Пром. зона, д. 2, лит. А и лит. Б
т. ф. +7 (812) 572-23-95, *10-41-70
mailto:info@medtest.ru www.medtest.ru

Класс по ГОСТ ISO 11140

5



Пронумеровано и прошнуровано

Листа/ов

Ген. директор

Р.Г. Котченко

