

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ЛИДКОР»

А.И. Улыбин

2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия

**«Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в тёплом виде крови,
компонентов крови, препаратов крови и инфузионных растворов «Leadmelt» 1»
по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020**

Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в тёплом виде крови, компонентов крови, препаратов крови и инфузионных растворов «Leadmelt» 1



Маркировка изделия



Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения
в тёплом виде крови, компонентов крови, препаратов крови
и инфузионных растворов «Leadmelt» 1
по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020
РУ

Наименование и юридический адрес изготовителя:
ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204.
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Питание: ~ 220 В ±10 %, 50 Гц, Рном = 1500 Вт

Заводской
номер

0001

Дата
выпуска

01.2020


~ 220 В, 50 Гц

Предохранитель:
5x20, F8H250V





Аппарат для быстрого размораживания, подогрева
и хранения в тёплом виде крови, компонентов крови,
препаратов крови и инфузионных растворов «Leadmelt» 1
по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020



Наименование и юридический адрес изготовителя:

**ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204. mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru**

Масса брутто: _____ кг

Заводской
номер

0001


Дата
выпуска

2020.01

Шнур электропитания сетевой



Трубка для слива теплоносителя

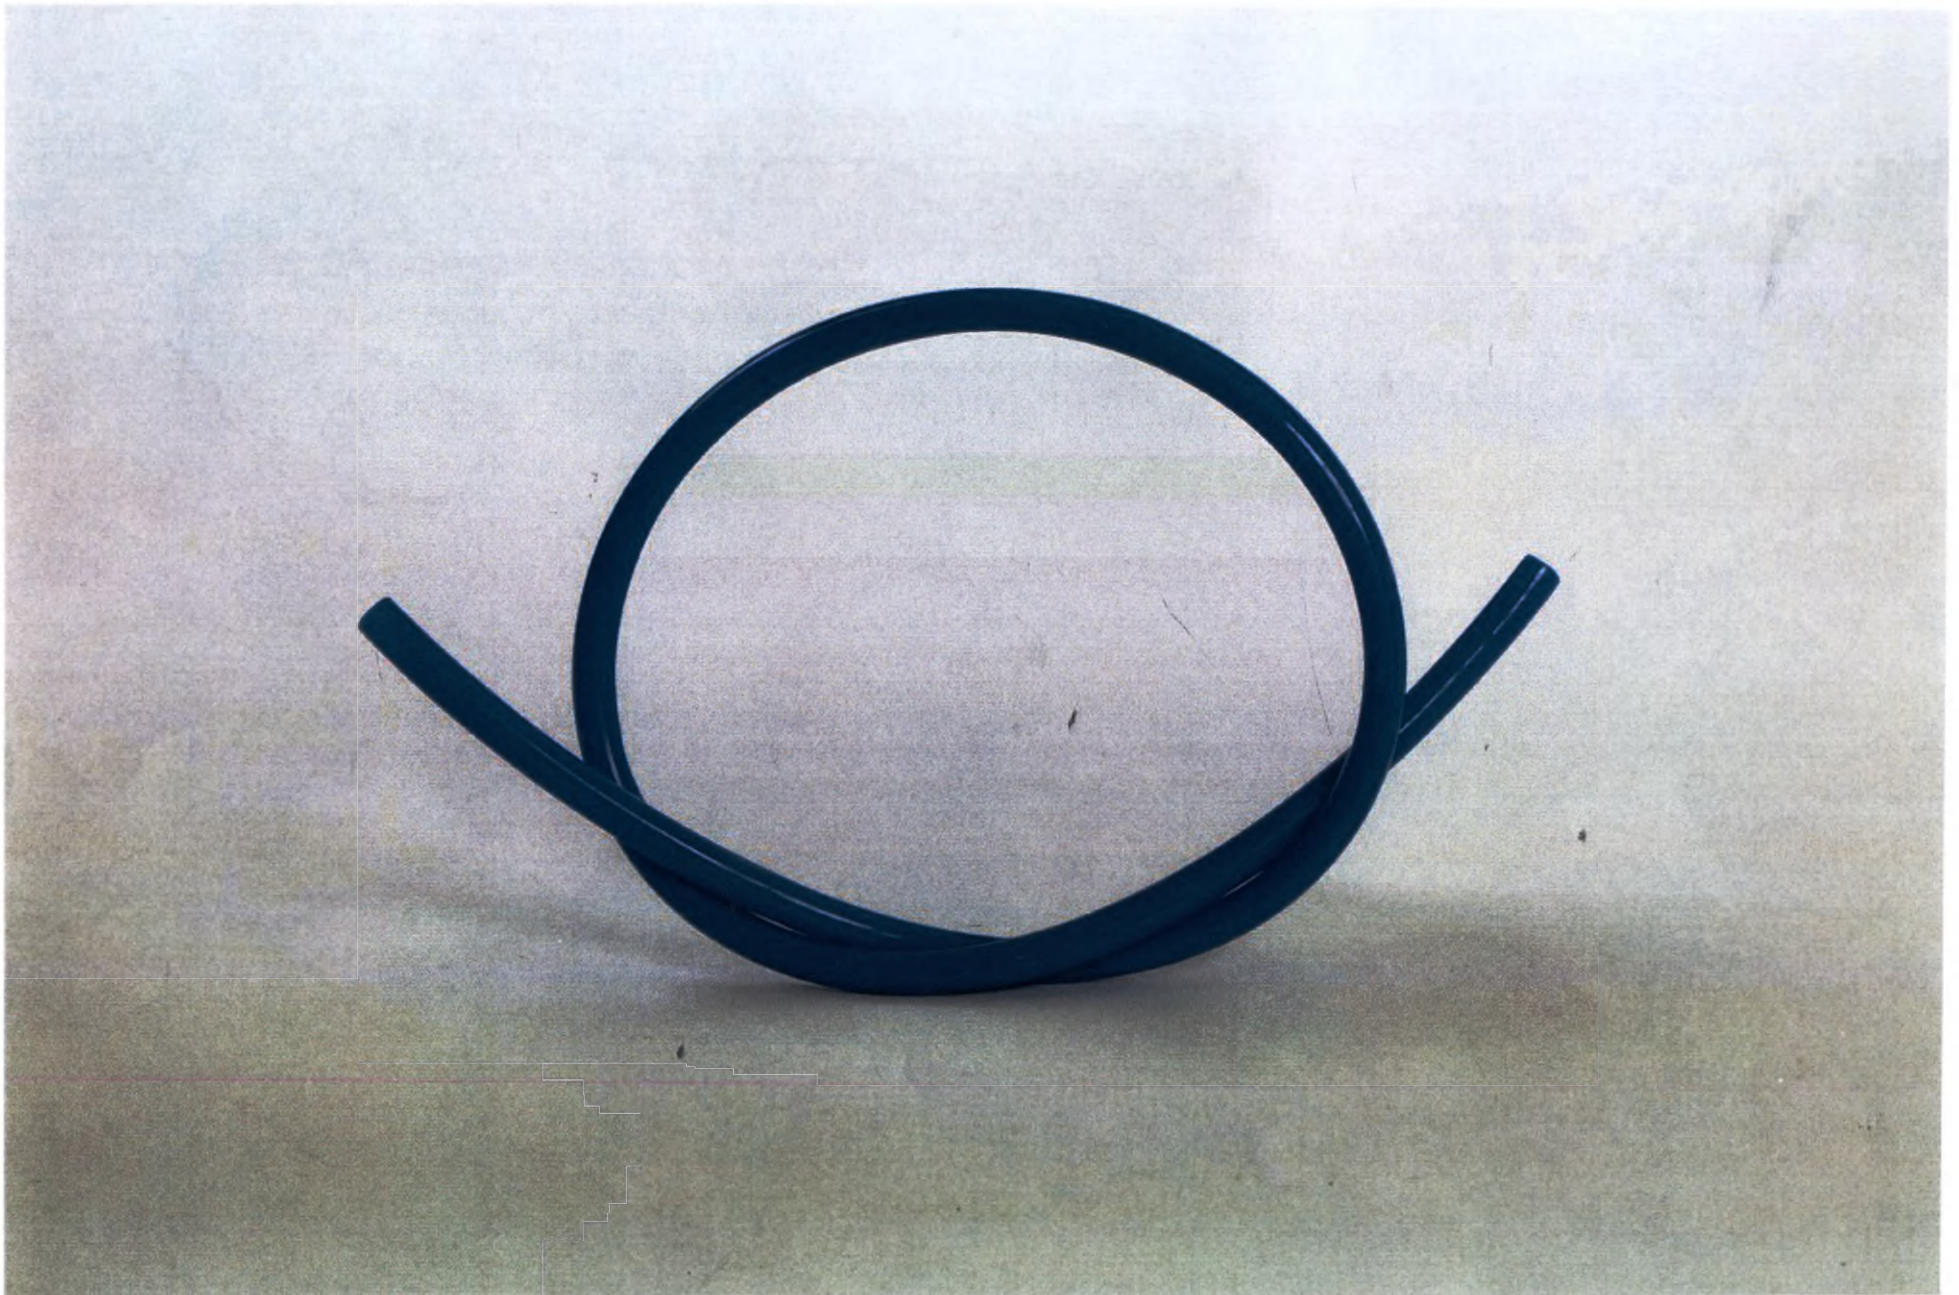


Технологический пакет для контейнера объемом до 500 мл




Технологический пакет для контейнера объемом до 1000 мл




Кассета для контейнера объемом до 500 мл

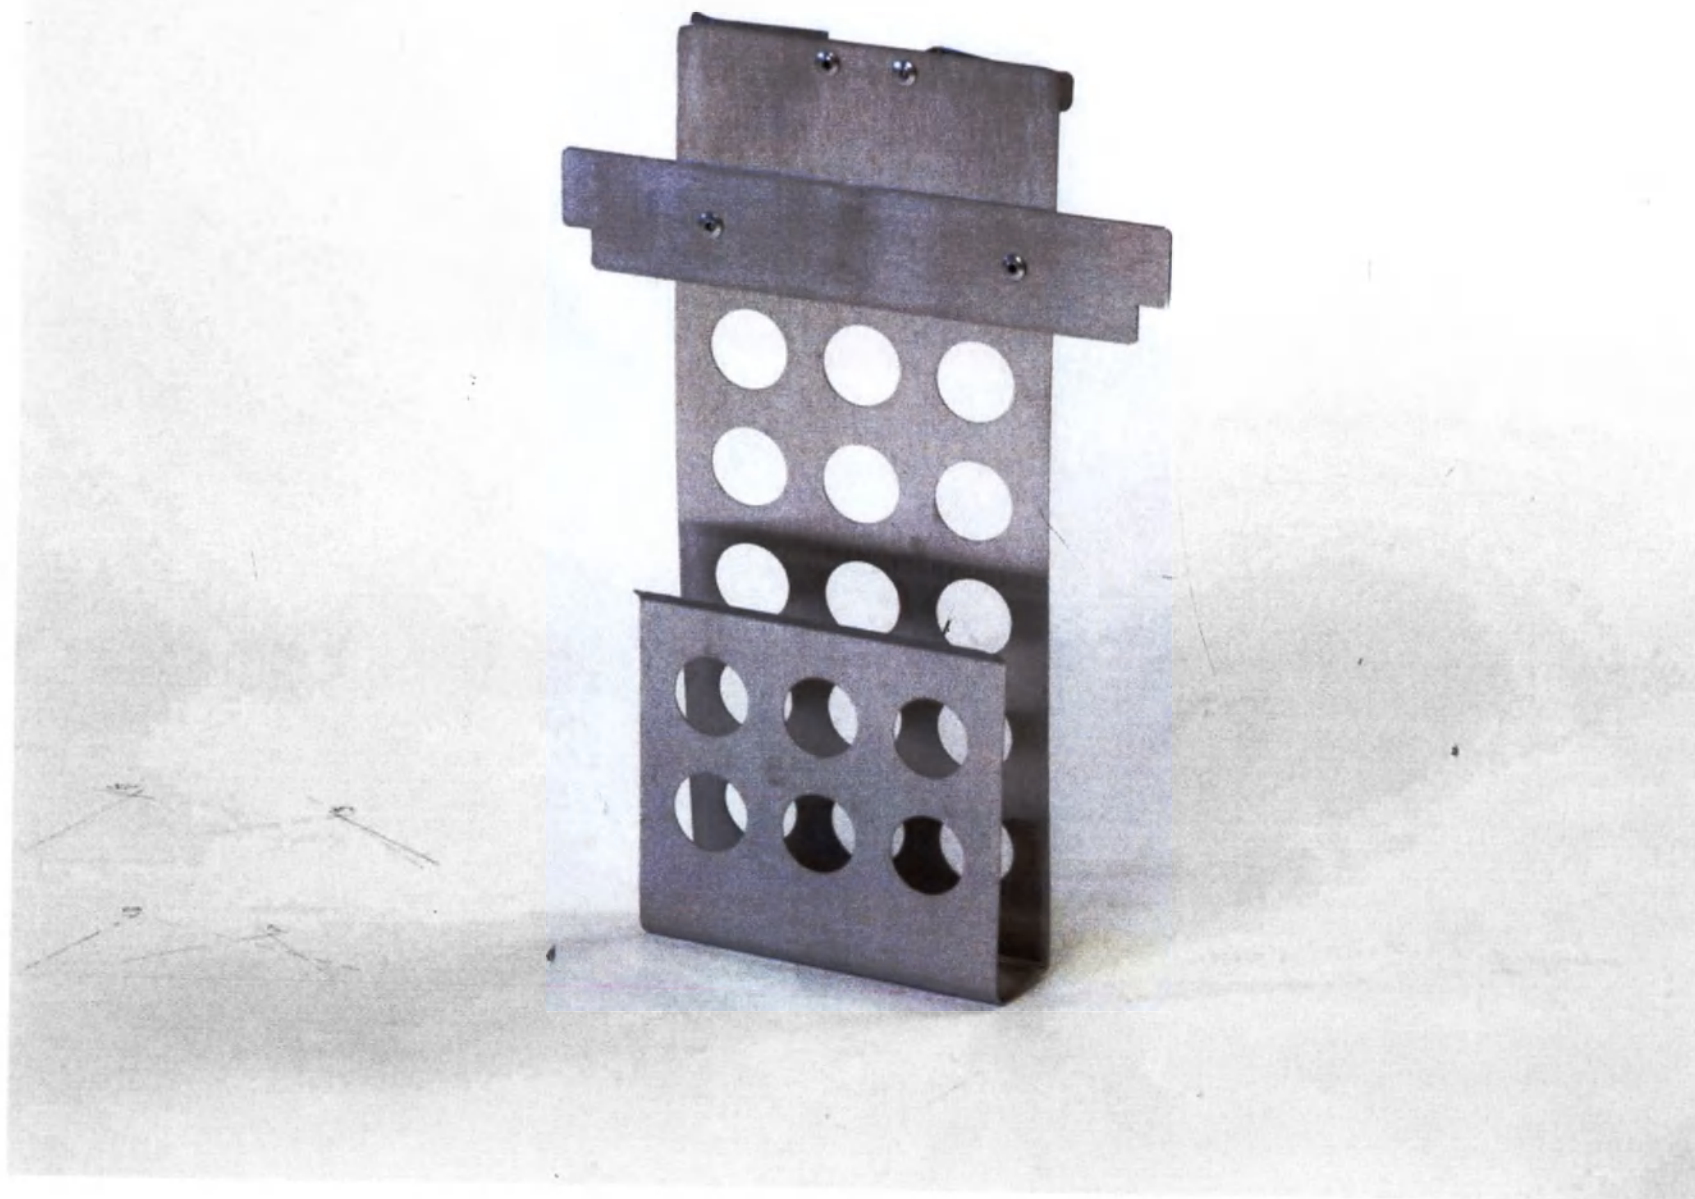

Кассета для контейнера объемом до 1000 мл

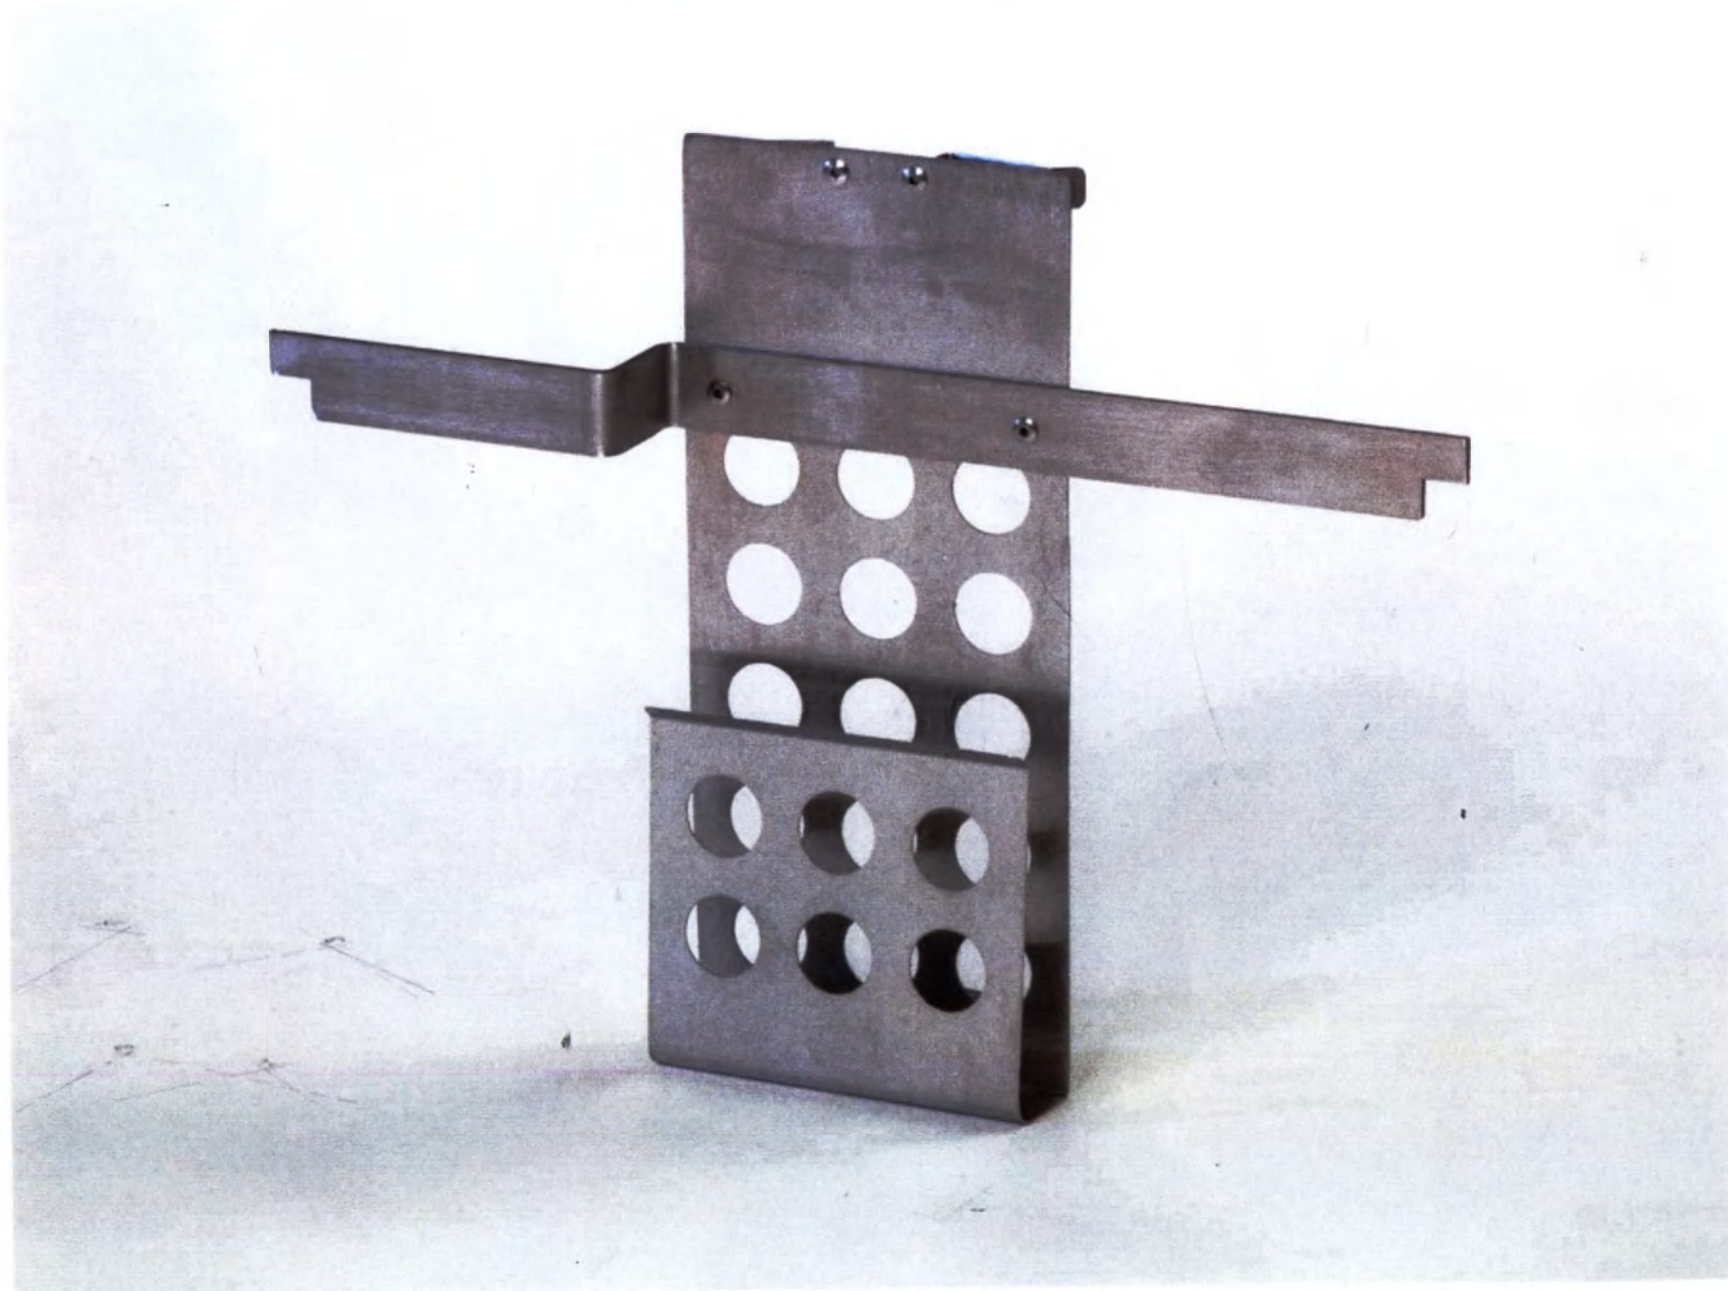

Кассета для флаконов объемом до 1000 мл

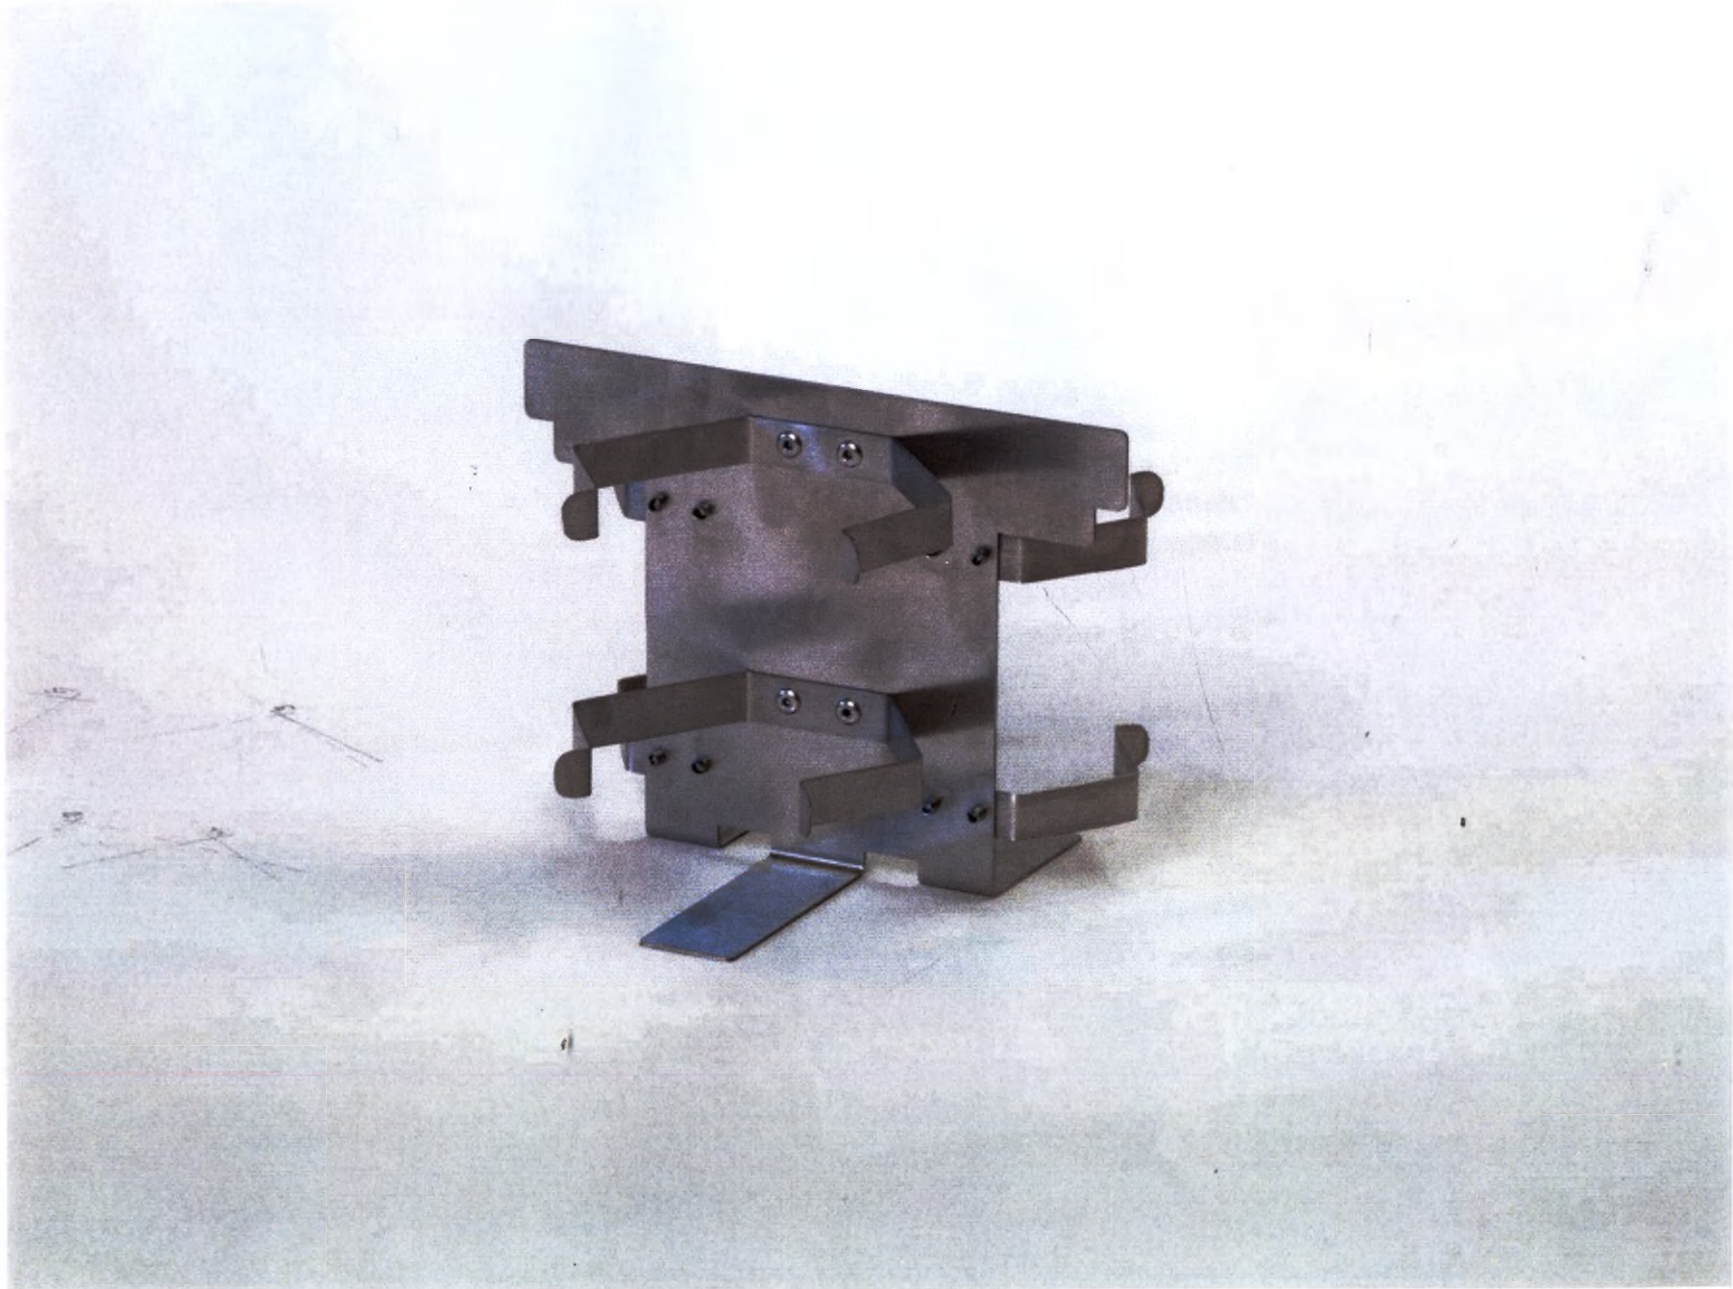

Руководство по эксплуатации на Leadmelt 1



**Аппарат для быстрого
размораживания, подогрева
и хранения в тёплом виде
крови, компонентов крови,
препаратов крови
и инфузионных растворов
«Leadmelt» 1**

по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Аппарат для быстрого
размораживания, подогрева
и хранения в тёплом виде
крови, компонентов крови,
препаратов крови
и инфузионных растворов
«Leadmelt» 1
по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 13,
(Динеруа) л.

Директор
ООО «ЛЮДКОР» / А.И. Улыбин



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «ЛИДКОР»

А.И. Улыбин

2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия

**«Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в тёплом виде крови,
компонентов крови, препаратов крови и инфузионных растворов «Leadmelt» 2»
по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020**

Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в тёплом виде крови, компонентов крови, препаратов крови и инфузионных растворов «Leadmelt» 2



Маркировка изделия



Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения
в тёплом виде крови, компонентов крови, препаратов крови
и инфузионных растворов «Leadmelt» 2
по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020
ру

Наименование и юридический адрес изготовителя:
ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204.
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Питание: ~ 220 В ±10 %, 50 Гц, Рном = 1500 Вт

Заводской
номер

0001

Дата
выпуска

01.2020



~ 220 В, 50 Гц

Предохранитель:
5x20, F8H250V




Маркировка транспортной тары



LEADCORE

Аппарат для быстрого размораживания, подогрева
и хранения в тёплом виде крови, компонентов крови,
препаратов крови и инфузионных растворов «Leadmelt» 2
по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020



Транспортировка

Наименование и юридический адрес изготовителя:

**ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204. mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru**

Масса брутто: _____ кг

Заводской
номер


0001

Дата
выпуска


2020.01




Шнур электропитания сетевой

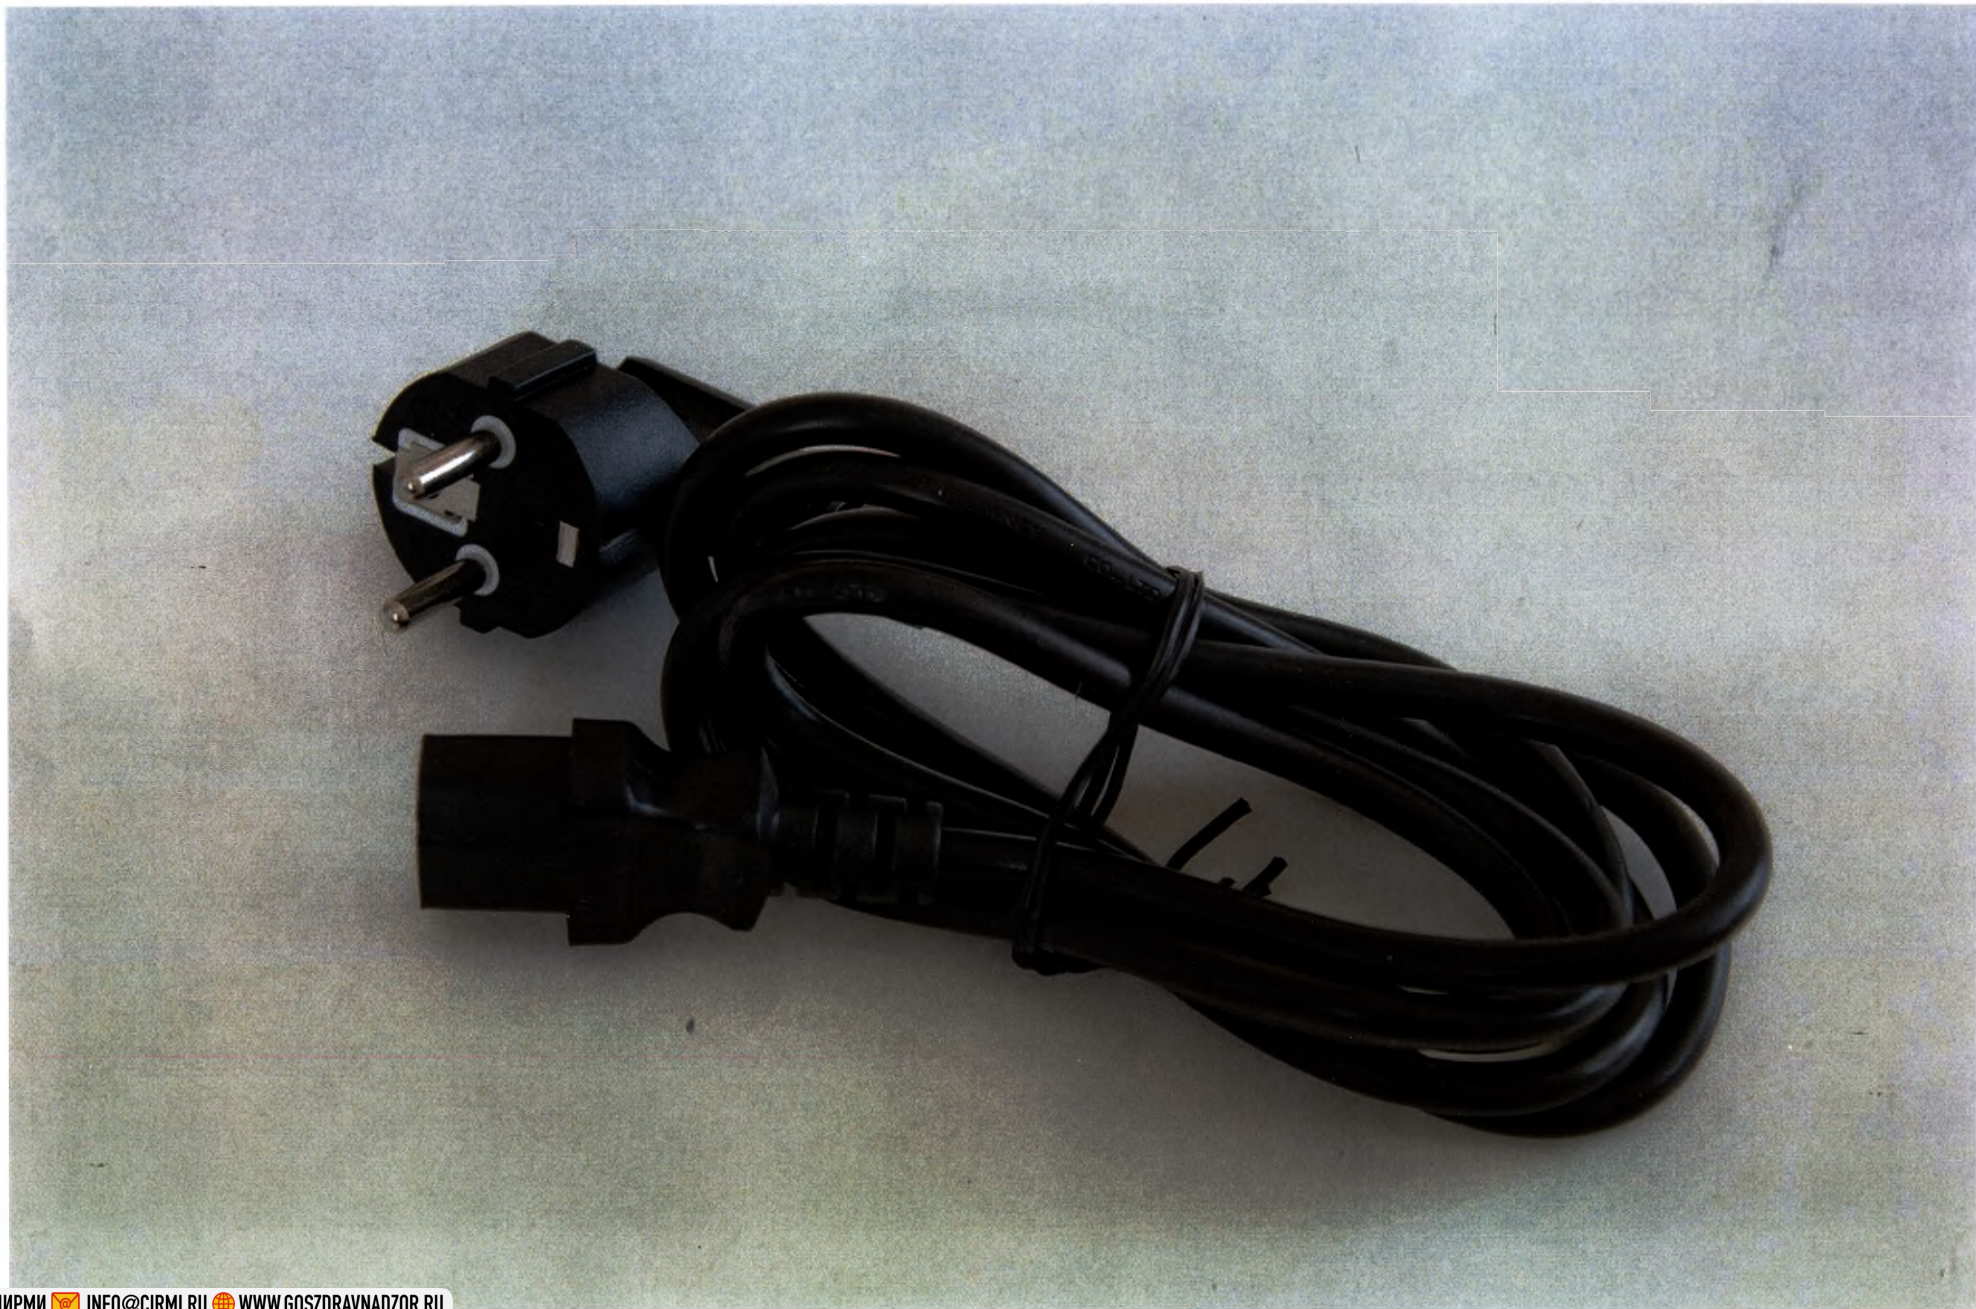


Трубка для слива теплоносителя

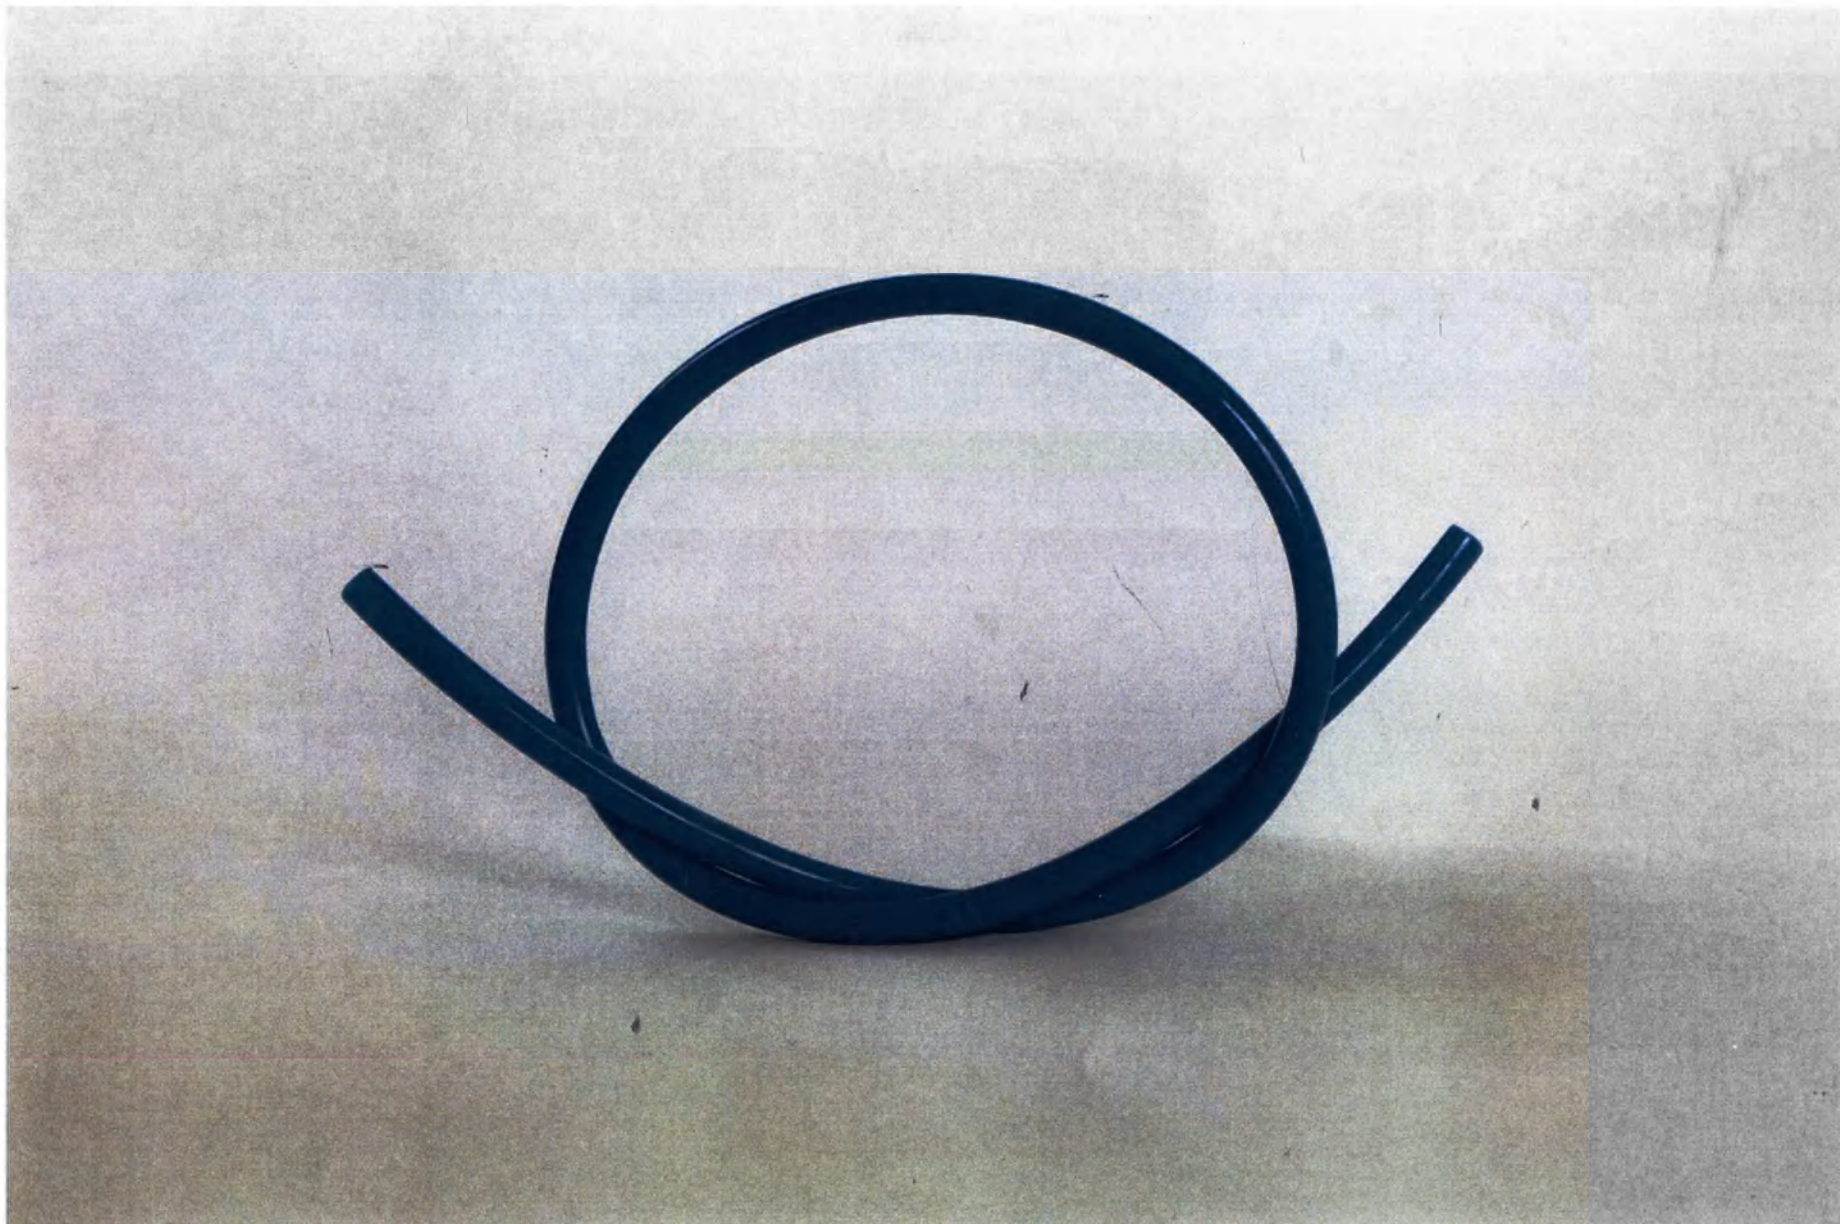


Корзина

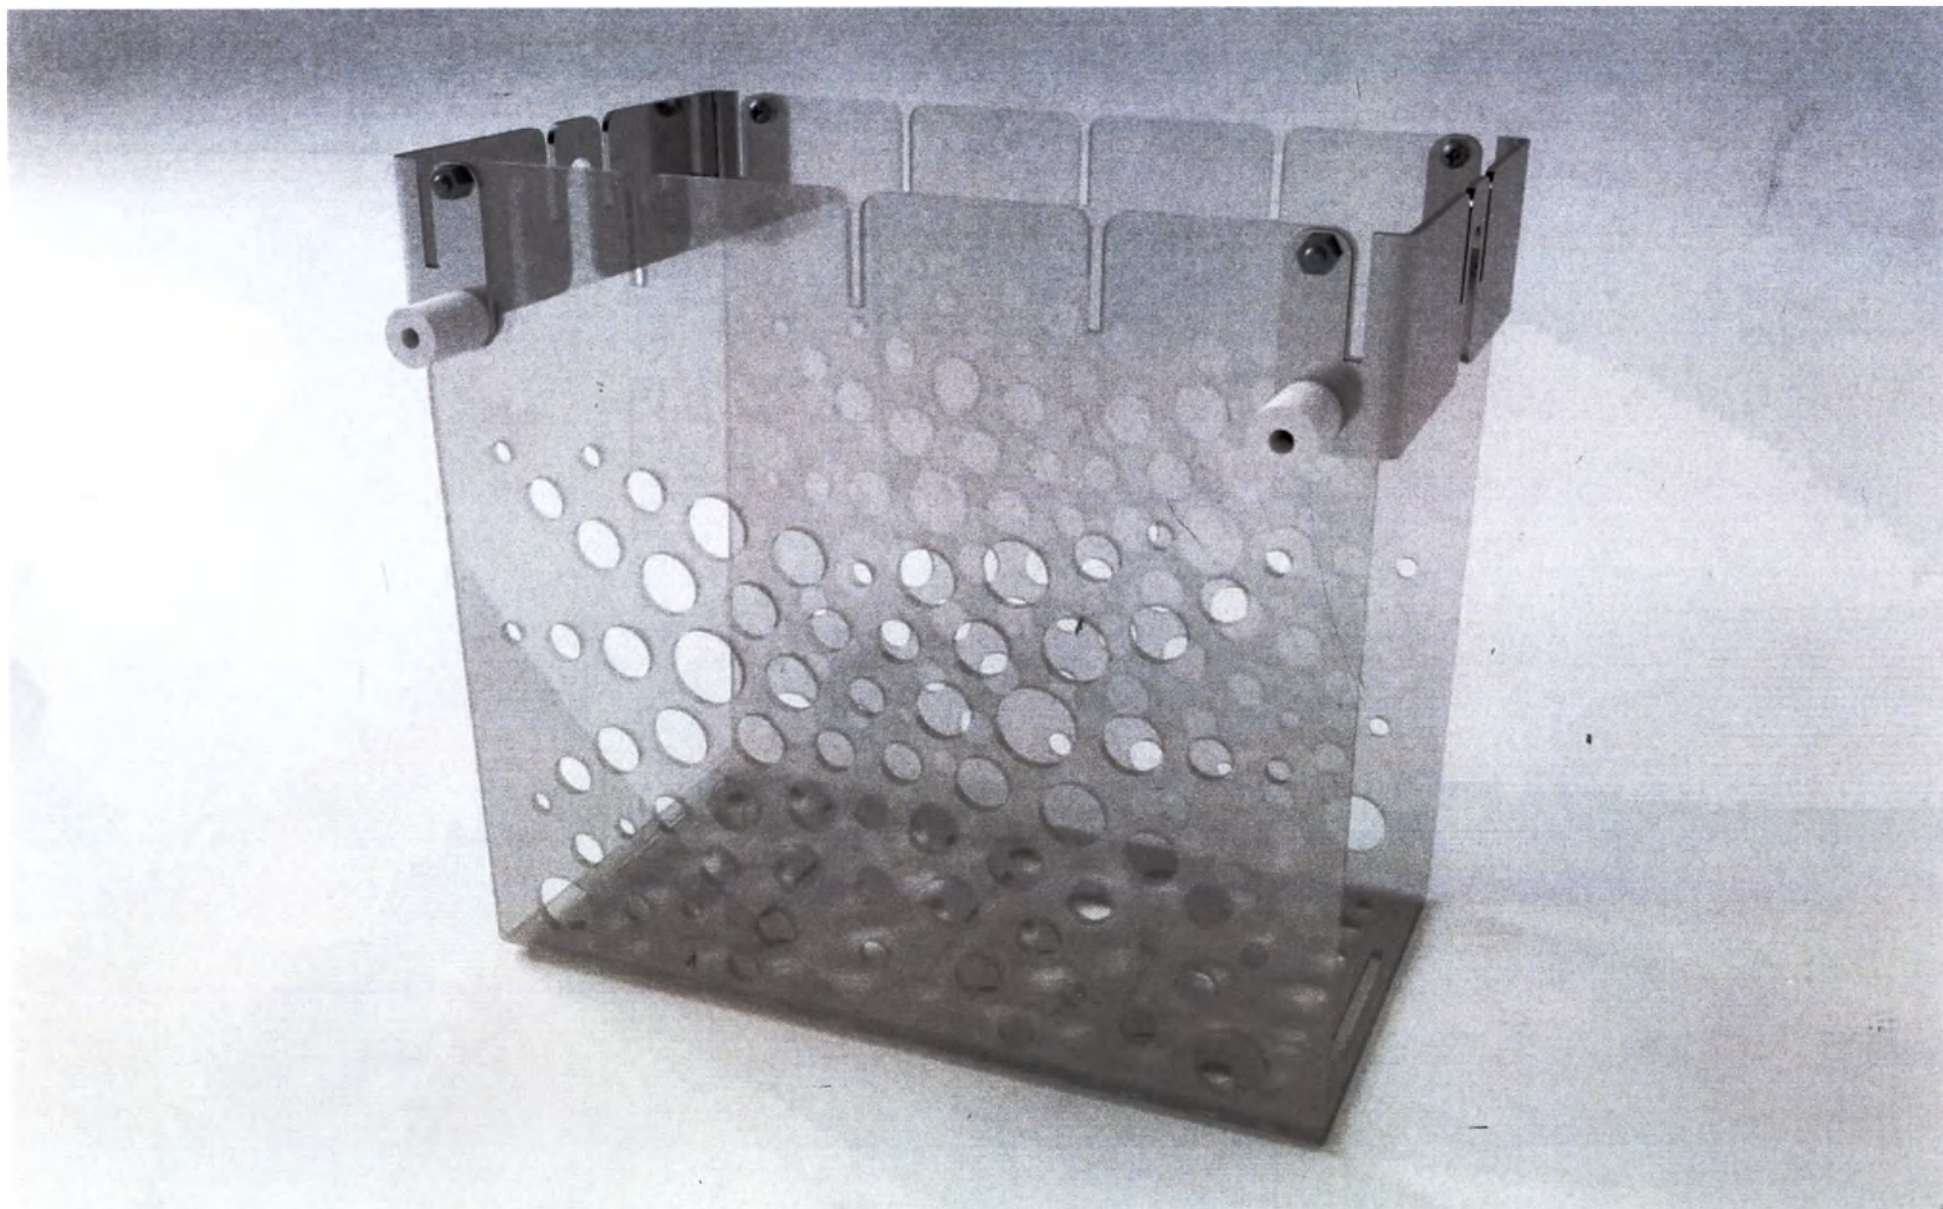

Пластина для контейнера поперечная

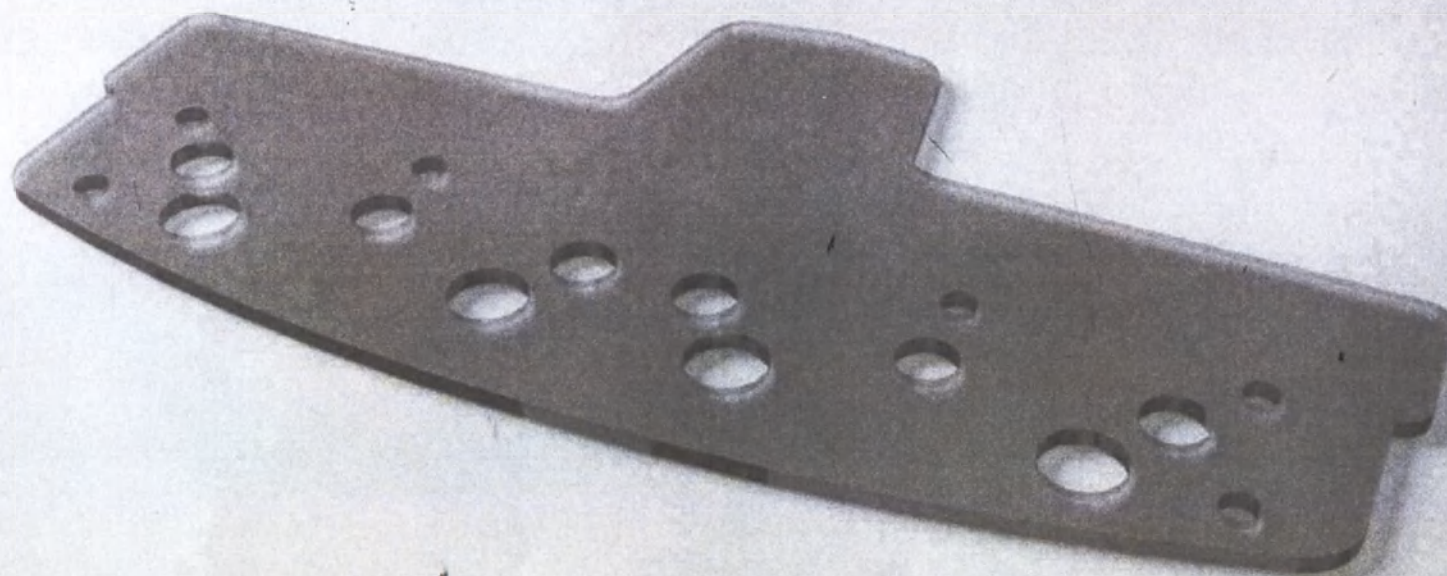

Пластина для контейнера продольная

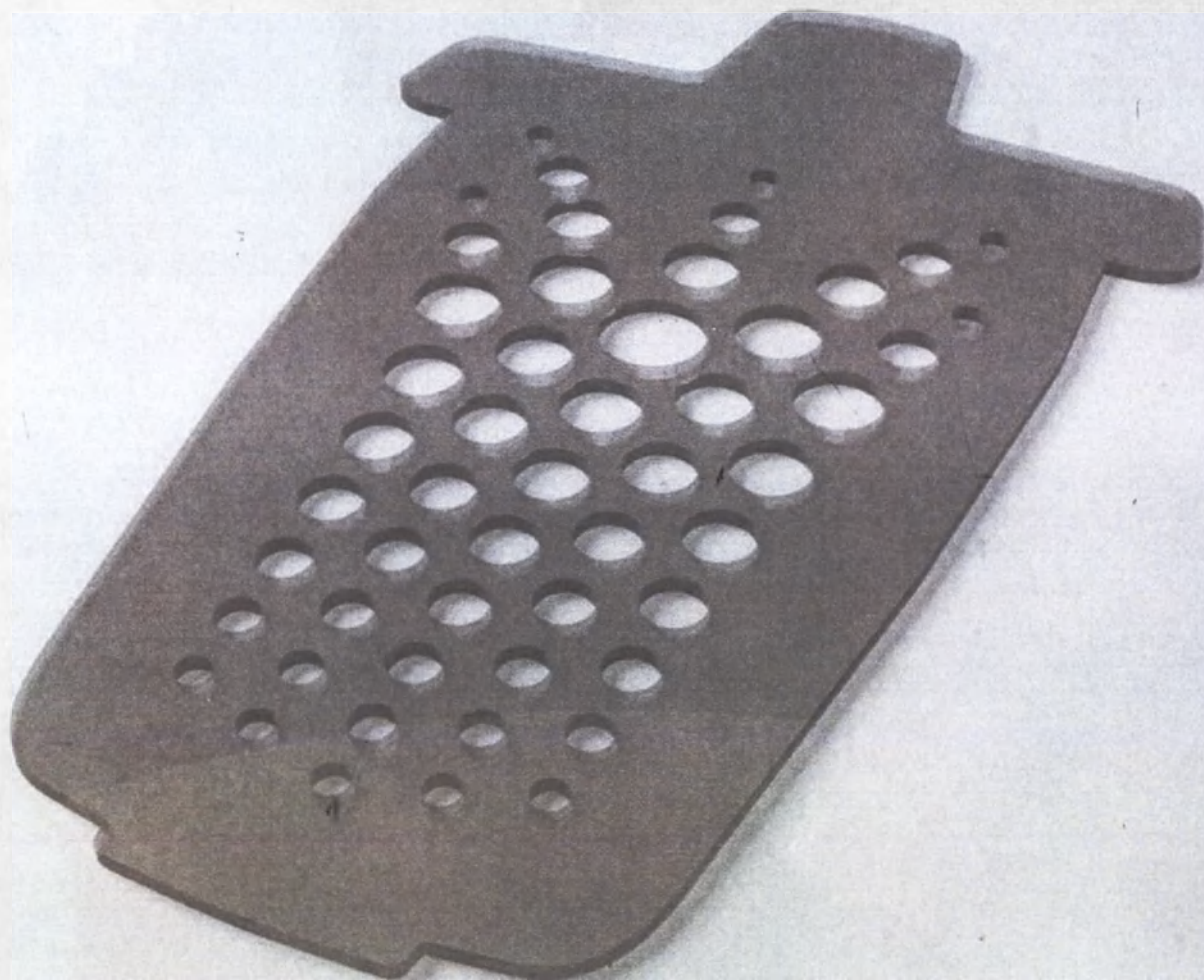

Технологический пакет для контейнера объемом до 500 мл



Технологический пакет для контейнера объемом до 1000 мл



Паспорт



Аппарат для быстрого
размораживания, подогрева
и хранения в тёплом виде
крови, компонентов крови,
препаратов крови
и инфузионных растворов
«Leadmelt» 2
по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020

Паспорт



**Аппарат для быстрого
размораживания, подогрева
и хранения в тёплом виде
крови, компонентов крови,
препаратов крови
и инфузионных растворов
«Leadmelt» 2**

по ТУ 32.50.50-005-65614693-2020

Руководство по эксплуатации

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 13
(Примерная) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР» _____ / А.И. Улыбин

