



**Приложение 1. Фотографические изображения испытуемого
медицинского изделия: «Набор реагентов для выделения РНК коронавируса
SARS-CoV-2 из клинического материала на магнитных частицах»
«SLT-NAMg-SARS-96»
по ТУ 21.20.23-001-75841125-2021
серия 210621,
производства ООО «СЛТ», Россия**


1. Фото 1.1. Маркировка на потребительской упаковке НАБОРА:

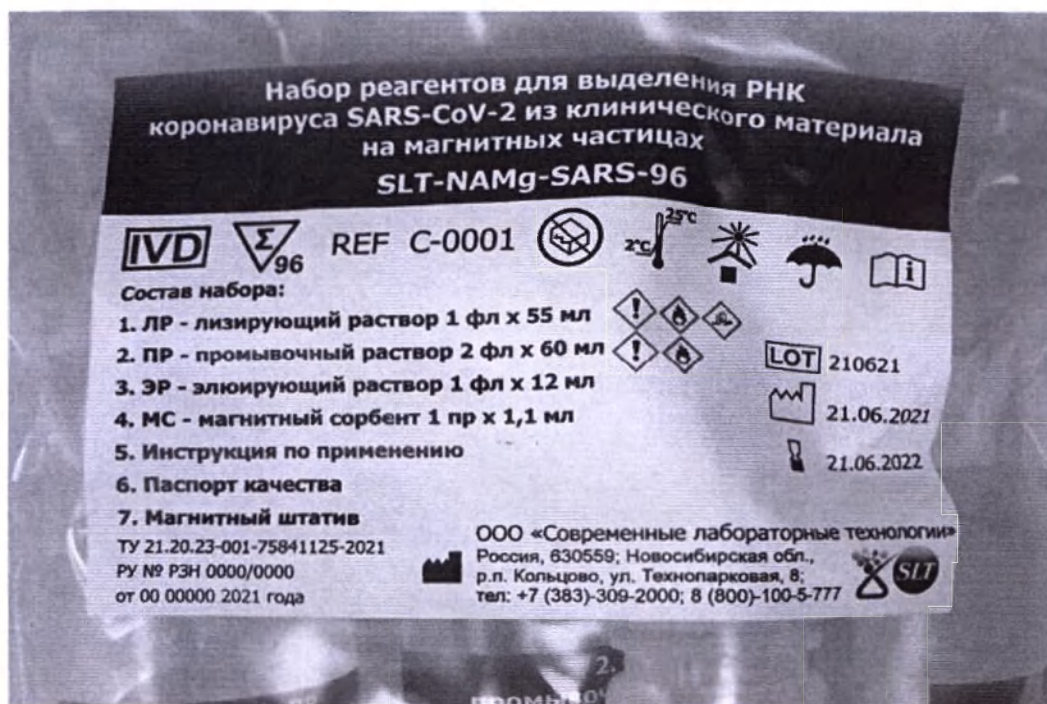


2. Фото 1.2. Содержимое потребительской упаковки, общий вид НАБОРА:

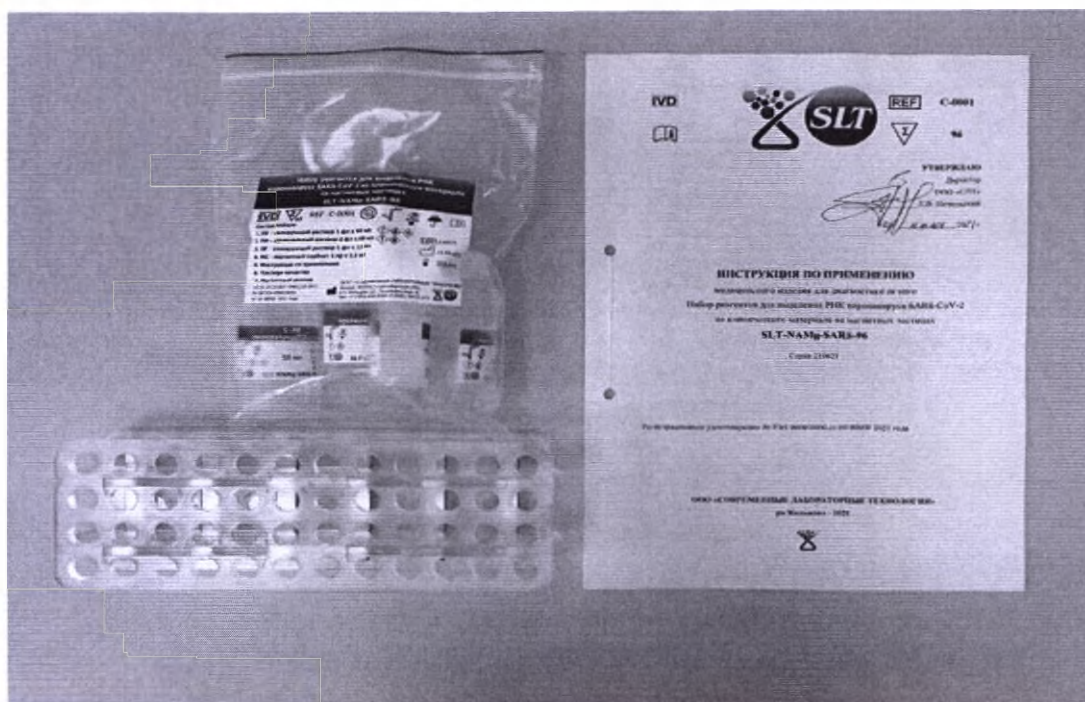


3. Фото 1.3. Магнитный штатив МагСов48:

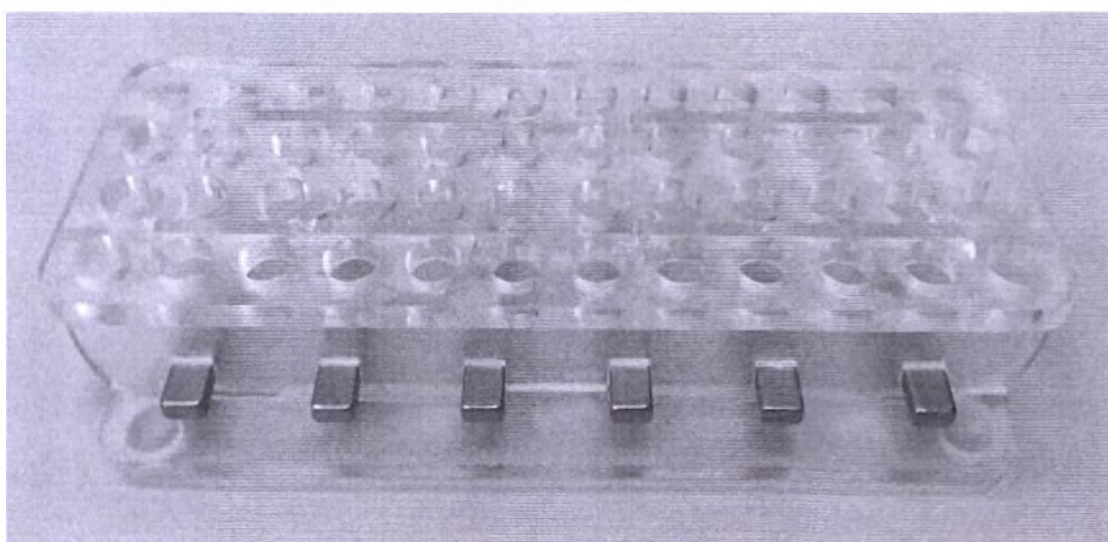


4. Фото 1.4. Флакон ЛР - лизирующий раствор с маркировкой:

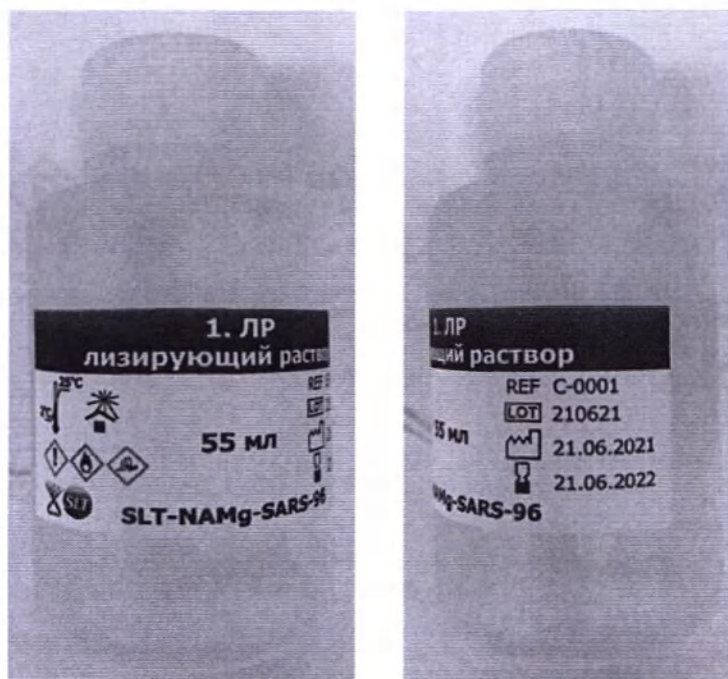


5. Фото 1.5. флакон ПР – промывочный раствор с маркировкой:

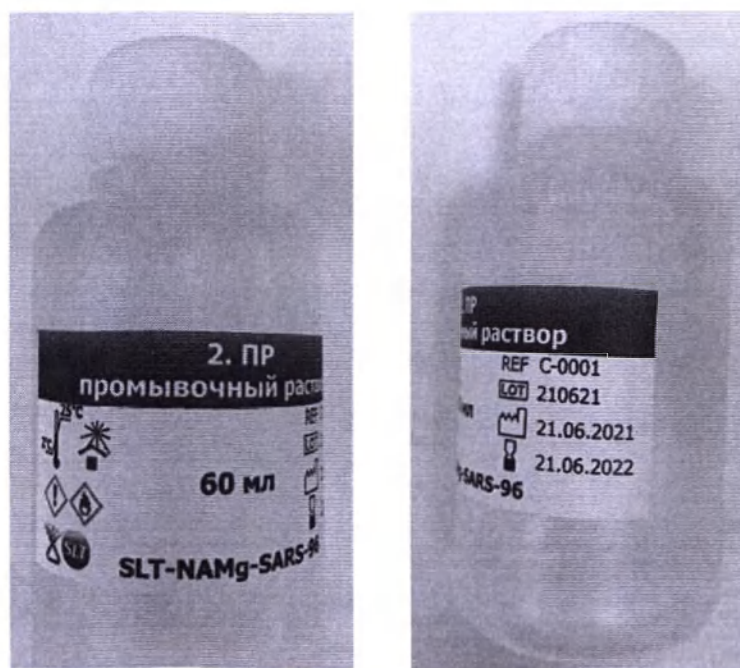

6. Фото 1.6. Флакон ЭР – элюирующий раствор с маркировкой:

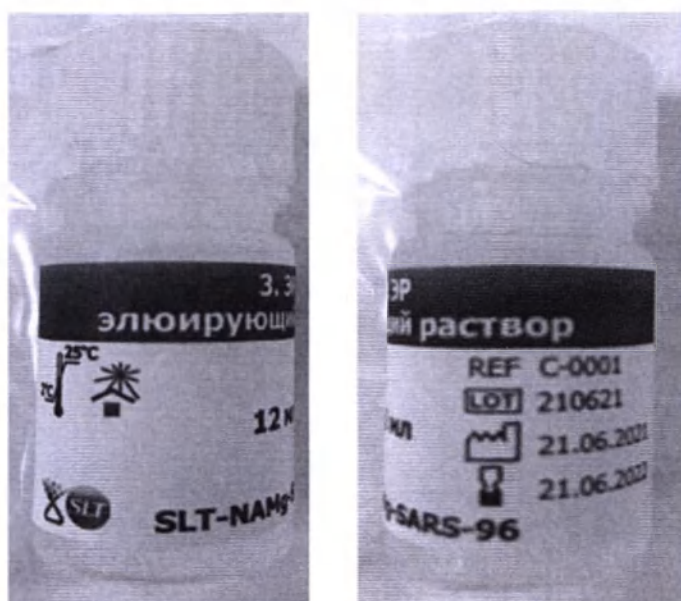


7. Фото 1.7 Пробирка МС – магнитный сорбент с маркировкой:

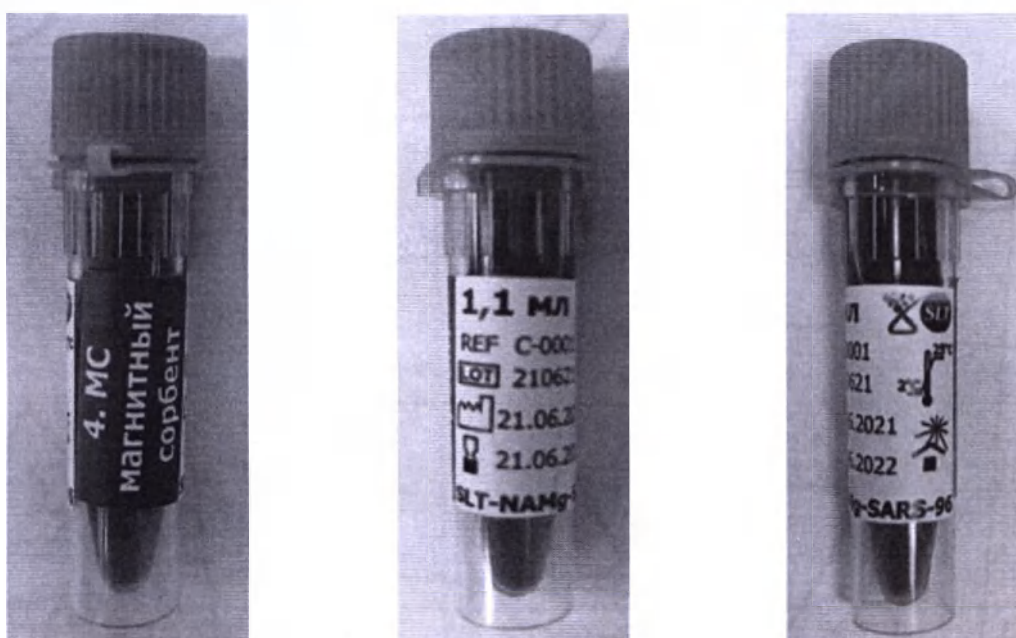




Приложение 2. Фотографические изображения медицинского изделия сравнения: «Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов, «РеалБестСорбитус» (вариант 1×96) производства АО «Вектор-Бест»» (ПУ № РЗН 2020/11364 от 22.09.2020)

1. Фото 2.1. Потребительская упаковка набора выделения:

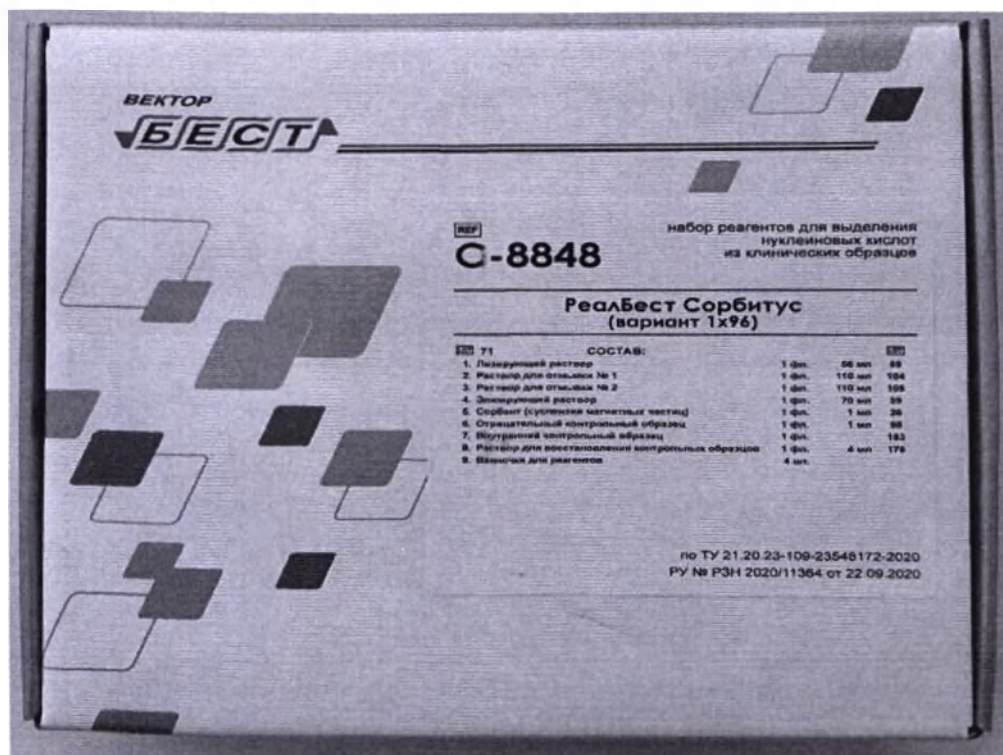


2. Фото 2.2. Маркировка на потребительской упаковке набора выделения:

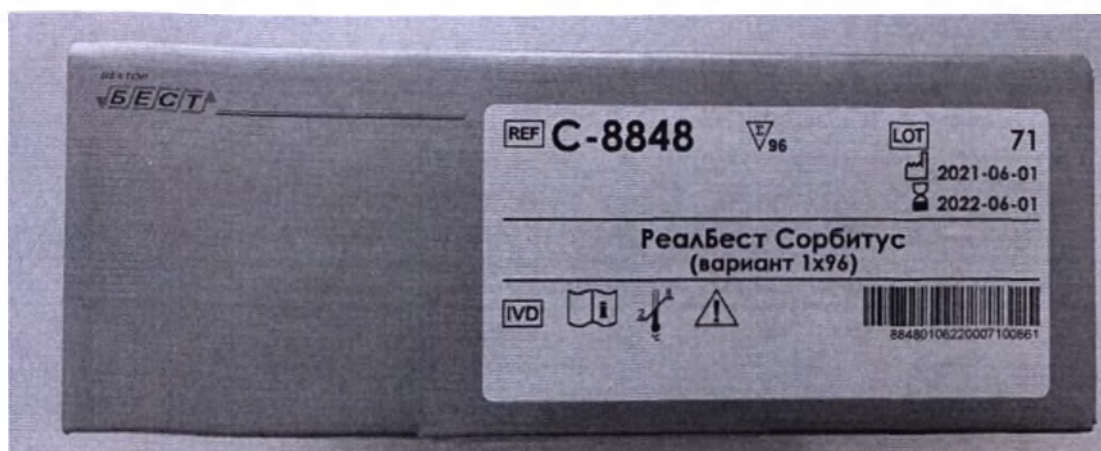

Фотографические изображения медицинского изделия сравнения:
 «Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
 клинических образцов, «РеалБест экстракция 100»
 производства АО «Вектор-Бест»» (РУ № РЗН 2014/1423 от 25.03.2017)

3. Фото 2.3. Потребительская упаковка набора выделения:

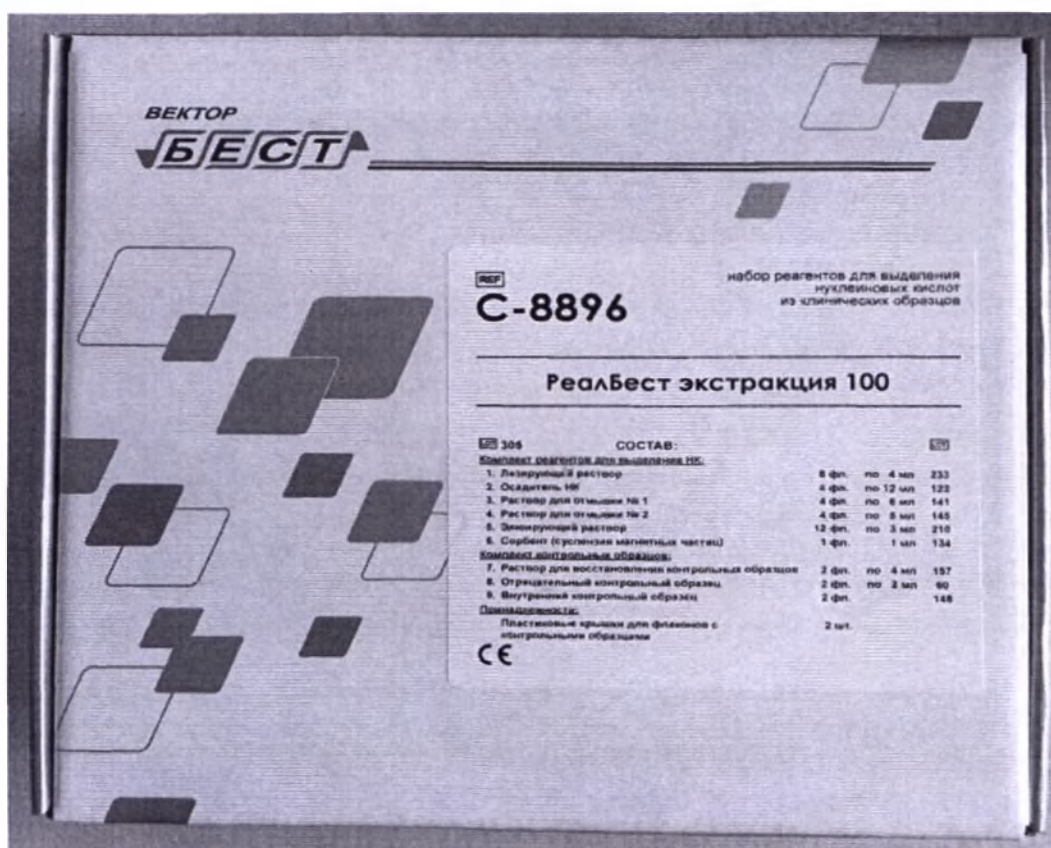

4. Фото 2.4. Маркировка на потребительской упаковке набора выделения:



Фотографические изображения дополнительного медицинского изделия для проведения оценки диагностической чувствительности и специфичности, влияния интерферирующих веществ и воспроизводимости:
 Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «РеалБест РНК SARS-CoV-2»
 (РУ РЗН 2020/9896 от 27.03.2020)

5. Фото 2.5. Потребительская упаковка набора ОТ-ПЦР:




6. Фото 2.6. Маркировка на упаковке набора для ОТ-ПЦР:




Набор реагентов для определения ДНК *энтеробактерий, стафилококков и стрептококков* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики in vitro «АмплиПраймФлороскрин® Аэробы»

7. Фото 2.7. Потребительская упаковка и маркировка дополнительного набора реагентов:

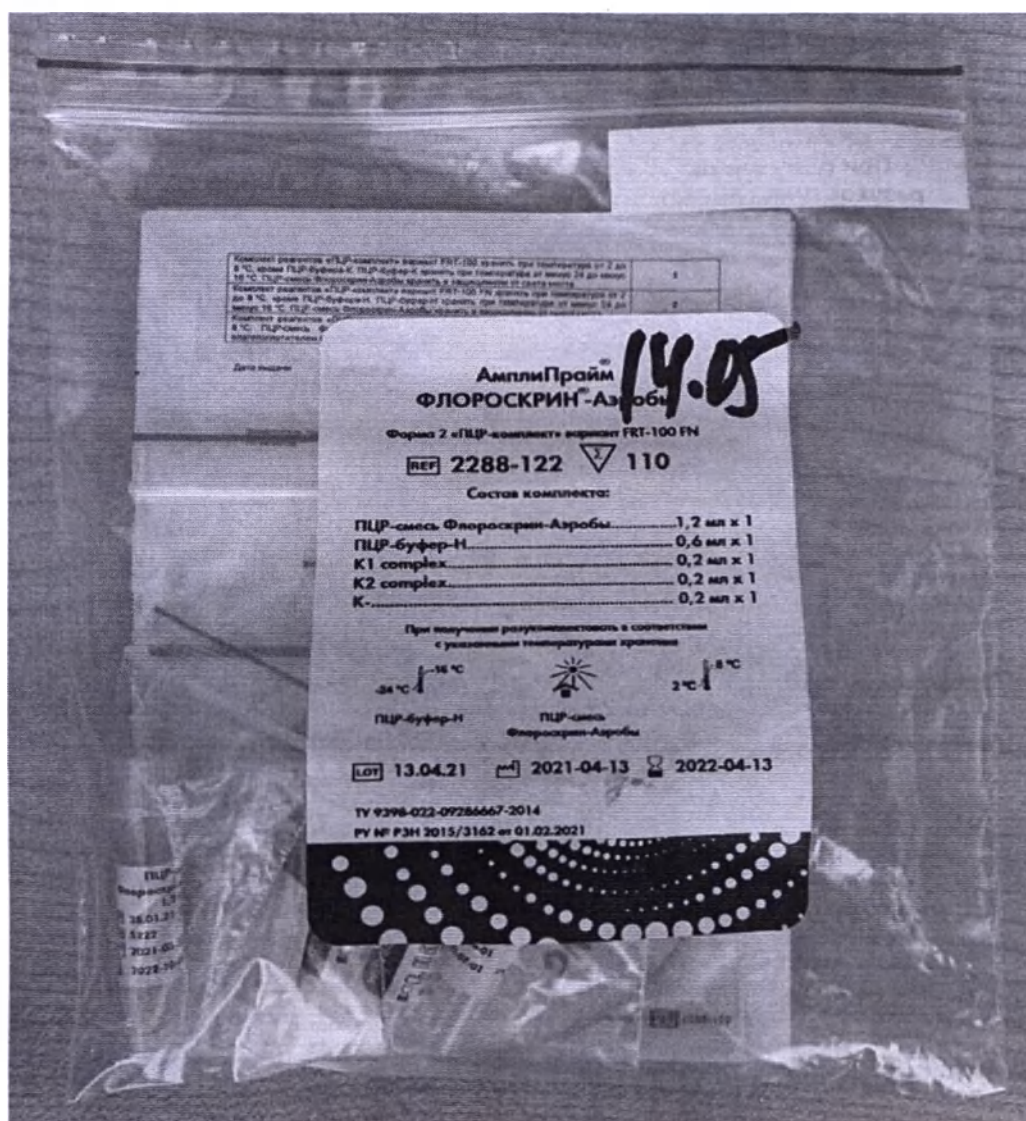

Набор реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) РНК респираторно-синцитиального вируса (*humanRespiratorySyncytialvirus - hRSv*), метапневмовируса (*humanMetapneumovirus-hMpv*), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (*humanParainfluenzavirus-1-4-hPiv*), коронавирусов (*humanCoronavirus - hCov*), риновирусов (*humanRhinovirus - hRv*), ДНК аденовирусов групп В, С и Е (*humanAdenovirusB,C,E- hAdv*) и бокавируса (*humanBocavirus - hBov*) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией»
«АмплиСенс® ОРВИ-скрин-FL»»
 (ПУ ФСР 2011/11258 от 26.02.2019)

8. Фото 2.8. Потребительская упаковка и маркировка дополнительного набора реагентов:

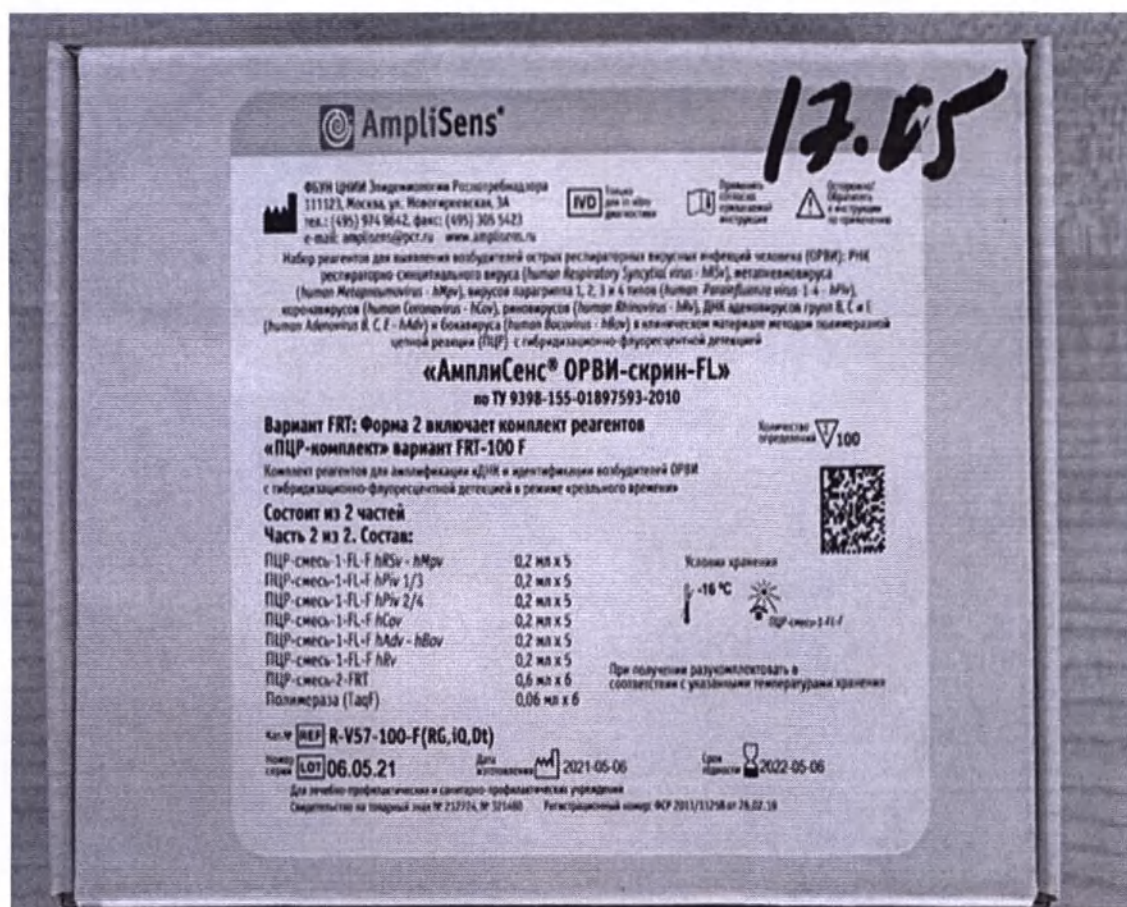

Прошито и скреплено печатью:

39 (тридцать девять) листов

Генеральный директор ООО «НАКФФ»

М.Ю.Лабанок

