



Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

Вариант 1, Комплектация 1




Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

г 1, Комплектация 2

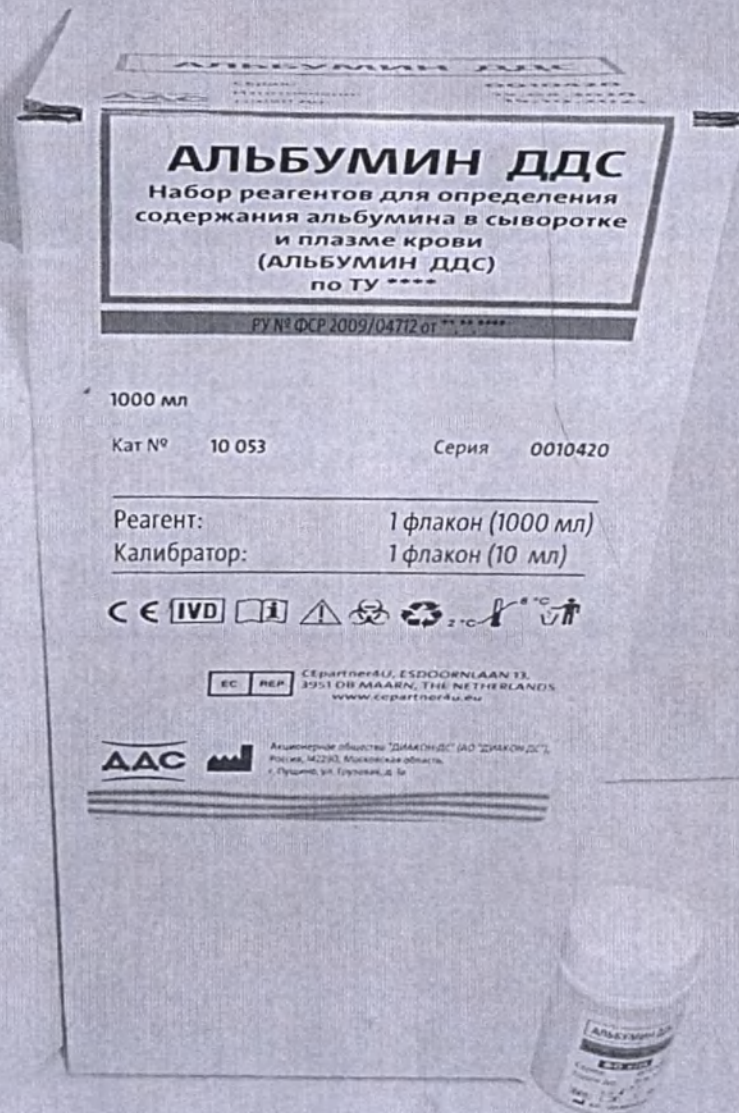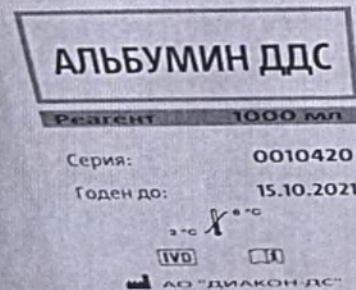


Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
 Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
 (АЛЬБУМИН ДДС)

1, Комплектация 3

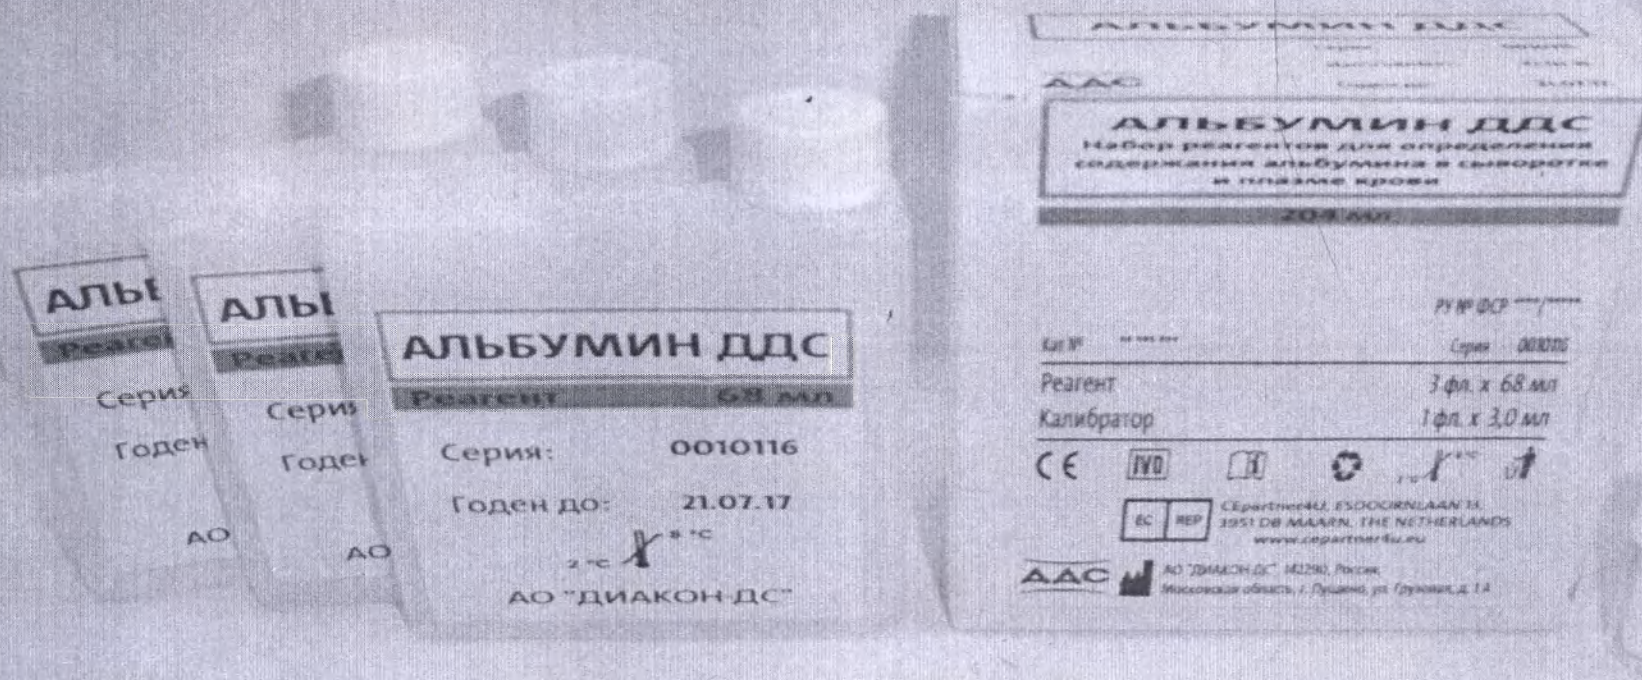





Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

1, Комплектация 4

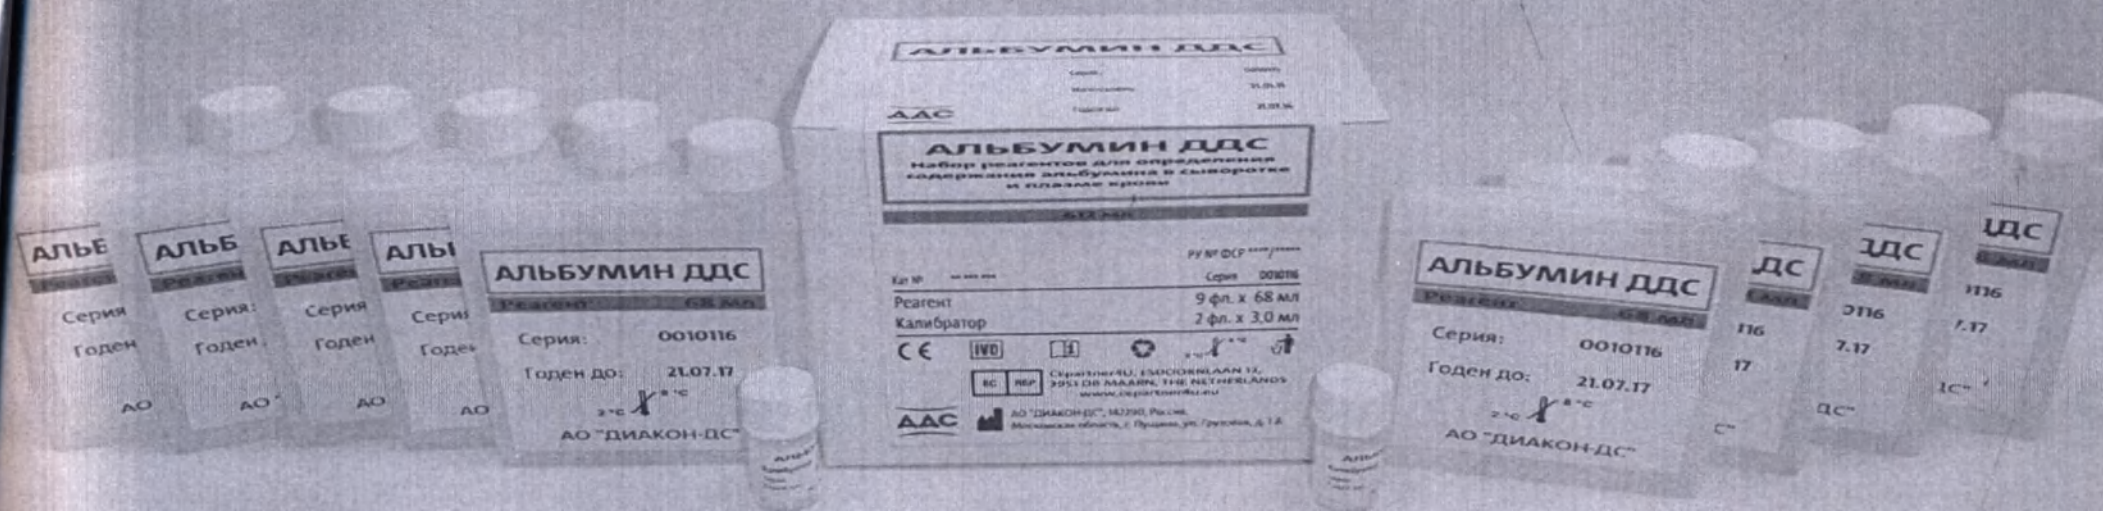

Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)


т 1, Комплектация 5

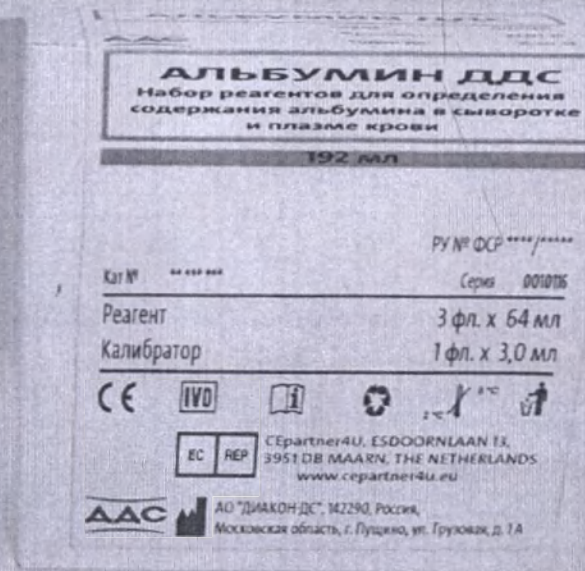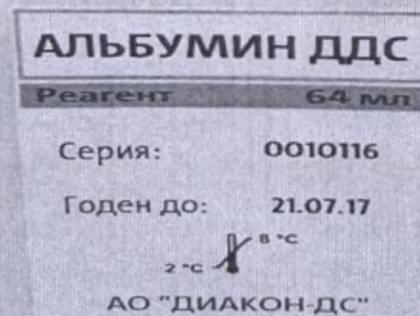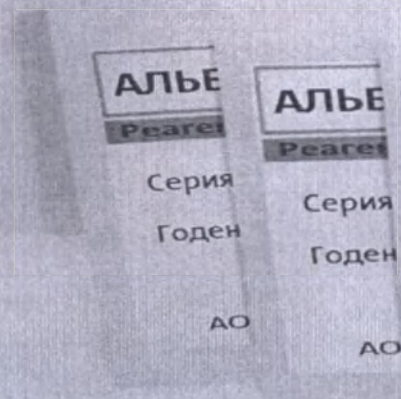

Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)


Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

1, Комплектация 6

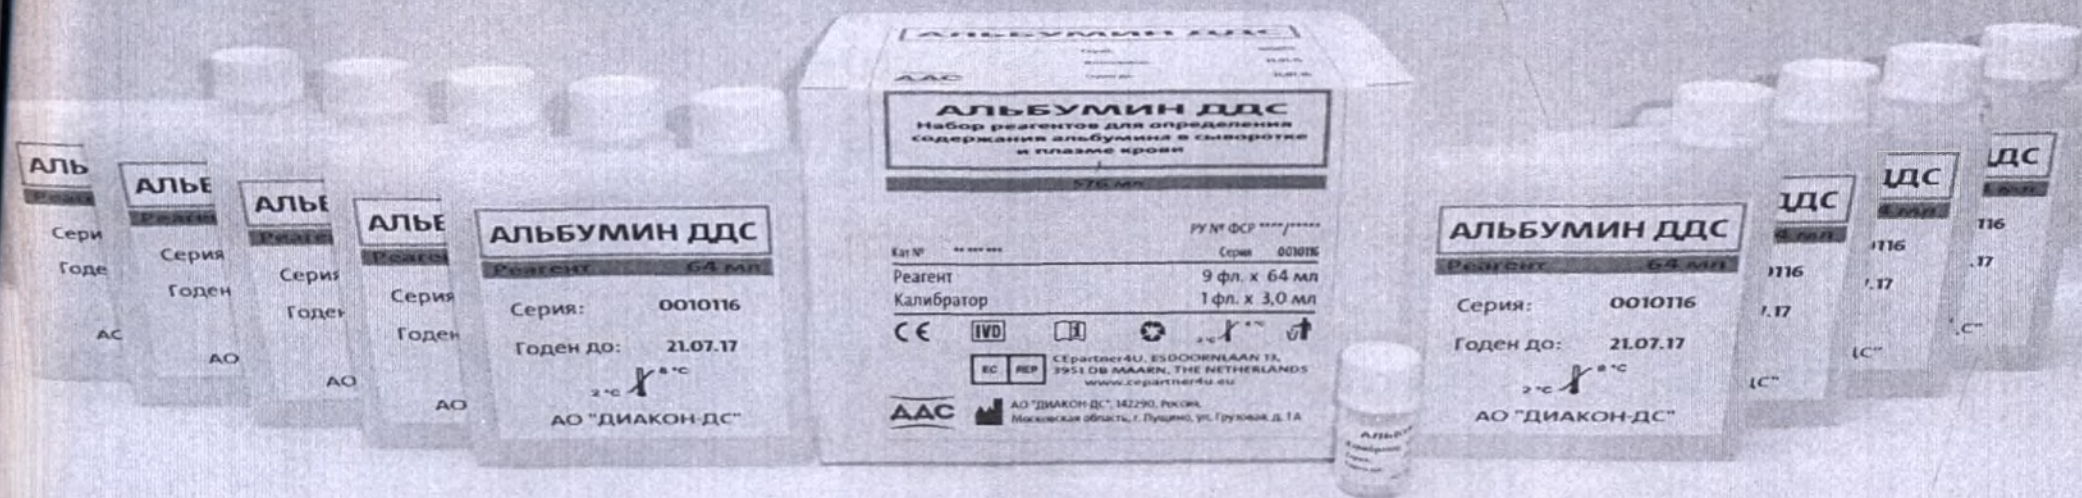

Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
 Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
 (АЛЬБУМИН ДДС)

т 1, Комплектация 7

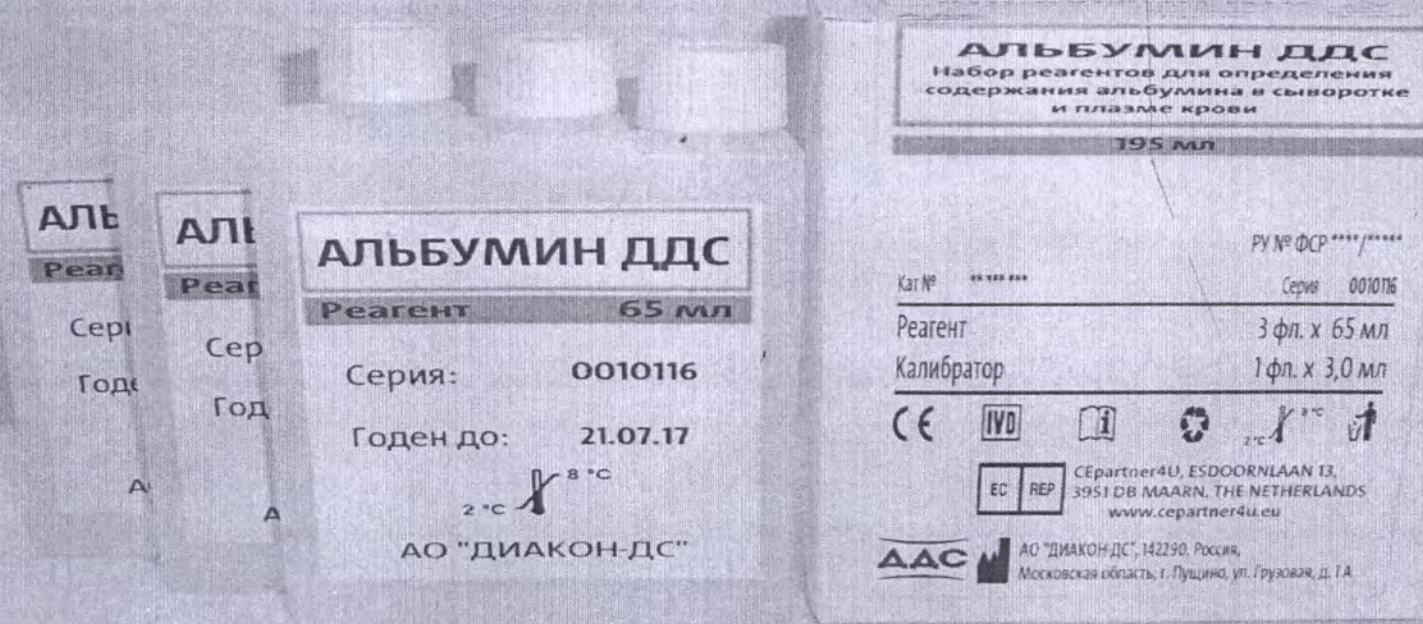

Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
 Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
 (АЛЬБУМИН ДДС)

т 1, Комплектация 8




Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

1, Комплектація 9




Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

т 1, Комплектация 10

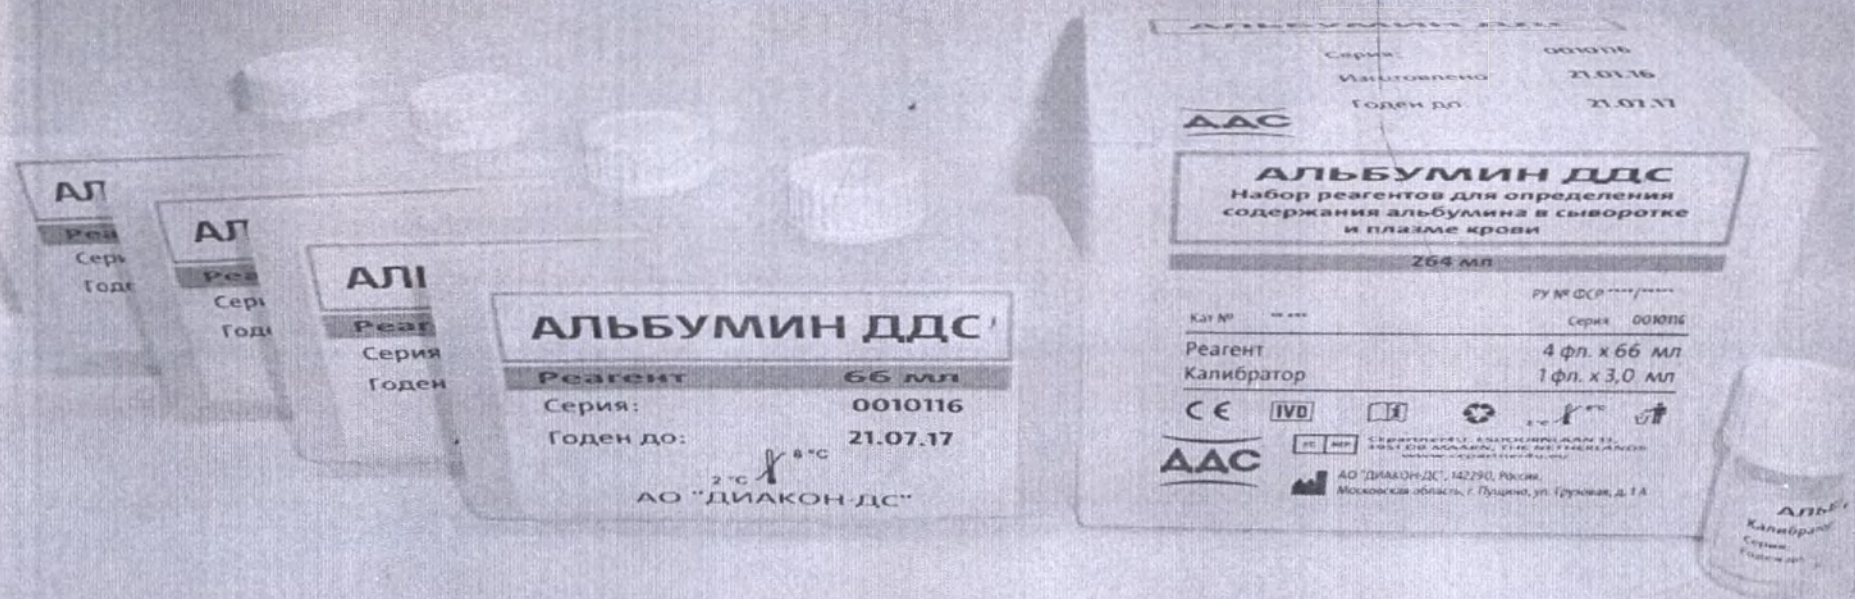

Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

т 1, Комплектация 11

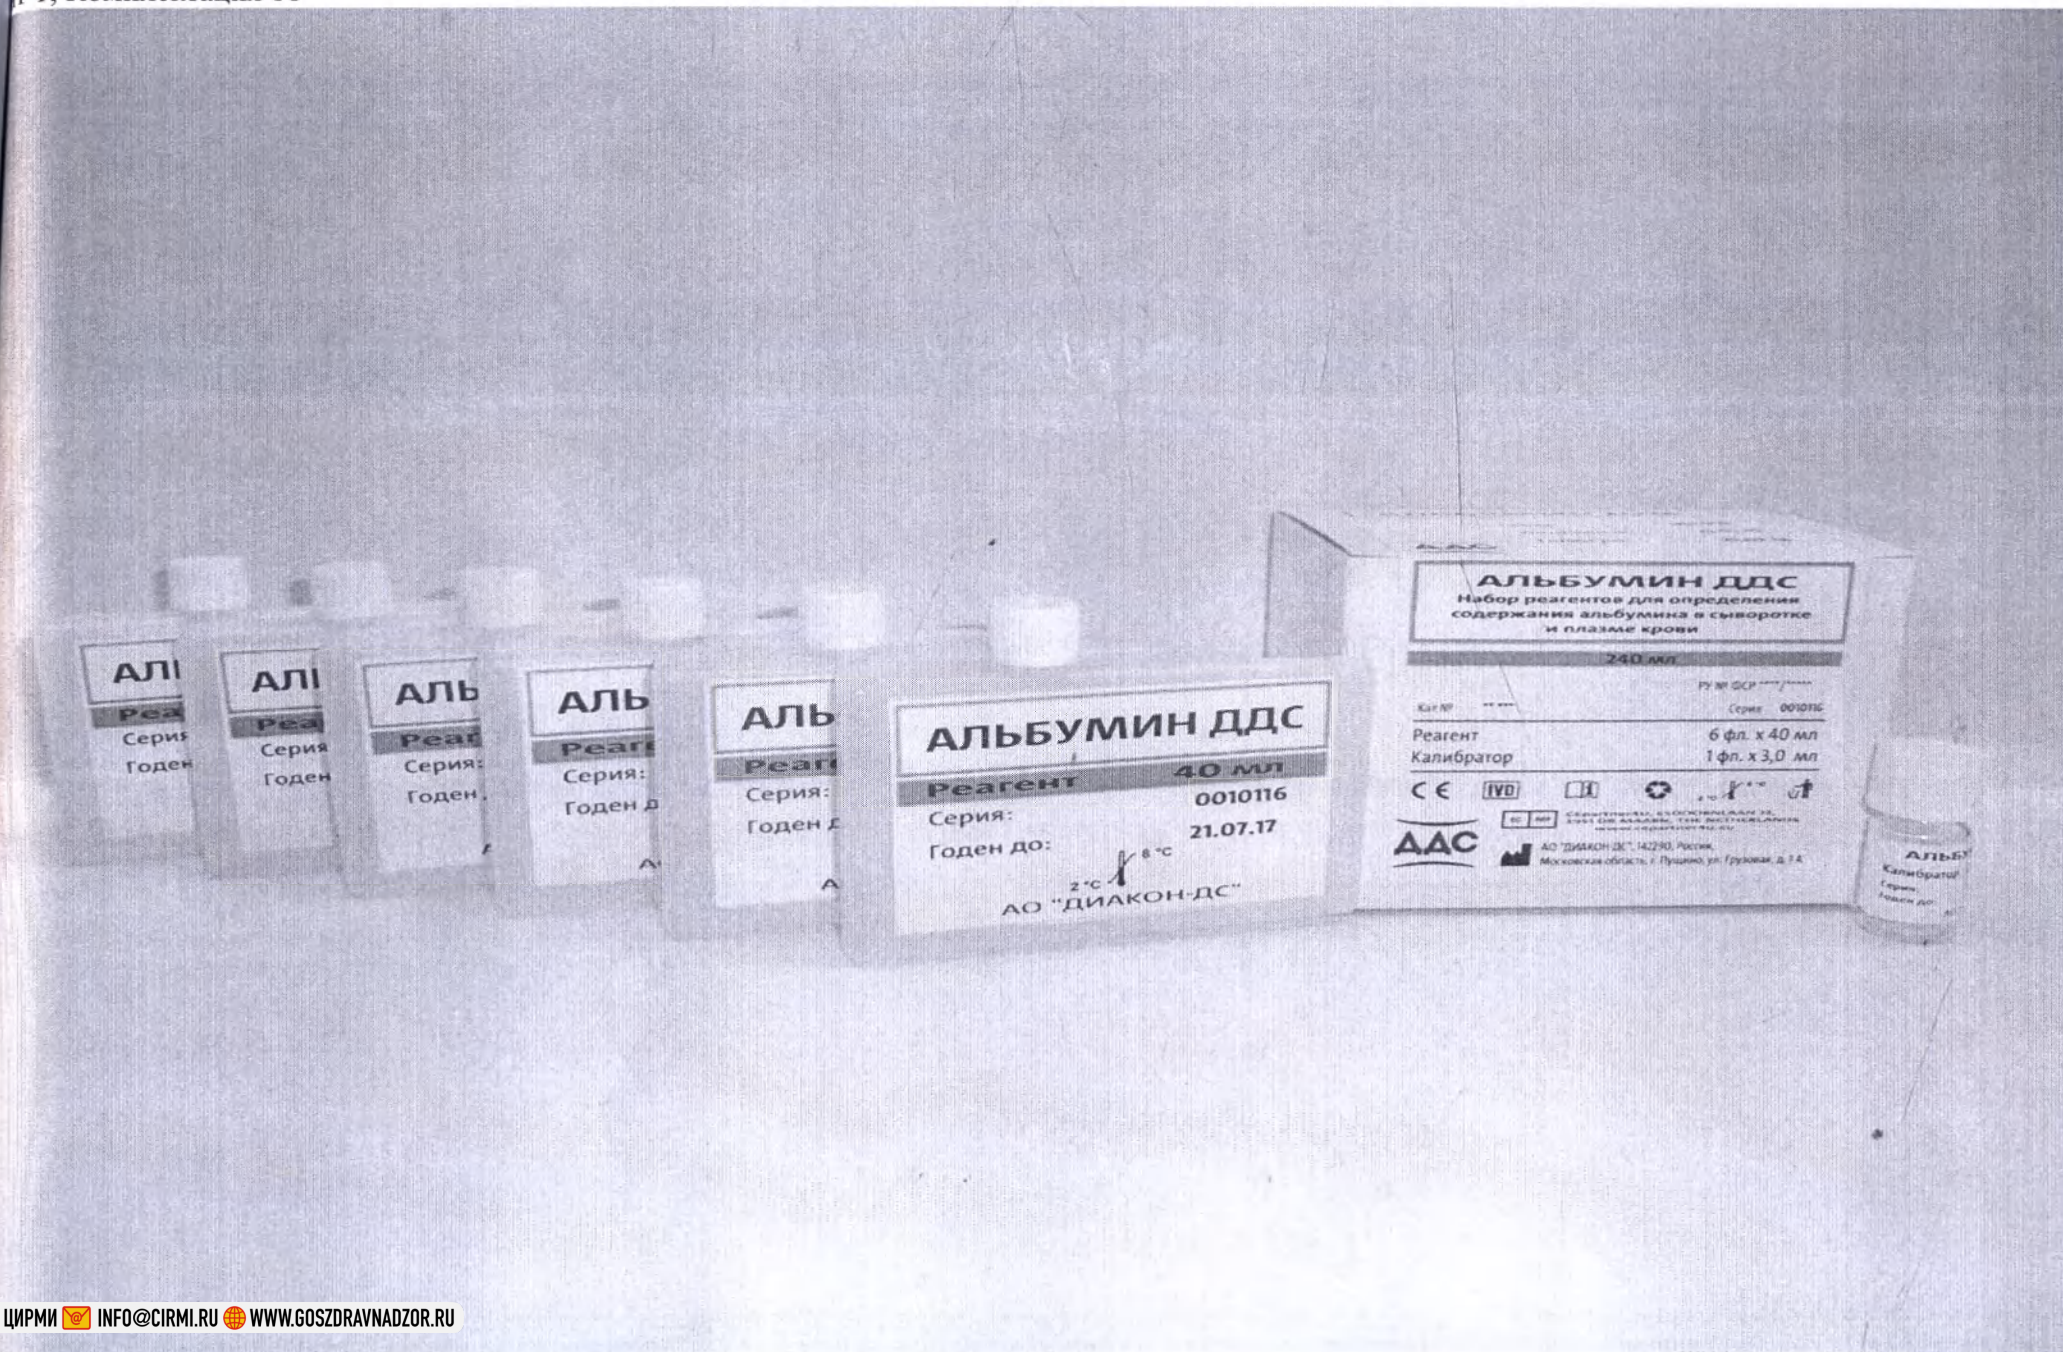


Т 1, Комплектация 12




Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

т 1, Комплектация 13

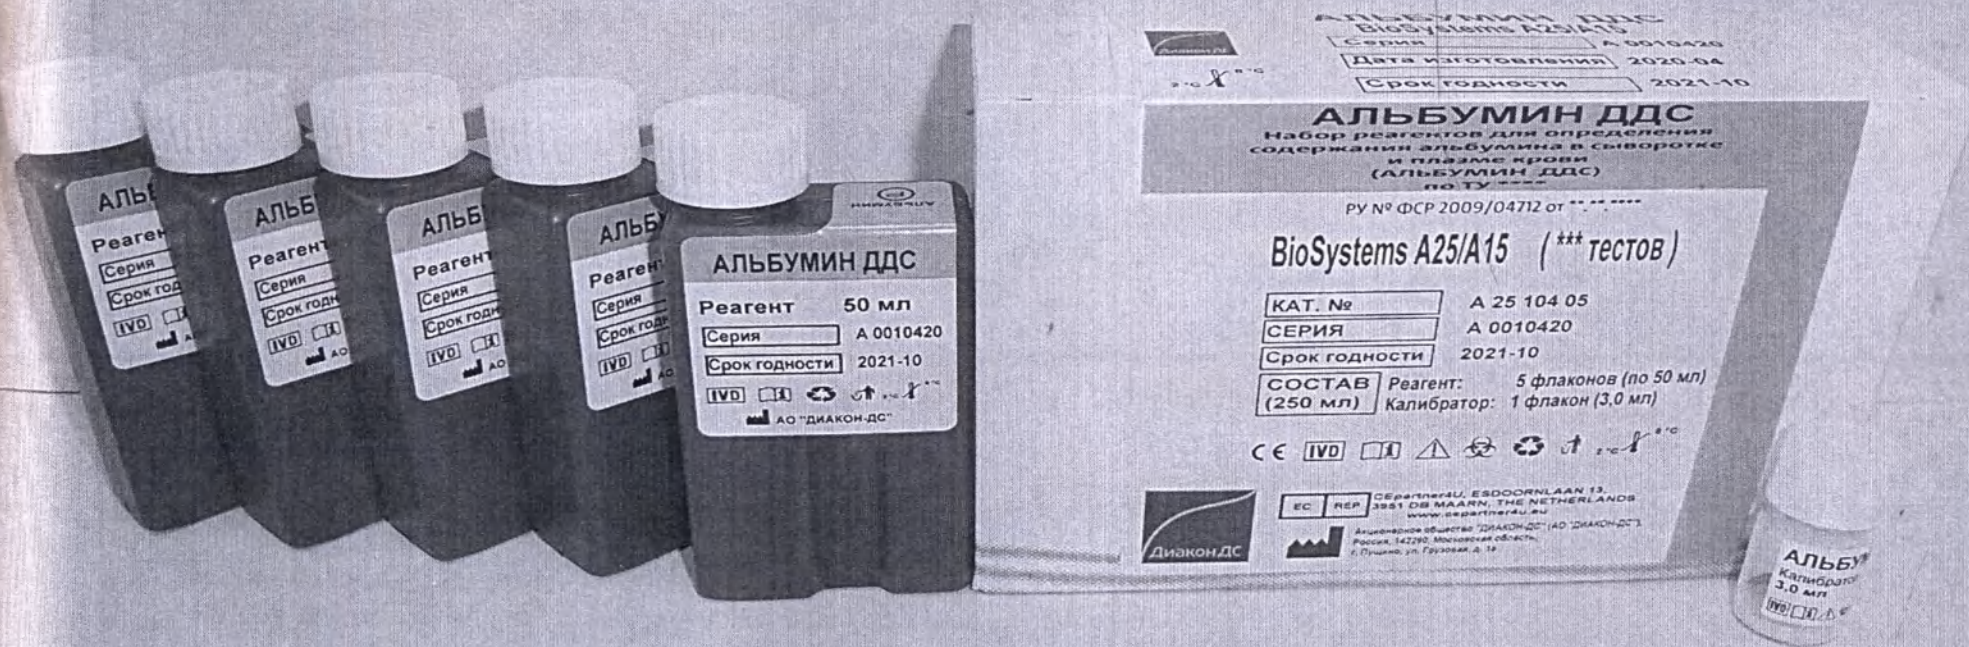


Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
 Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
 (АЛЬБУМИН ДДС)

ИНТ 1, Комплектация 14

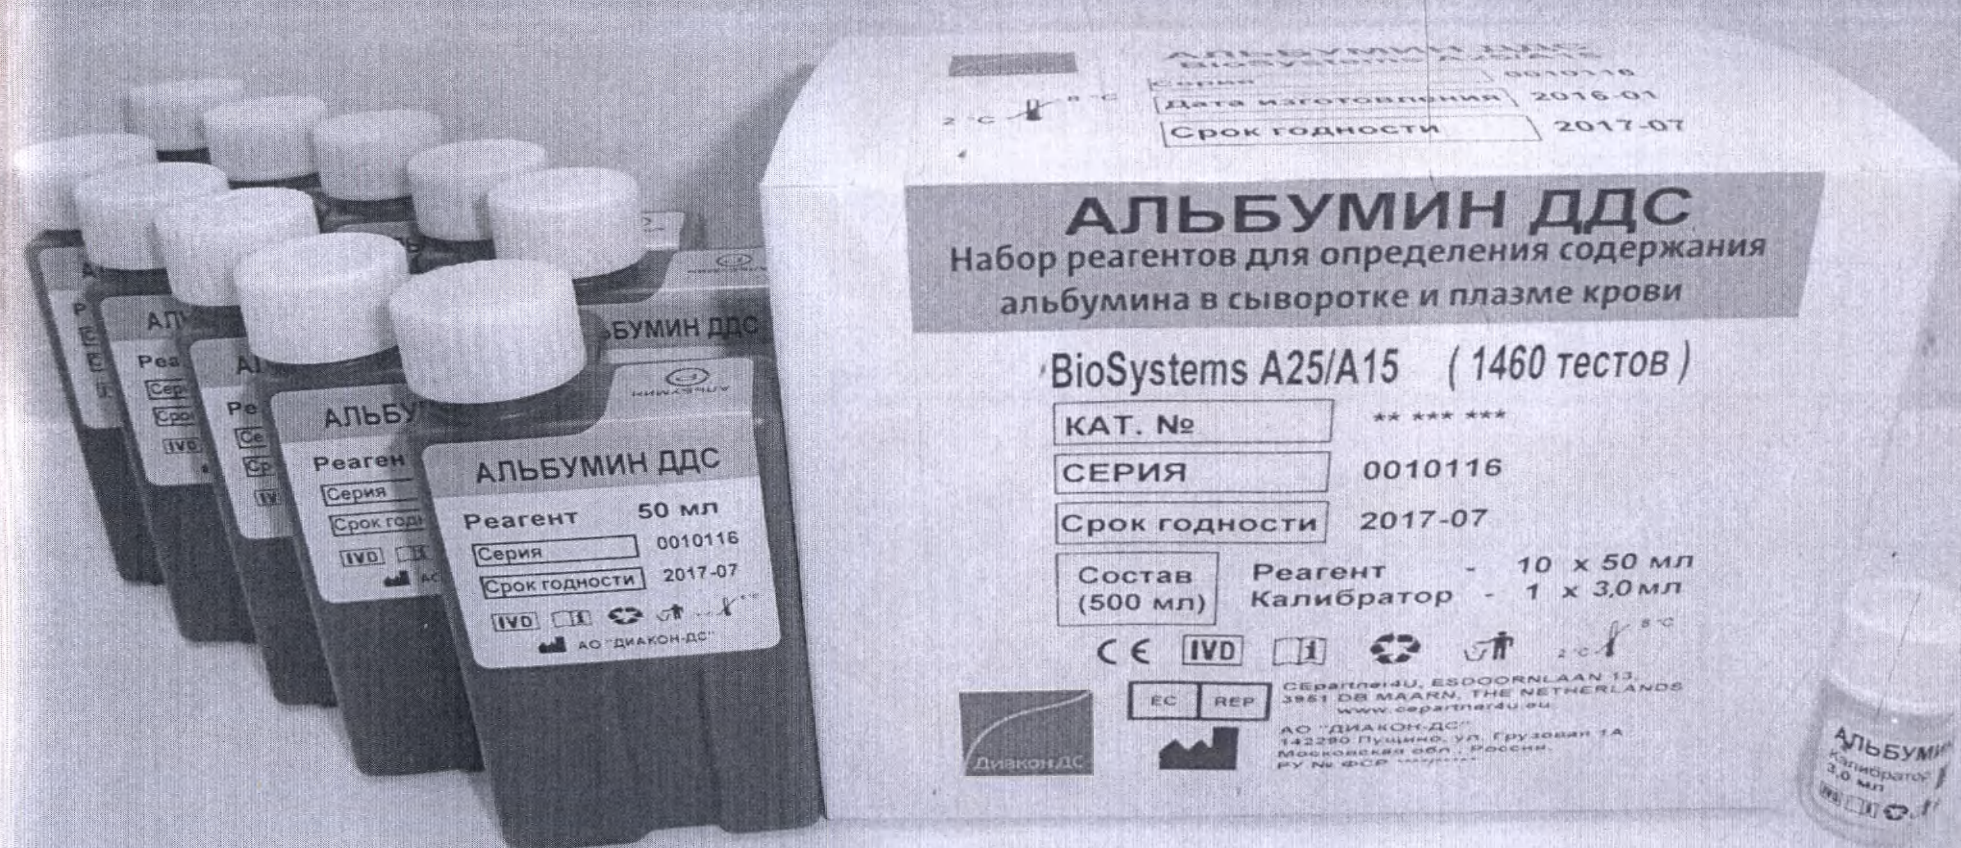


Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

Лист 1, Комплектация 15

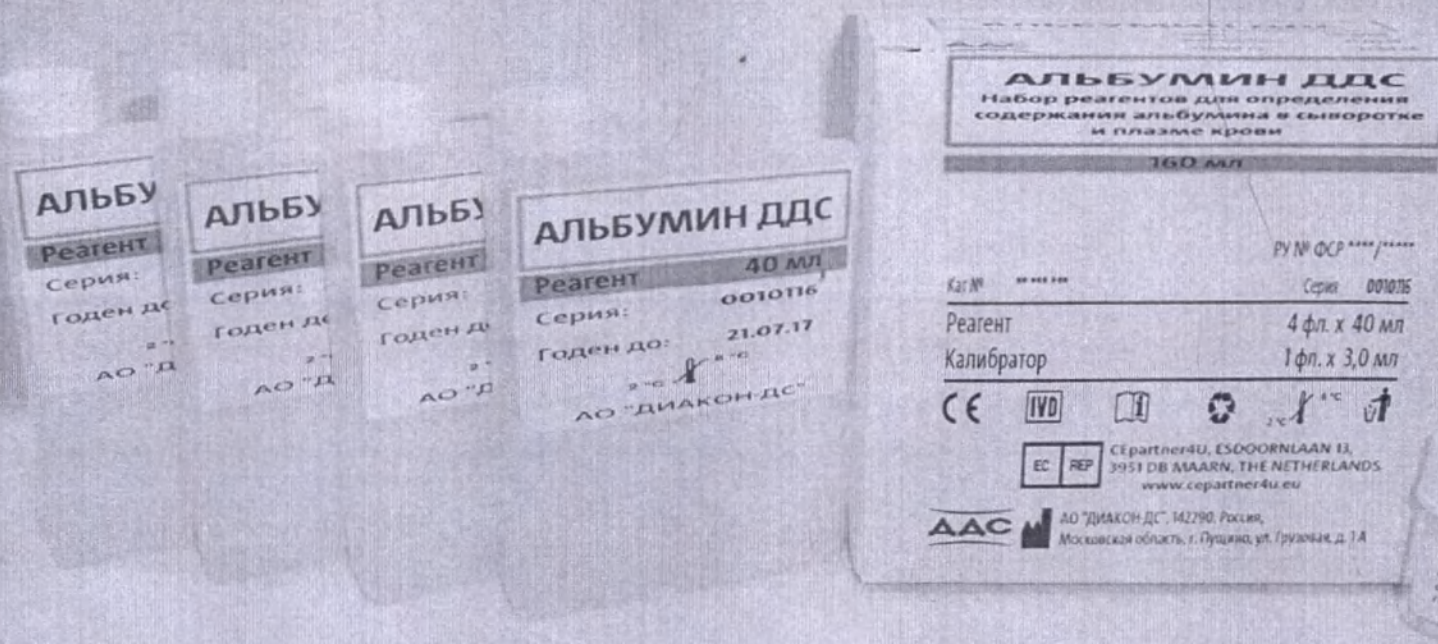

Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови (АЛЬБУМИН ДДС)


т 1, Комплектация 16

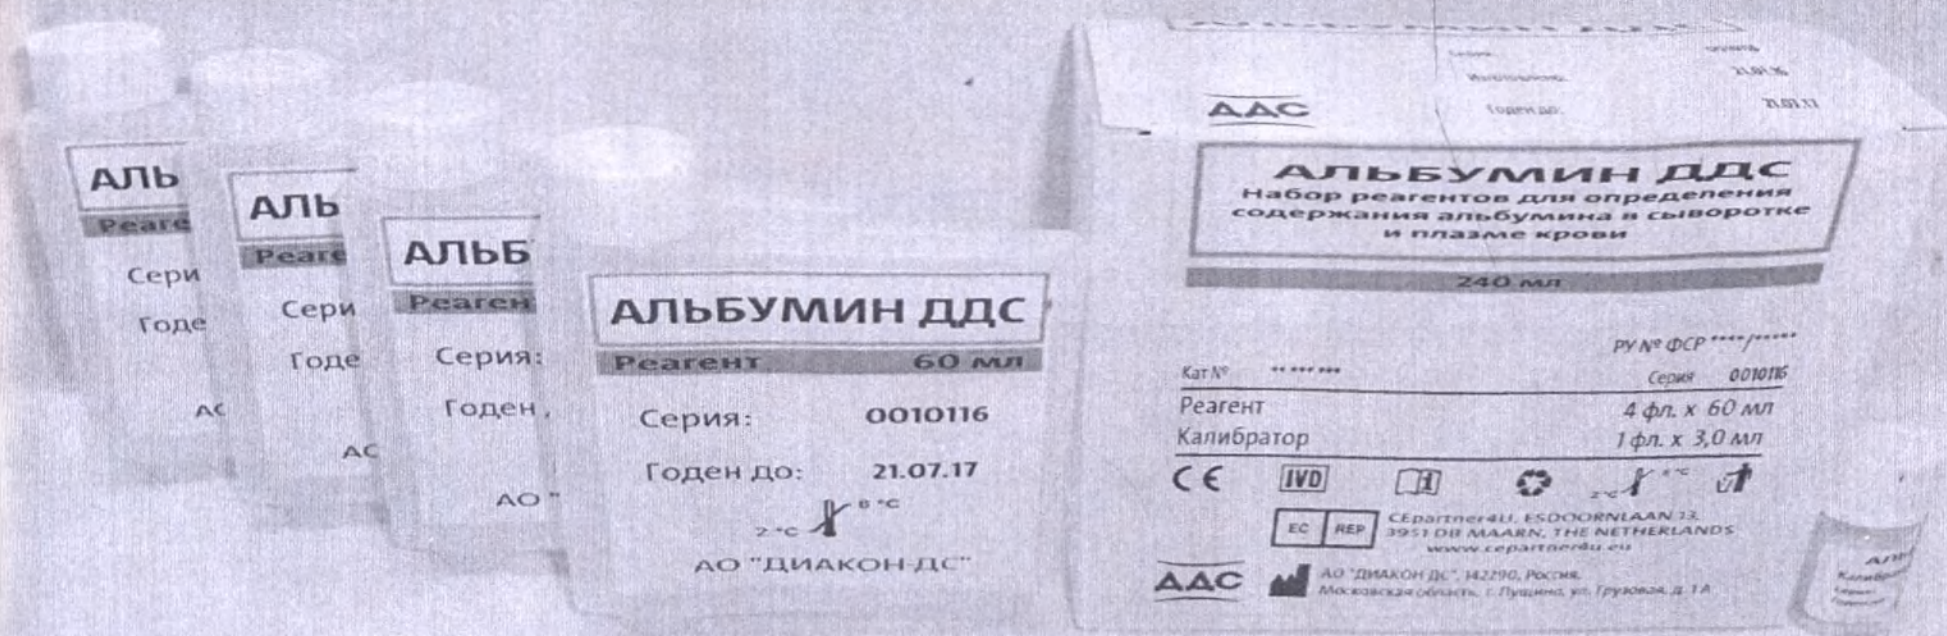





Внешний вид (комплектация по 32 ГД 1272 и 1273)
**Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
 (АЛЬБУМИН ДДС)**

Лист 1, Комплектация 19

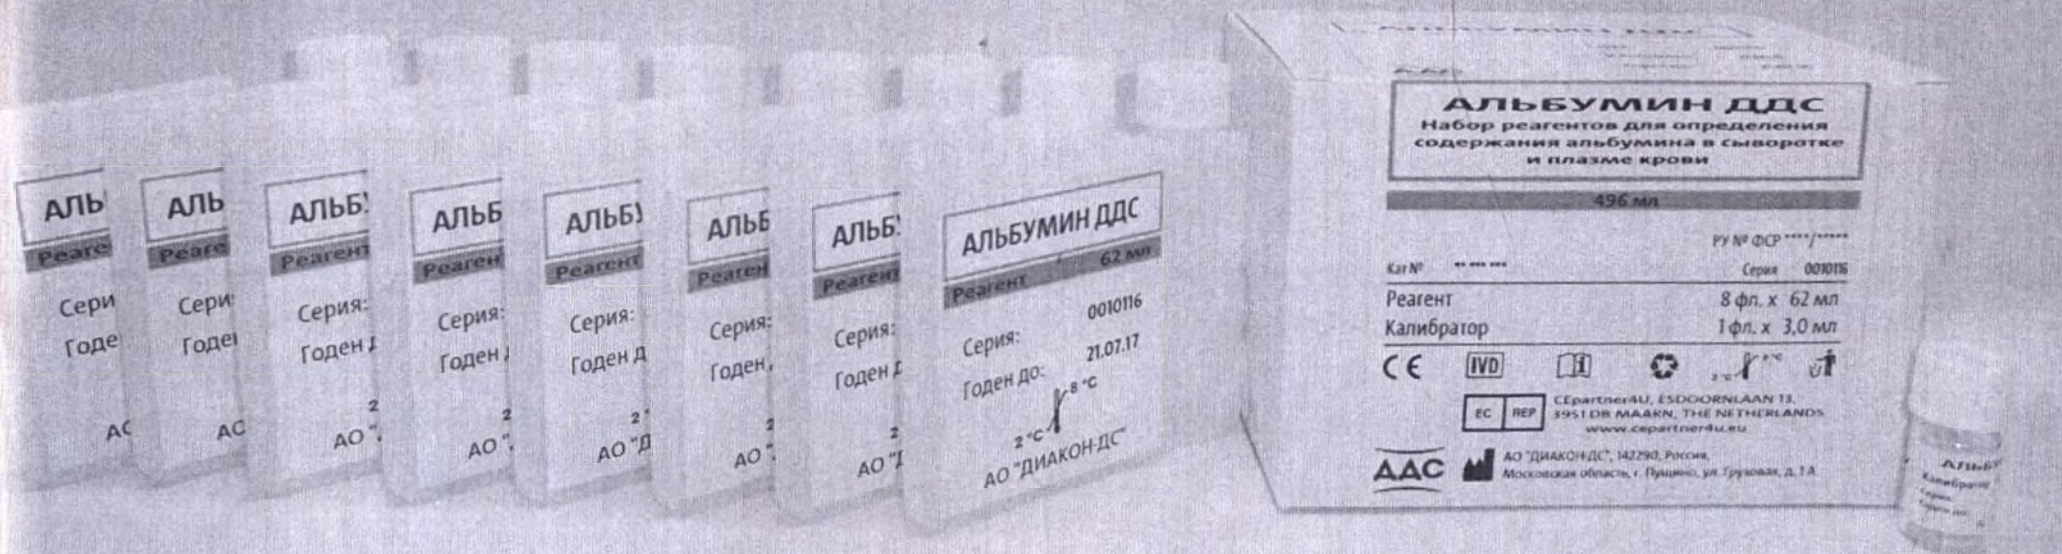




Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

ант 1, Комплектация 20

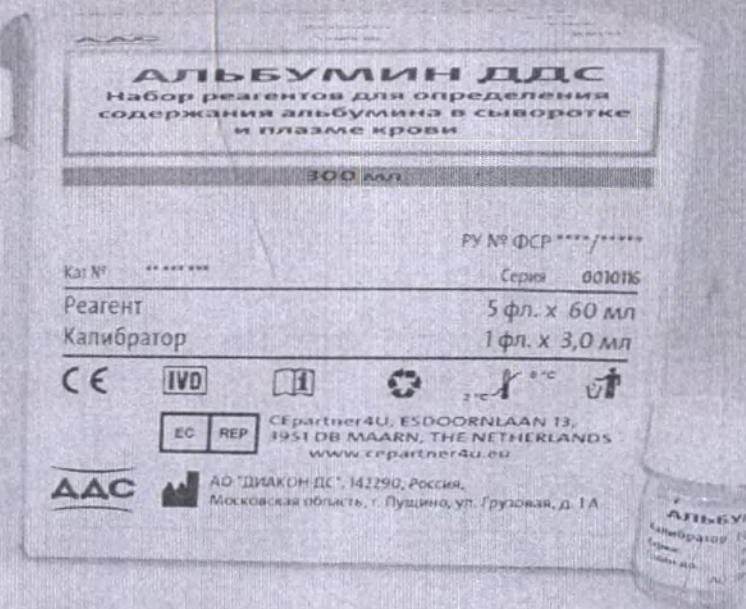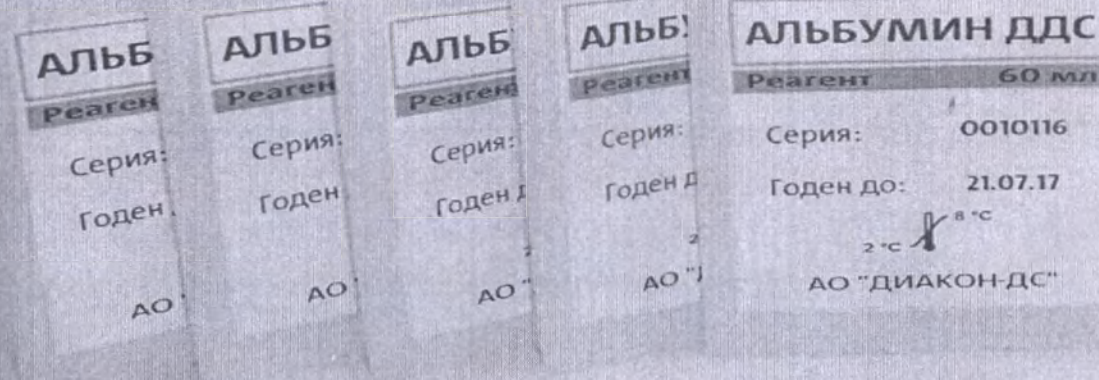


Внешний вид (комплектаций по № РД-12724/43931 от 18.08.2016)
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

ант 1, Комплектация 21

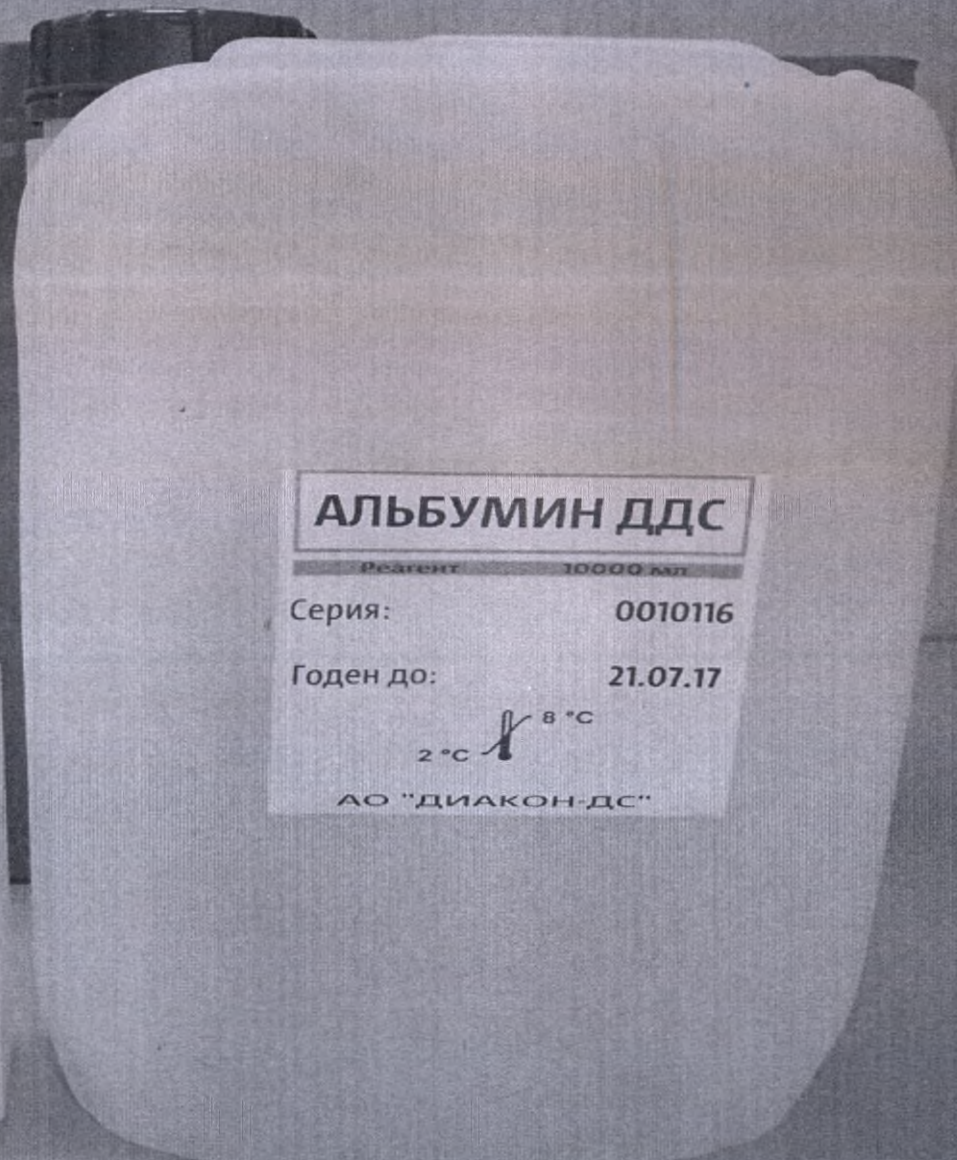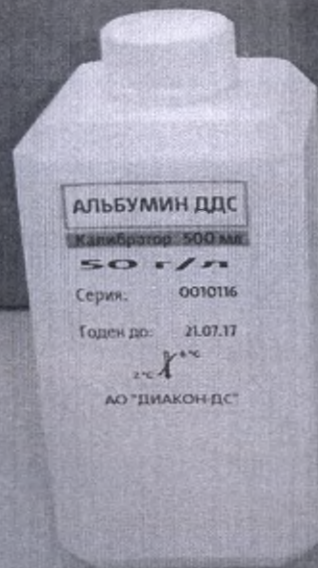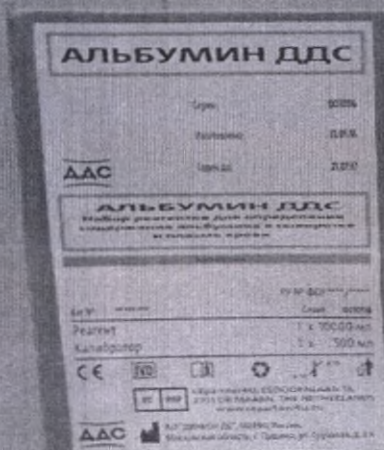

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 21


Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»


Т.Ю. Корзун



Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови (АЛЬБУМИН ДДС)

Вариант 1, Комплектация 22

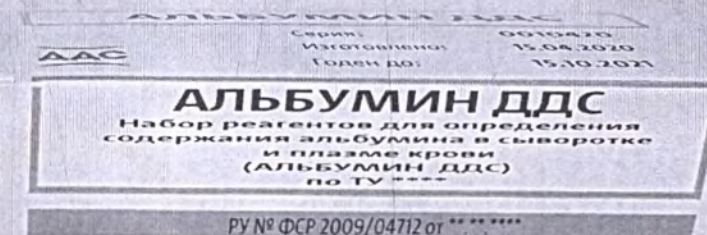


90 мл

Кат № ****


Серия 0010420

Реагент: 5 флаконов (по 18 мл)

Калибратор: 1 флакон (3,0 мл)



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu




Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а



внешний вид
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

лент 1, Комплектация 23

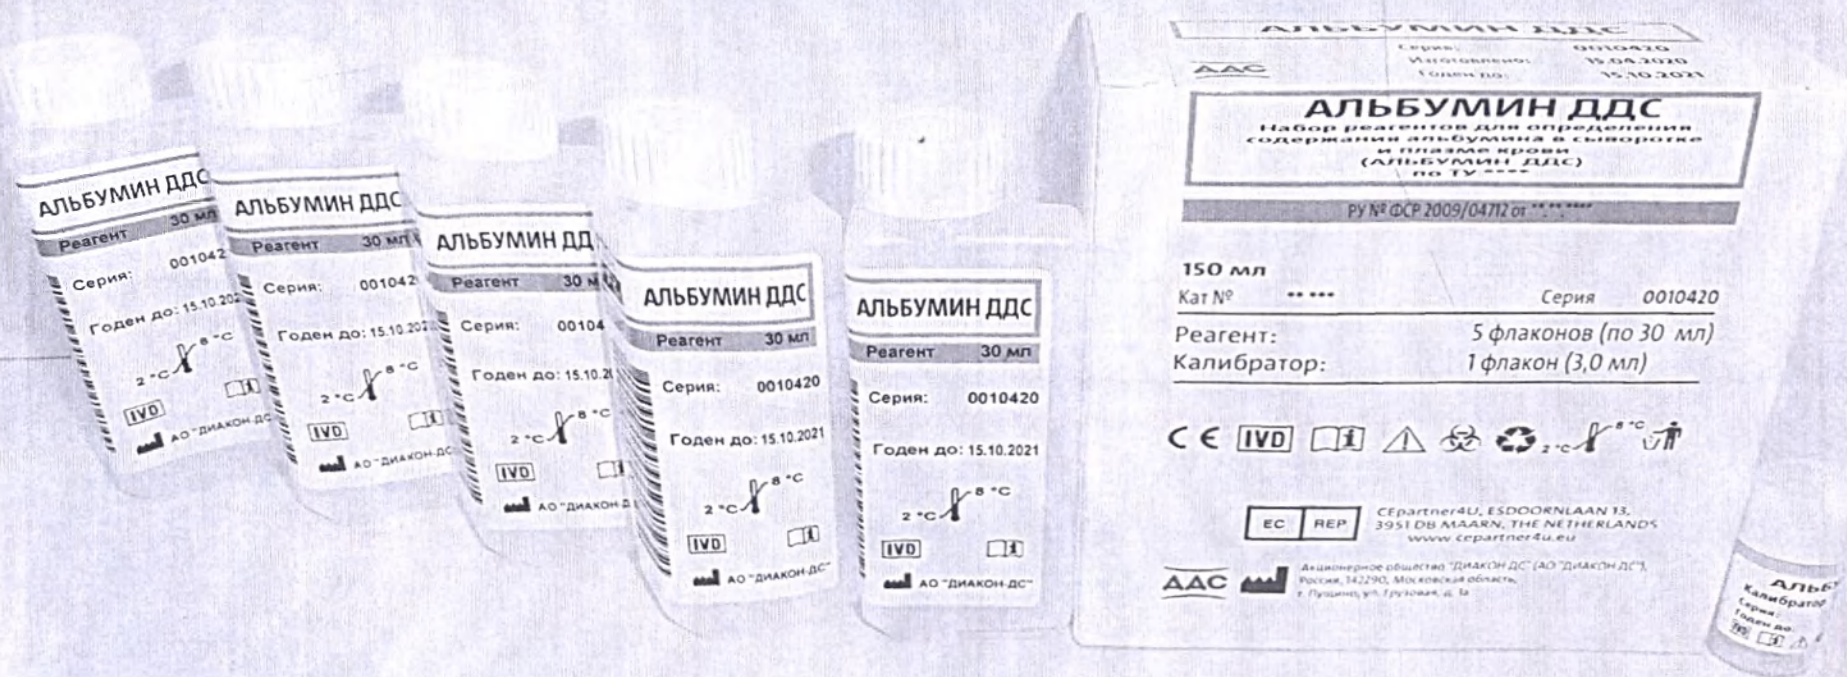

Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)

т 1, Комплектация 24

АЛЬБУМИН ДДС
Реагент
Серия: 00K
Годен до: 15.10
2°C 8°C
IVD AO "ДИАКОН"

АЛЬБУМИН ДДС
Реагент 100 мл
Серия: 0010420
Годен до: 15.10.2021
2°C 8°C
IVD AO "ДИАКОН ДС"

АЛЬБУМИН ДДС
Реагент 100 мл
Серия: 0010420
Годен до: 15.10.2021
2°C 8°C
IVD AO "ДИАКОН ДС"

АЛЬБУМИН ДДС
Реагент 100 мл
Серия: 0010420
Годен до: 15.10.2021
2°C 8°C
IVD AO "ДИАКОН ДС"

АЛЬБУМИН ДДС
Набор реагентов для определения
содержания альбумина в сыворотке
и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)
по ТУ ----
ПУ № ФСР 2009/04712 от --. --. --
600 мл
Кат. № ----
Серия 0010420
Реагент: 6 флаконов (по 100 мл)
Калибратор: 2 флакона (по 3,0 мл)
CE IVD EC REP
СЕpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.separtner4u.eu
Акционерное общество "ДИАКОН ДС" (АО "ДИАКОН ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а




Внешний вид
Набора реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови
(АЛЬБУМИН ДДС)


л 2, Комплектация 1



2, Комплектация 2



2, Комплектація 3

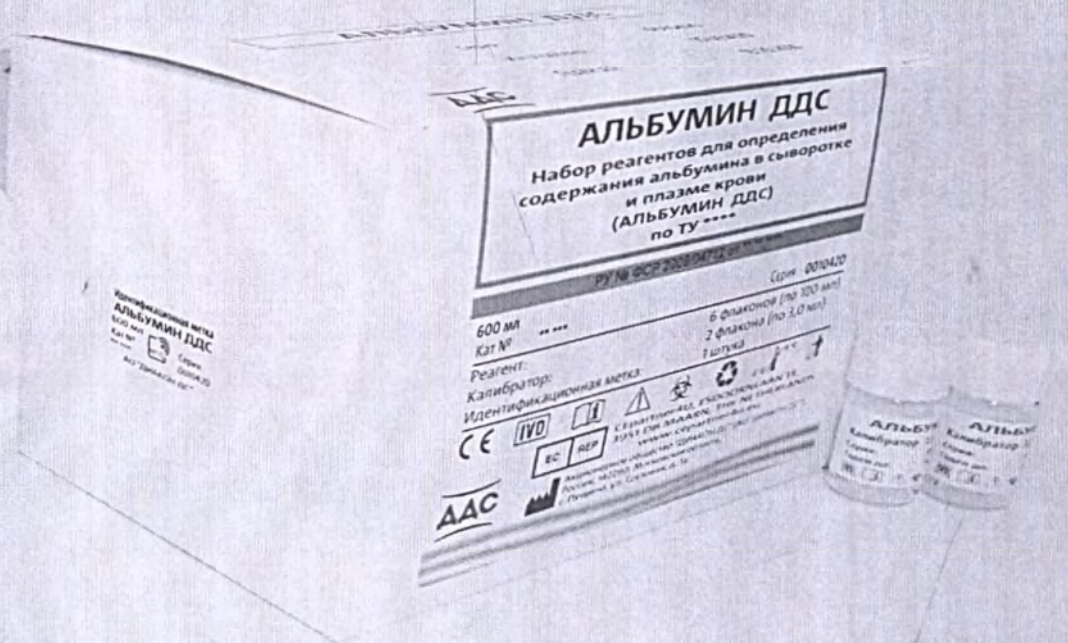

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



Т.Ю. Корзун

