



17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

ПОДТВЕРЖДАЮ

Старший специалист по регистрации
ООО "Джонсон & Джонсон"
Финкель Ростислав
на основании доверенности
от № 77 АБ 8567469 от 19.11.2015



Фотографические изображения

**«Катетер навигационный для электрофизиологического
исследования сердца»,
производства Biosense Webster, Inc., USA**



Рисунок 1.

Вторичная упаковка Катетера навигационного для электрофизиологического исследования сердца

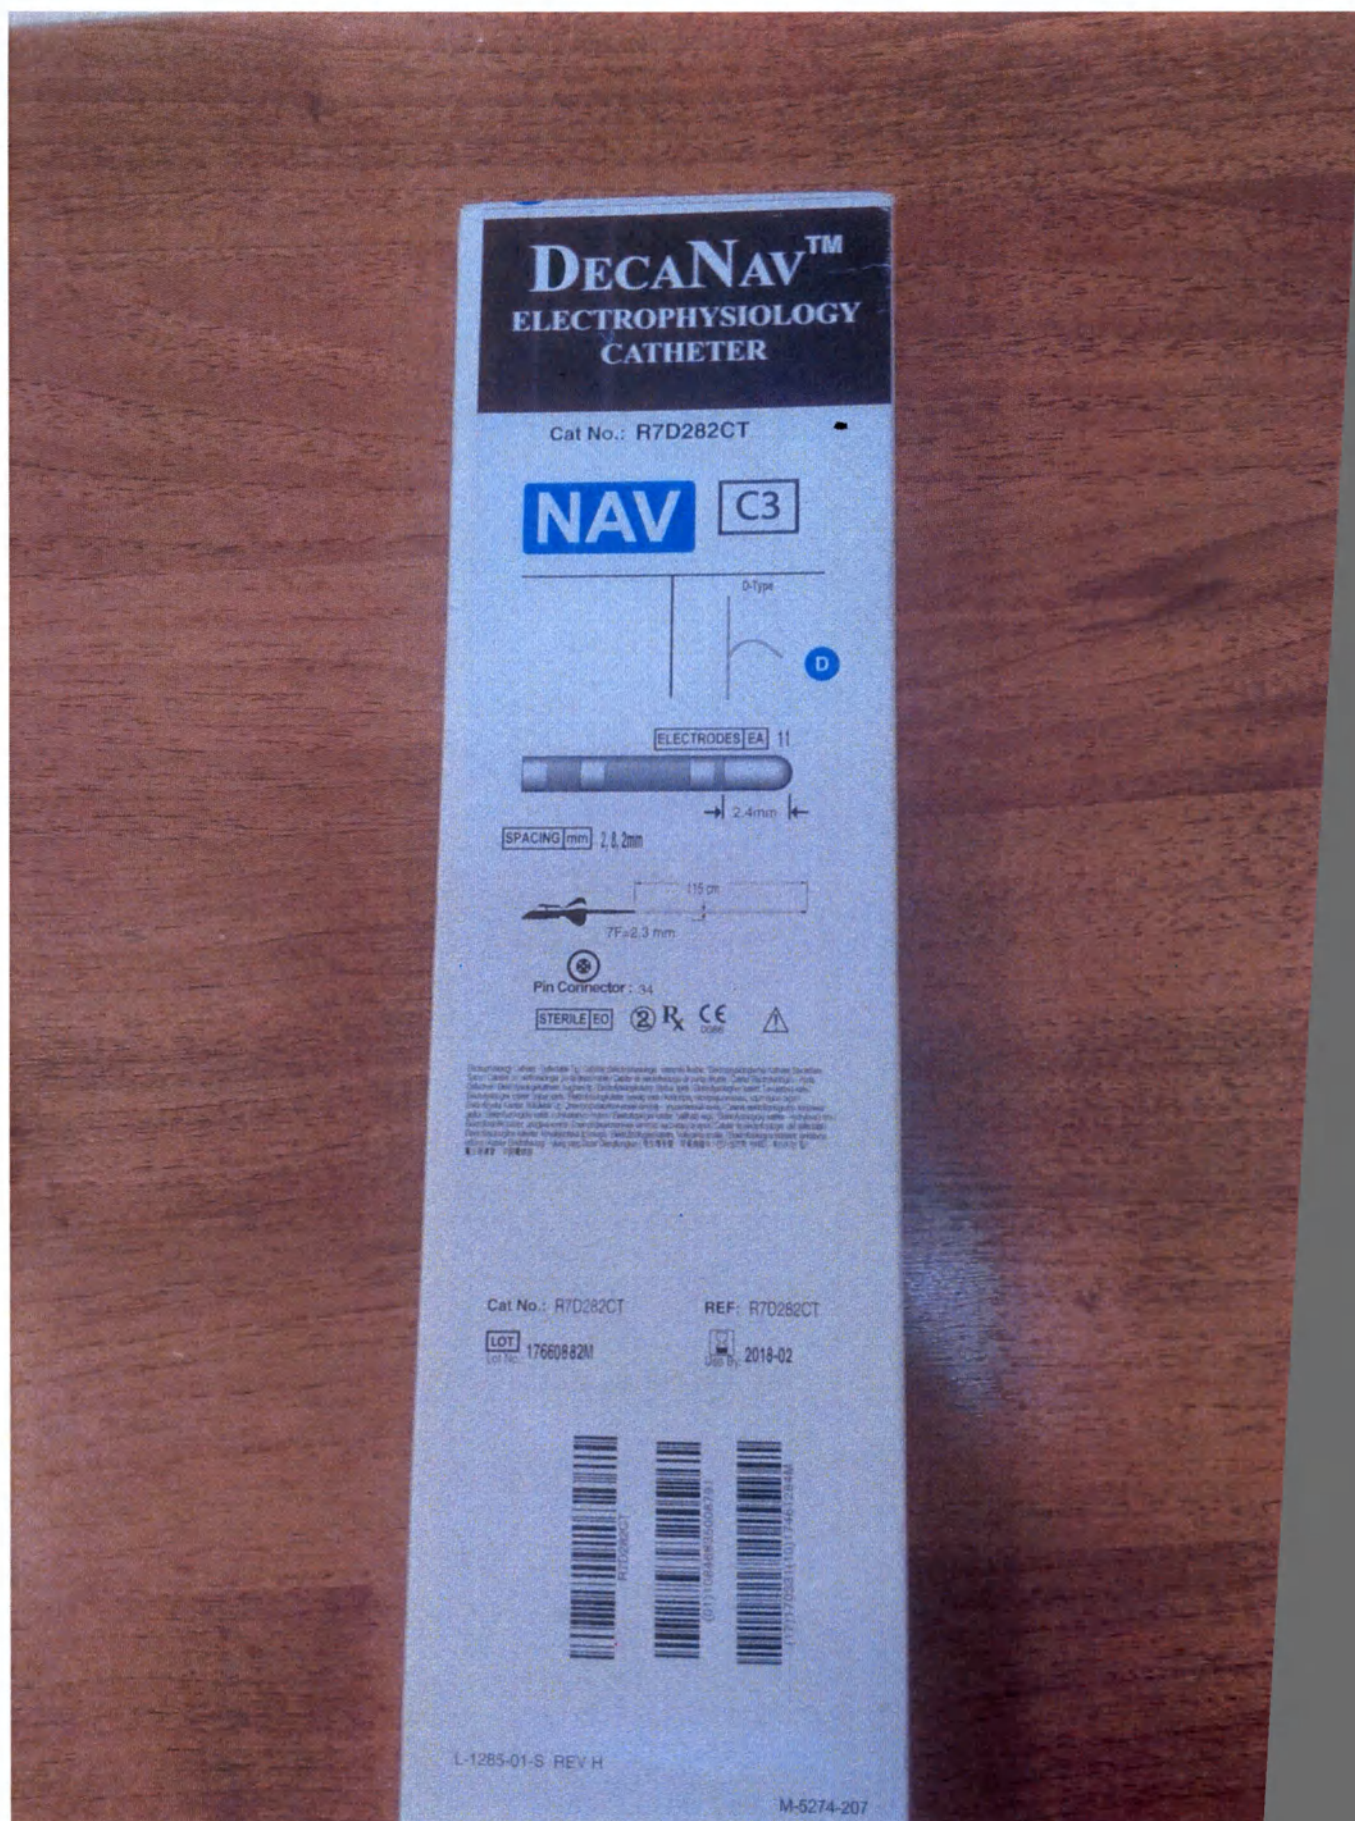


Рисунок 2.

Маркировка вторичной упаковки Катетера навигационного для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер DecaNav)



Рисунок 3.

Маркировка первичной упаковки Катетера навигационного для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер DecaNav)

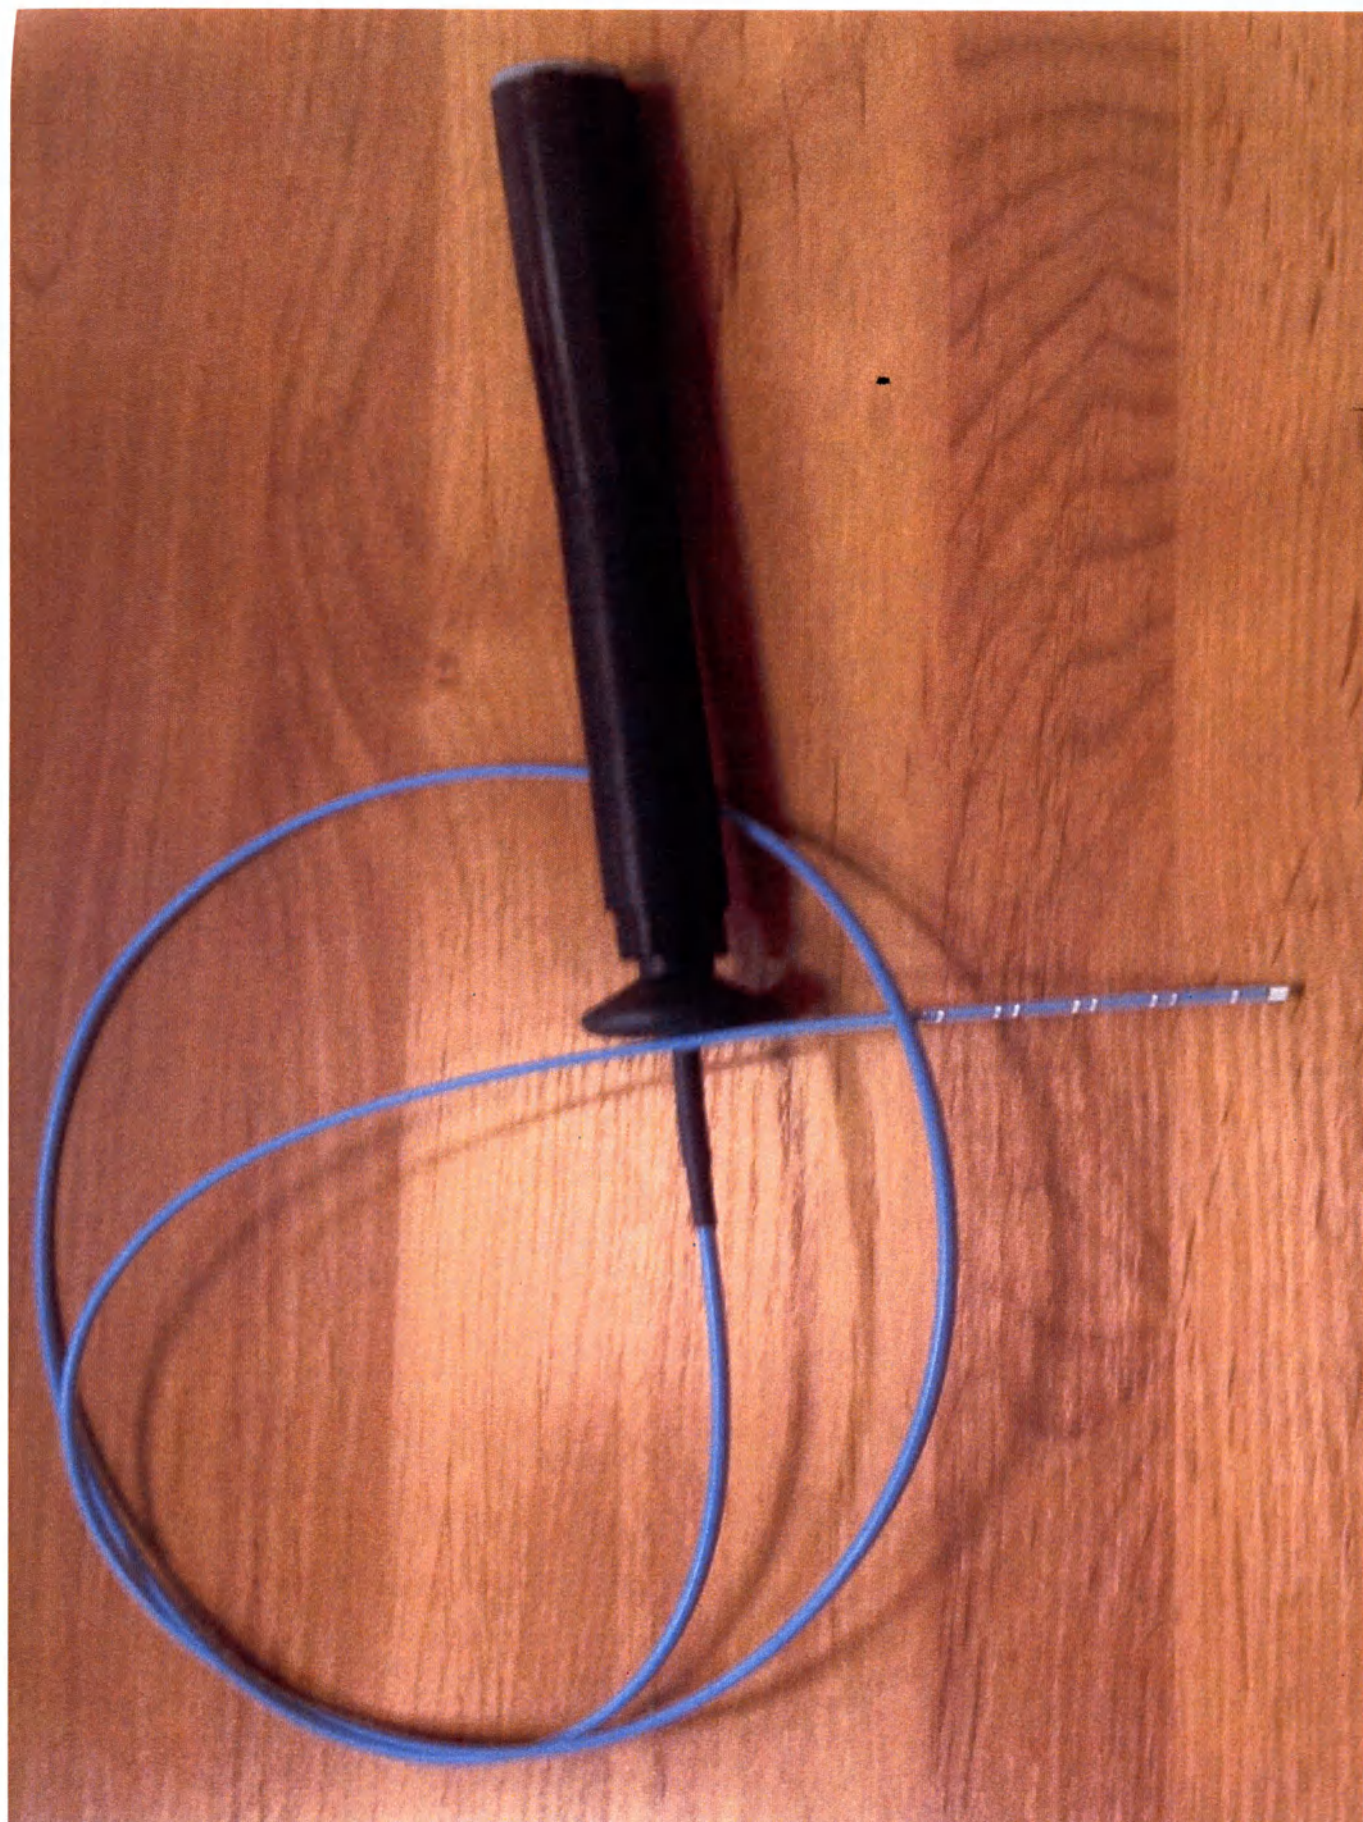


Рисунок 4.

Катетер навигационной для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер DecaNav)



Рисунок 5.

Рукоятка Катетера навигационного для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер DecaNav)



Рисунок 6.

Конец Катетера навигационного для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер DecaNav)



Рисунок 8.

Первичная упаковка Катетера навигационного для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер Lasso 2515 NAV eco)



Рисунок 9.

Катетер навигационный для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер Lasso 2515 NAV eco) в лотке



Рисунок 10.
Катетер навигационный для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения)
Катетер Lasso 2515 NAV eco) в лотке

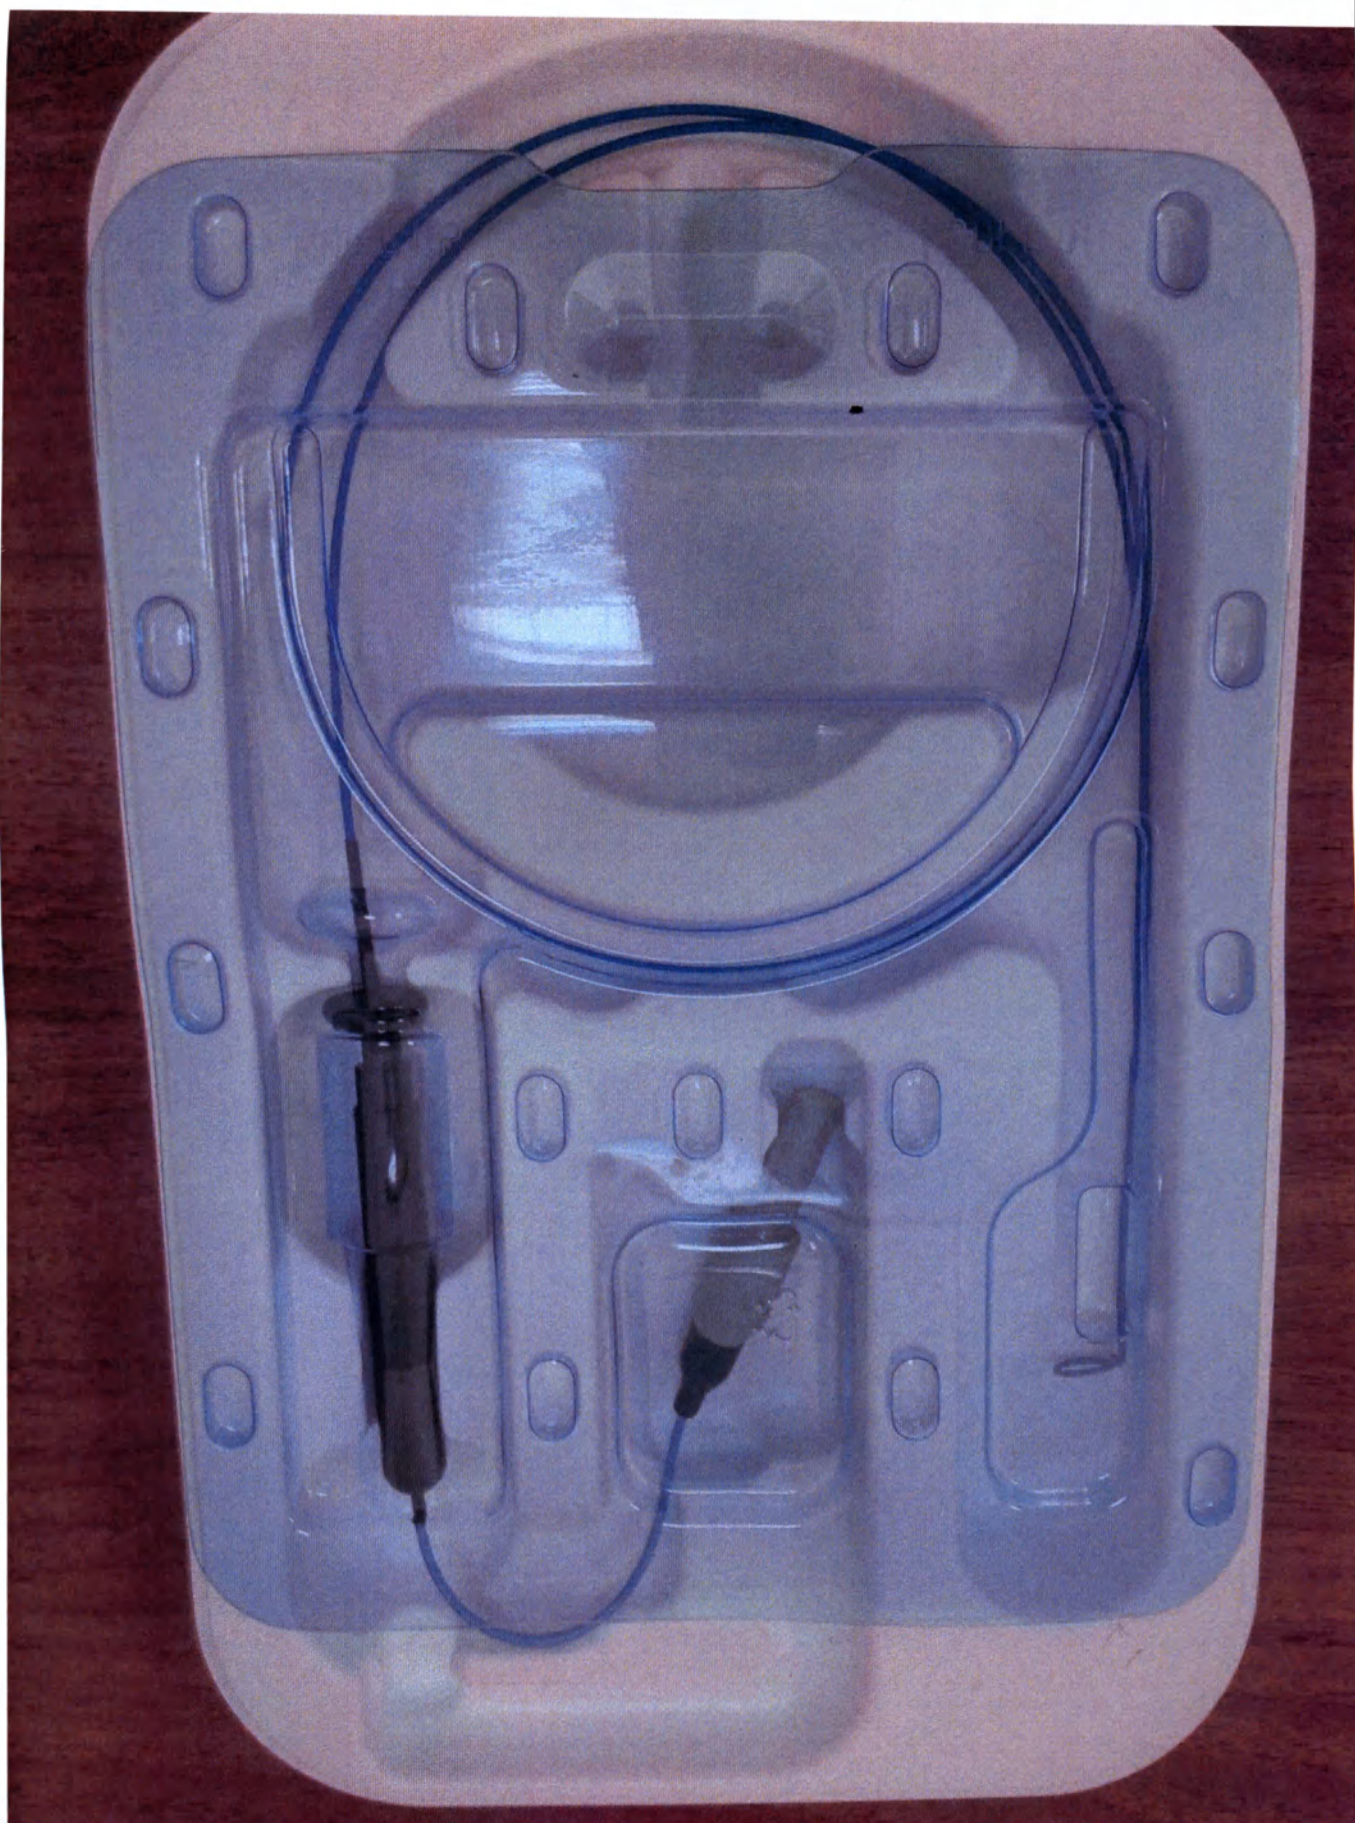


Рисунок 11.

Катетер навигационный для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер Lasso NAV eso) в лотке



Рисунок 12.

Катетер навигационный для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер Lasso NAV eco)

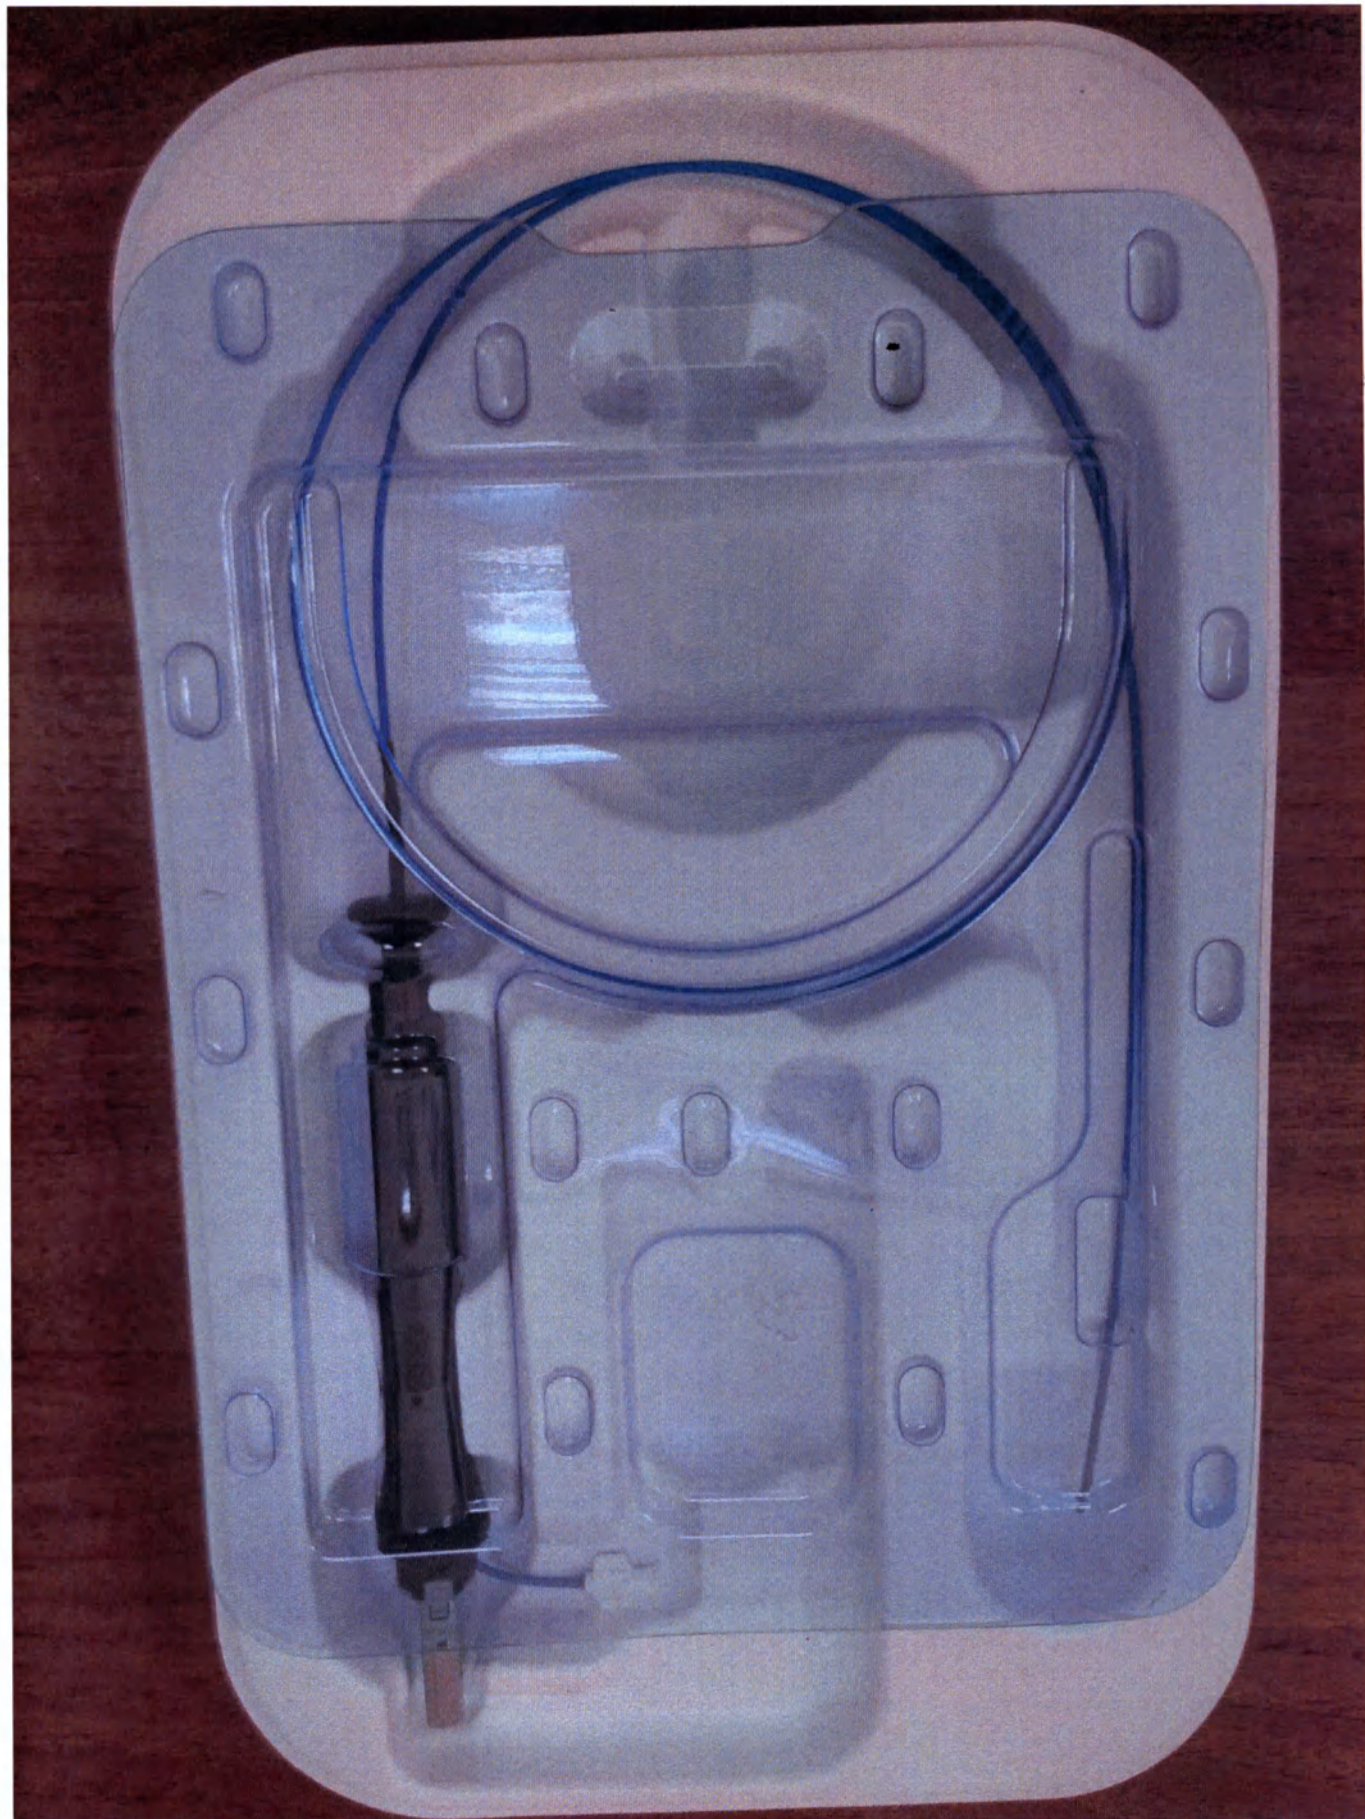


Рисунок 13.

Катетер навигационный для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер PentaRay NAV eco) в лотке

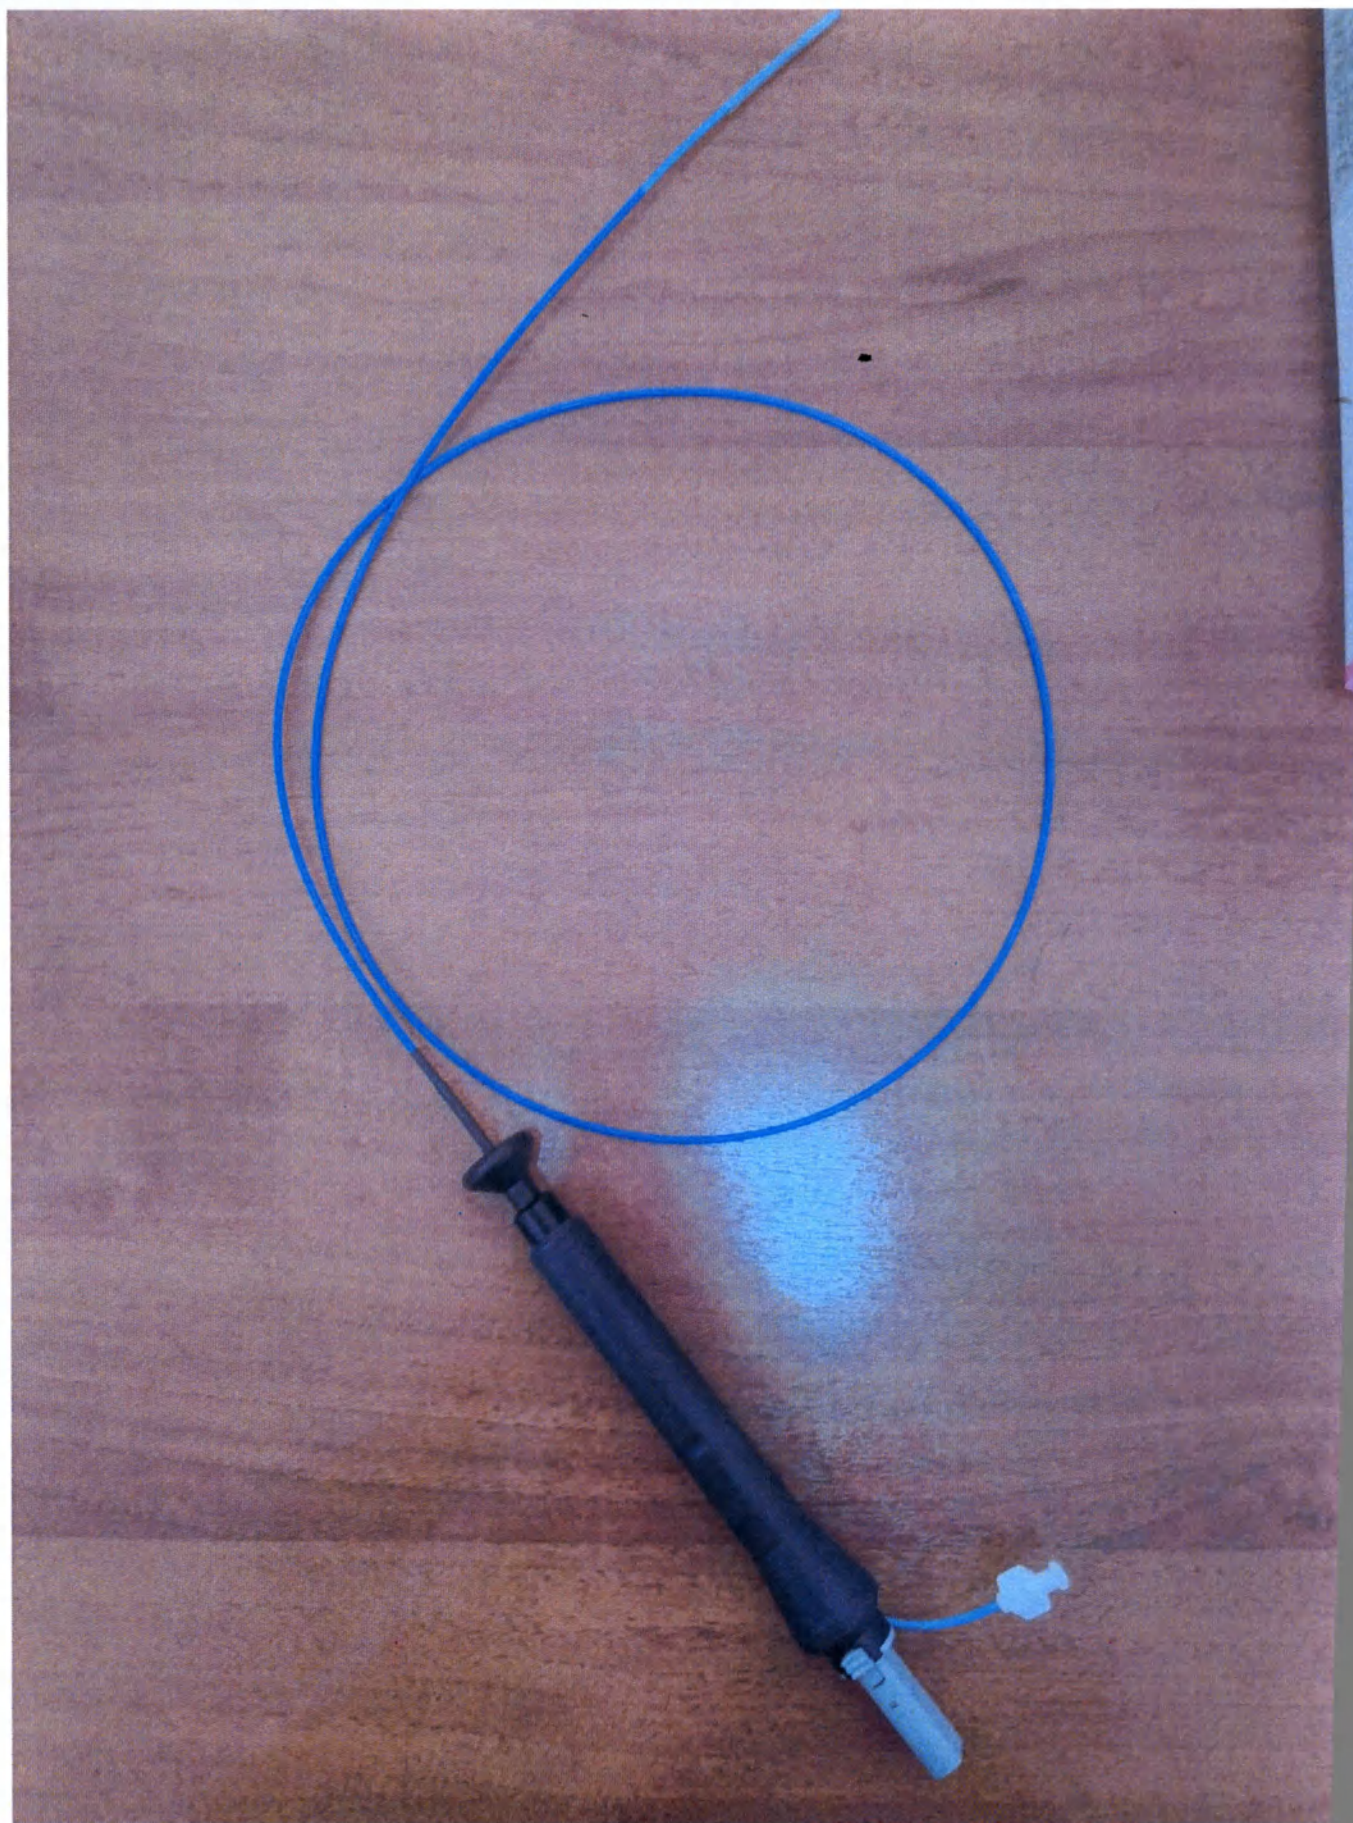


Рисунок 14.

Катетер навигационный для электрофизиологического исследования сердца (вариант исполнения Катетер PentaRay NAV eco)



CARTO[®] 3 SYSTEM INTERFACE CABLE

L-1286-03-9

STERILE EO

34 Pin - Red

[illegible]

34 Pin - Red

1. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 2. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 3. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 4. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 5. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 6. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 7. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 8. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 9. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)
 10. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml) (10 min, 100°C)


Case No. CR243473

REF: CR3434CT



LOT 17405181L

2018-12



501-525-4500



(17) 101233(10)1740518

[illegible]

Рисунок 15.
Вторичная упаковка кабеля соединительного.

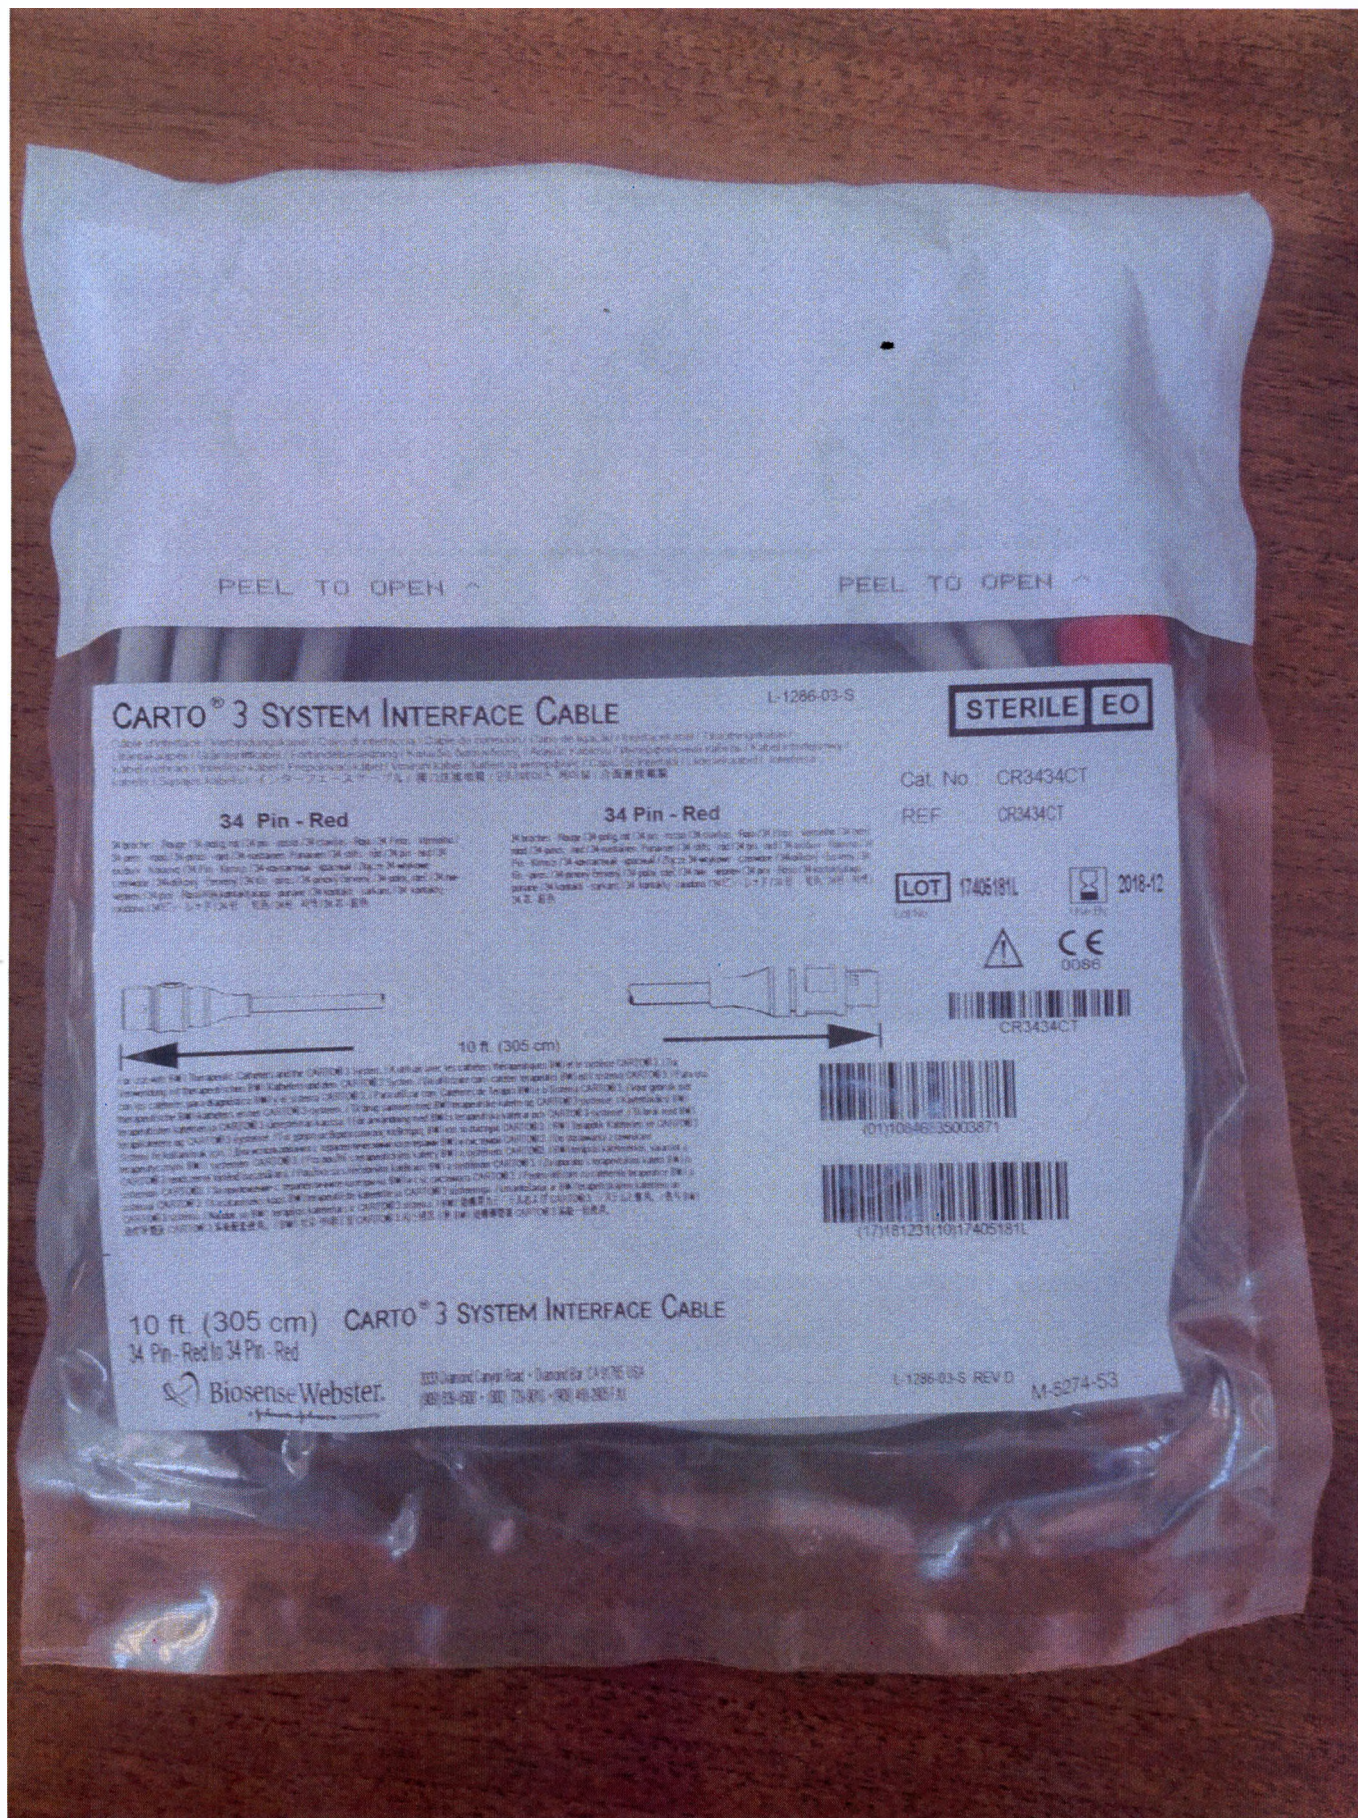


Рисунок 16.

Первичная упаковка и маркировка кабеля соединительного.



Рисунок 17.
Кабель соединительный в первичной упаковке

