

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «УАЙТ СЕРВИС»

Голодок А.В.

«06» сентября 2021 г.

М.П.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из
носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag
Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021»**

наименование медицинского изделия


Вариант исполнения 1

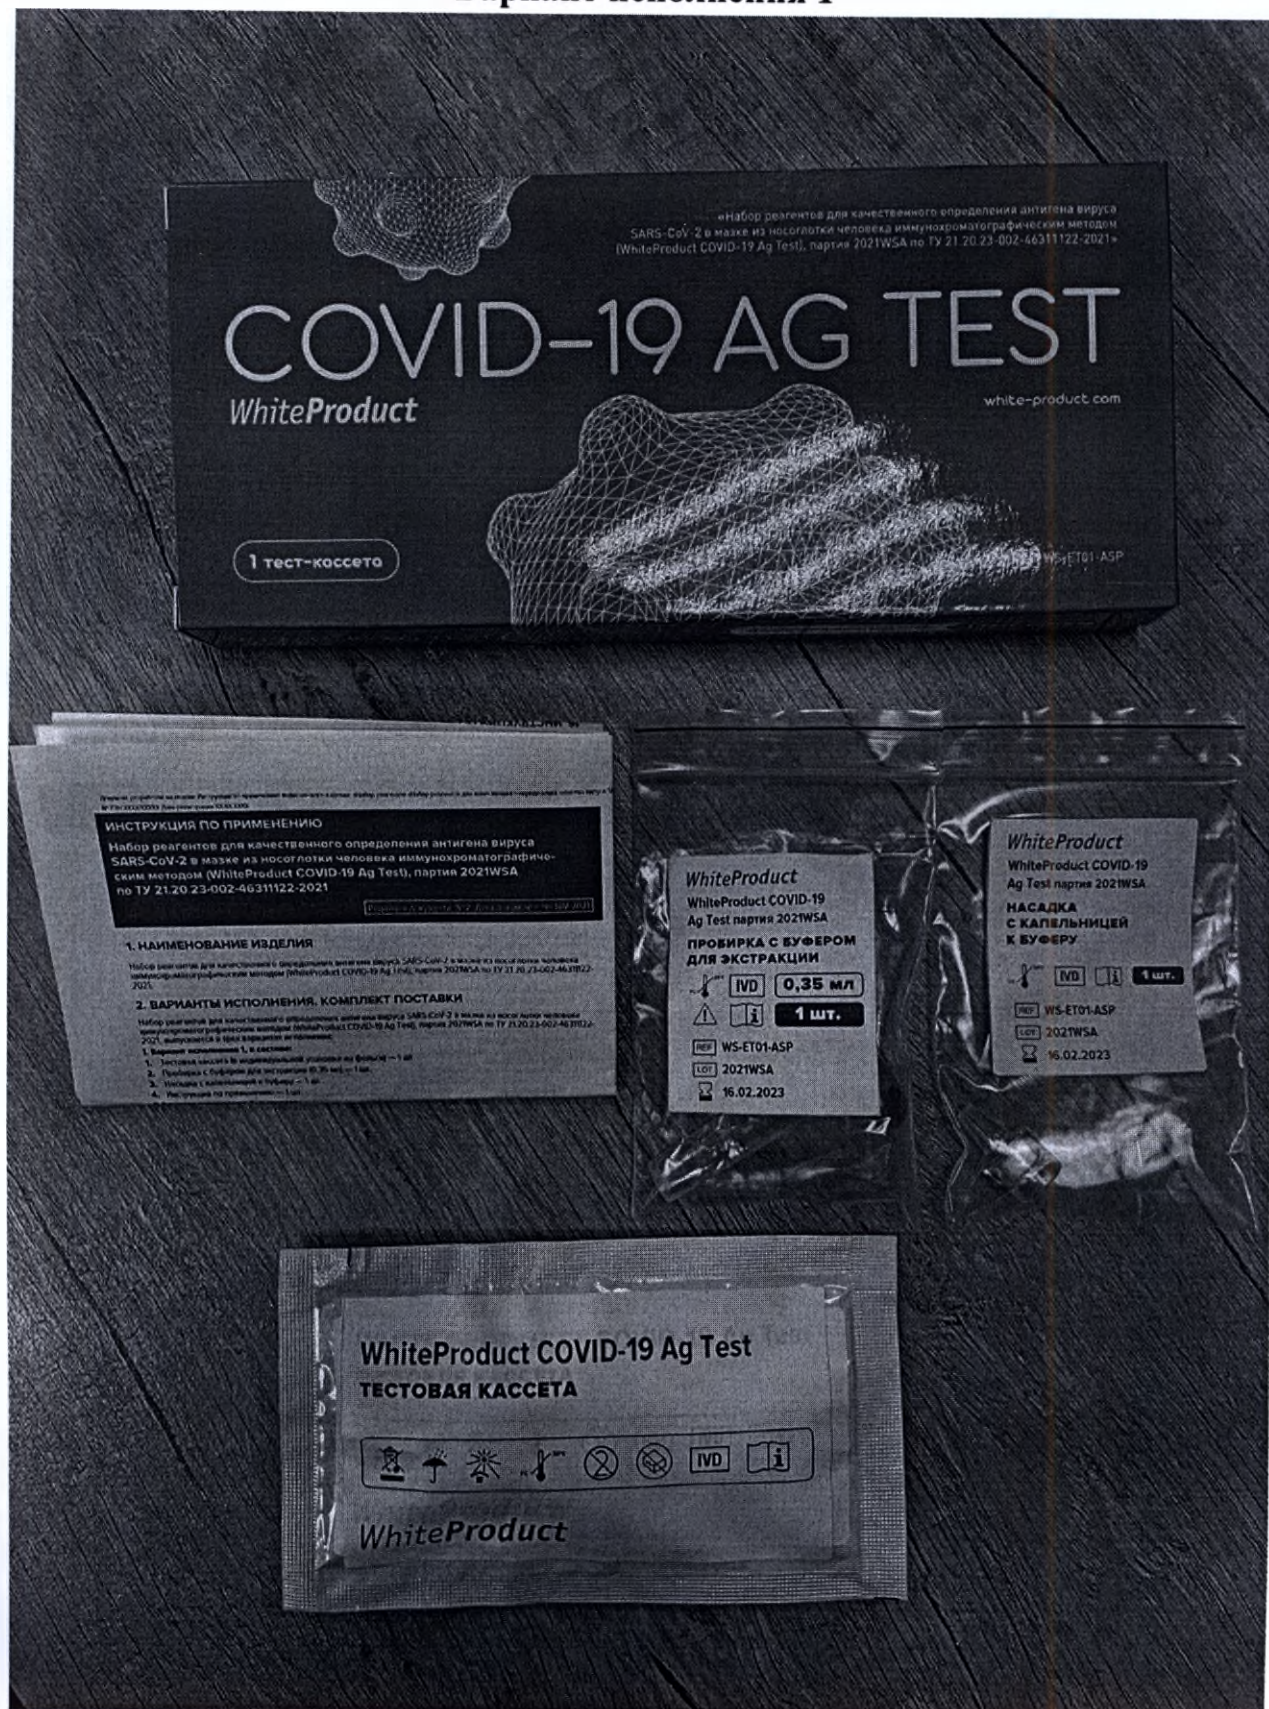

Общий вид медицинского изделия: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 1



Общий вид потребительской упаковки: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 1

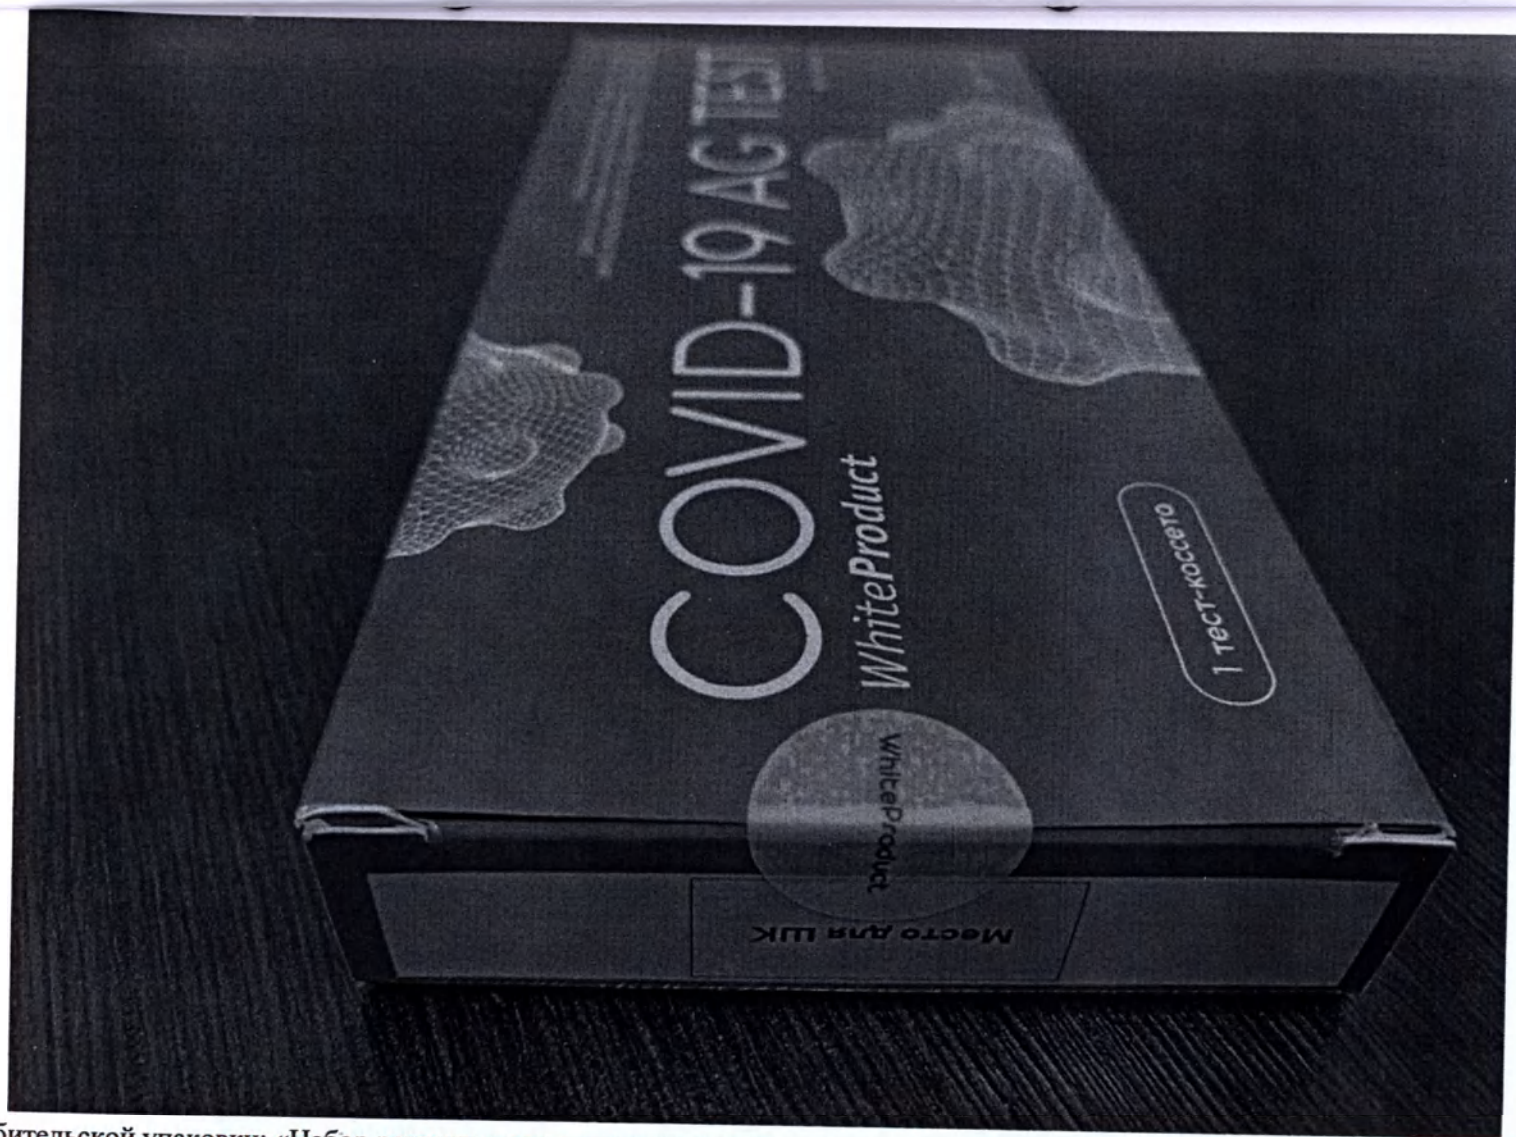

Общий вид потребительской упаковки: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021».

Вариант исполнения 1

Для in vitro диагностики 1 тест-кассета

WhiteProduct
COVID-19 AG TEST

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021»

COVID-19 AG TEST

WhiteProduct

white-product.com

1 тест-кассета

REF WS-ET01-ASP

COVID-19 AG TEST
WhiteProduct

Для in vitro диагностики

1 тест-кассета

COVID-19 AG TEST
WhiteProduct

Для in vitro диагностики

1 тест-кассета

Для in vitro диагностики

ТУ 21.20.23-002-46311122-2021

Вариант исполнения 1, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) × 1 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) × 1 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу × 1 шт.
4. Инструкция по применению × 1 шт.

Производитель

ООО «Уайт Сервис»

Россия, 141983, Московская область, г.о. Дубна,

г. Дубна, пр-кт Науки, д. 33, помещ. 2.3

Тел.: +7 (495) 108-75-79 | E-mail: info@white-service.org

Уполномоченный представитель производителя по России и СНГ

ООО «Уайт Продактс»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7, этаж 3, помещение VIII, комната 3.2

Тел.: +7 (495) 108-52-41 | E-mail: info@white-product.com | www.white-product.com



Для профессионального применения



РУ №РЗН XXXX/XXXX от ЧЧ.ММ.ГГ


LOT 2021WSA

16.02.2023



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ПРОДУКТА
(см. инструкцию)

Увеличенный текст маркировки потребительской упаковки: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 1

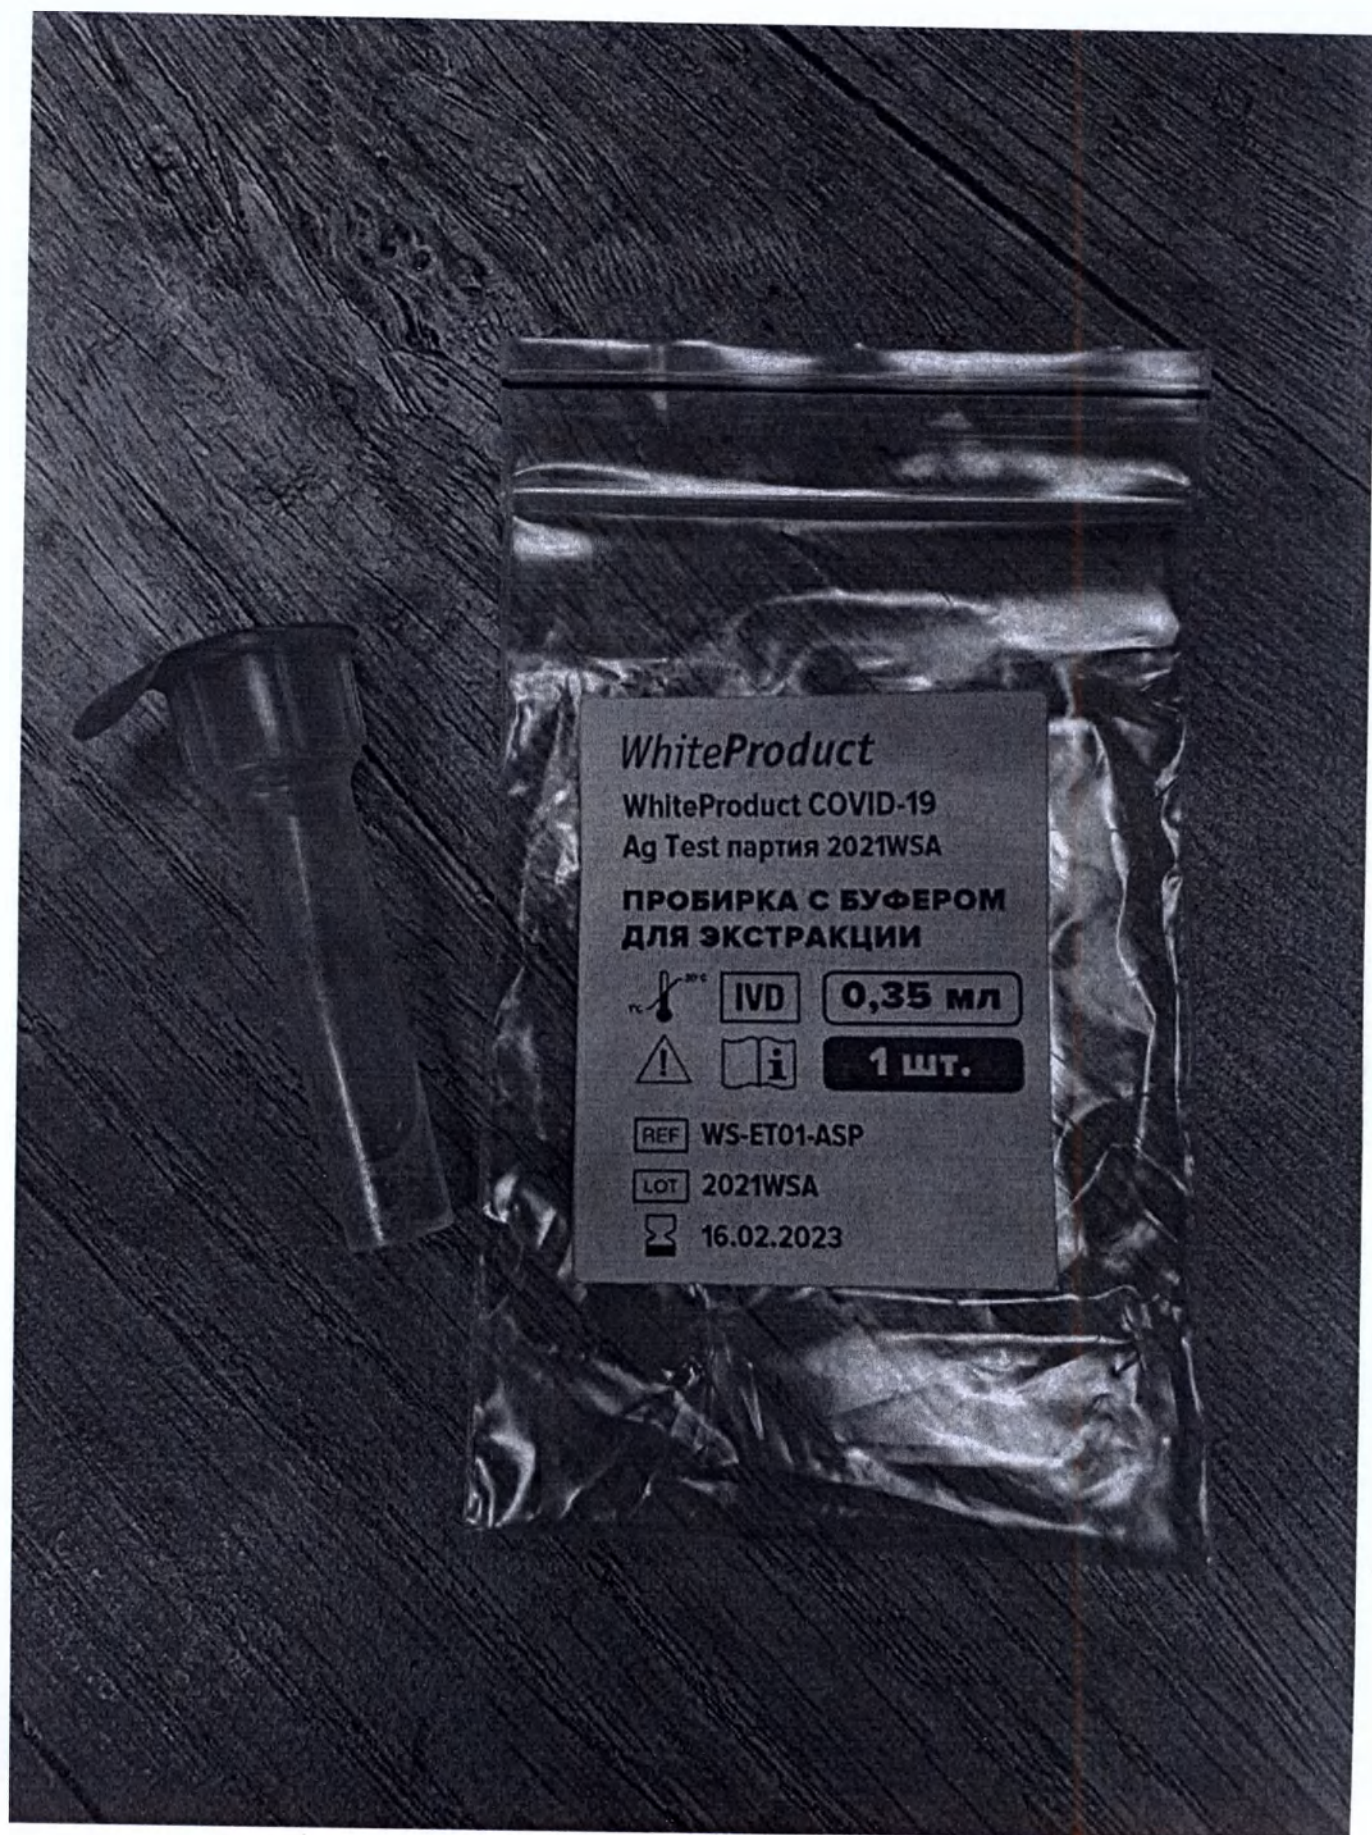

Общий вид изделия: Пробирка с буфером для экстракции -1 шт




Общий вид изделия: Пробирка с буфером для экстракции -1 шт



Общий вид изделия: Насадка с капельницей к буферу -1 шт




Общий вид изделия: Насадка с капельницей к буферу-1 шт

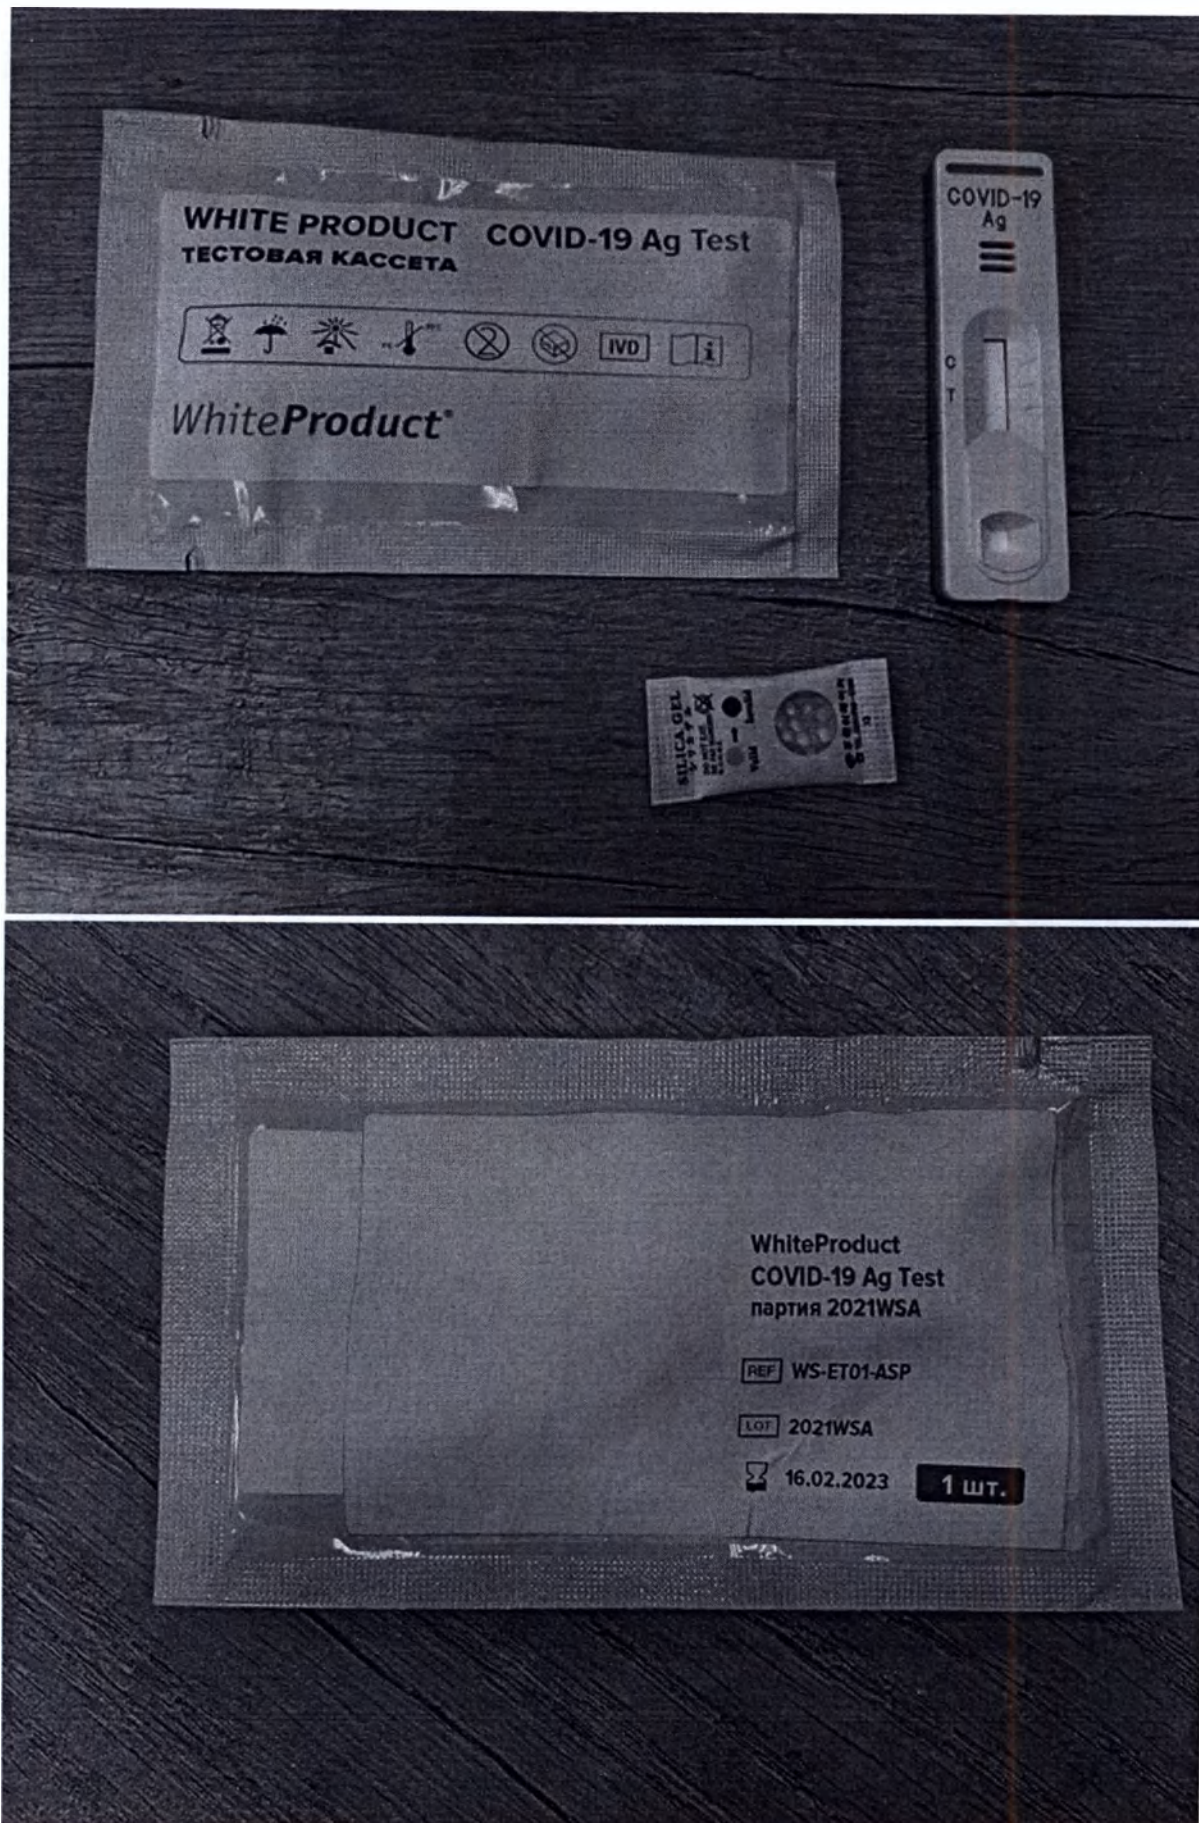


Общий вид изделия: Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) -1 шт

Вариант исполнения 2

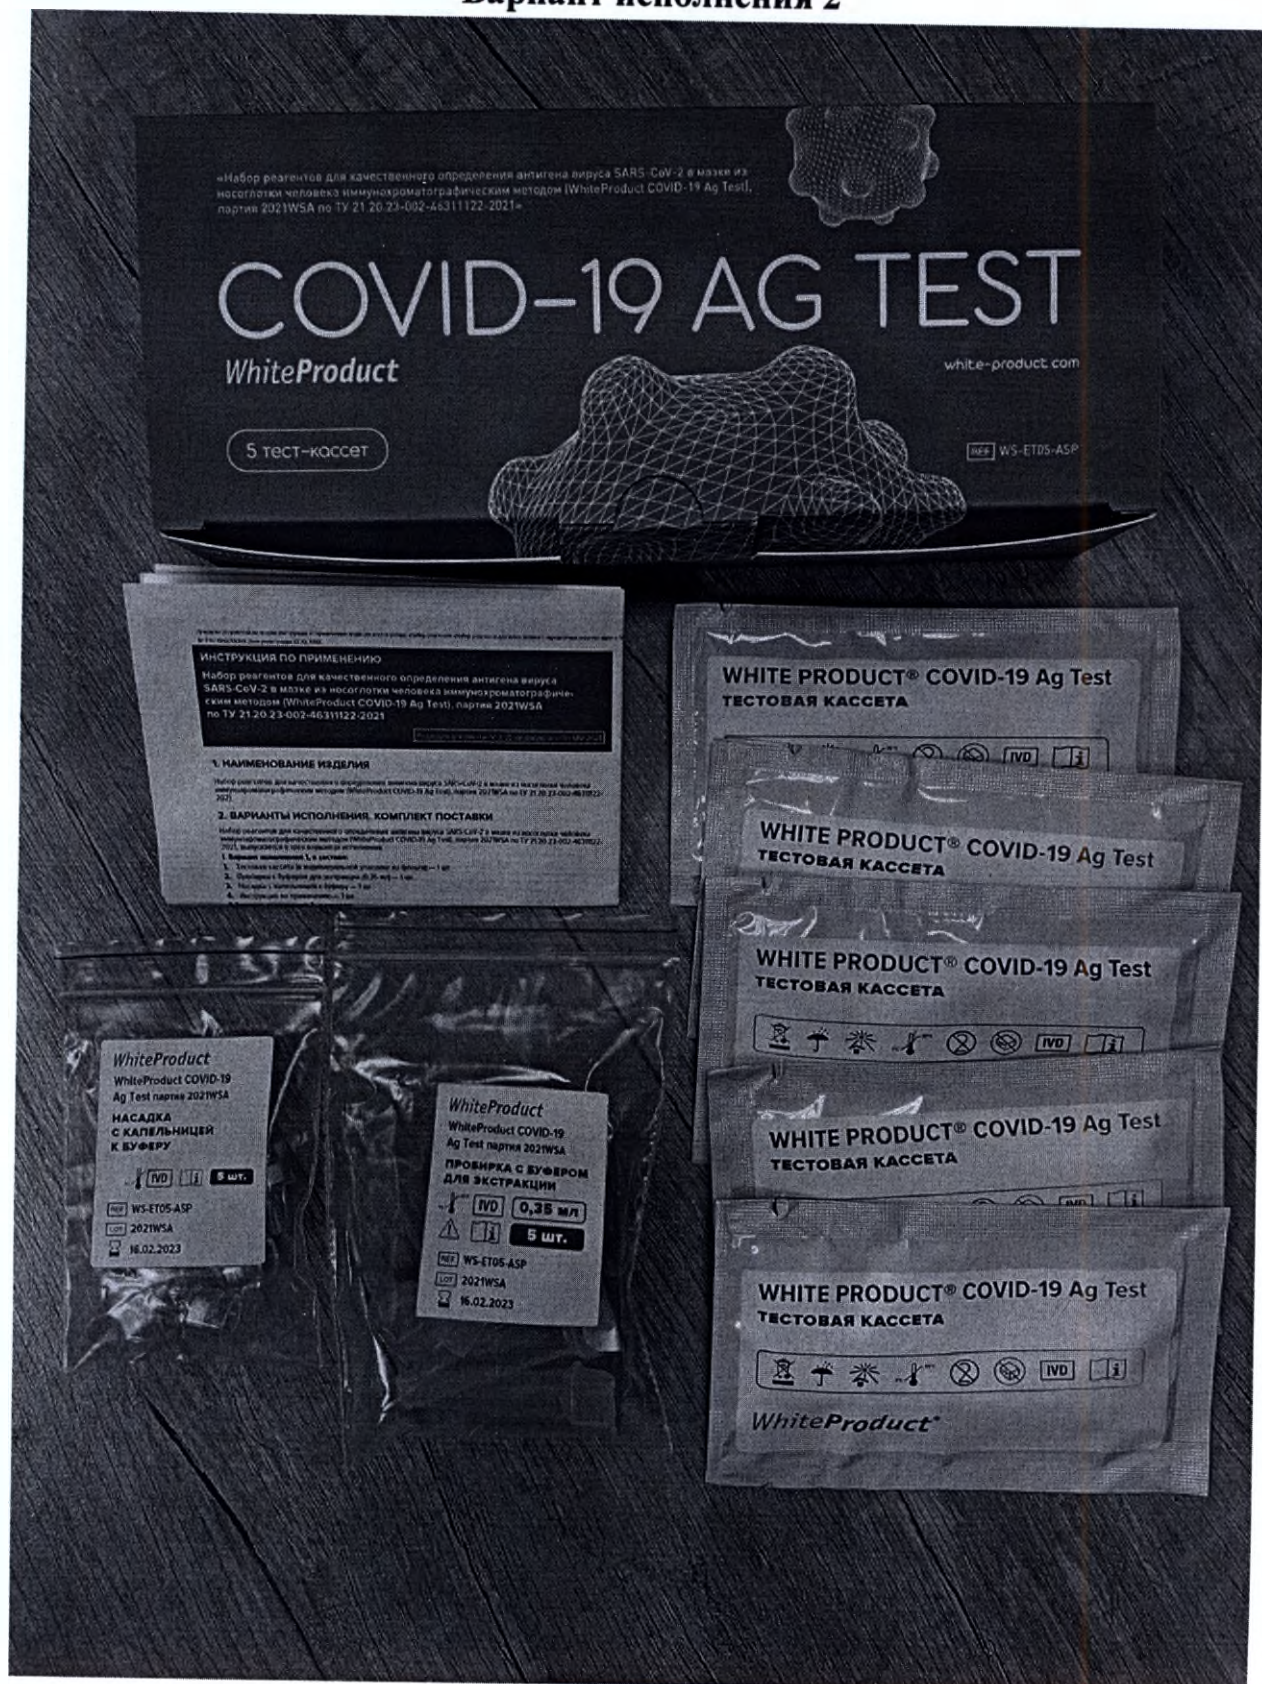


Общий вид потребительской упаковки: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021».

Вариант исполнения 2



Общий вид потребительской упаковки: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021».
Вариант исполнения 2

COVID-19 AG TEST




Для in vitro диагностики

5 тест-кассет

WhiteProduct

COVID-19 AG TEST

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021».

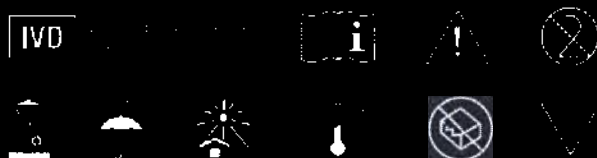

Для in vitro диагностики


5 тест-кассет

по: 2021WSA
ТУ 21.20.23-002-46311122-2021

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ПРОДУКТА
ОБРАТИТЕСЬ К НОМ.




Увеличенный текст маркировки потребительской упаковки: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021».
Вариант исполнения 2

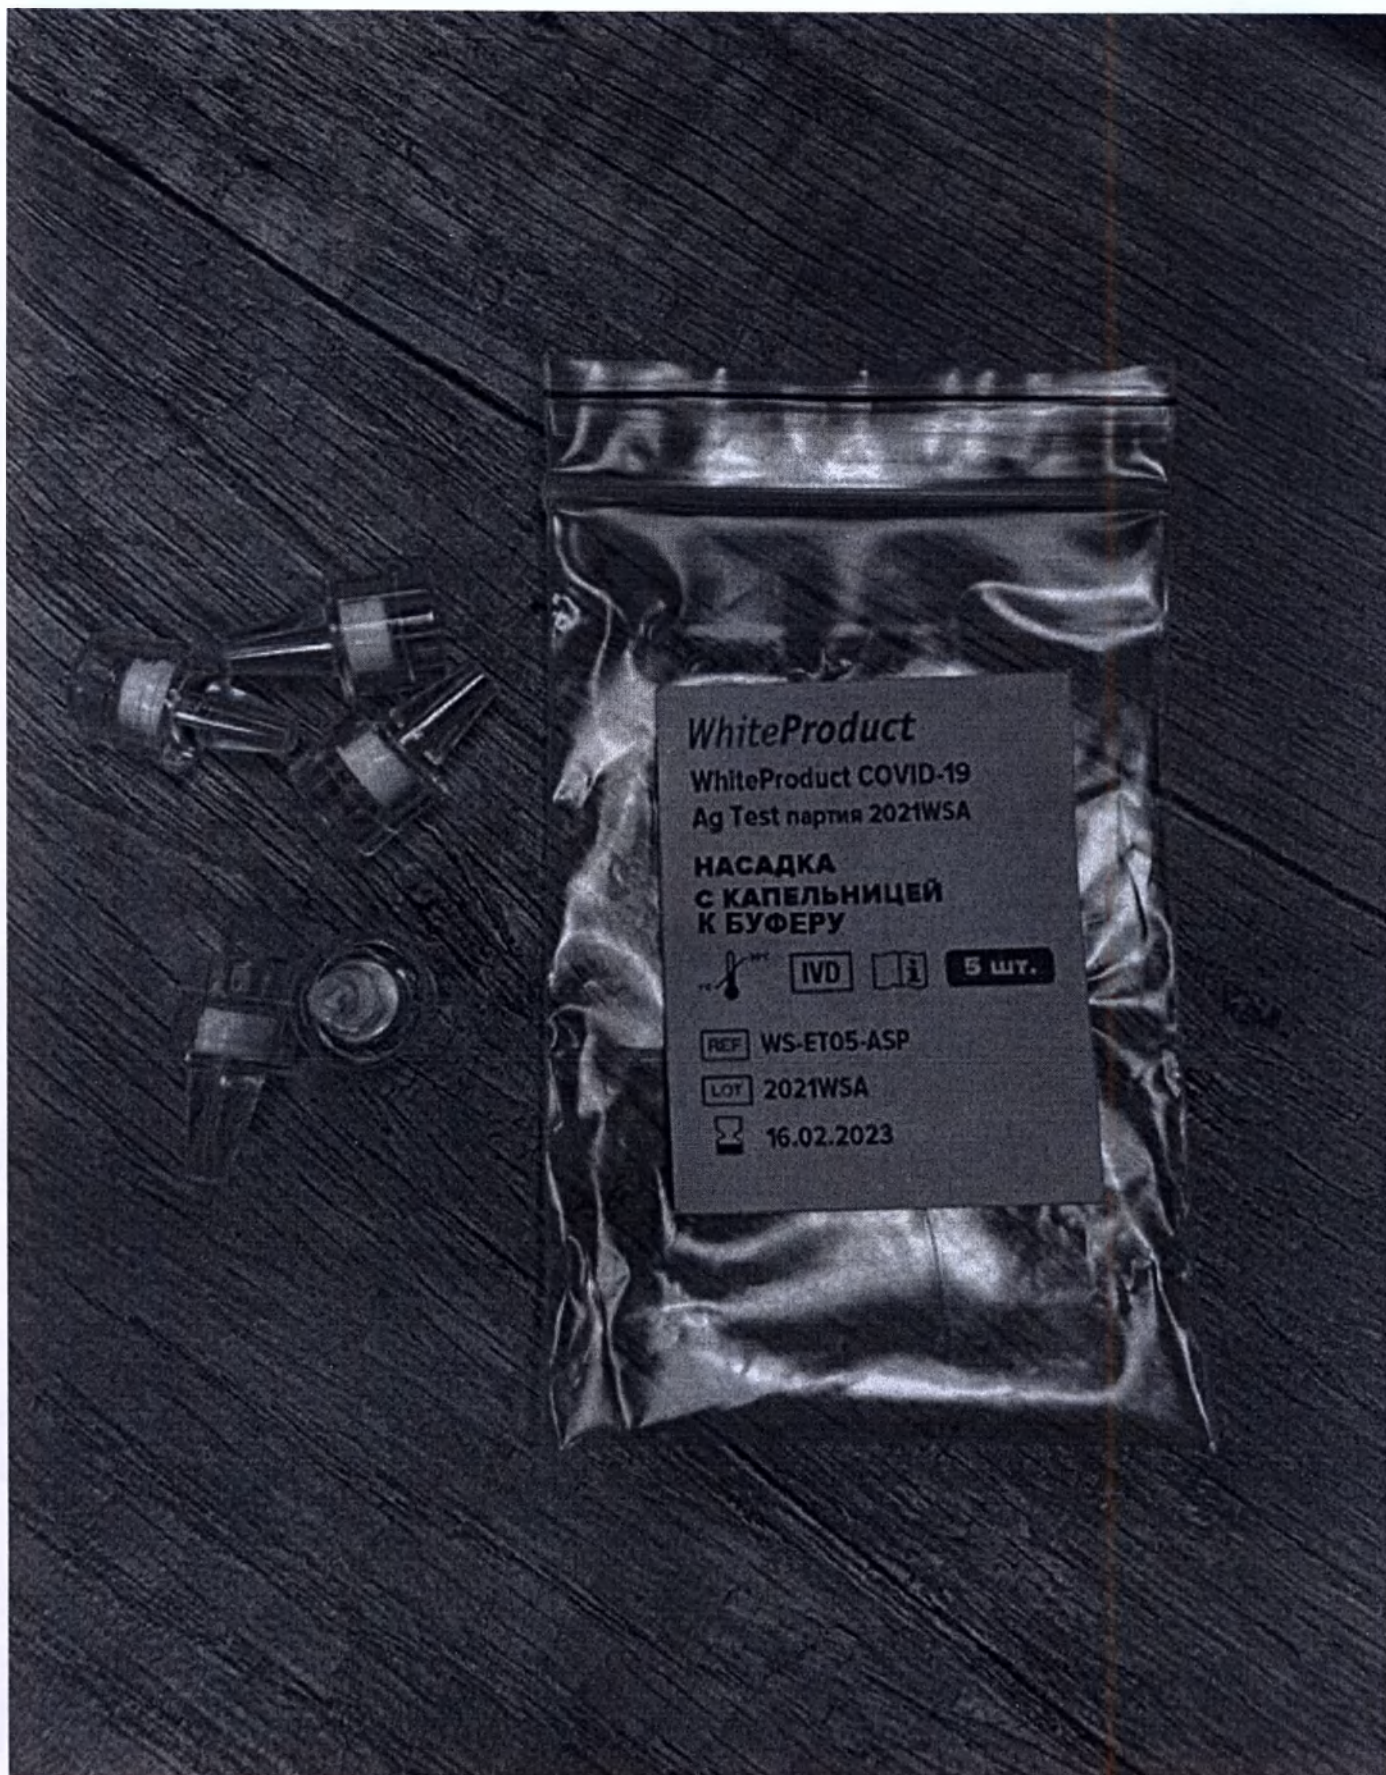

Общий вид изделия: Насадка с капельницей к буферу -5 шт





Общий вид изделия: Насадка с капельницей к буферу -5 шт

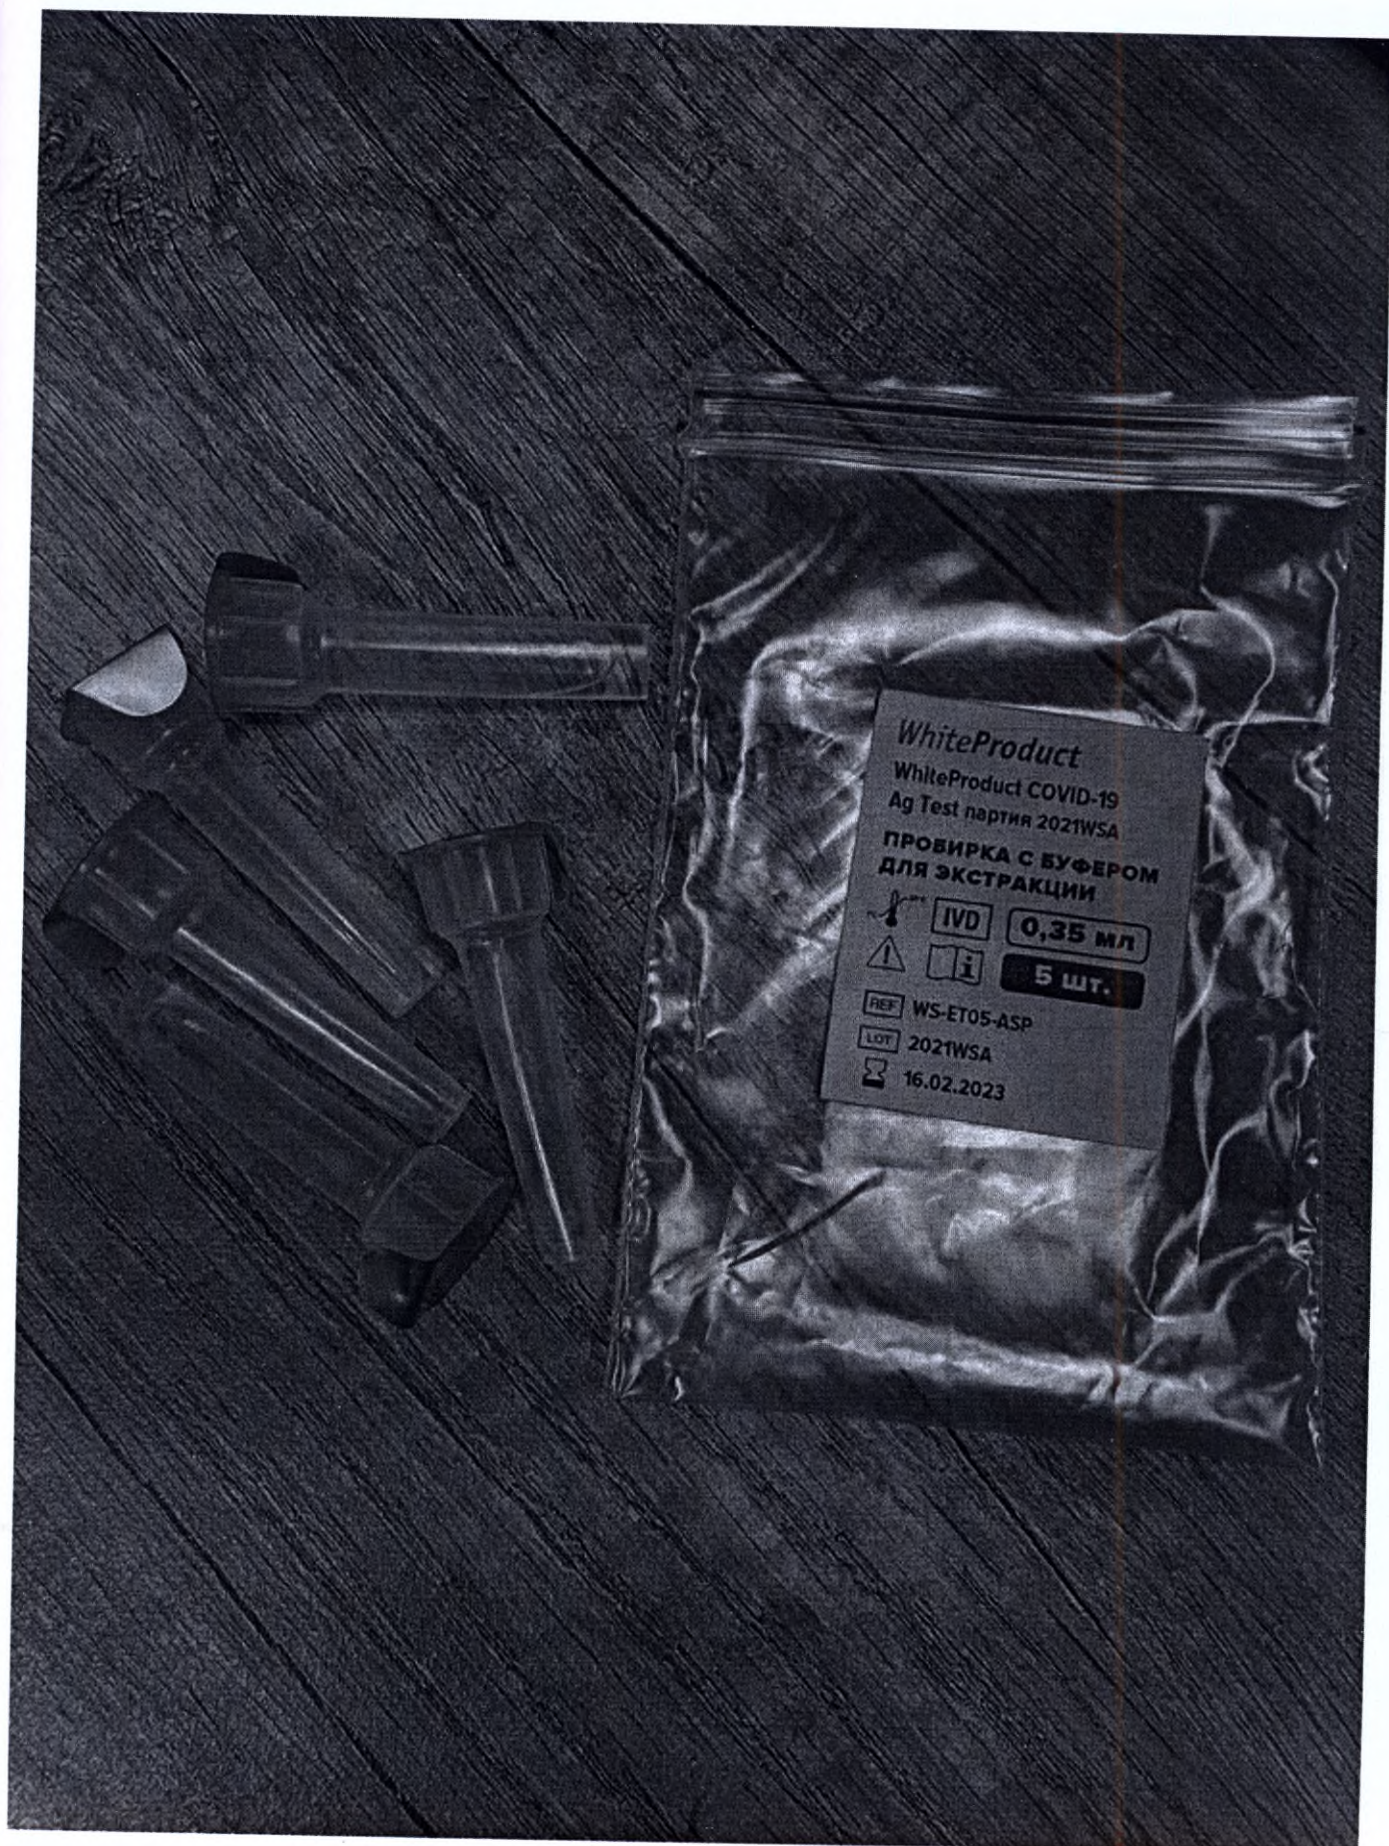

Общий вид изделия: Пробирка с буфером для экстракции - 5 шт



Общий вид изделия: Пробирка с буфером для экстракции - 5 шт

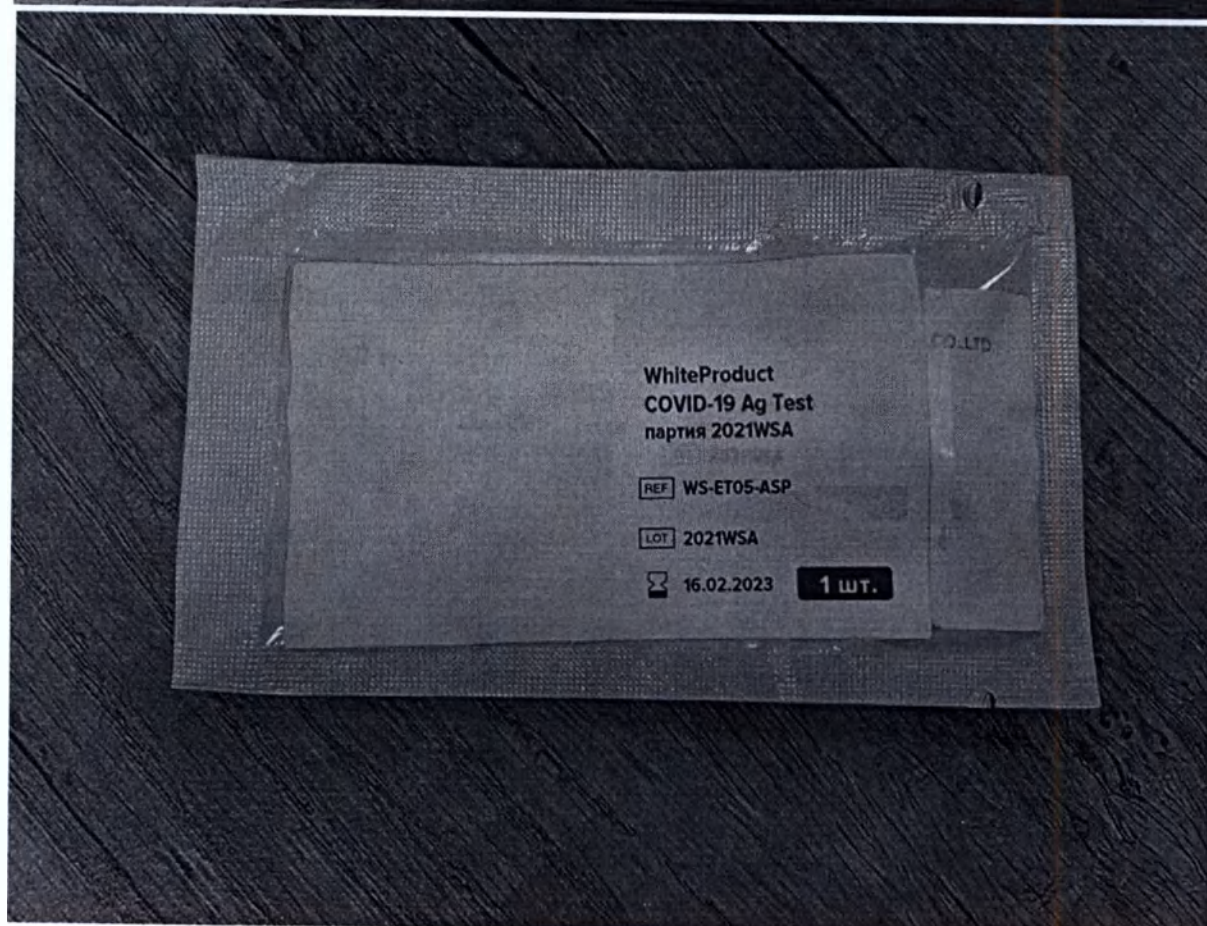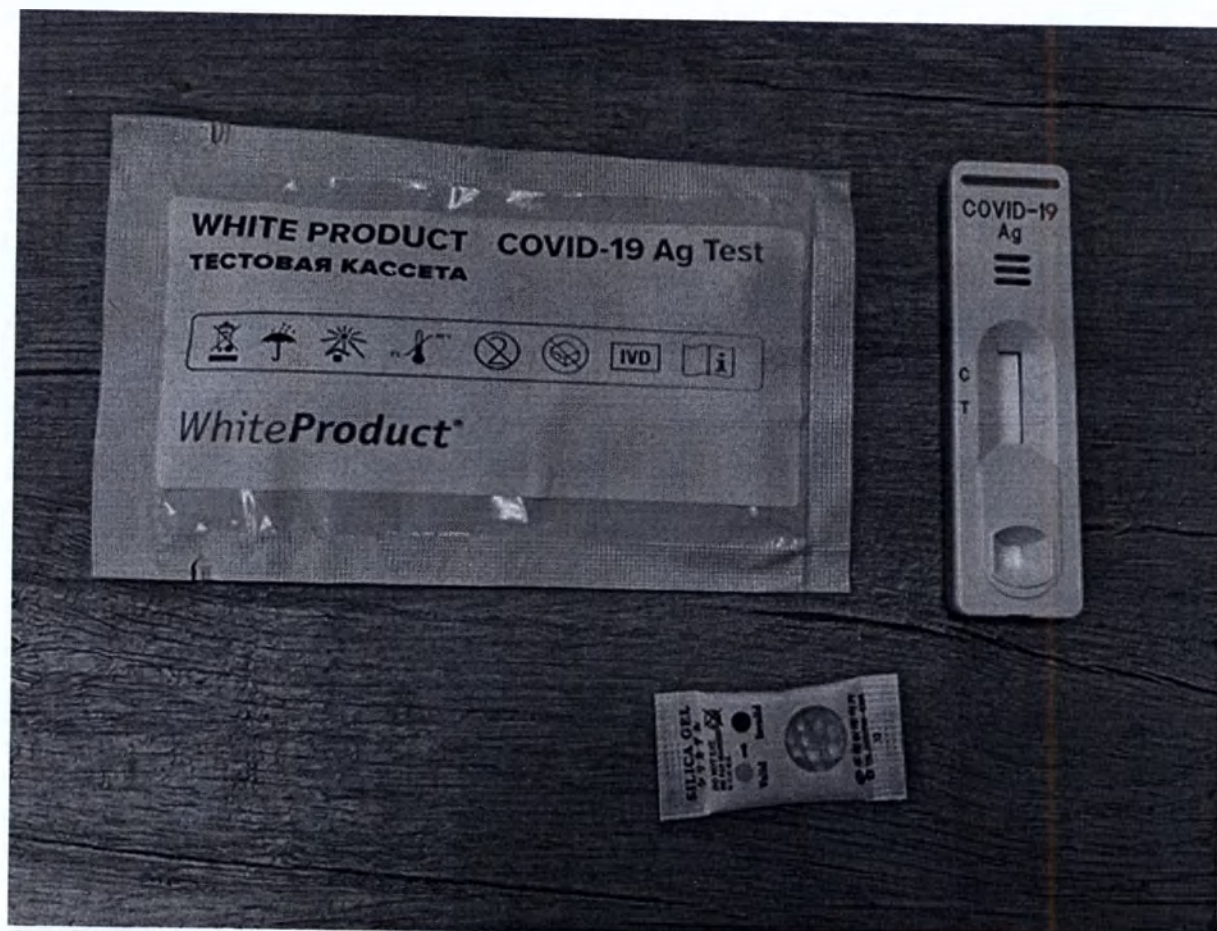


Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт

Вариант исполнения 3



Общий вид медицинского изделия: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 3

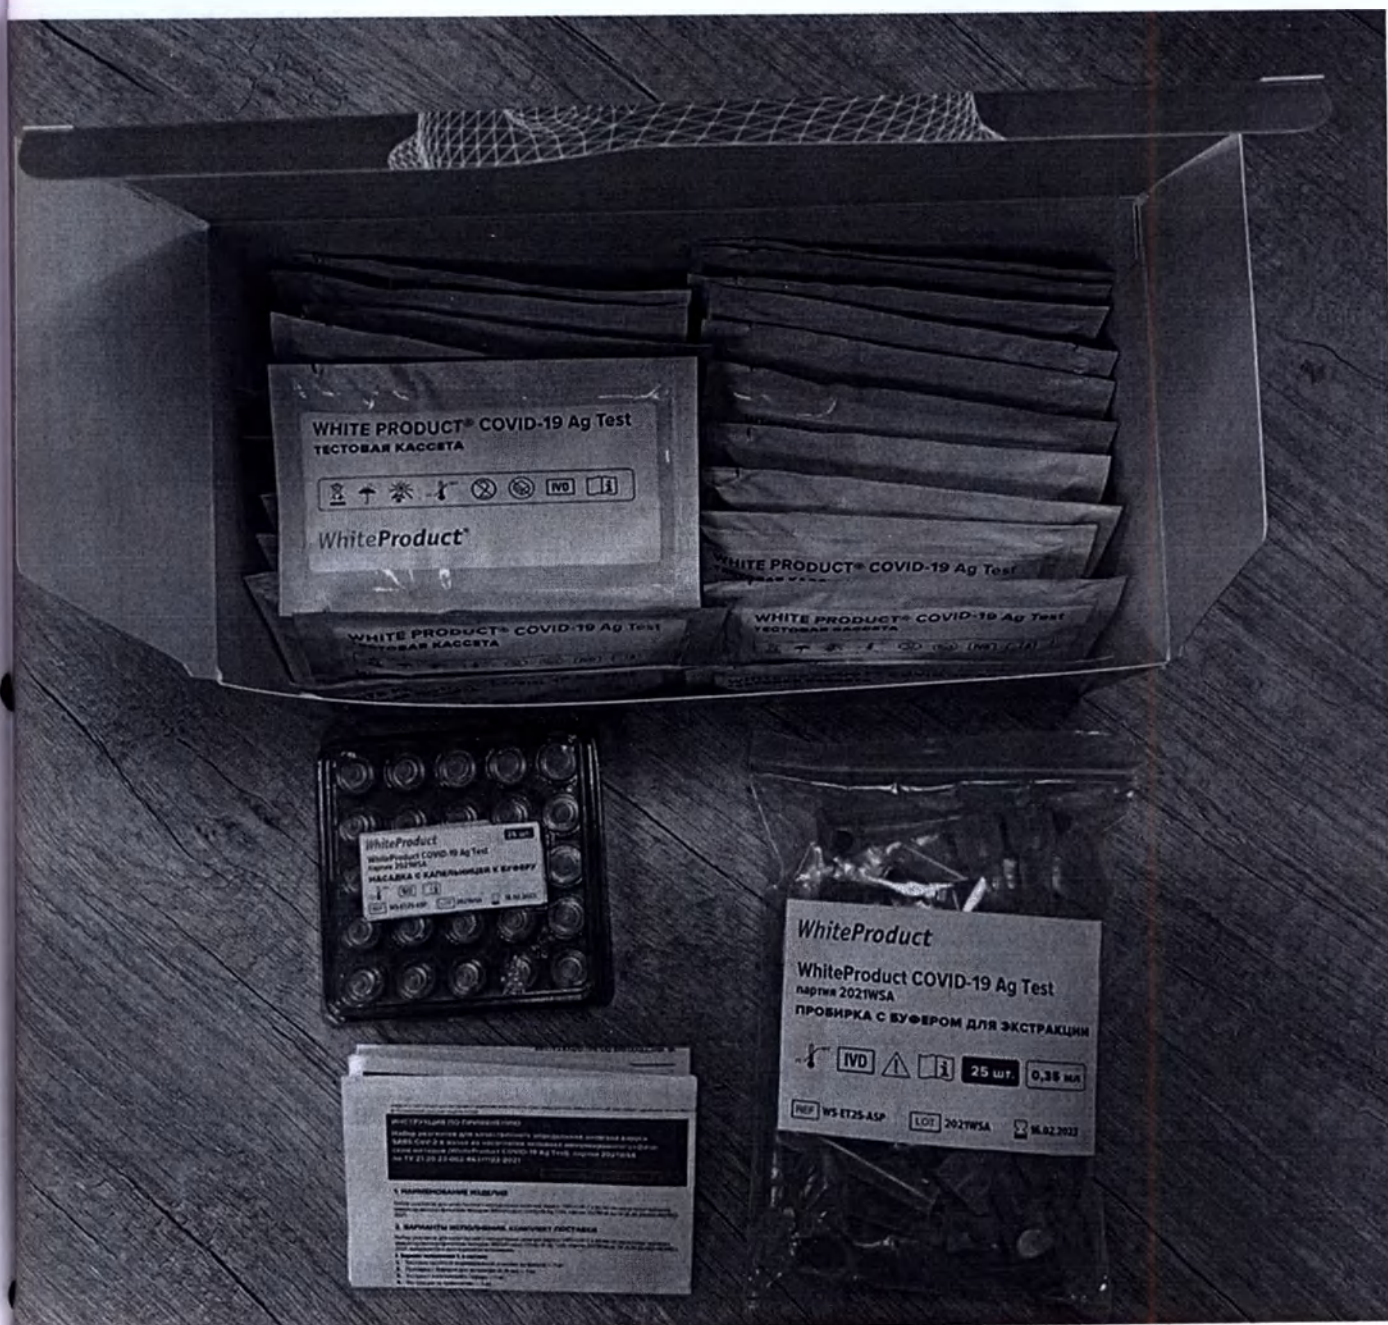


общий вид медицинского изделия: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 3



Общий вид потребительской упаковки: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021».
Вариант исполнения 3

COVID-19 AG TEST

Product




WhiteProduct

WhiteProduct

Увеличенный текст маркировки потребительской упаковки:

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 3




определения антигена вируса SARS-CoV-2
иммунохроматографическим методом
WSA

25 тестов

Длина упаковки: 100 мм





Увеличенный текст маркировки потребительской упаковки: «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 3

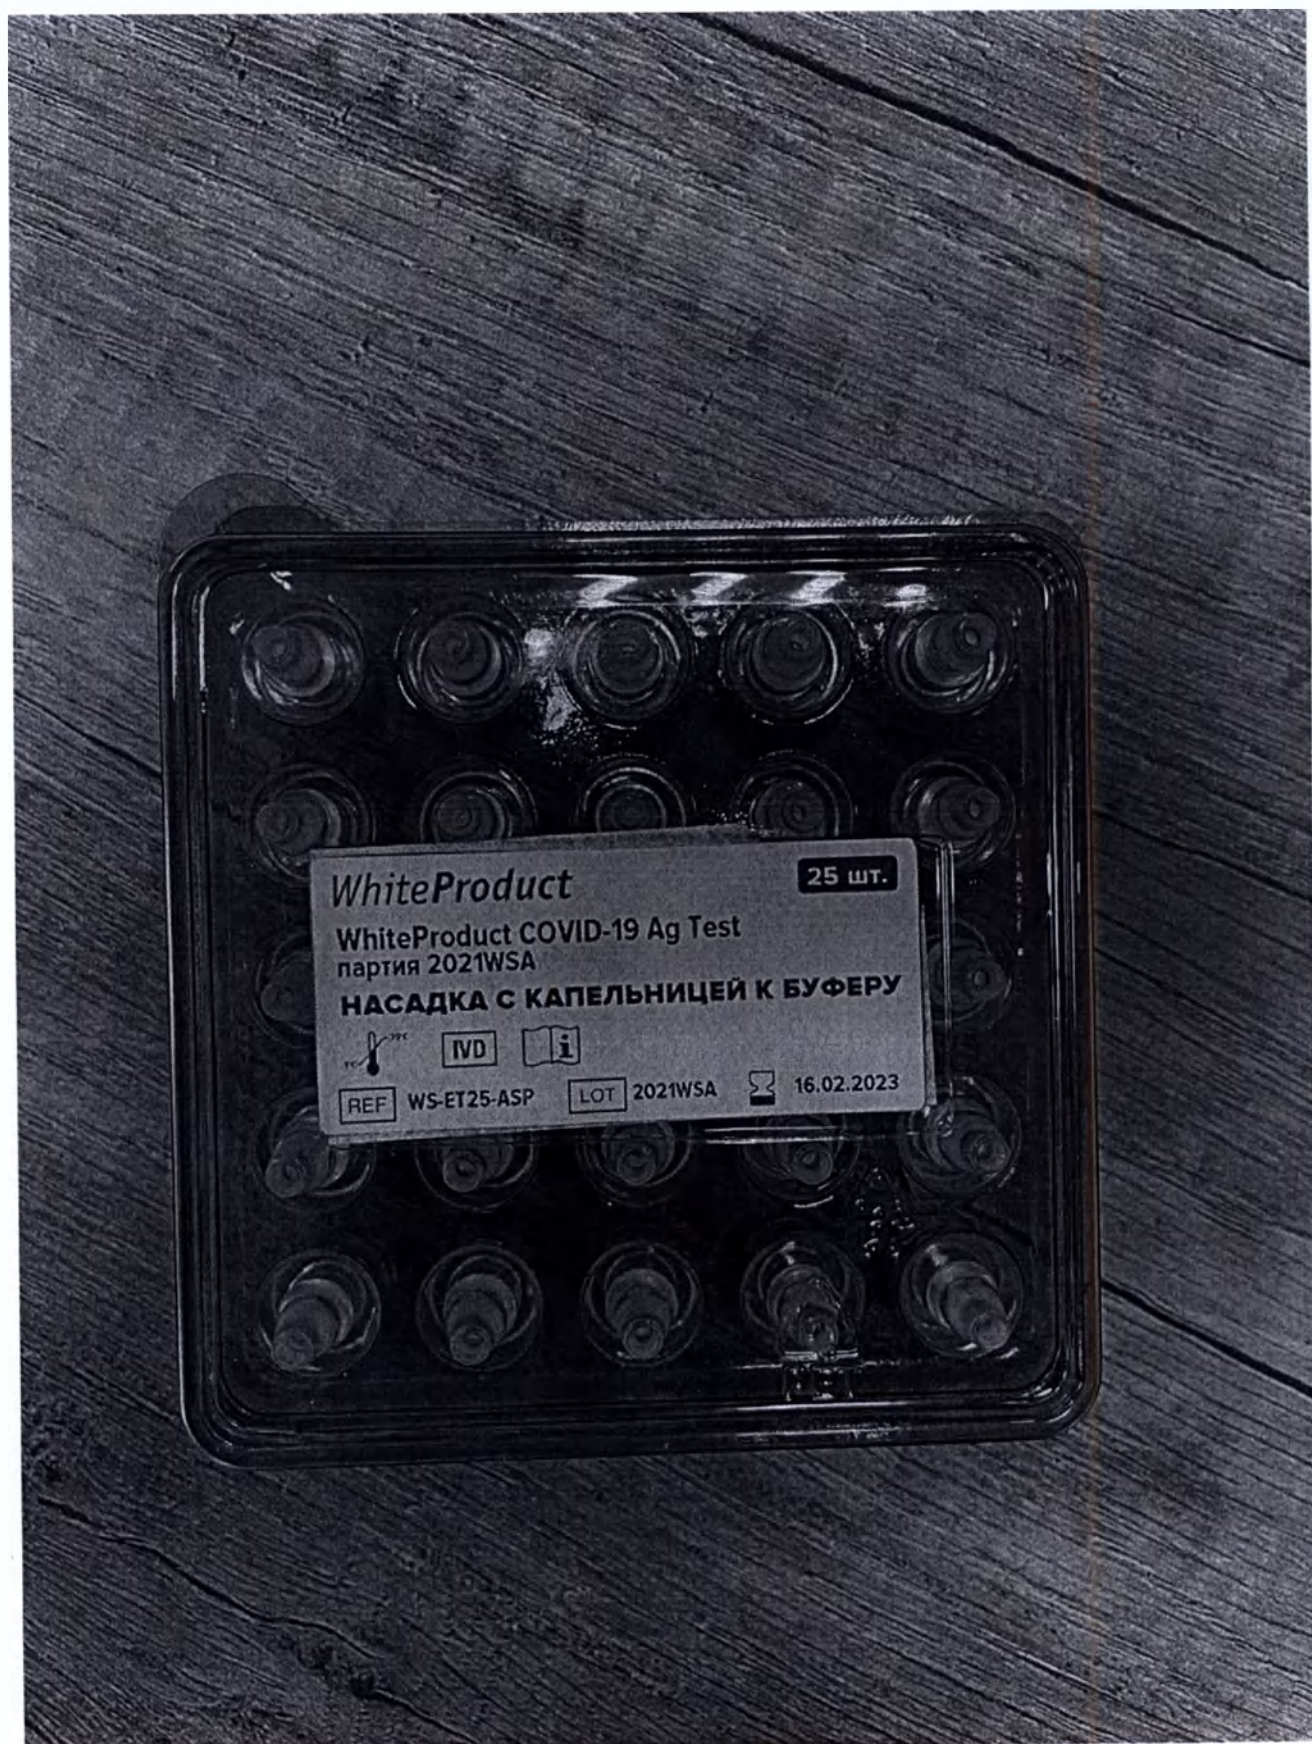

Общий вид изделия: Насадка с капельницей к буферу -25 шт




Общий вид изделия: Пробирка с буфером для экстракции- 25 шт

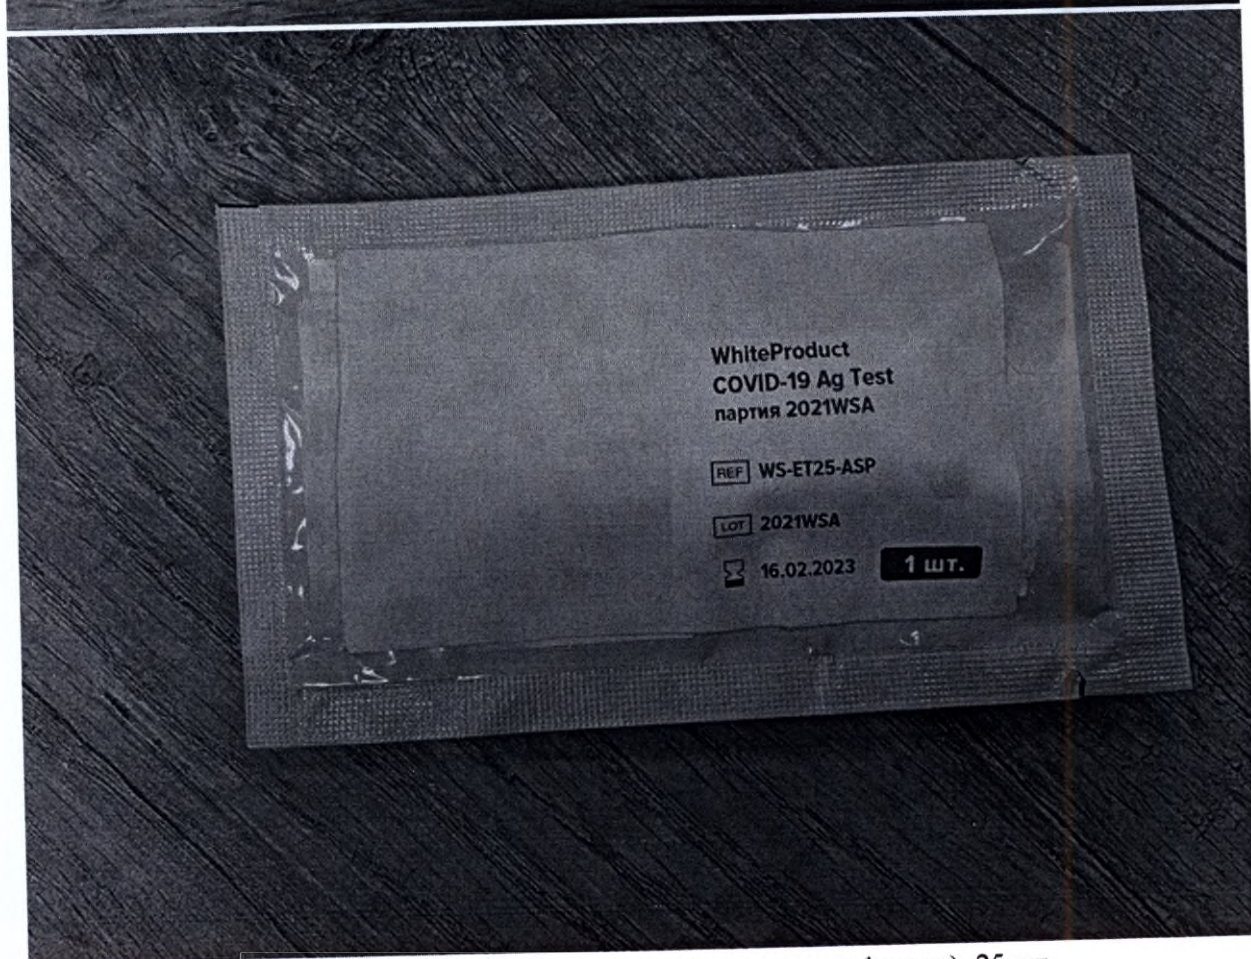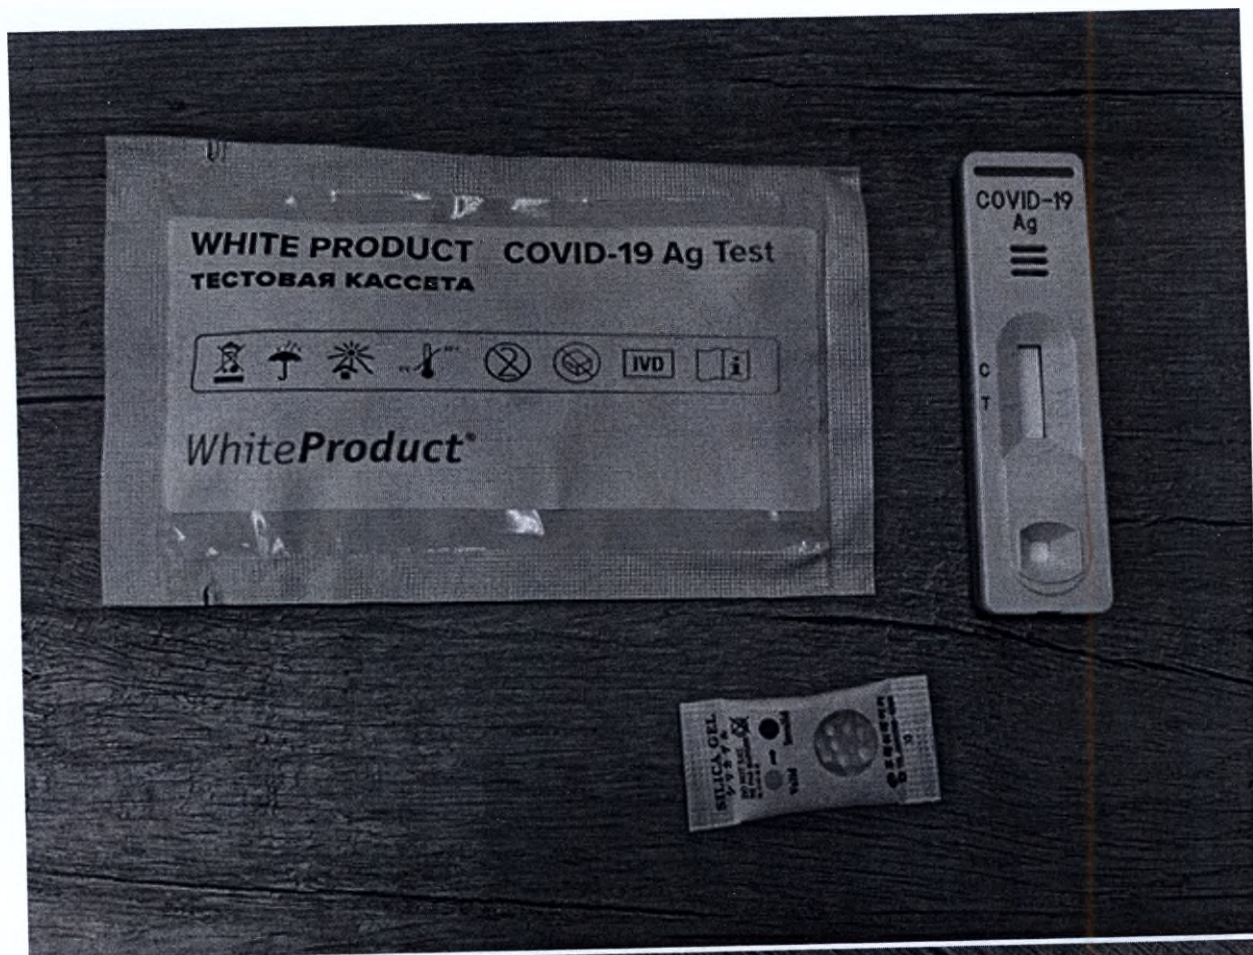

Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги)- 25 шт



Общий вид изделия: Тестовая кассета

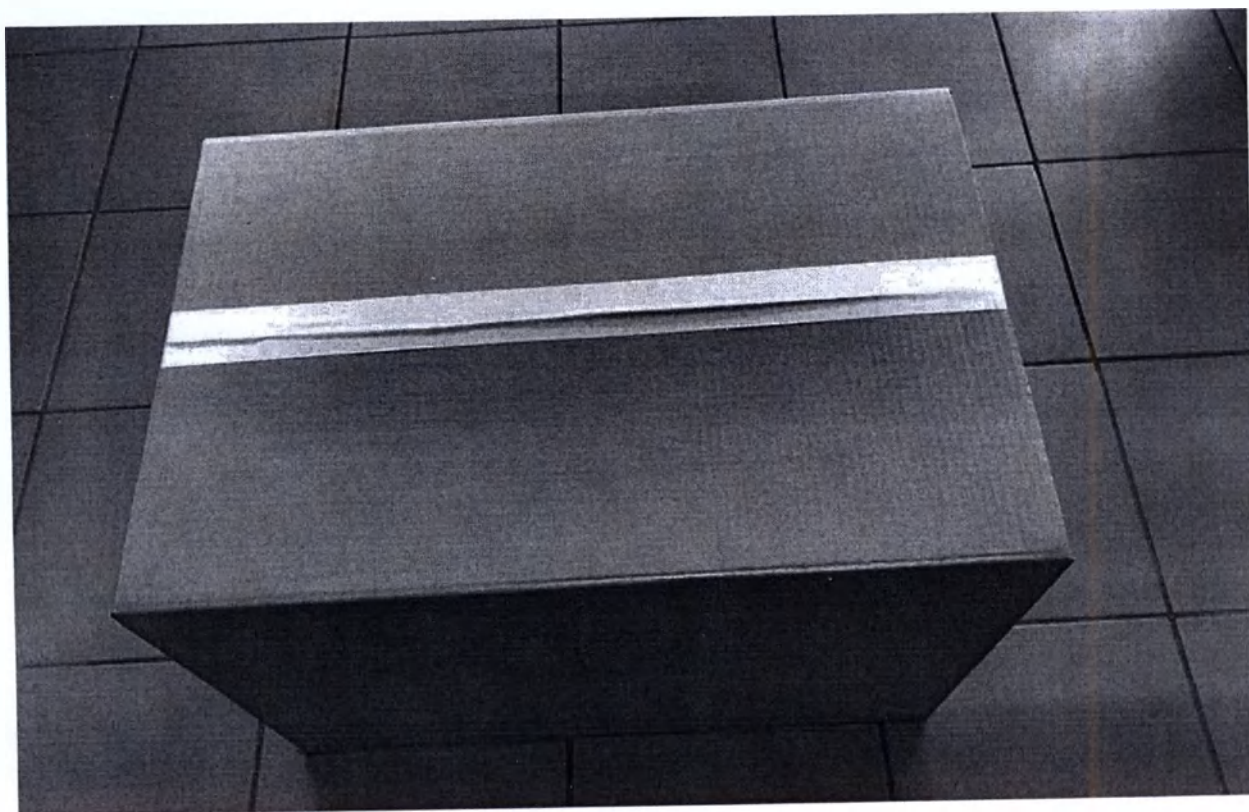

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-4631122-2021»



2021WSA



17.02.2021




16.02.2023

Количество изделий в упаковке:

☐ 1 шт.

☐ 5 шт.

☐ 25 шт.



1°C 30°C



ООО «УАЙТ СЕРВИС»

Россия, 141983, Московская область,
г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки, д.33,
помещ.23.

тел. +7 (495) 108-75-79,

E-mail: info@white-service.org

Масса нетто:

Масса брутто:

Количество упаковочных единиц



РУН®РЗН XXXX/XXXX от ЧЧ.ММ.ГГ



Общий вид транспортной упаковки и маркировки

Приложение (справочное)

Варианты исполнения и состав медицинского изделия

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021»

I. Вариант исполнения 1, в составе:

- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) -1 шт
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) -1 шт
- 3.Насадка с капельницей к буферу -1 шт
- 4.Инструкция по применению -1 шт

II.Вариант исполнения 2, в составе:

- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) - 5 шт
- 3.Насадка с капельницей к буферу -5 шт
- 4.Инструкция по применению -1 шт

III.Вариант исполнения 3, в составе:

- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги)- 25 шт
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) - 25 шт
- 3.Насадка с капельницей к буферу - 25 шт
- 4.Инструкция по применению -1 шт

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

28 (двадцать восемь) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись _____

08 » октября 2024 г.

МП



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "УАЙТ СЕРВИС"

Головков А.В.

«06» сентября 2021 г.

М.П.



**МАКЕТЫ МАРКИРОВОК
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из
носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag
Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021»**

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

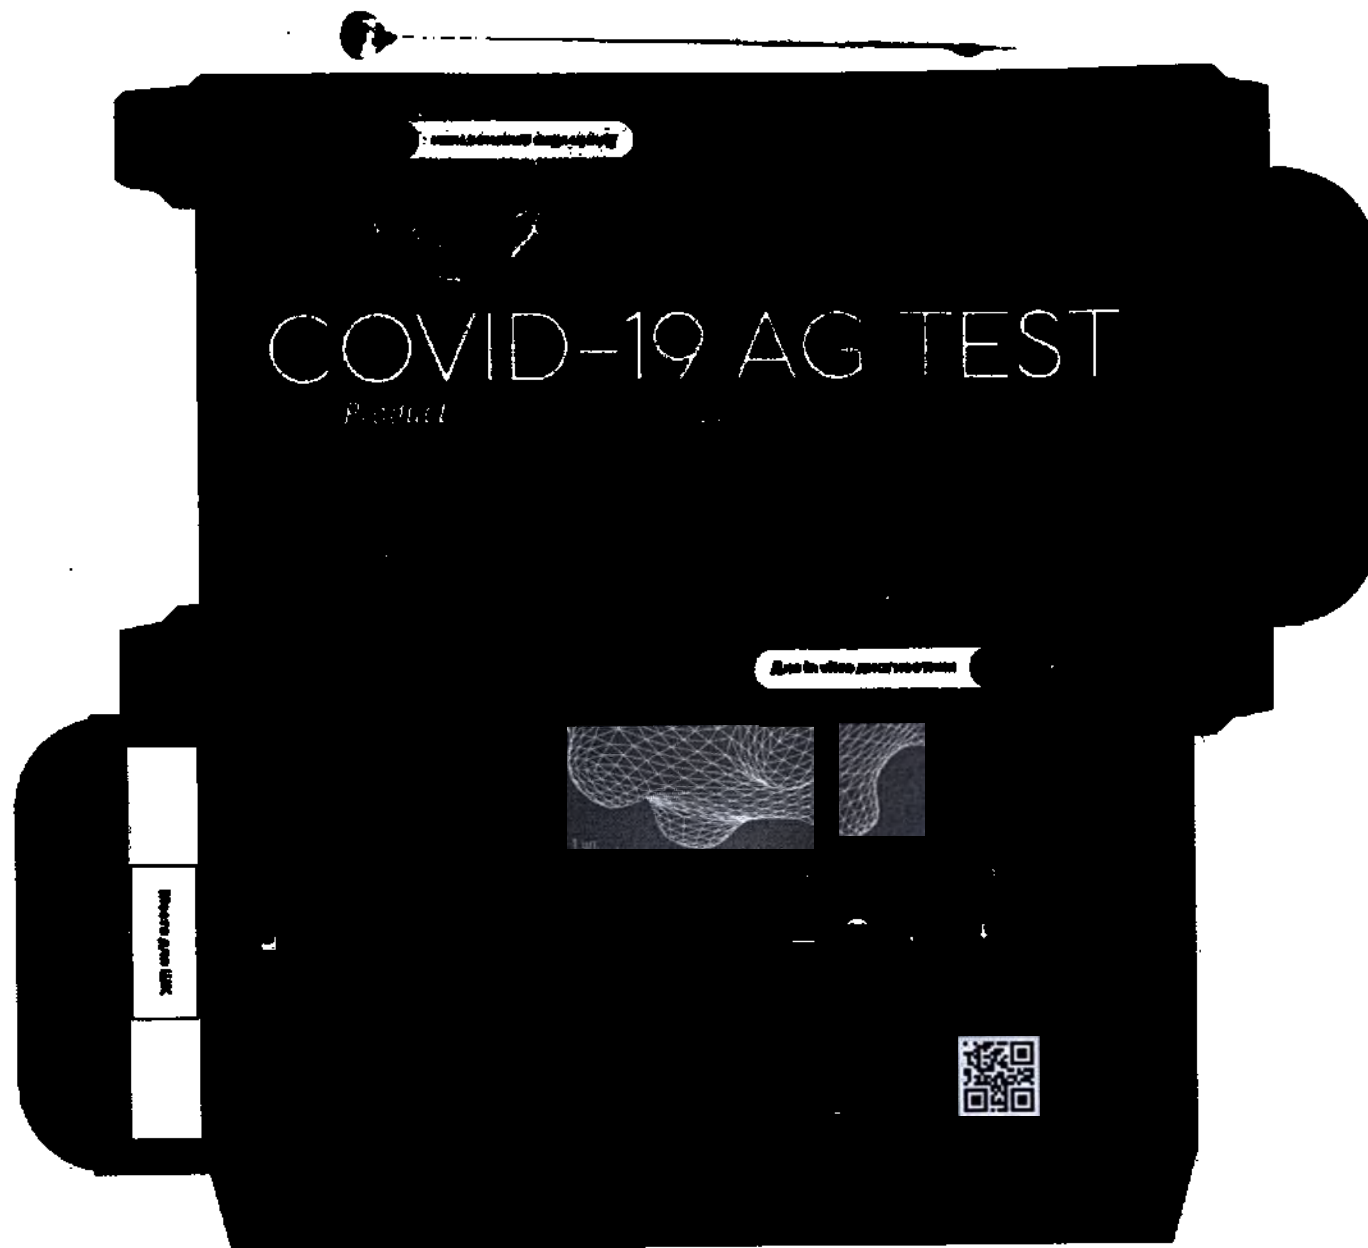


Рисунок 1. «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 1, в составе:

- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) -1 шт**
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) -1 шт**
- 3.Насадка с капельницей к буферу -1 шт**
- 4.Инструкция по применению -1 шт**

WhiteProduct
COVID-19 AG TEST

Для in vitro диагностики 1 тест-кассета

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA no TY 21.20.23-002-46311122-2021»

COVID-19 AG TEST

WhiteProduct

white-product.com

1 тест-кассета

REF WS-ET01-ASP

COVID-19 AG TEST
WhiteProduct

Для in vitro диагностики 1 тест-кассета

COVID-19 AG TEST
WhiteProduct

Для in vitro диагностики 1 тест-кассета

Для in vitro диагностики

TY 21.20.23-002-46311122-2021

Вариант исполнения 1, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) × 1 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) × 1 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу × 1 шт.
4. Инструкция по применению × 1 шт.

Производитель

ООО «Уайт Сервис»
Россия, 141983, Московская область, г.о. Дубна,
г. Дубна, пр-кт Науки, д. 33, помещ. 2.3
Тел.: +7 (495) 108-75-79 | E-mail: info@white-service.org

Уполномоченный представитель производителя по России и СНГ

ООО «Уайт Продакт»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7, этаж 3, помещение VIII, комната 3.2
Тел.: +7 (495) 108-52-41 | E-mail: info@white-product.com | www.white-product.com



Для профессионального применения



ПУ №РЗН XXXX/XXXX от ЧЧ.ММ.ГГ

LOT 2021WSA

16.02.2023



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ПРОДУКТА
(см. инструкцию)

Увеличенный текст рисунка 1

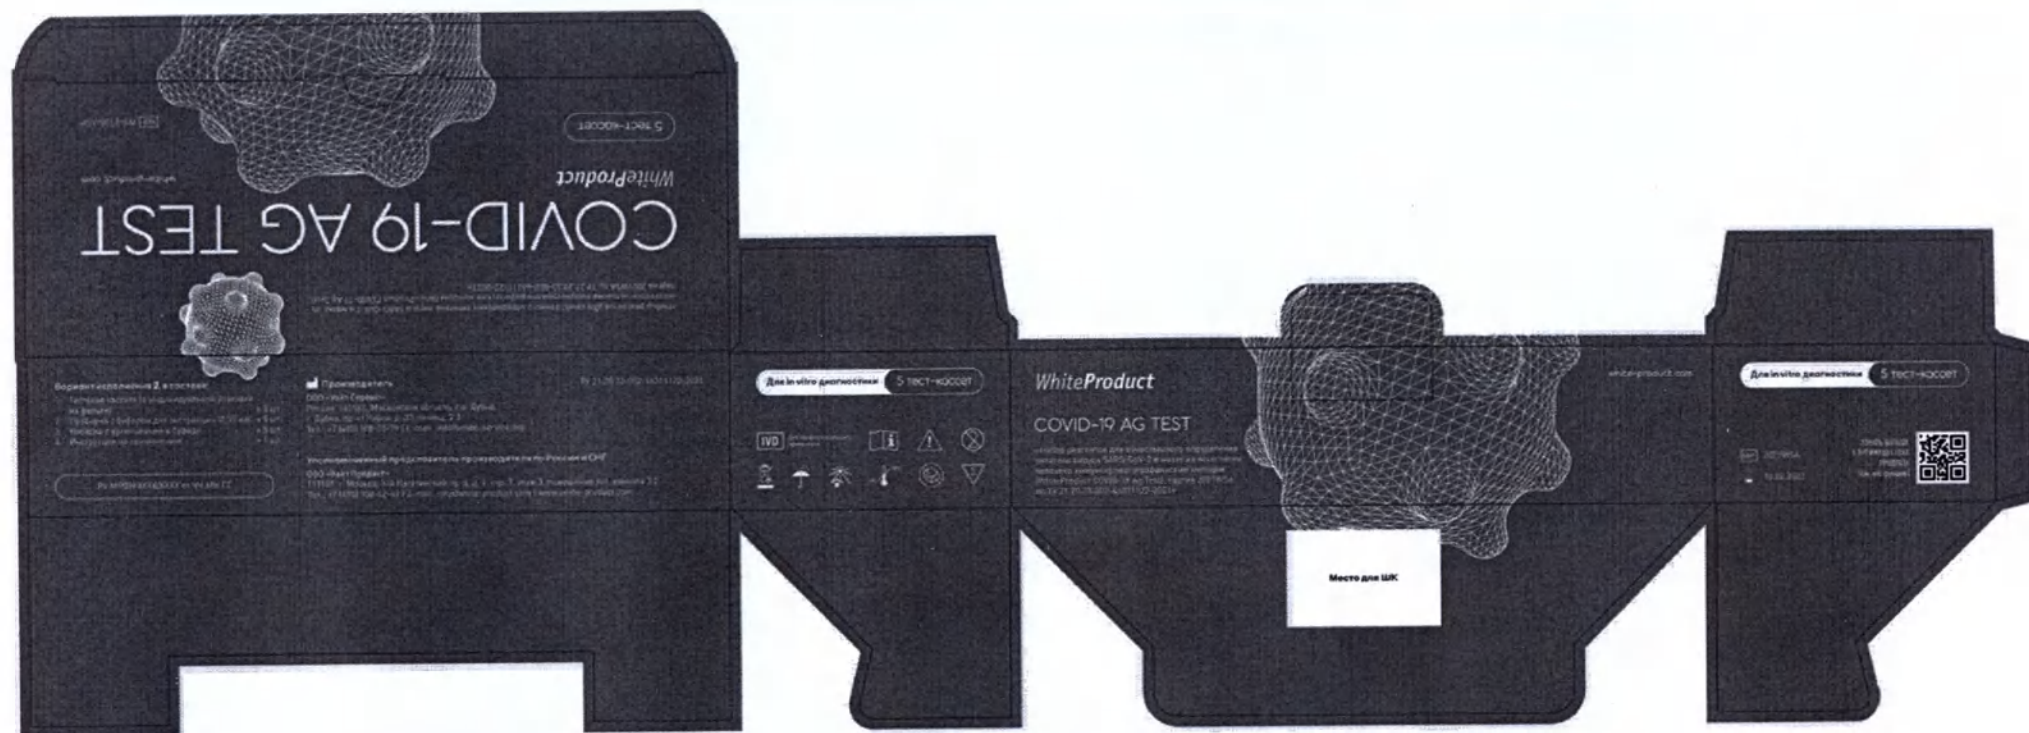


Рисунок 2. «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 2, в составе:

- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) - 5 шт
- 3.Насадка с капельницей к буферу -5 шт
- 4.Инструкция по применению -1 шт



Канал связи
с сервисом
поддержки

Скачать инструкцию

Скачать инструкцию

5 test-kode

Для in vitro диагностики

COVID-19 AG TEST



WhiteProduct

5 test-kode

Для in vitro диагностики

COVID-19 AG TEST

WhiteProduct



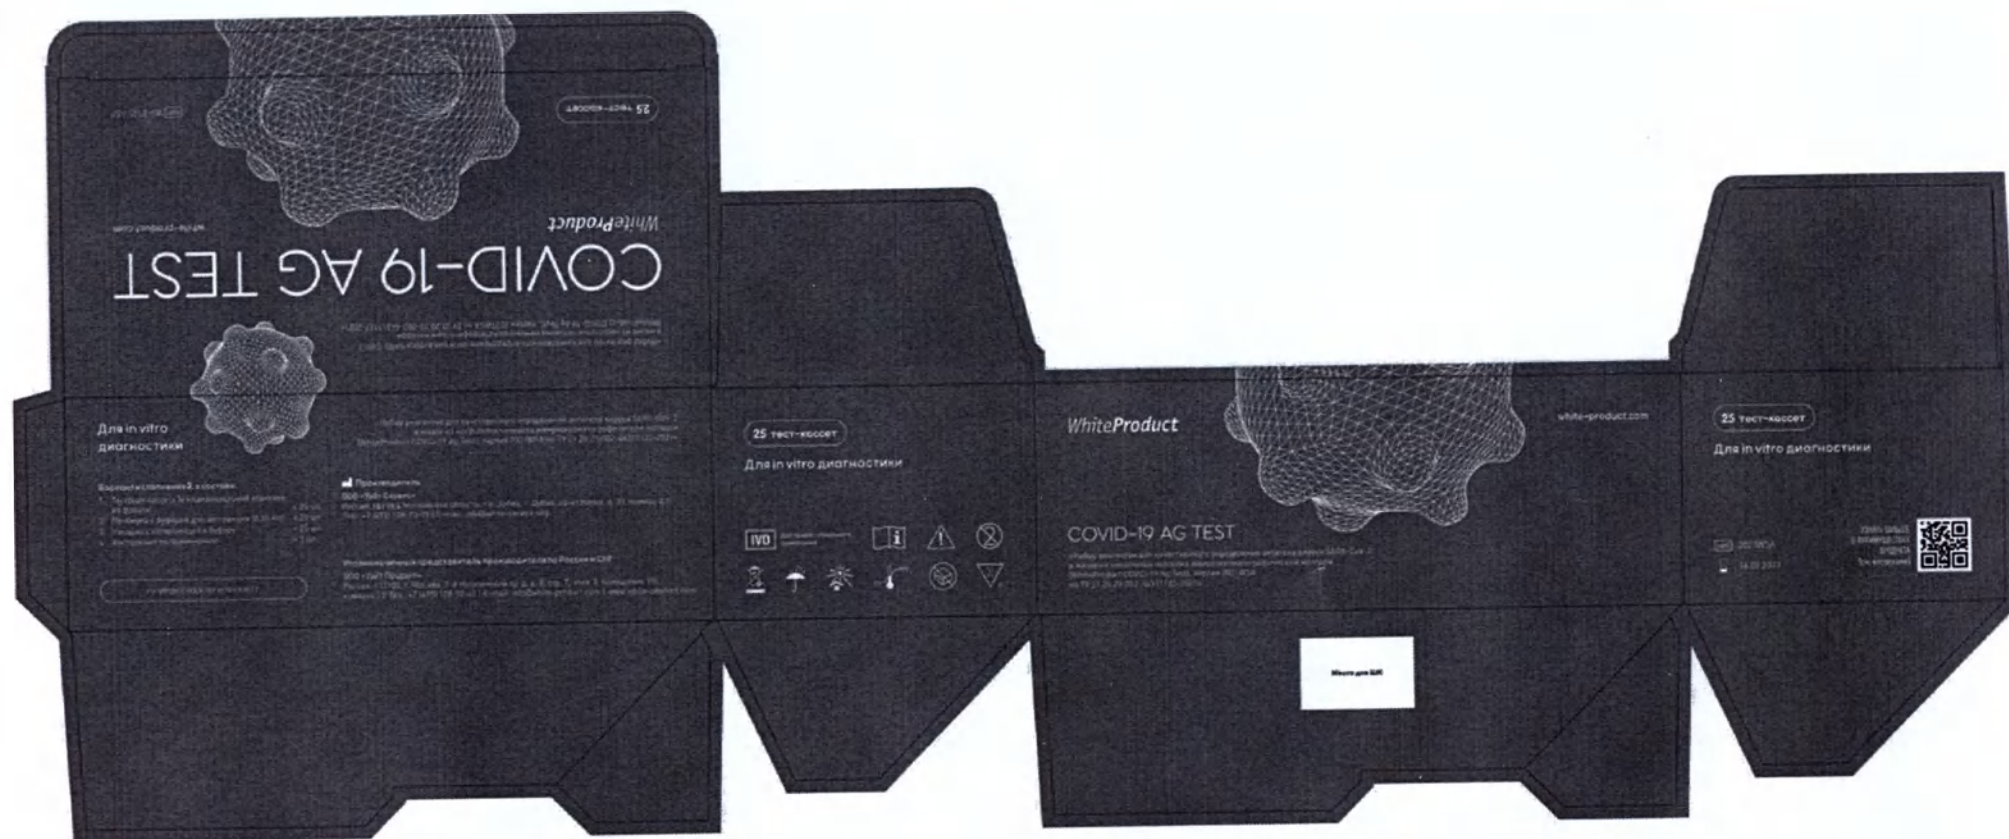


Рисунок 3. «Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021». Вариант исполнения 3, в составе:


- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги)- 25 шт
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) - 25 шт
- 3.Насадка с капельницей к буферу - 25 шт
- 4.Инструкция по применению -1 шт

WS-E125-ASP
25 тест-кассет

white-product.com

WhiteProduct

COVID-19 AG TEST



«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по TY 21.20.23-002-46311122-2021»

Для in vitro диагностики

Вариант исполнения 3, в составе:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) × 25 шт.
2. Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) × 25 шт.
3. Насадка с капельницей к буферу × 25 шт.
4. Инструкция по применению × 1 шт.

Производитель

ООО «Уайт Сервис»
Россия, 141983 Московская область, г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки, д. 33, помещ. 2.3
Тел.: +7 (495) 108-75-79 | E-mail: info@white-service.org

Уполномоченный представитель производителя по России и СНГ

ООО «Уайт Продакт»
Россия, 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7, этаж 3, помещение VIII, комната 3.2 Тел.: +7 (495) 108-52-41.1 | E-mail: info@white-product.com | www.white-product.com

РУ №РЭН ХХХХ/ХХХХ от 04.04.2021 г.

25 тест-кассет

WhiteProduct

COVID-19 AG TEST

Для in vitro диагностики

Для профессионального применения

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по TY 21.20.23-002-46311122-2021»

25 тест-кассет

Для in vitro диагностики

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ПРОДУКТА
(см. инструкцию)



LOT 2021WSA

16.02.2023

Увеличенный текст рисунка 3

WhiteProduct


WhiteProduct COVID-19 Ag Test
партия 2021WSA

25 шт.

**НАСАДКА С КАПЕЛЬНИЦЕЙ
К БУФЕРУ**



WS-ET25-ASP



2021WSA




16.02.2023

WhiteProduct

WhiteProduct COVID-19
Ag Test партия 2021WSA

**НАСАДКА
С КАПЕЛЬНИЦЕЙ
К БУФЕРУ**



1 шт.



WS-ET01-ASP



2021WSA



16.02.2023

WhiteProduct

WhiteProduct COVID-19
Ag Test партия 2021WSA

**НАСАДКА
С КАПЕЛЬНИЦЕЙ
К БУФЕРУ**



5 шт.



WS-ET05-ASP



2021WSA



16.02.2023

Рисунок 4. Макет маркировки насадки с капельницей к буферу (1 шт, 5 шт, 25 шт. в упаковке)

WhiteProduct

WhiteProduct COVID-19 Ag Test

партия 2021WSA

ПРОБИРКА С БУФЕРОМ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ



IVD



25 шт.

0,35 мл

REF

WS-ET25-ASP

LOT

2021WSA




16.02.2023

для набора 25 шт. в комплекте

WhiteProduct

WhiteProduct COVID-19
Ag Test партия 2021WSA

**ПРОБИРКА С БУФЕРОМ
ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ**



IVD

0,35 мл



1 шт.

REF

WS-ET01-ASP

LOT

2021WSA



16.02.2023

для набора 1 шт. в комплекте

WhiteProduct

WhiteProduct COVID-19
Ag Test партия 2021WSA

**ПРОБИРКА С БУФЕРОМ
ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ**



IVD

0,35 мл



5 шт.

REF

WS-ET05-ASP

LOT

2021WSA




16.02.2023

для набора 5 шт. в комплекте

Рисунок 5. Макет маркировки пробирки с буфером для экстракции.

WhiteProduct COVID-19 Ag Test

ТЕСТОВАЯ КАССЕТА



WhiteProduct

Рисунок 6. Макет маркировки индивидуальной упаковки из фольги «Тестовая кассета»

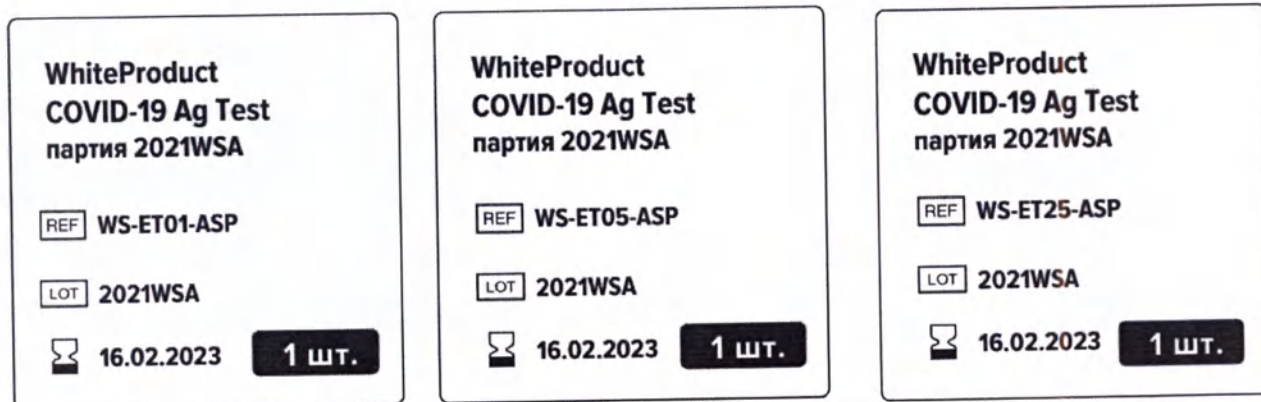


Рисунок 9. Дополнительные стикеры для индивидуальной упаковки из фольги «Тестовая кассета» (для 1 шт. в наборе, 5 шт. в наборе, 25 шт в наборе)

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021»

LOT

2021WSA



17.02.2021



16.02.2023



ООО «УАЙТ СЕРВИС»

Россия, 141983, Московская область,
г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки, д.33,
помещ.23.

тел. +7 (495) 108-75-79,

E-mail: info@white-service.org



Количество изделий в упаковке:

☐ 1 шт.

☐ 5 шт.

☐ 25 шт.

IVD

1°C 30°C

Масса нетто:

Масса брутто:

Количество упаковочных единиц



РУ№РЗН XXXX/XXXX от ЧЧ.ММ.ГГ

Рисунок 10. Макет маркировки транспортной упаковки

**ПРИЛОЖЕНИЕ
(СПРАВОЧНОЕ)**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

«Набор реагентов для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (WhiteProduct COVID-19 Ag Test), партия 2021WSA по ТУ 21.20.23-002-46311122-2021»

I. Вариант исполнения 1, в составе:

- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) -1 шт
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) -1 шт
- 3.Насадка с капельницей к буферу -1 шт
- 4.Инструкция по применению -1 шт

II.Вариант исполнения 2, в составе:

- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги) - 5 шт
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) - 5 шт
- 3.Насадка с капельницей к буферу -5 шт
- 4.Инструкция по применению -1 шт

III.Вариант исполнения 3, в составе:

- 1.Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги)- 25 шт
- 2.Пробирка с буфером для экстракции (0,35 мл) - 25 шт
- 3.Насадка с капельницей к буферу - 25 шт
- 4.Инструкция по применению -1 шт

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

12 (Двенадцать) листов
цифрами прописью

Должность

Подпись

«04» октября 20 22 г.

