

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «РИВЬЕРА БИОТЕК»

Я.Б. Миркин

30 сентября 2021 года




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

*Аппарат криохирургический «Cryo-S»
в вариантах исполнения*


Cryosurgery device «Cryo-S»

производства компании / manufactured by the company
Метрум Криофлекс Сп. з.о.о., Сп. К./ Metrum Cryoflex Sp. z o.o., Sp. K.




2021 г.

Аппарат криохирургический «Cryo-S Electric II» – блок основной (вид спереди)




Аппарат криохирургический «Cryo-S Electric II» – блок основной (вид слева)



Аппарат криохирургический «Cryo-S Electric II» – блок основной (вид справа)





Аппарат криохирургический «Cryo-S Electric II» – блок основной (вид сзади)

Аппарат криохирургический «Cryo-S Painless» – блок основной (вид спереди)



ЗАМЕНА БАЛЛОНА

Чтобы заменить баллон следует:

1. Нажать клавишу КОНЕЦ РАБОТЫ.
2. Закрыть баллон.
3. Нажать клавишу ОК.
4. Подождать пока давление спадет до «0».
5. Отсоединить шланг от коннектора на баллоне.
6. Открутить коннектор от пустого баллона.
7. Присоединить коннектор к новому баллону.
8. Подключить шланг к коннектору.

АППАРАТ ГОТОВ К РАБОТЕ


ВНИМАНИЕ!

**ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ПРОЦЕДУР СЛЕДУЕТ
ВЫПУСТИТЬ ГАЗ
ИЗ АППАРАТА!**

Аппарат
криохирургический
«Cryo-S Painless» –
блок основной (вид
сверху)

ТОК
СТИМУЛЯЦИИ
ПОТОК

Аппарат криохирургический «Cryo-S Painless» – блок основной (вид слева)




Аппарат криохирургический «Cryo-S Painless» – блок основной (вид справа)



Аппарат криохирургический «Cryo-S Painless» – блок основной (вид сзади)




Аппарат криохирургический
«Cryo-S Painless» с
установленным держателем
шланга криозонда и шлангом
для подключения криозонда с
кабелем нейростимулятора




Держатель шланга криозонда
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Блок управления ножной со шнуром
(в составе Аппаратов криохирургических
«Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Шланг для подключения аппарата к баллону,
длина 0,5 м
(в составе Аппаратов криохирургических
«Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




**Шланг для подключения аппарата к баллону,
длина 3,0 м
(в составе Аппаратов криохирургических
«Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)**






Кабель питания
(в составе Аппаратов криохирургических
«Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)


Коннектор N₂O для подключения к
баллону
(в составе Аппаратов криохирургических
«Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Коннектор CO₂ для подключения к
баллону
(в составе Аппаратов криохирургических
«Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Шланг для подключения криозонда
(в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Electric II»)

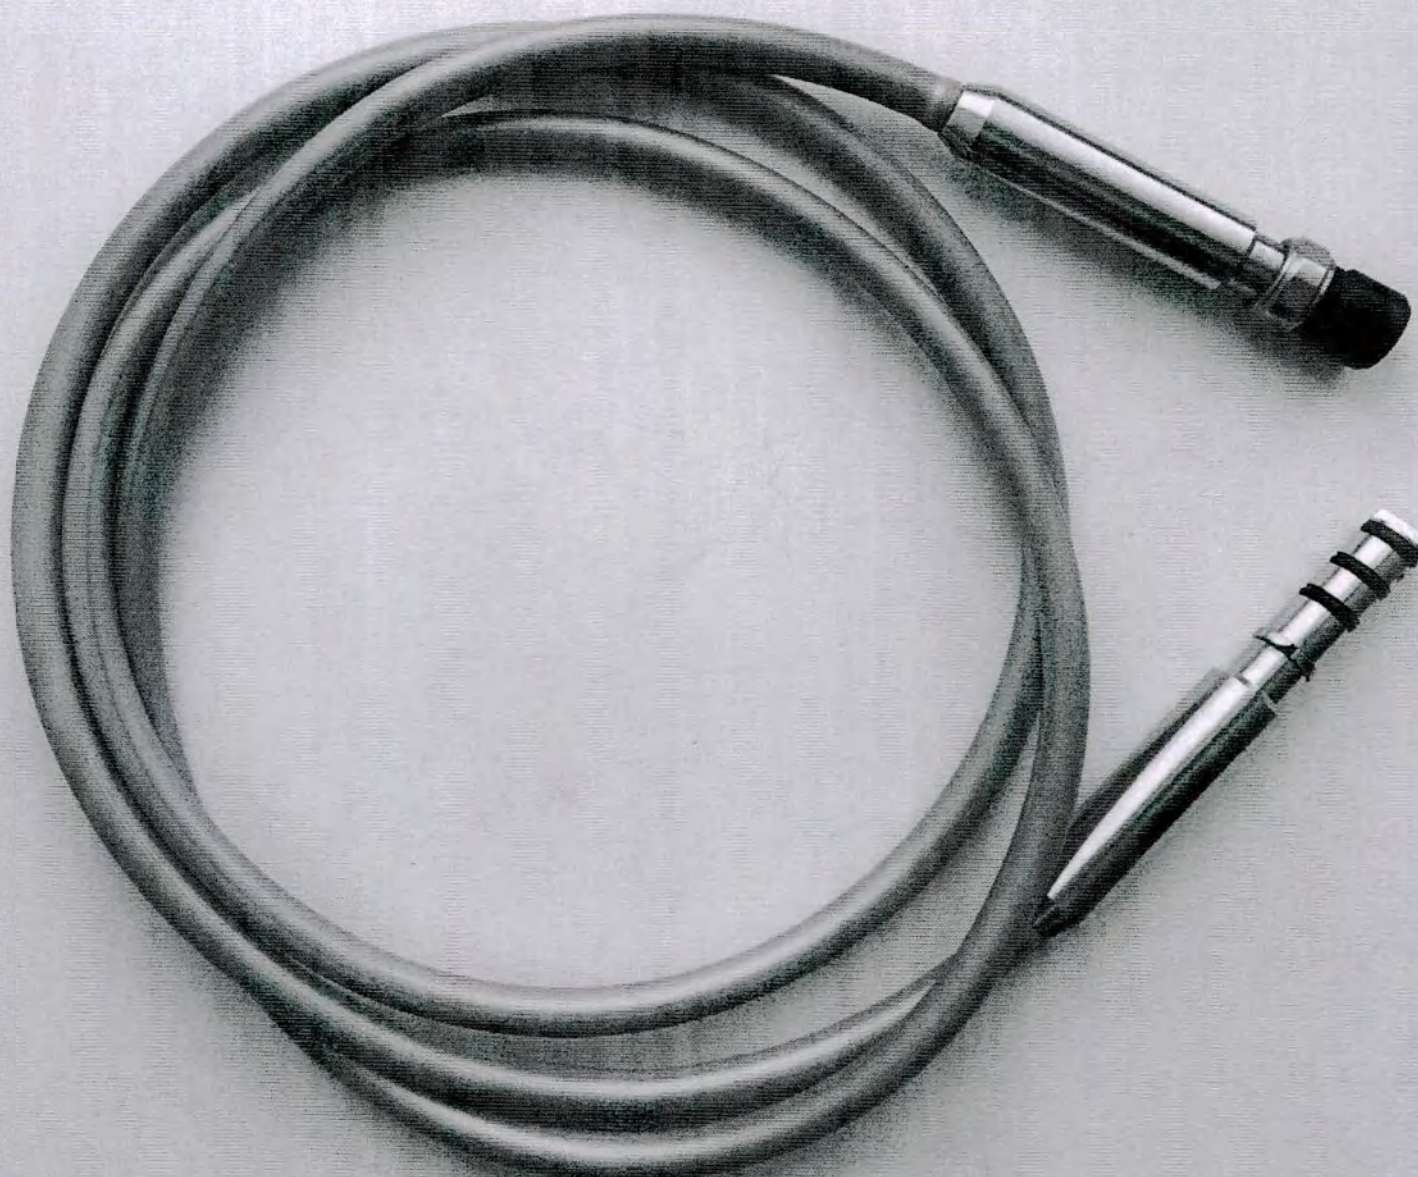


Шланг для подключения криозонда с кабелем нейростимулятора
(в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Painless»)



Чехол фирменный на баллон
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)

 METRUM CRYOFLEX


Ключ гаечный разводной
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)

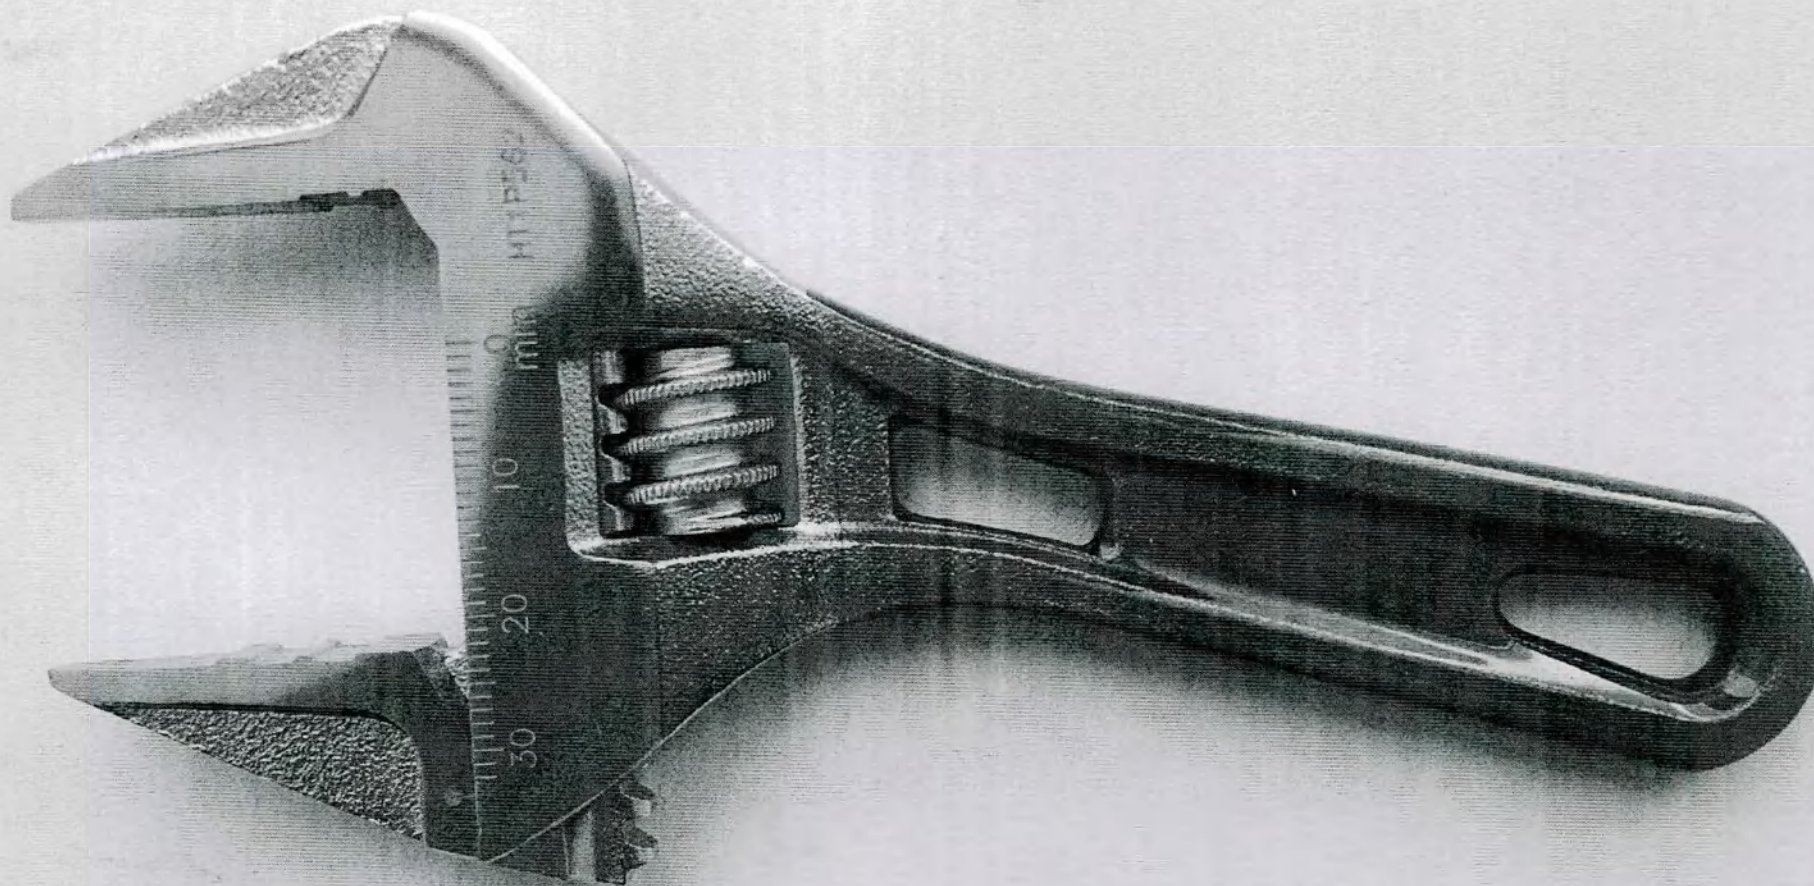

Комплект заглушек для разъёмов запасной
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Заглушка коннектора для подключения CO₂ / N₂O



Заглушка разъёма для подключения криозондов

Комплект заглушек для разъёмов запасной
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Прокладка пластиковая 19,0 × 11,0 × 4,0 мм – 1 шт.
Прокладка пластиковая 14,0 × 7,0 × 3,0 мм – 1 шт.
Кольцо резиновое уплотнительное 2,8 × 6,0 × 1,4 мм – 3 шт.
Кольцо резиновое уплотнительное 3,8 × 8,0 × 2,5 мм – 3 шт.
Кольцо резиновое уплотнительное 5,7 × 10,0 × 2,5 мм – 2 шт.
Кольцо резиновое уплотнительное 8,7 × 13,0 × 2,5 мм – 5 шт.

Комплект заглушек для разъёмов запасной
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Приспособление для установки колец уплотнительных с насадками – 1 шт.




Материал смазочный силиконовый 3,5 г – 1 шт.

Предохранитель T1,25L/250B запасной – 2 шт.
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа D-10/RF, номер по каталогу: 0 1 1000 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Kontaktowy sonda kriochirurgiczna Contact cryosonde
TYP SONDY TYPE OF PROBE **D-21/RF**
REF **0 1 2145 1**
M C METRUM CRYOFLEX
ul. Żwirki 28
05-402 Białe Łąki nad Wisłą
tel. (44) 22 13 13 780
biuro@metrum.com.pl www.metrum.com.pl
CE 2274


Криозонд контактный многоразовый типа D-21/RF, номер по каталогу: 0 1 2145 1, с индивидуальной упаковкой (в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа D-22/RF, номер по каталогу: 0 1 2255 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Кризонд контактный многоразовый типа D-23/RF, номер по каталогу: 0 1 2370 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Кризонд контактный многоразовый типа D-30/RF, номер по каталогу: 0 1 3000 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа G-30/2/RF, номер по каталогу: 0 4 3002 1 с индивидуальной упаковкой
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа G-10/20/RF, номер по каталогу: 0 4 1020 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа G-10/22/RF, номер по каталогу: 0 4 1022 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



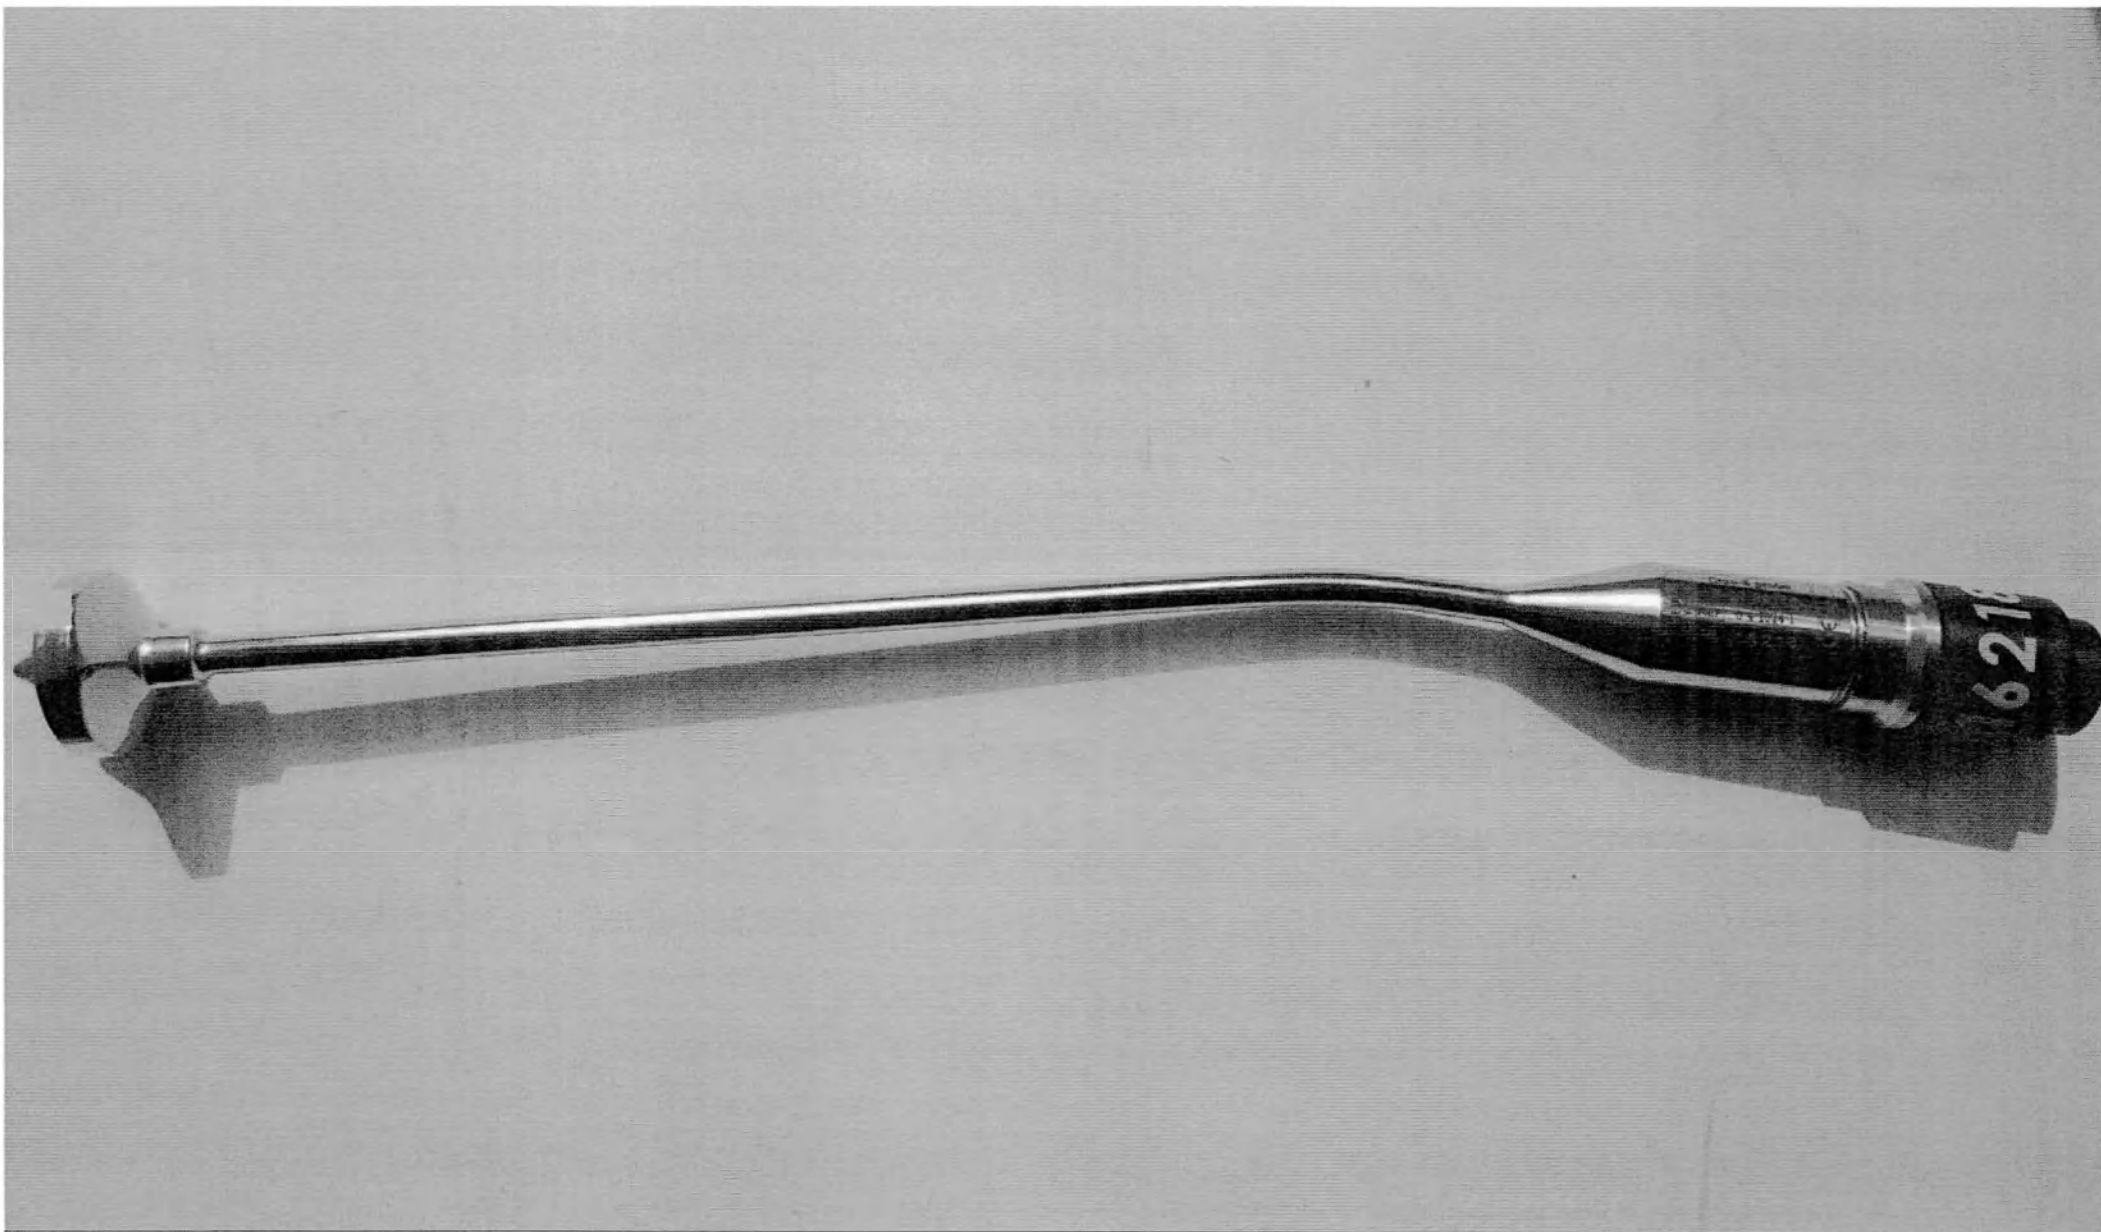

Криозонд контактный многоразовый типа G-10/24/RF, номер по каталогу: 0 4 1024 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)

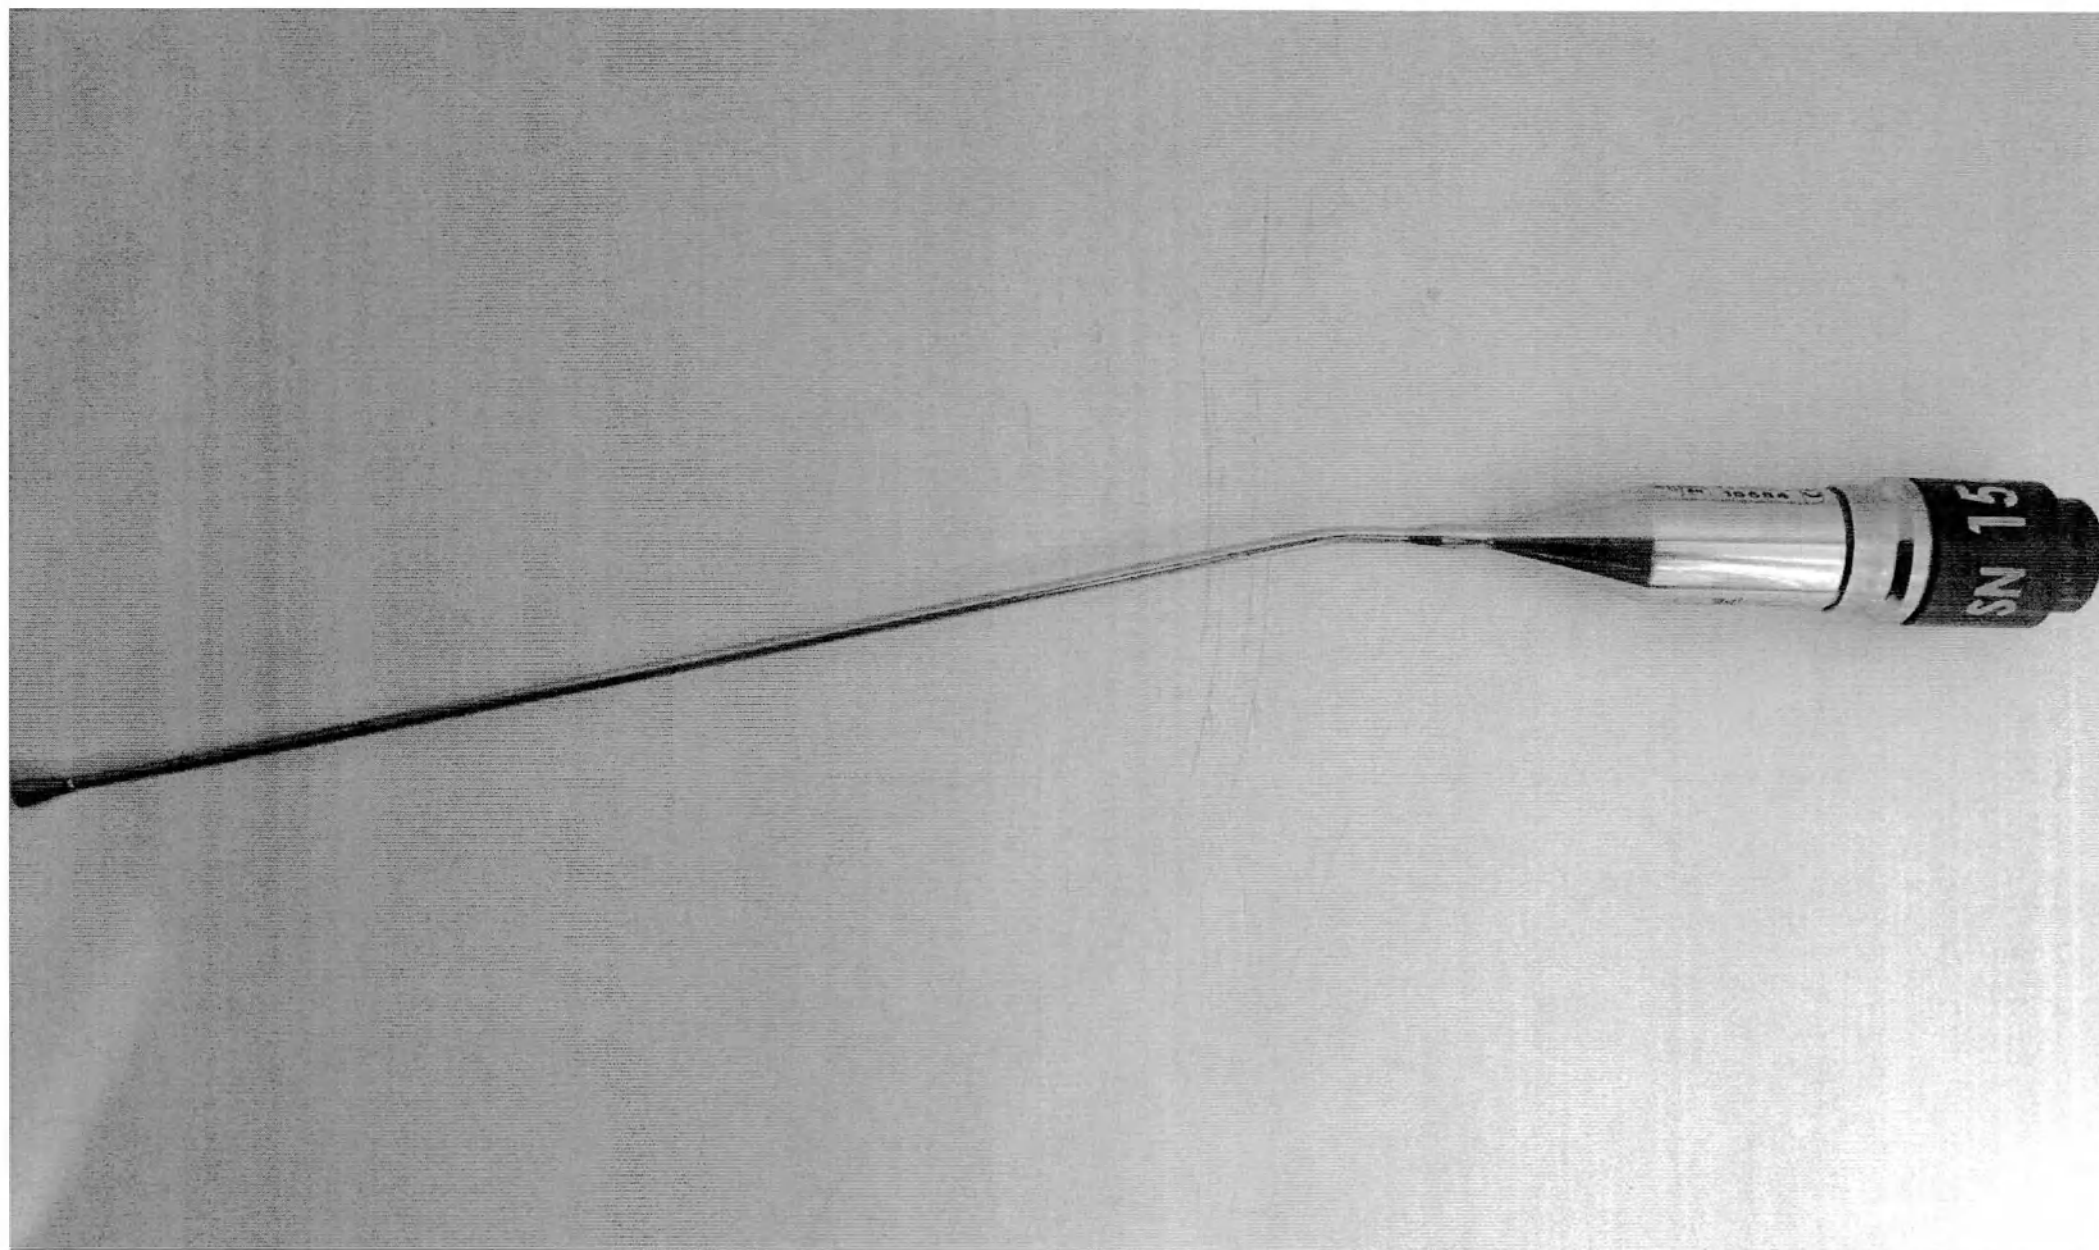


Криозонд контактный многоразовый типа G-20/RF, номер по каталогу: 0 4 2000 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)

Кризонд контактный многоразовый типа G-30/RF, номер по каталогу: 0 4 3003 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Кризонд контактный многоразовый типа G-40/4/RF, номер по каталогу: 0 4 4004 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Криозонд контактный многоразовый типа G-40/6/RF, номер по каталогу: 0 4 4006 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Кризонд контактный многоразовый типа G-60/RF, номер по каталогу: 0 4 6015 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа G-50/15/RF, номер по каталогу: 0 4 5015 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



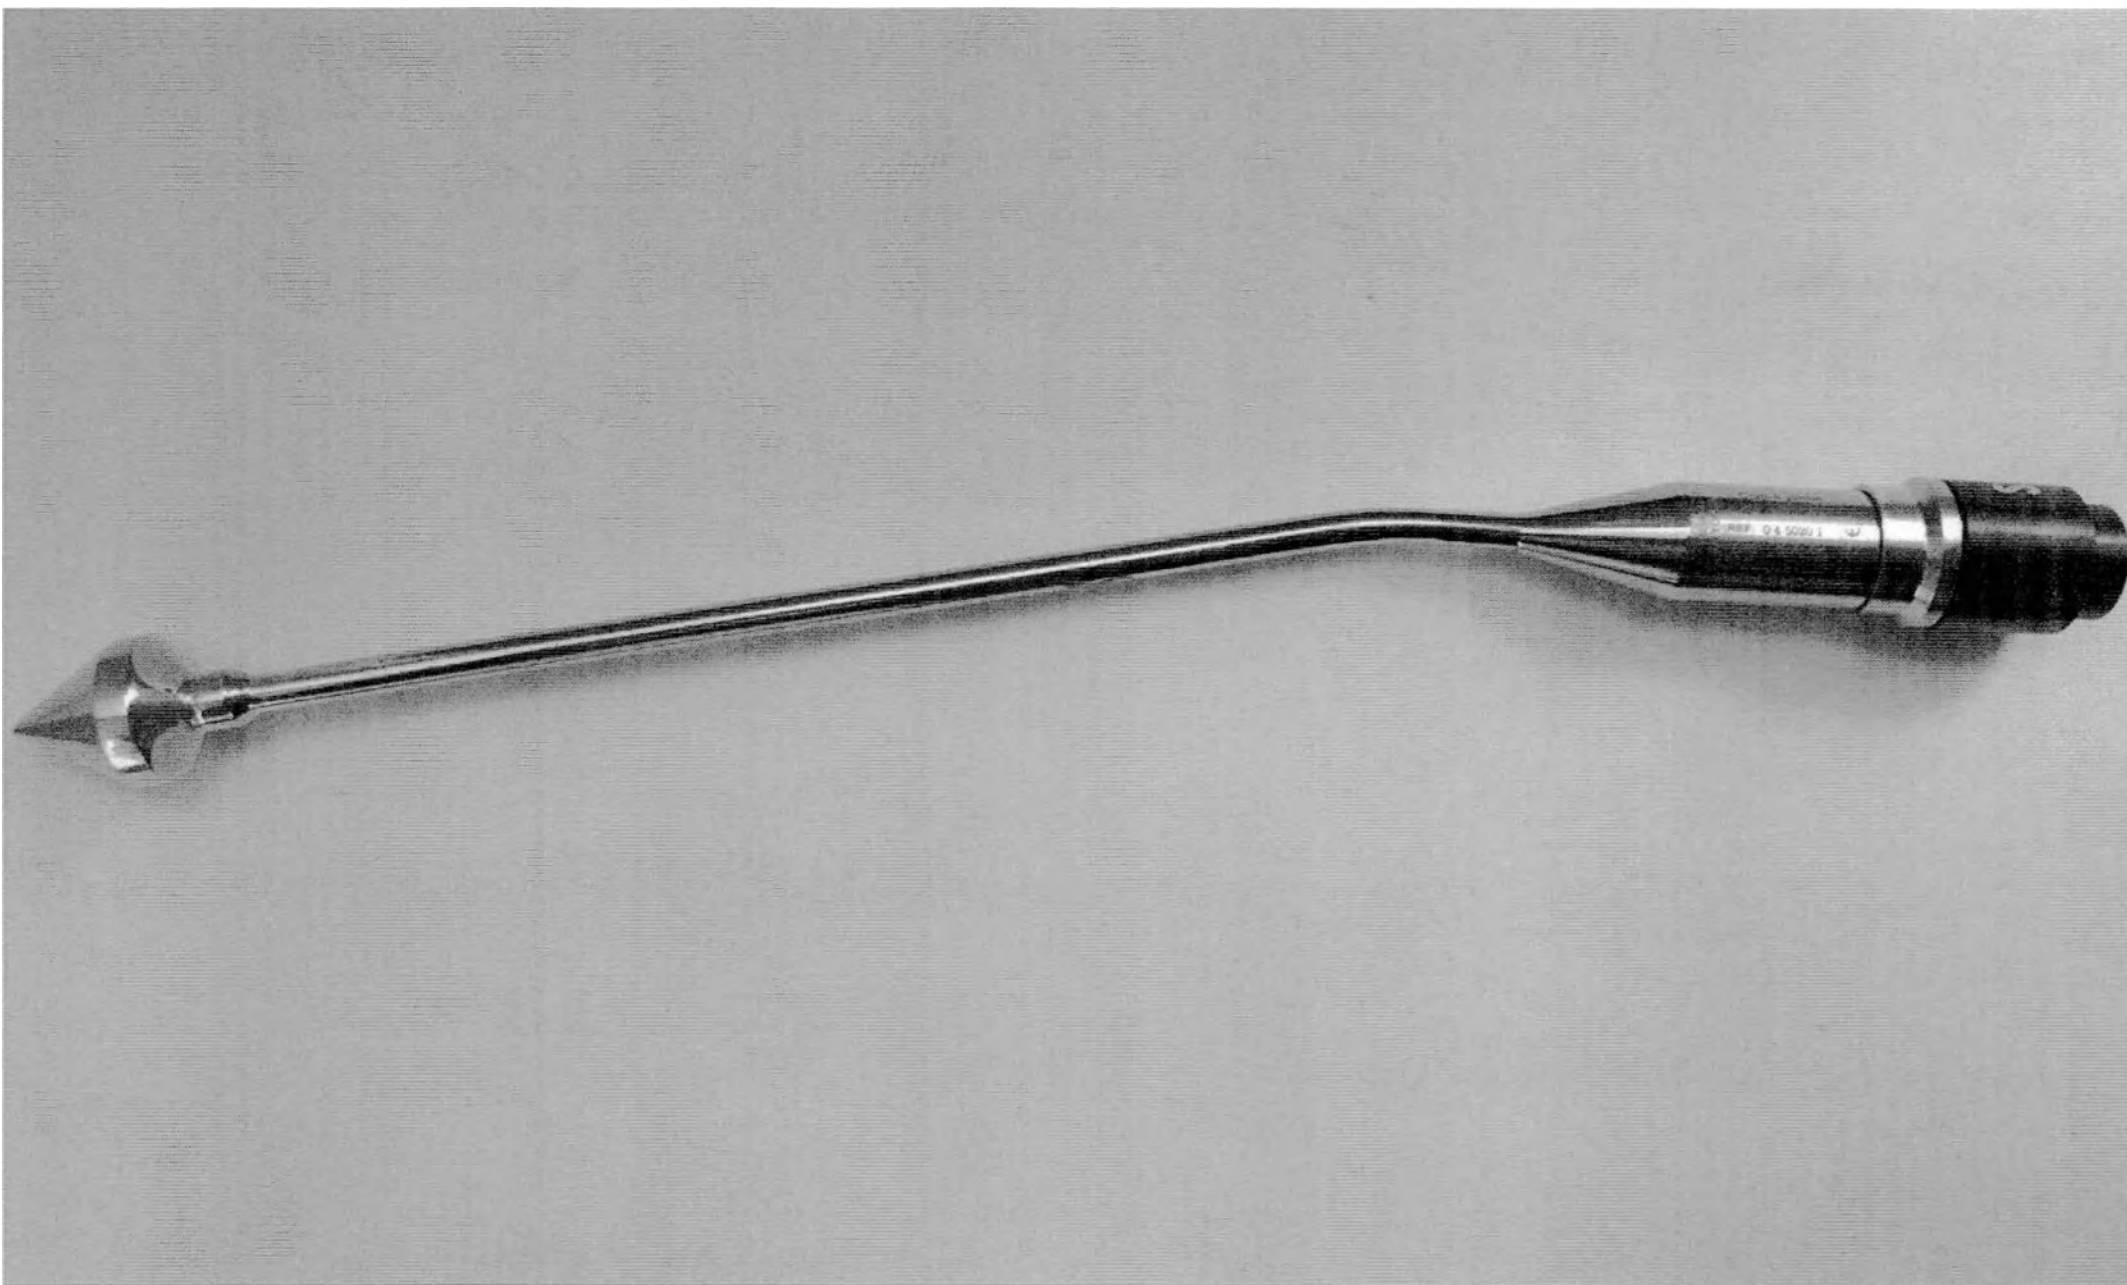


Криозонд контактный многоразовый типа G-50/20/RF, номер по каталогу: 0 4 5020 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)

Криозонд контактный многоразовый типа G-70/RF, номер по каталогу: 0 4 7015 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Криозонд контактный многоразовый типа GH-1/RF, номер по каталогу: 0 4 8001 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)







Криозонд контактный многоразовый типа G-H3/RF, номер по каталогу: 0 4 8003 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Кризонд контактный многоразовый типа GH-2/RF, номер по каталогу: 0 4 8002 1 с индивидуальной упаковкой (в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Криозонд контактный многоразовый типа ОП-Н015S, номер по каталогу: 0 2 3004 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа OP-H015L, номер по каталогу: 0 2 3006 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа OP-L008/RF, номер по каталогу: 0 2 4010 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)


Kontaktowa sonda kriochirurgiczna Contact cryoprobe
TYP SONDY **OP-L008/RF**
TYPE OF PROBE
REF **0 2 4010 1**
 **M C** METRUM CRYOFLEX
ul. Zielna 29
05-082 Blizne Laszczyńskiąg
tel.: +48) 22 33 13 750
biuro@metrum.com.pl www.metrum.com.pl
 **2274**




Криозонд контактный многоразовый типа OP-N008/RF, номер по каталогу: 0 2 5008 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа OP-R009/RF, номер по каталогу: 0 2 6016 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа OP-R010S/RF, номер по каталогу: 0 2 6130 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Кризонд контактный многоразовый типа OP-R010L/RF, номер по каталогу: 0 2 6131 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Криозонд контактный многоразовый типа OP-R011S/RF, номер по каталогу: 0 2 6230 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Криозонд контактный многоразовый типа OP-R011L/RF, номер по каталогу: 0 2 6231 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Кризонд контактный многоразовый типа OP-C013/RF, номер по каталогу: 0 2 1013 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа OP-G014/RF, номер по каталогу: 0 2 2014 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа OP-V008/RF, номер по каталогу: 0 2 7010 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Кризонд контактный многоразовый типа A-16/80/RF, номер по каталогу: 0 3 1608 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа А-25/170/Р/RF, номер по каталогу: 0 3 2517
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа А-25/220/Р/RF, номер по каталогу: 0 3 2522 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




Кризонд контактный многоразовый типа А-30/300/Р/RF, номер по каталогу: 0 3 3030 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



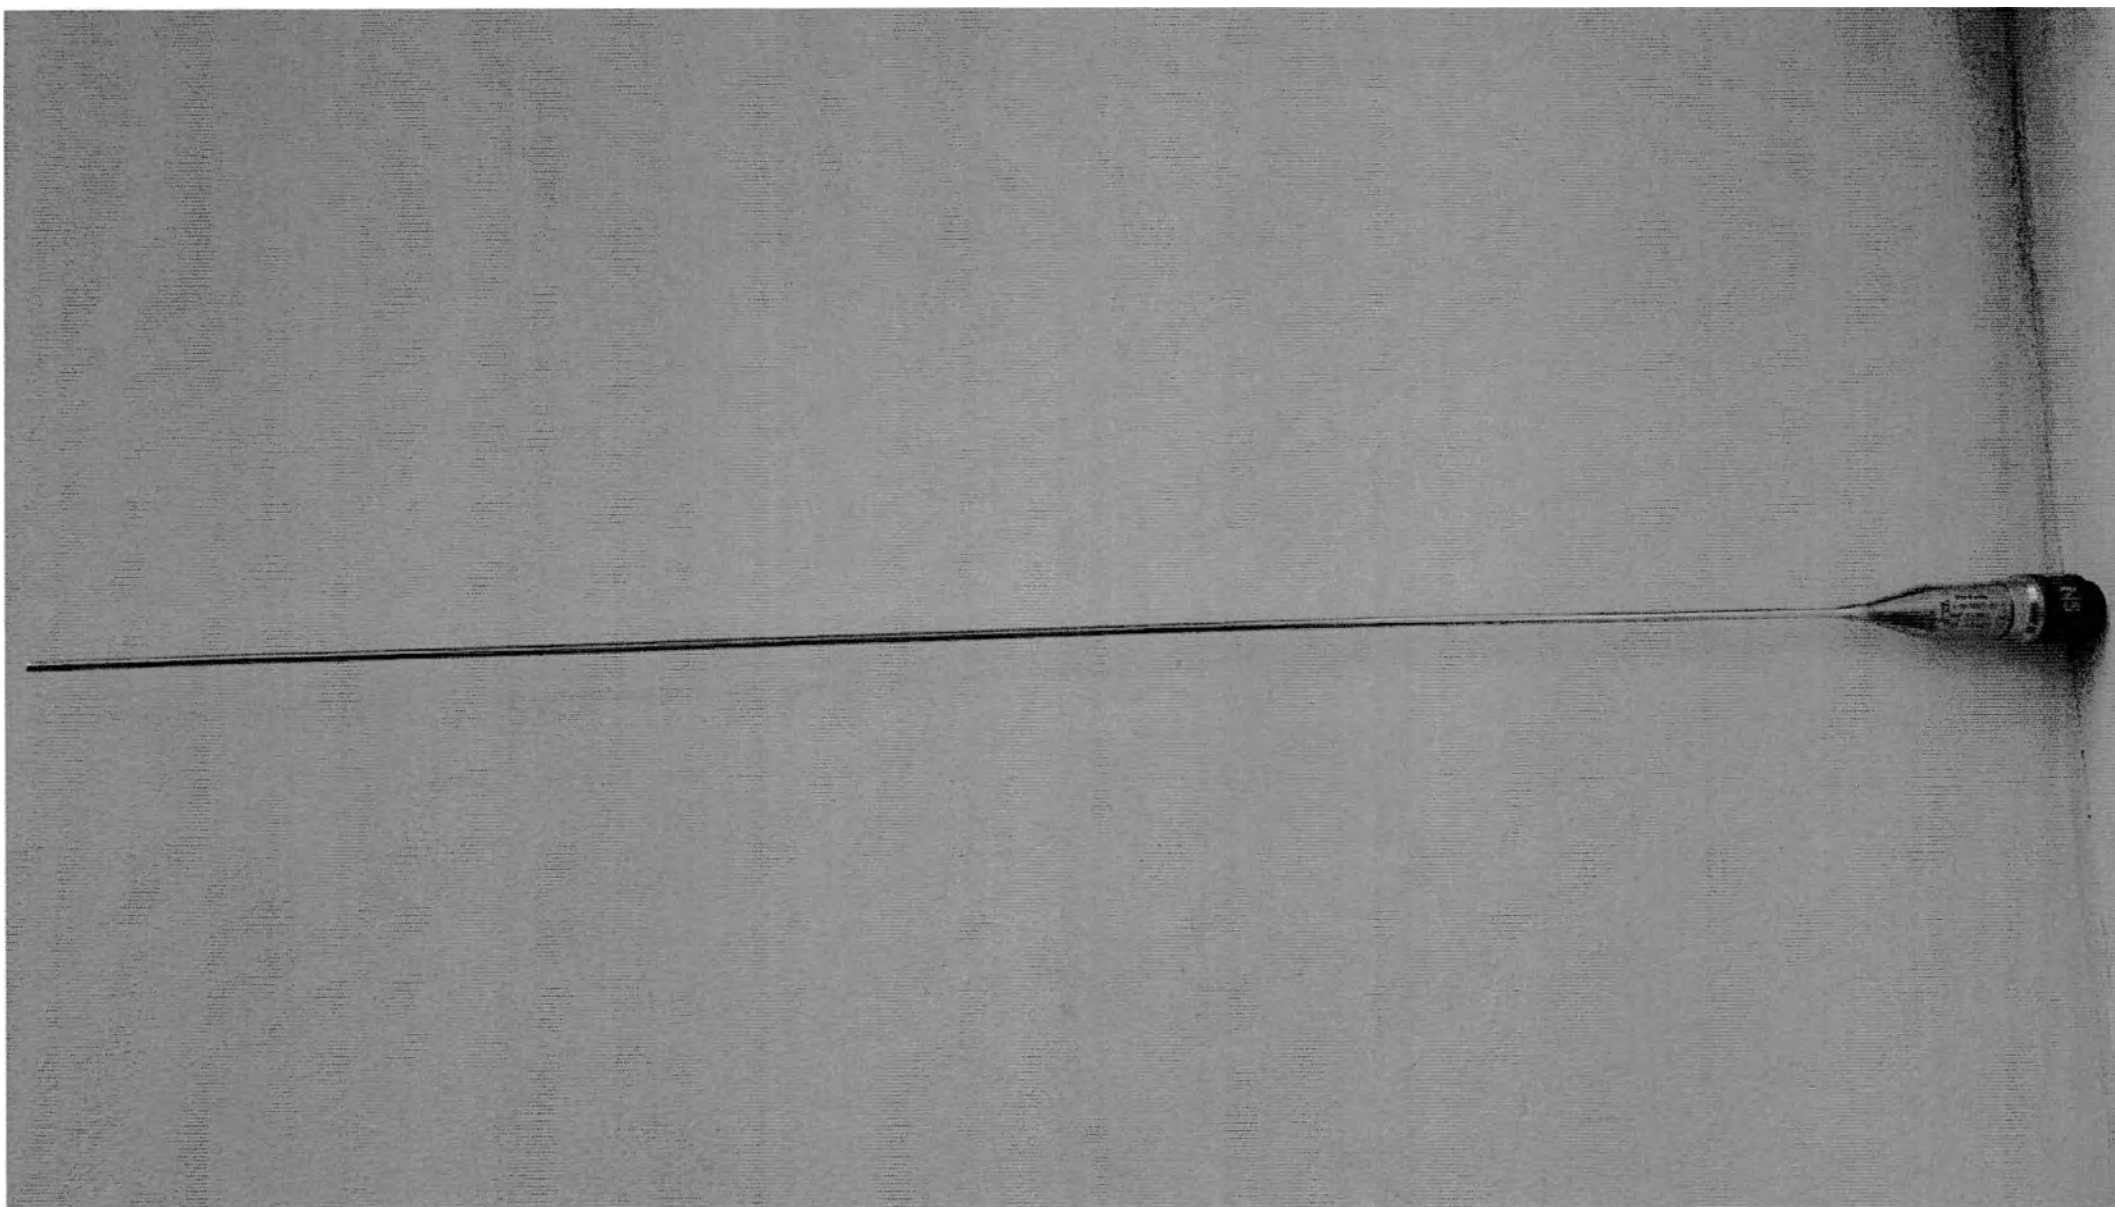


**Криозонд контактный многоразовый типа А-30/500/Р/RF, номер по каталогу: 0 3 3050 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)**

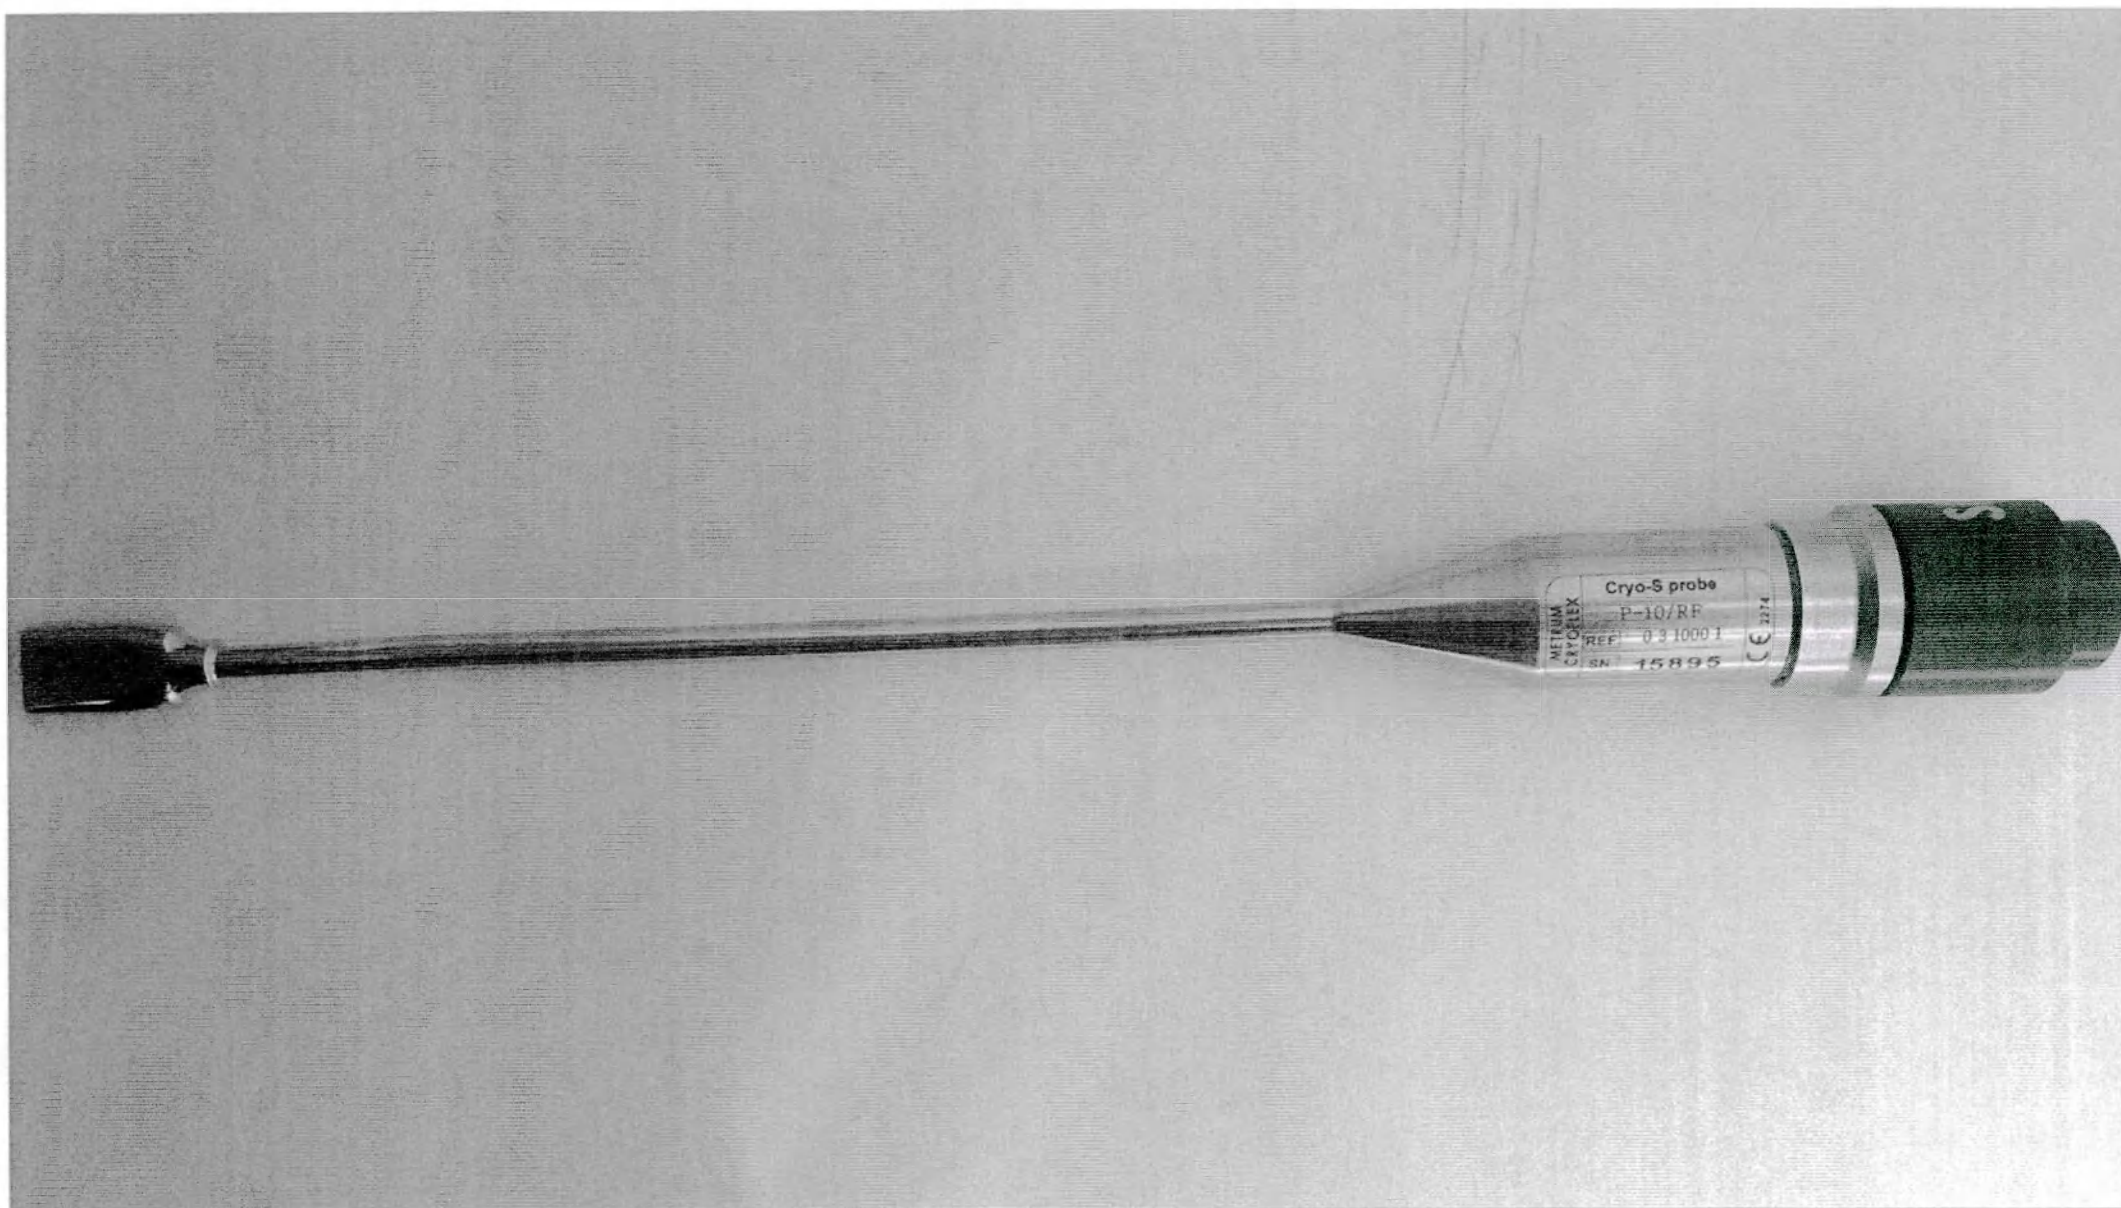


Криозонд контактный многогранный типа P-10/RF, номер по каталогу: 0310001
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)

Криозонд распылительный многоразовый типа SD-10 номер по каталогу: 0 1 0000 1, в составе: Криозонд распылительный многоразовый типа SD-10 номер по каталогу: 0 1 0000 1 – 1 шт.; Ограничитель области заморзания дерматологический – 6 шт.; Адаптер для разблокировки распылительной насадки – 1 шт.; Инструмент для подготовки ватных палочек – 1 шт.; Палочки ватные нестерильные – 10 шт.; Колпачок защитный распыляющего сопла – 2 шт. Бокс пластиковый – 1 шт. (в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)



Криозонд распылительный многоразовый типа SD-10 номер по каталогу: 0 1 0000 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)




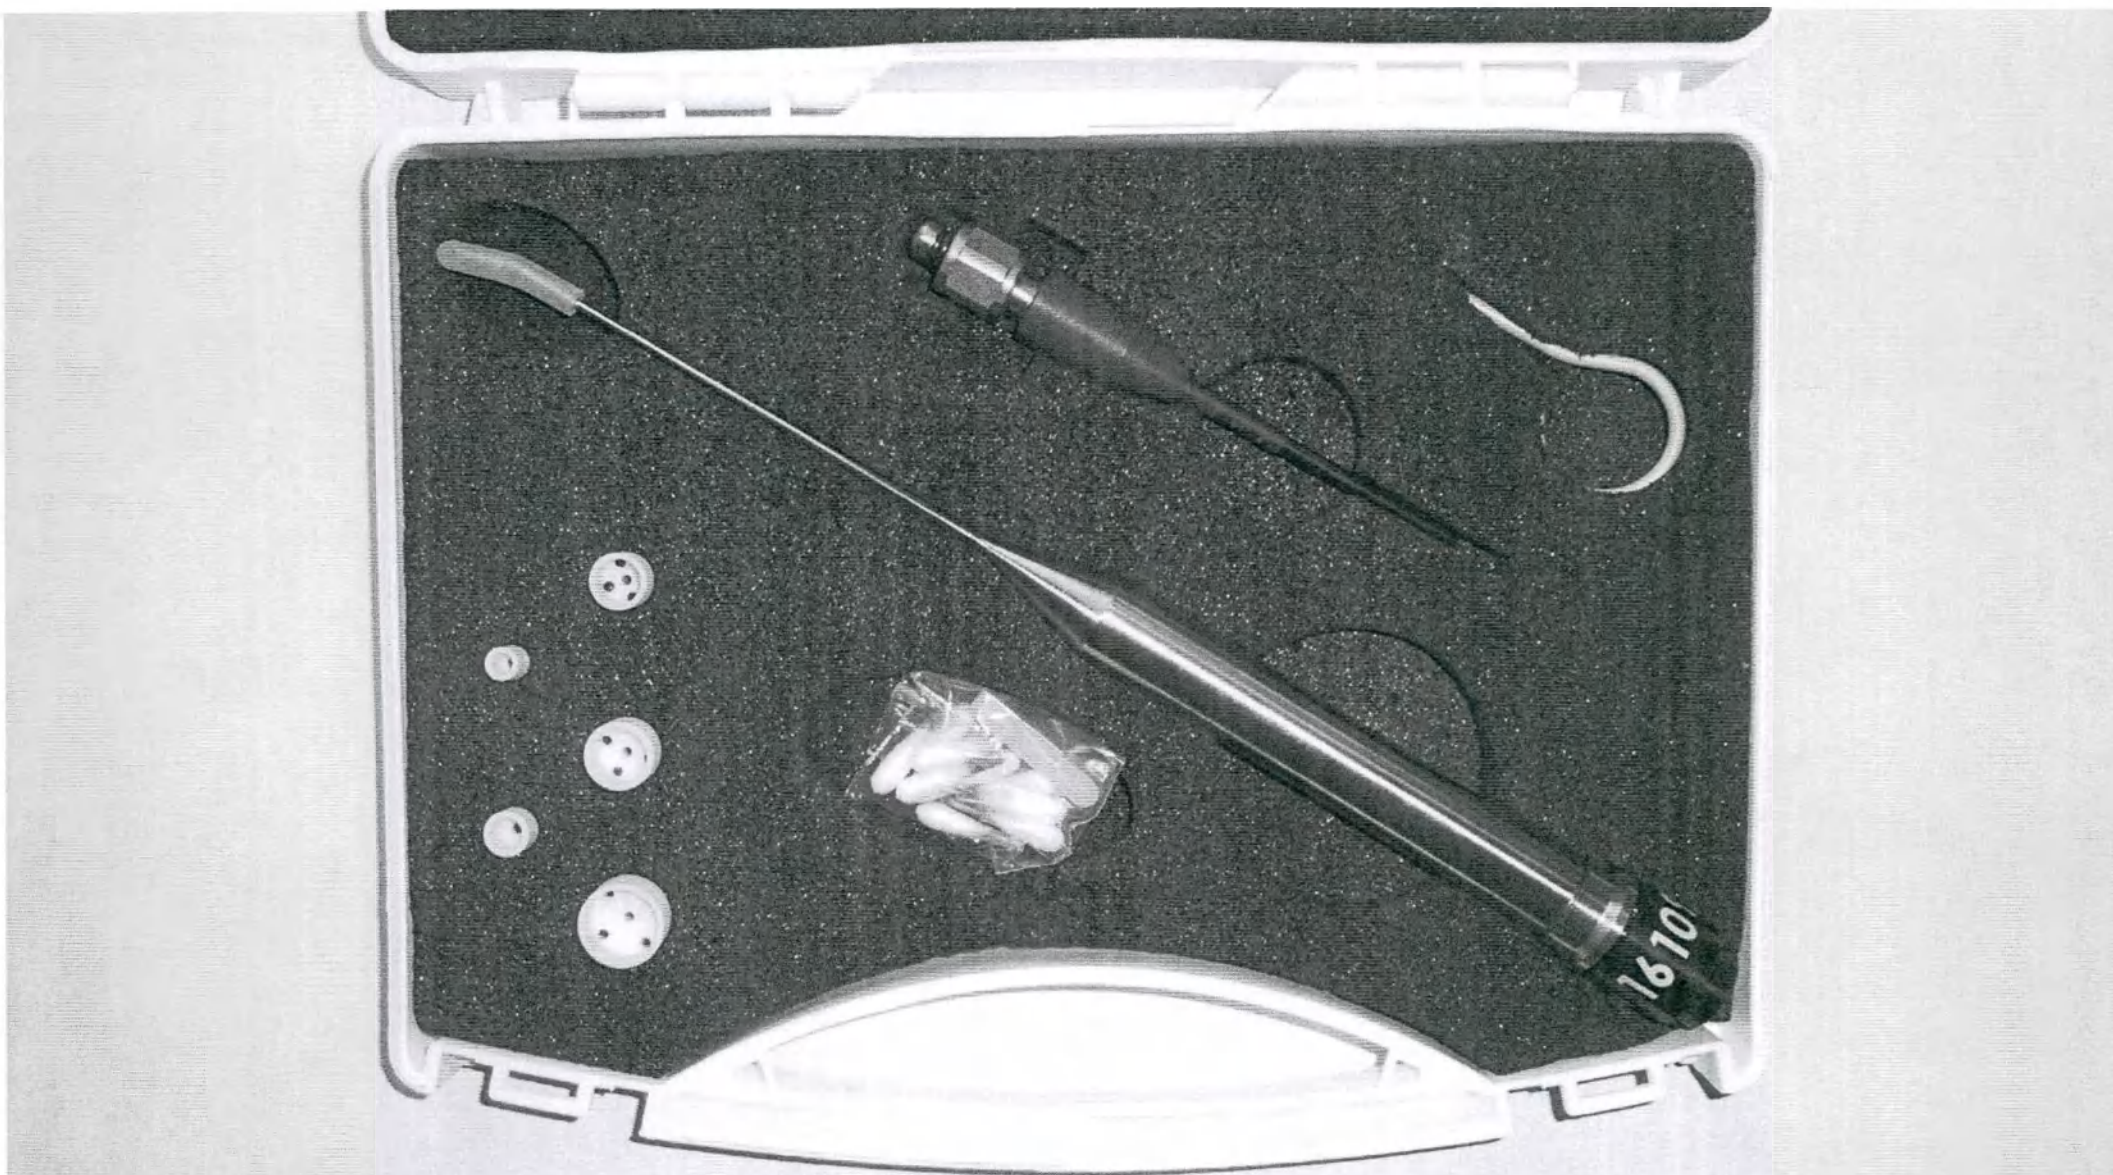


Криозонд распылительный многоразовый типа SG-10, номер по каталогу: 0 4 0000 1, в составе: Криозонд распылительный многоразовый типа SG-10, номер по каталогу: 0 4 0000 1 – 1 шт.; Ограничитель области заморозания гинекологический – 5 шт.; Адаптер для разблокировки распылительной насадки – 1 шт.; Инструмент для подготовки ватных палочек – 1 шт.; Палочки ватные нестерильные – 10 шт.; Колпачок защитный распыляющего сопла – 2 шт.; Бокс пластиковый – 1 шт. (в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)

Криозонд распылительный многоразовый типа SG-10, номер по каталогу: 0 4 0000 1
(в составе Аппаратов криохирургических «Cryo-S Painless» и «Cryo-S Painless»)







Кризонд контактный многоразовый типа А-08/20/Н/RF, номер по каталогу: N 0 6 0802 2 1 – защитный колпачок с RFID-чипом снят (в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Painless»)



Криозонд контактный многоразовый типа А-08/20/Н/RF, номер по
каталогу: N 0 6 0809 2 1
(в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа А-08/20/Н/RF, номер по каталогу: N 0 6 0809 1 1
(в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа А-13/120/Т/RF, номер по каталогу: N 0 6 1312 0 1
(в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Painless»)




Криозонд контактный многоразовый типа А-13/120/Р/RF, номер по каталогу: N 0 6 1312 1 1
(в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Painless»)




Кризонд контактный многоразовый типа G-30/2/RF, номер по каталогу: N 0 6 3002 0 1
(в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Painless»)





Электрод нейтральный Skintact типа RS05, однократного применения – вид снизу
(в составе Apparata криохирургического «Cryo-S Painless»)



Электрод нейтральный Skintact типа RS05, однократного применения – вид сверху
(в составе Apparata криохирургического «Cryo-S Painless»)

Электрод нейтральный Skintact типа RS05, однократного применения – в упаковке
(в составе Apparata криохирургического «Cryo-S Painless»)

NEUTRAL ELECTRODES

ELECTRODES NEUTRES
NEUTRALELEKTRODEN
ELETTRODI NEUTRI
ELECTRODOS NEUTROS
ELETRODOS NEUTROS
NEUTRALE ELEKTRODES
NEUTRALELEKTRODER
NEUTRAALIELEKTRODIT
NØYTRALELEKTRODER
ELETRODOS NEUTROS
NEUTRÁLNÍ ELEKTRODY
NEUTRÁLNE ELEKTRODY
ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
NÖTR ELEKTROTLAR
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
中性电极
لکترودات حیادیة

SKINTACT®




www.skintact.com

COOL CONTACT

00174 / 09.31.20

STANDARD

5 x REF RS05 /5



GTIN 19005531586915

LOT 181011-0804

2021-10-11

0191182055315869151011181011-080417321101

CE 0483

SKINTACT REF RS05 /5
GTIN 19005531586915
LOT 181011-0804

SKINTACT REF RS05 /5
GTIN 19005531586915
LOT 181011-0804

SKINTACT REF RS05 /5
GTIN 19005531586915
LOT 181011-0804

SKINTACT REF RS05 /5
GTIN 19005531586915
LOT 181011-0804

SKINTACT REF RS05 /5
GTIN 19005531586915
LOT 181011-0804



Leonhard Lang GmbH, Archernweg 56, 6020 Innsbruck, Austria; fax +43 512 392210; medical@LeonhardLang.at

Кабель Skintact типа NEK300A для подключения электрода нейтрального
(в составе Аппарата криохирургического «Cryo-S Painless»)





Тележка для установки аппарата
и 1 баллона, номер по каталогу:
TRCSE
(в составе Аппаратов
криохирургических «Cryo-S
Painless» и «Cryo-S Painless»)



Тележка для установки аппарата
и 2 баллонов, номер по каталогу:

TRCSE

(в составе Аппаратов
криохирургических «Cryo-S
Painless» и «Cryo-S Painless»)

Аппарат криохирургический «Cryo-S Painless – в упаковке с маркировкой на русском и польском языках



METRUM CRYOFLEX

MEDICAL DEVICE MANUFACTURER
www.metrum.com.pl

M C METRUM CRYOFLEX

PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ
MEDICAL DEVICES MANUFACTURER

NATRYSKOWA SONDA KRIOCHIRURGICZNA SPRAY
do aparatu Cryo-S Typ: SD-10
CRYOSURGERY PROBE SPRAY
for Cryo-S device: Type: SD-10

M C METRUM CRYOFLEX

ul. Zielna 29
05-082 Blizne Łaszczyskiego
POLAND / EU
tel: (+48) 22 33 13 750
fax: (+48) 22 33 13 766
e-mail: biuro@metrum.com.pl
www.metrum.com.pl

TRANSPORT



Natryskowa sonda krio chirurgiczna Spray do aparatu serii Cryo-S
Cryosurgery probe Spray for Cryo-S cryosurgical devices

TYP SONDY TYPE OF PROBE	SD-10
REF	0 1 0000 1
CE 2274	2019 SN 16230
M C METRUM CRYOFLEX tel: (+48) 22 33 13 750 ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyskiego, POLAND biuro@metrum.com.pl www.metrum.com.pl	

5 907559 220666

CE 2274

Metrum CryoFlex

producent aparatury medycznej
medical devices manufacturer

SONDA NATRYSKOWA
GINEKOLOGICZNA SG 10
DO APARATU Cryo-S

GYNEACOLOGICAL
SPRAY TYPE
CRYOPROBE SG 10
FOR Cryo-S DEVICE

ul. Kolejowa 16A
05-092 Łomianki/POLAND
tel: (+48) 22 33 13 750
fax: (+48) 22 33 13 766
www.metrum.com.pl
biuro@metrum.com.pl

TRANSPORT



Natryskowa sonda krio chirurgiczna Spray do aparatu serii Cryo-S
Cryosurgery probe Spray for Cryo-S cryosurgical devices

TYP SONDY TYPE OF PROBE	SG-10
REF	0 4 0000 1
CE 2274	2019 SN 16109
M C METRUM CRYOFLEX tel: (+48) 22 33 13 750 ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyskiego, POLAND biuro@metrum.com.pl www.metrum.com.pl	

5 907559 220673

CE 2274


Криозонд контактный многоразовый типа P-10/RF, номер по каталогу: 0 3 1000 1 и Криозонд
распылительный многоразовый типа SG-10, номер по каталогу: 0 4 0000 1 – в пластиковом боксе с
маркировкой



Шланг для подключения аппарата к баллону, длина 3,0 м – пример маркировки на шланге



Шланг для подключения аппарата к баллону, длина 0,5 м – пример маркировки на шланге



Шланг для подключения криозонда с кабелем нейростимулятора в индивидуальной упаковке с маркировкой на польском языке



Шланг для подключения криозонда с кабелем нейростимулятора в индивидуальной упаковке с маркировкой на русском языке



Шланг для подключения кризонда с кабелем нейростимулятора – пример маркировки на шланге

	M C	METRUM CRYOFLEX
ul. Zielna 29, 05-082 Bliźne Laszczynskiego, POLAND, tel: (+48) 22 33 13 750 www.metrum.com.pl		
Шланг для подключения кризонда с кабелем нейростимулятора		
 06.2019	004674	
REF PZS.N	1 шт.	

Шланг для подключения кризонда с кабелем нейростимулятора – пример маркировки на упаковке на русском языке

	M C	METRUM CRYOFLEX
ul. Zielna 29, 05-082 Bliźne Laszczynskiego, POLAND, tel: (+48) 22 33 13 750 www.metrum.com.pl		
Przewod zasilajacy sondy CSEP		
 06.2019	004674	
REF PZS.N	1 szt.	




METRUM CRYOFLEX
ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Laszczynskiego, POLAND, tel: (+48) 22 33 13 750 www.metrum.com.pl

Przewod zasilajacy sondy CSEA

 **11.2018** **004674** 

REF PZS.A 1 szt.

Шланг для подключения криозонда – пример маркировки на упаковке на польском языке




METRUM CRYOFLEX
ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Laszczynskiego, POLAND, tel: (+48) 22 33 13 750 www.metrum.com.pl

Шланг для подключения криозонда


 **11.2018** **004674** 

REF PZS.A 1 шт.

Шланг для подключения криозонда – пример маркировки на упаковке на русском языке

DIATHERMY CABLE
CÂBLE POUR PLAQUES ÉLECTROCHIRURGICALES
NEUTRALELEKTRODENKABEL
CAVO PER PIASTRE
CABLE PARA PLACA DE ELECTROBISTURÍ
CABO PLACA TERRA ELETROCIRÚRGICA

SKINTACT®
www.skintact.com

1 x  **3m REM compatible**

REF NEK300A
LOT LOT70605

 **reusable / réutilisable / mehrfach verwendbar / riutilizzabile reusable / reusável**    

Leonhard Lang GmbH
Ardenweg 58, 6020 Innsbruck, Austria
fax +43 512 392210, medical@LeonhardLang.at

UK: Leonhard Lang (UK) Ltd
Suite 3, Fern House, Daniels Industrial Estate, Bath Road, Stroud,
Glos, GL5 3TJ, fax 01453 874131, sales@LeonhardLang.co.uk

58482



Тележка для установки аппарата и 1 баллона, номер по каталогу: TRCSE – пример маркировки на русском языке



Тележка для установки аппарата и 2 баллонов, номер по каталогу: TRCSE – пример маркировки на русском языке

MC METRUM CRYOFLEX		ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ	
Кризонд распылительный многоразовый типа SD-10 для аппаратов криохирургических «Cryo-S»			
MC METRUM CRYOFLEX			
ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Laszczynskiego, POLAND / EU tel: (+48) 22 33 13 750 fax: (+48) 22 33 13 756 E-mail: biuro@metrum.com.pl www.metrum.com.pl		Кризонд распылительный многоразовый для аппаратов криохирургических «Cryo-S»	
		ТИП КРИОЗОНДА	SD-10
		REF	01 0000 1
		CE 2274	2019 SN 16230
		MC METRUM CRYOFLEX ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Laszczynskiego, POLAND tel: (+48) 22 33 13 750 biuro@metrum.com.pl www.metrum.com.pl	
TRANSPORTИРОВАНИЕ			
CE 2274			

Криозонд распылительный многоразовый типа SD-10 номер по каталогу: 0 1 0000 1 – пример маркировки на упаковке на русском языке

Криозонд контактный многоразовый для аппаратов криохирургических «Cryo-S»			G-60/RF	REF 0 4 6015 1	SN 14007	
G-60/RF						
[SN] 14007 [REF] 0 4 6015 1						
M C METRUM CRYOFLEX ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego tel.: (+48) 22 33 13 750 www.metrum.com.pl						

Криозонд контактный многоразовый типа G-60/RF, номер по каталогу: 0 4 6015 1 – пример маркировки на упаковке на русском языке

M C METRUM CRYOFLEX ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, POLAND, tel: (+48) 22 33 13 750 www.metrum.com.pl biuro@metrum.com.pl		Aparat do KRIOCHIRURGII Cryosurgical Device Crio-S Painless	
[SN]		CSEP 430 KO	
TRANSPORT 			 Medical Device IIb class EK-CSEP.A-07.03.2018

Аппарат криохирургический «Cryo-S Painless» – пример маркировочной этикетки на польском языке

M C METRUM CRYOFLEX ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, POLAND, tel: (+48) 22 33 13 750 www.metrum.com.pl biuro@metrum.com.pl		Аппарат криохирургический Crio-S Painless	
[SN]		CSEP 430 KO	
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 			 Медицинское изделие класса IIb EK-CSEP.A-07.03.2018



Metrum Cryoflex

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k.

ul. Zielna 29
05-082

Blizne Łaszczyńskiego

tel.: +48 22 33 13 750

fax: +48 22 33 13 766

biuro@metrum.com.pl

REF

CRYO-S Electric II

Аппарат
для
криохирургии

SN

CSEA 416 KO



2018



5907559 220680

Питание ----- 100-240 V 50/60 Hz

Потребляемая мощность - 150 VA

Класс защиты ----- I

Рабочая среда ----- N₂O / CO₂

Рабочее давление ----- 40-70 bar

Степень защиты IP корпуса --IP 21

CE 2274

UMDNs
18-051



MADE IN POLAND

Медицинское изделие класса IIb согласно с MDD 93/42/EEC

TZ-CSEA-120419-RU

Аппарат криохирургический «Cryo-S Electric II» – пример маркировки основного блока



Metrum Cryoflex

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k.

ul. Zielna 29
05-082

Blizne Łaszczyńskiego

tel.: +48 22 33 13 750

fax: +48 22 33 13 766

biuro@metrum.com.pl

REF

CRYO-S Painless

Аппарат
для
криохирургии

SN

CSEP 430 KO



2018



5907559 220680

Питание ----- 100-240 V 50/60 Hz

Потребляемая мощность - 150 VA

Класс защиты ----- I

Рабочая среда ----- N₂O / CO₂

Рабочее давление ----- 40-70 bar

Степень защиты IP корпуса --IP 21

CE 2274

UMDNs
18-051



MADE IN POLAND

Медицинское изделие класса IIb согласно с MDD 93/42/EEC

TZ-CSEP-030821-RU

Аппарат криохирургический «Cryo-S Painless» – пример маркировки основного блока

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 89 (восемьдесят девять) лист(а/ов)

Директор

ООО «РИВЬЕРА БИОТЕК»

Я.Б. Миркин

