


Фотографические изображения

«Раствор буферный для снижения нагрузки вируса SARS-CoV-2 в образце для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (SARS-CoV2 Extraction Solution cobas e analyzers), бутылка, объем 1000 мл»

Раствор буферный для снижения нагрузки вируса SARS-CoV-2 в образце для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (SARS-CoV2 Extraction Solution cobas e analyzers), бутыл, объем 1000 мл



Раствор буферный для снижения нагрузки вируса SARS-CoV-2 в образце для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (SARS-CoV2 Extraction Solution cobas e analyzers), бутылка, объем 1000 мл

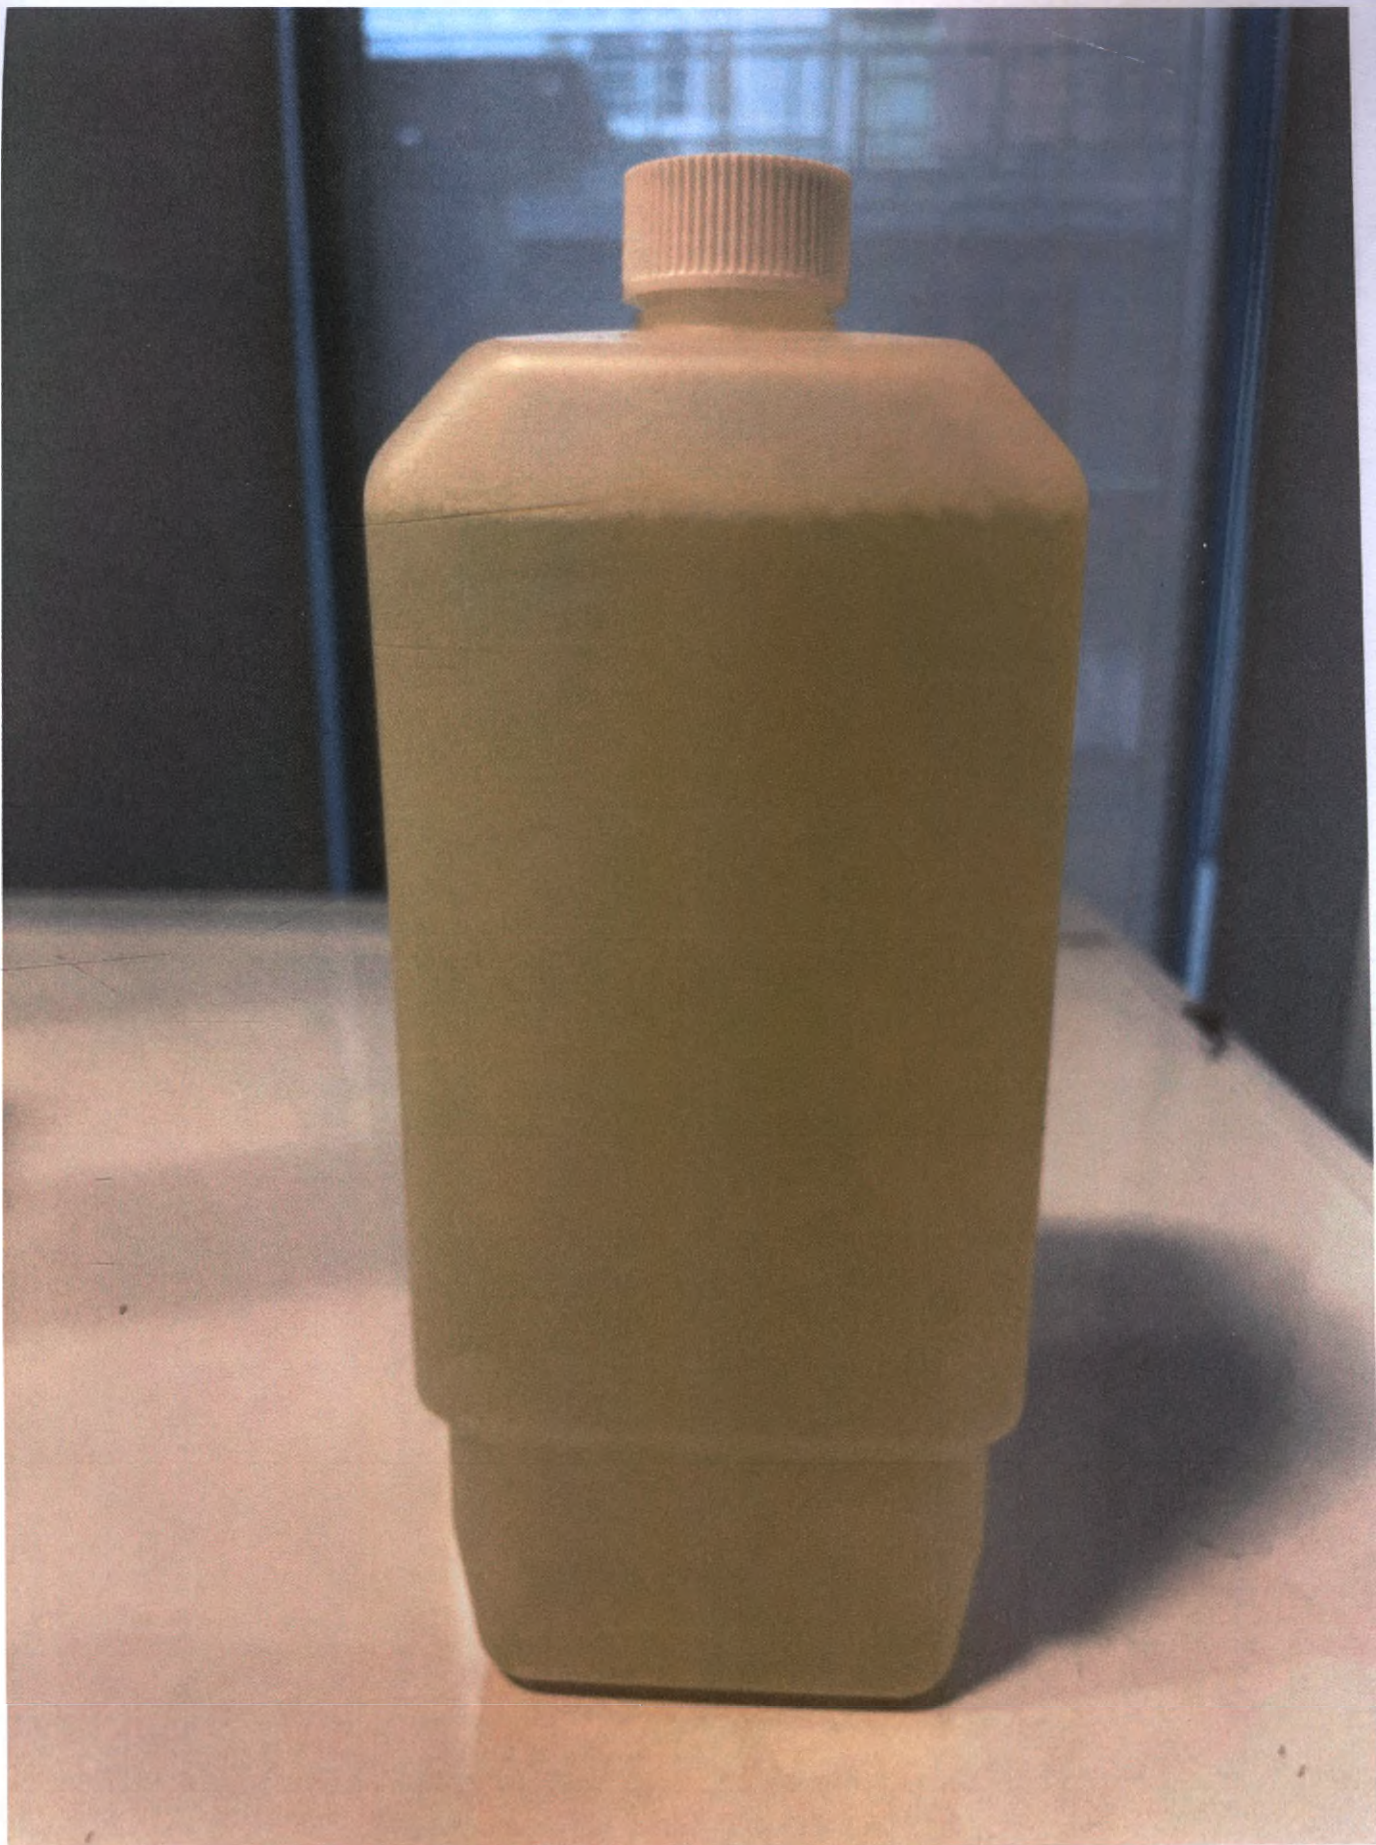

Раствор буферный для снижения нагрузки вируса SARS-CoV-2 в образце для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (SARS-CoV2 Extraction Solution cobas e analyzers), бутылка, объем 1000 мл

Раствор буферный для снижения нагрузки вируса SARS-CoV-2 в образце для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (SARS-CoV2 Extraction Solution cobas e analyzers), бутылка, объем 1000 мл

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Учтите дату см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностика ГмбХ"),
Klenzburger Strasse 114, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Рох Диагностика Рус», 107031, Москва, Трудовая площадь, д.2
Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-54
E-mail: marketing_ru@roche.com
Кат. номер 98270064 100



по доверенности
от 04.02.2021