

Индивидуальный предприниматель
Дубровин Сергей Александрович

121433, г.Москва, ул.Малая Филевская , д. 54 , кв.25
ИНН 773172584083
ОГРНИП 318774600648347

Тел: 8 985 990 89 52
E-mail: ipdubrovin_sa@mail.ru

Система хирургическая для стабилизации и ретракции черепа с принадлежностями

Варианты исполнения:

1. Система хирургическая для стабилизации и ретракции черепа с принадлежностями (МНФ) в составе:

Фото 1. Фиксатор головы

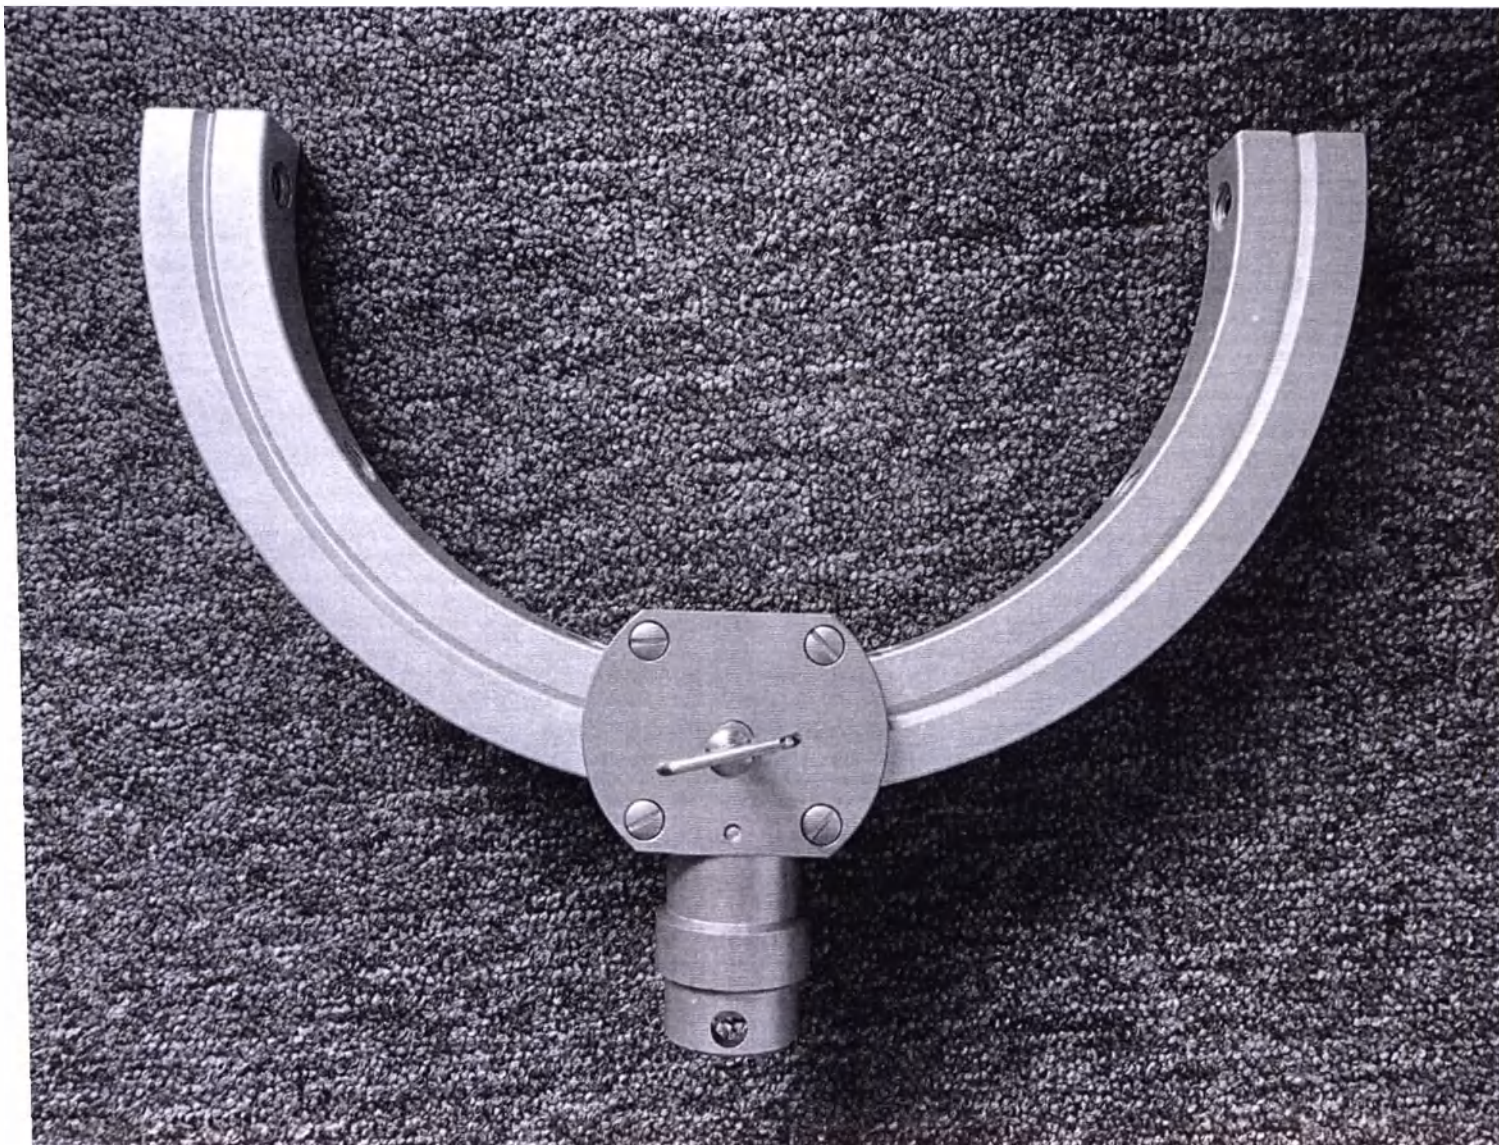


Фото 2. Фиксатор головы (упаковка)



Фото 3. Фиксатор головы (упаковка)



Фото 4. Основная рама/полукруглая рама

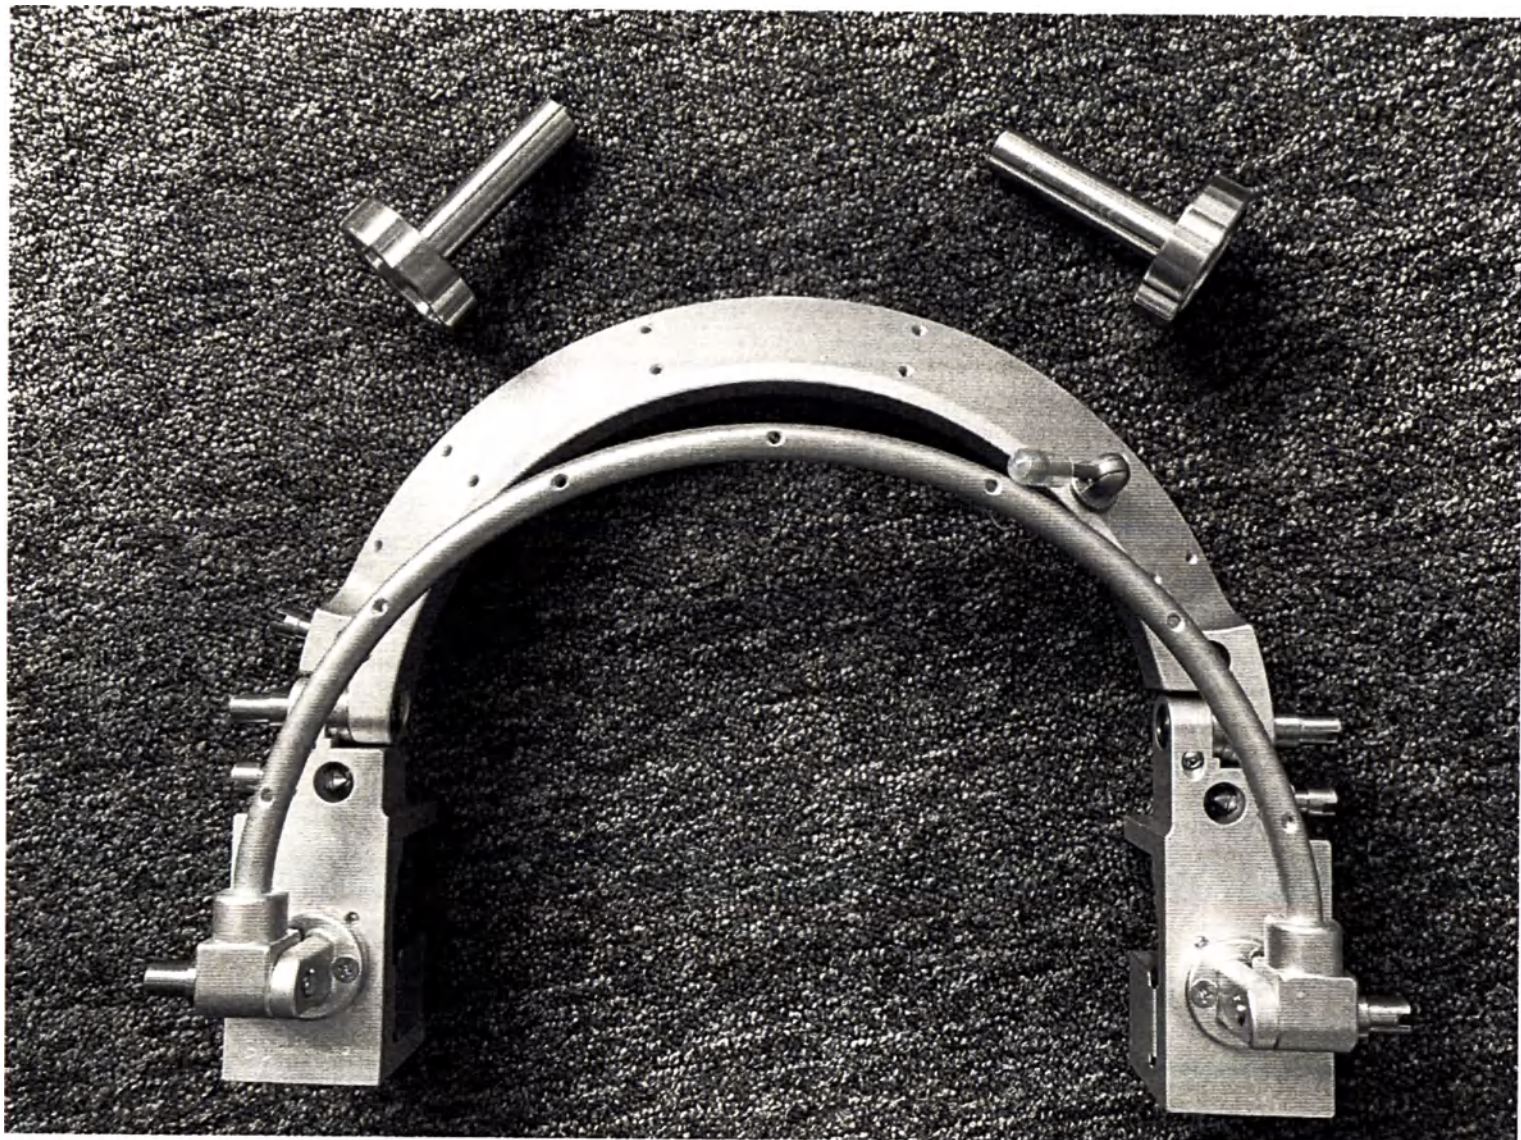


Фото 5. Основная рама/полукруглая рама (упаковка)

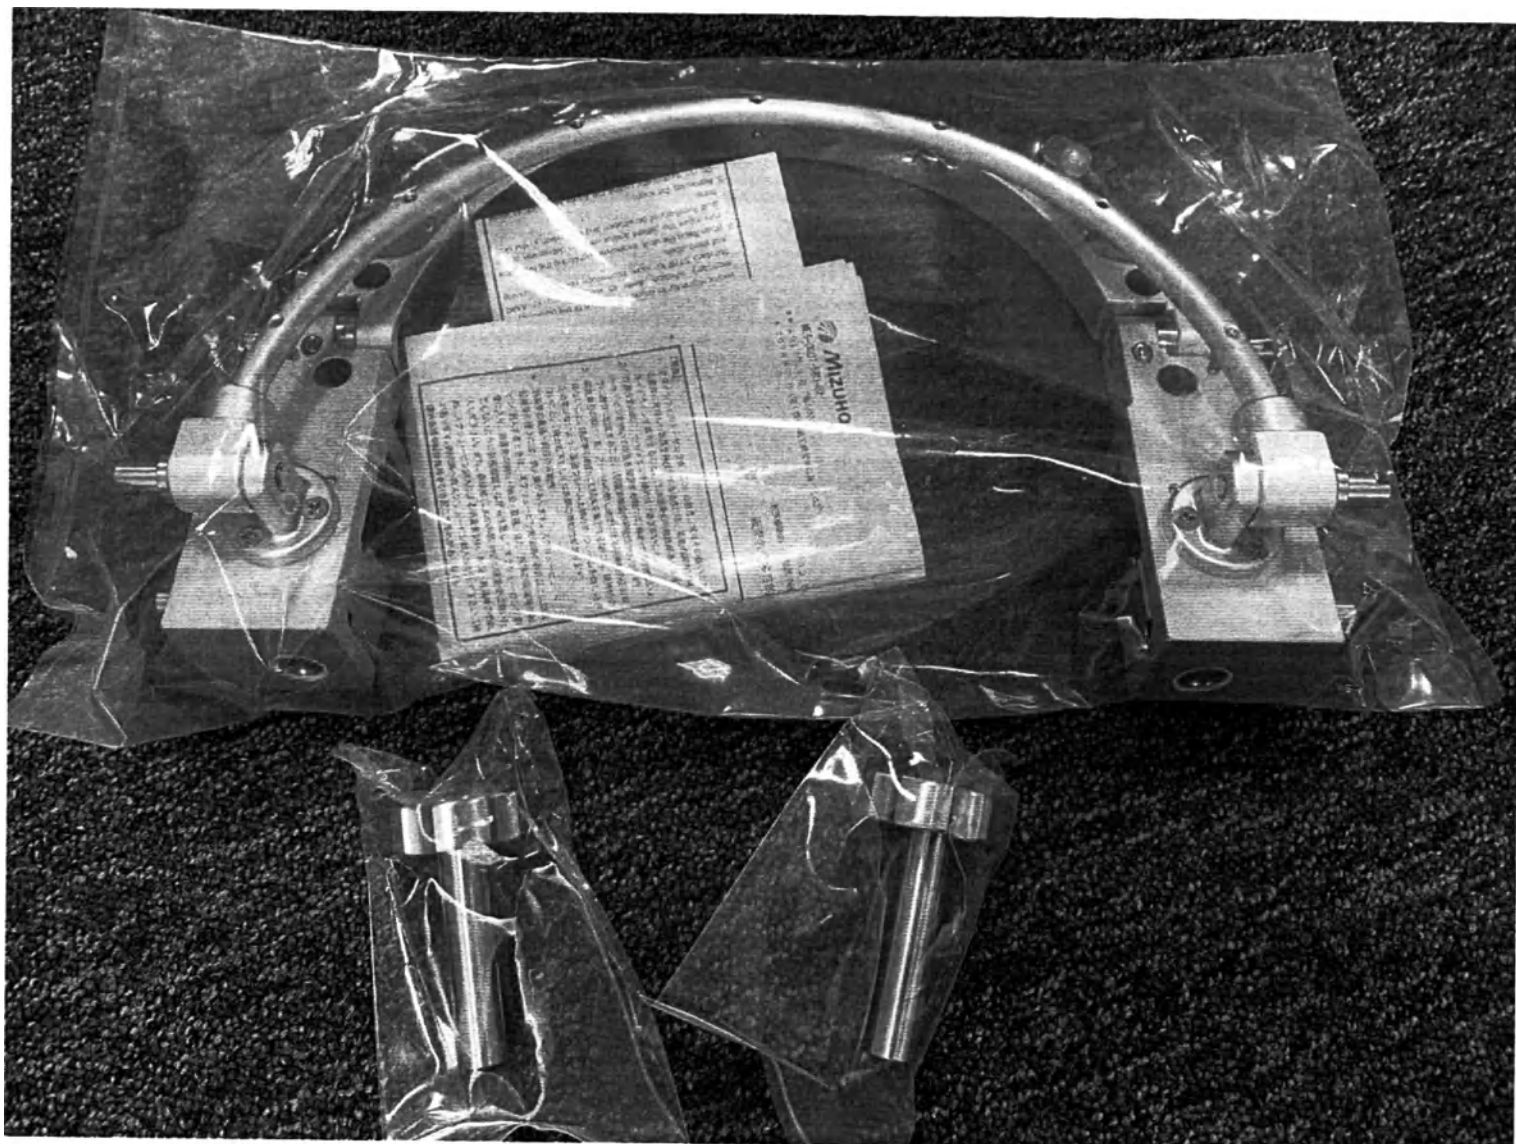


Фото 6. Основная рама/полукруглая рама (упаковка)

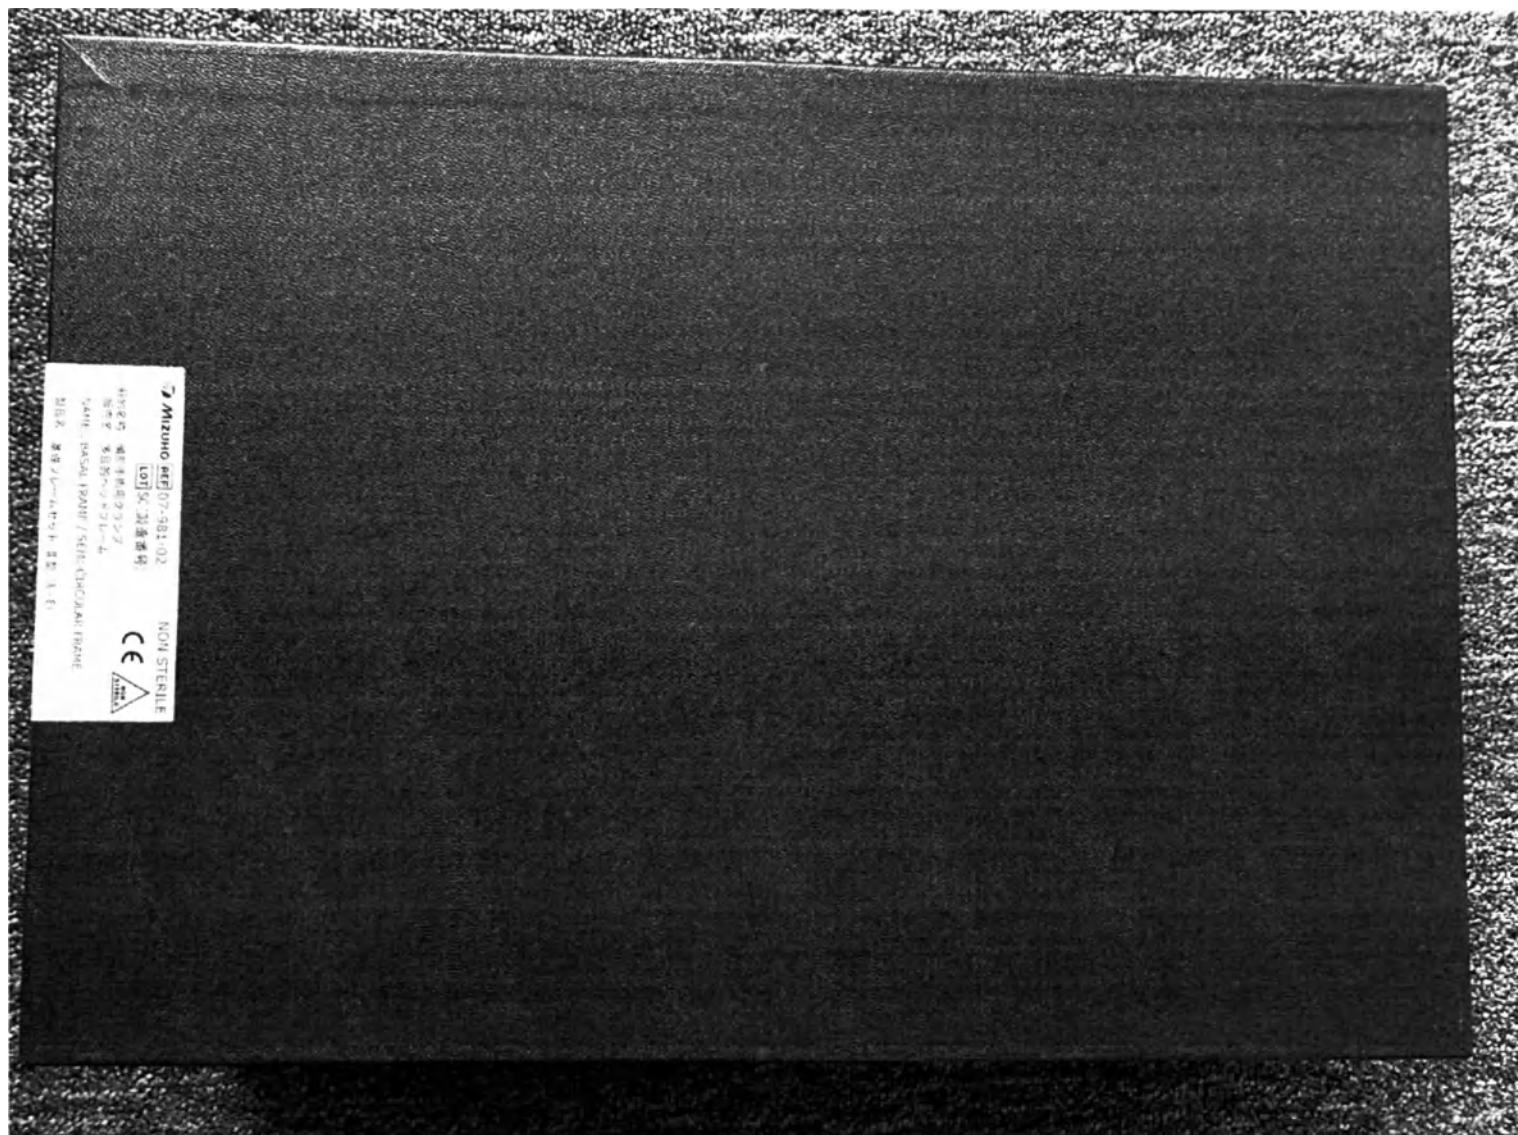


Фото 7. Шип-фиксатор стандартный из нержавеющей стали



Фото 8. Шип-фиксатор стандартный из нержавеющей стали (упаковка)

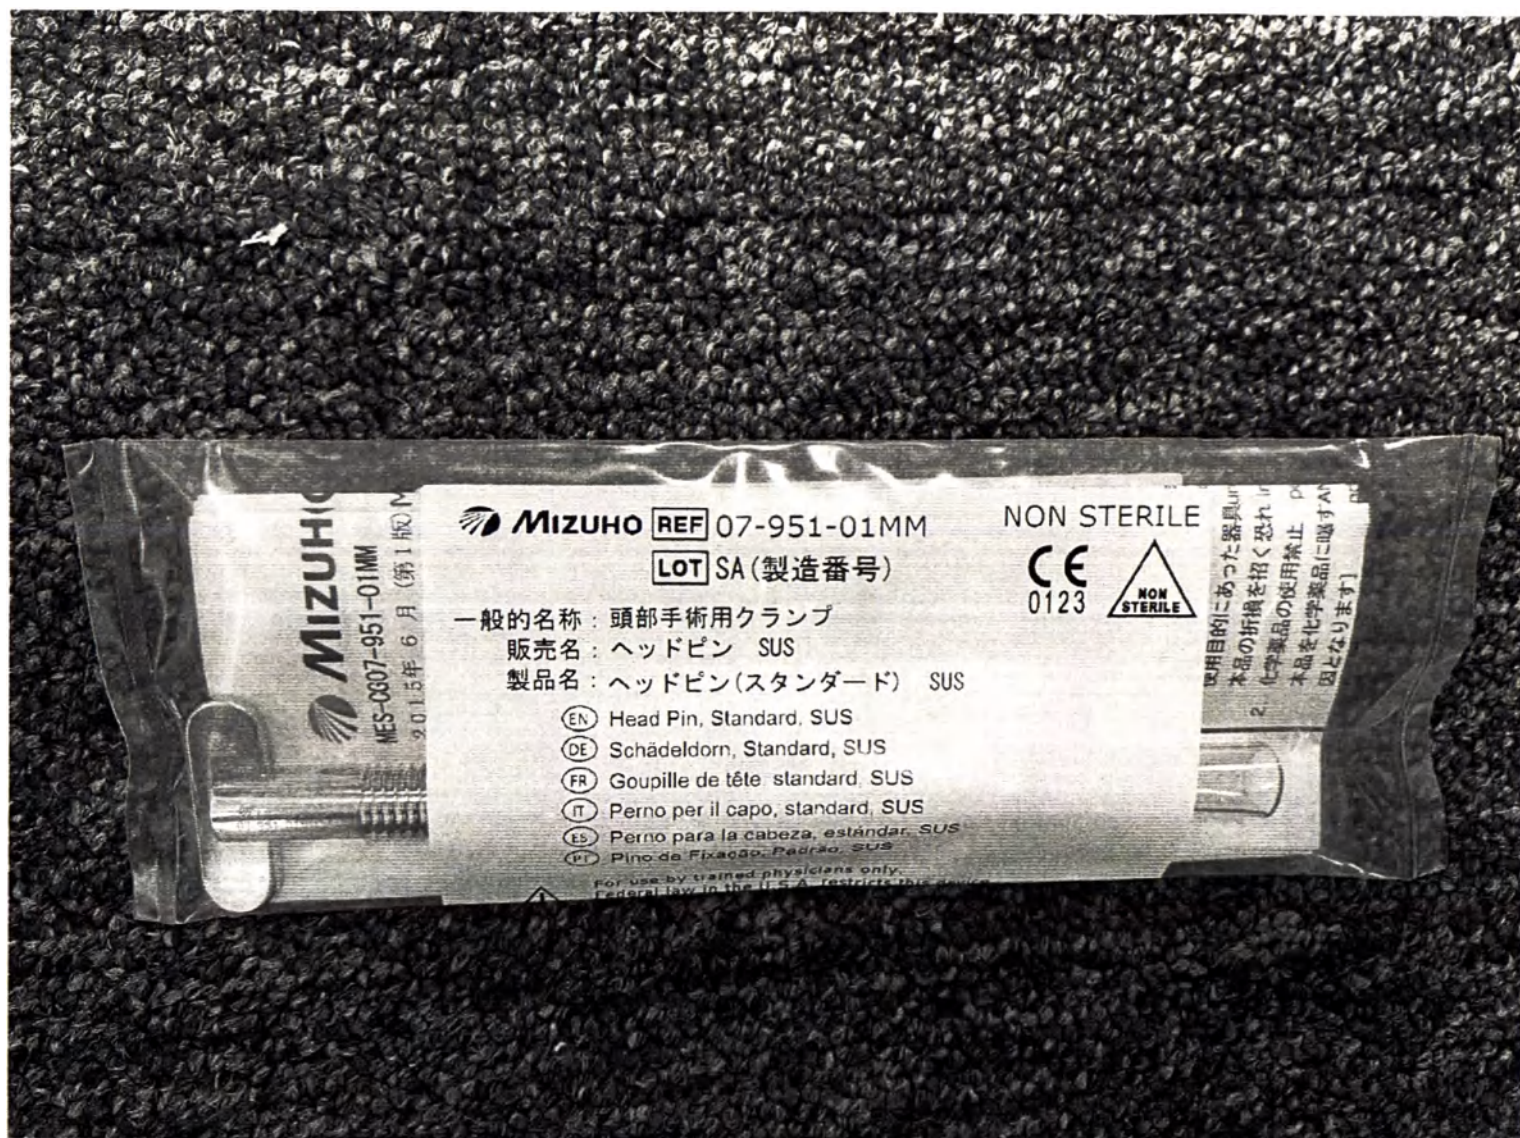


Фото 9. Шип-фиксатор с коротким наконечником для взрослых из нержавеющей стали



Фото 10. Шип-фиксатор с коротким наконечником для взрослых из нержавеющей стали (упаковка)

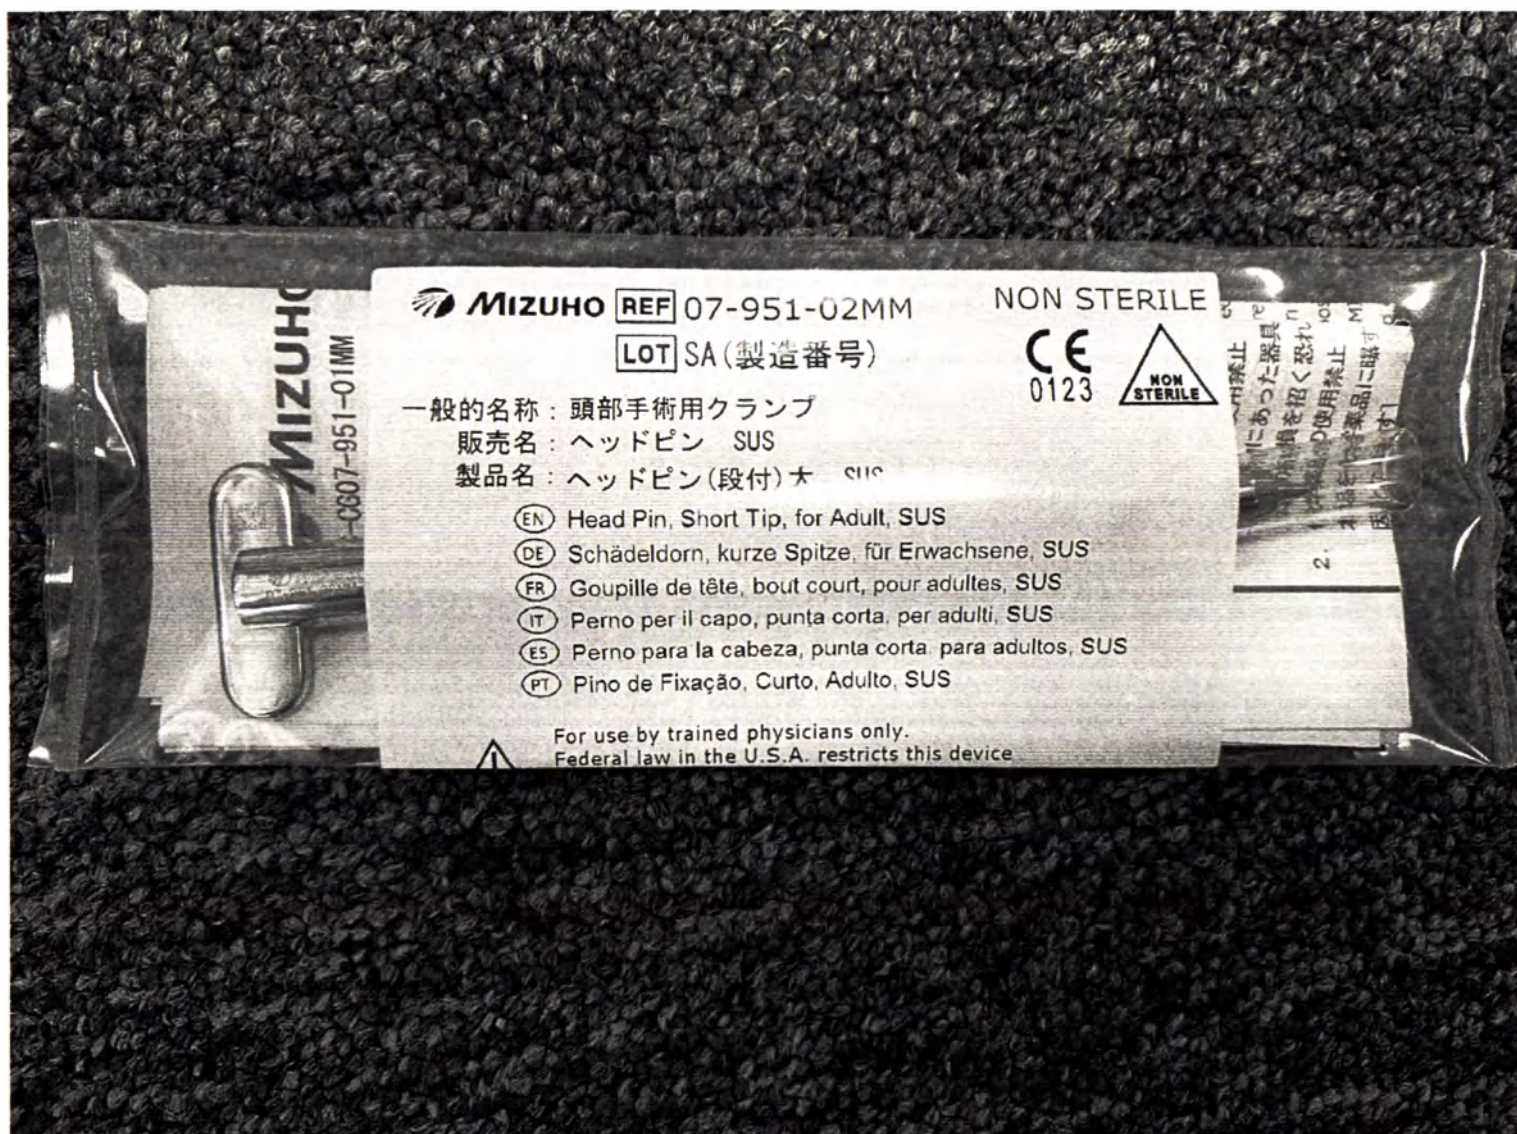


Фото 11. Шип-фиксатор с коротким наконечником для детей из нержавеющей стали



Фото 12. Шип-фиксатор с коротким наконечником для детей из нержавеющей стали (упаковка)



●
Фото 13. Крепление к столу

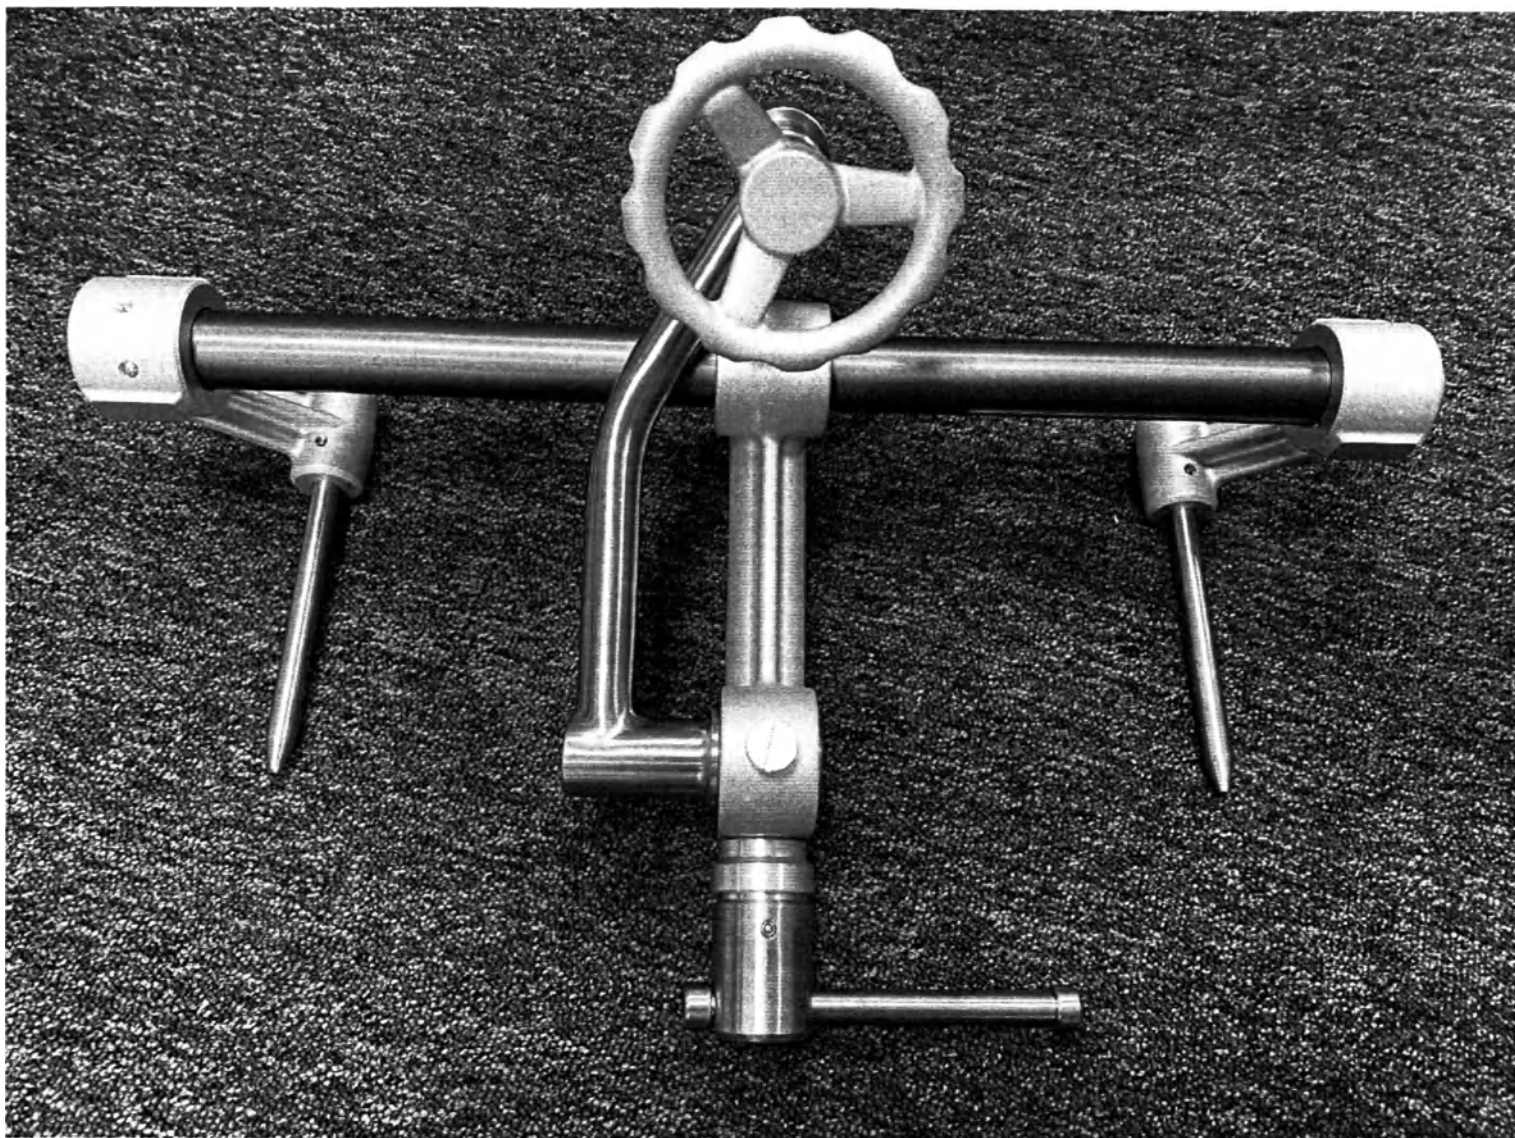


Фото 14. Крепление к столу (упаковка)



Фото 15. Крепление к столу для 2080

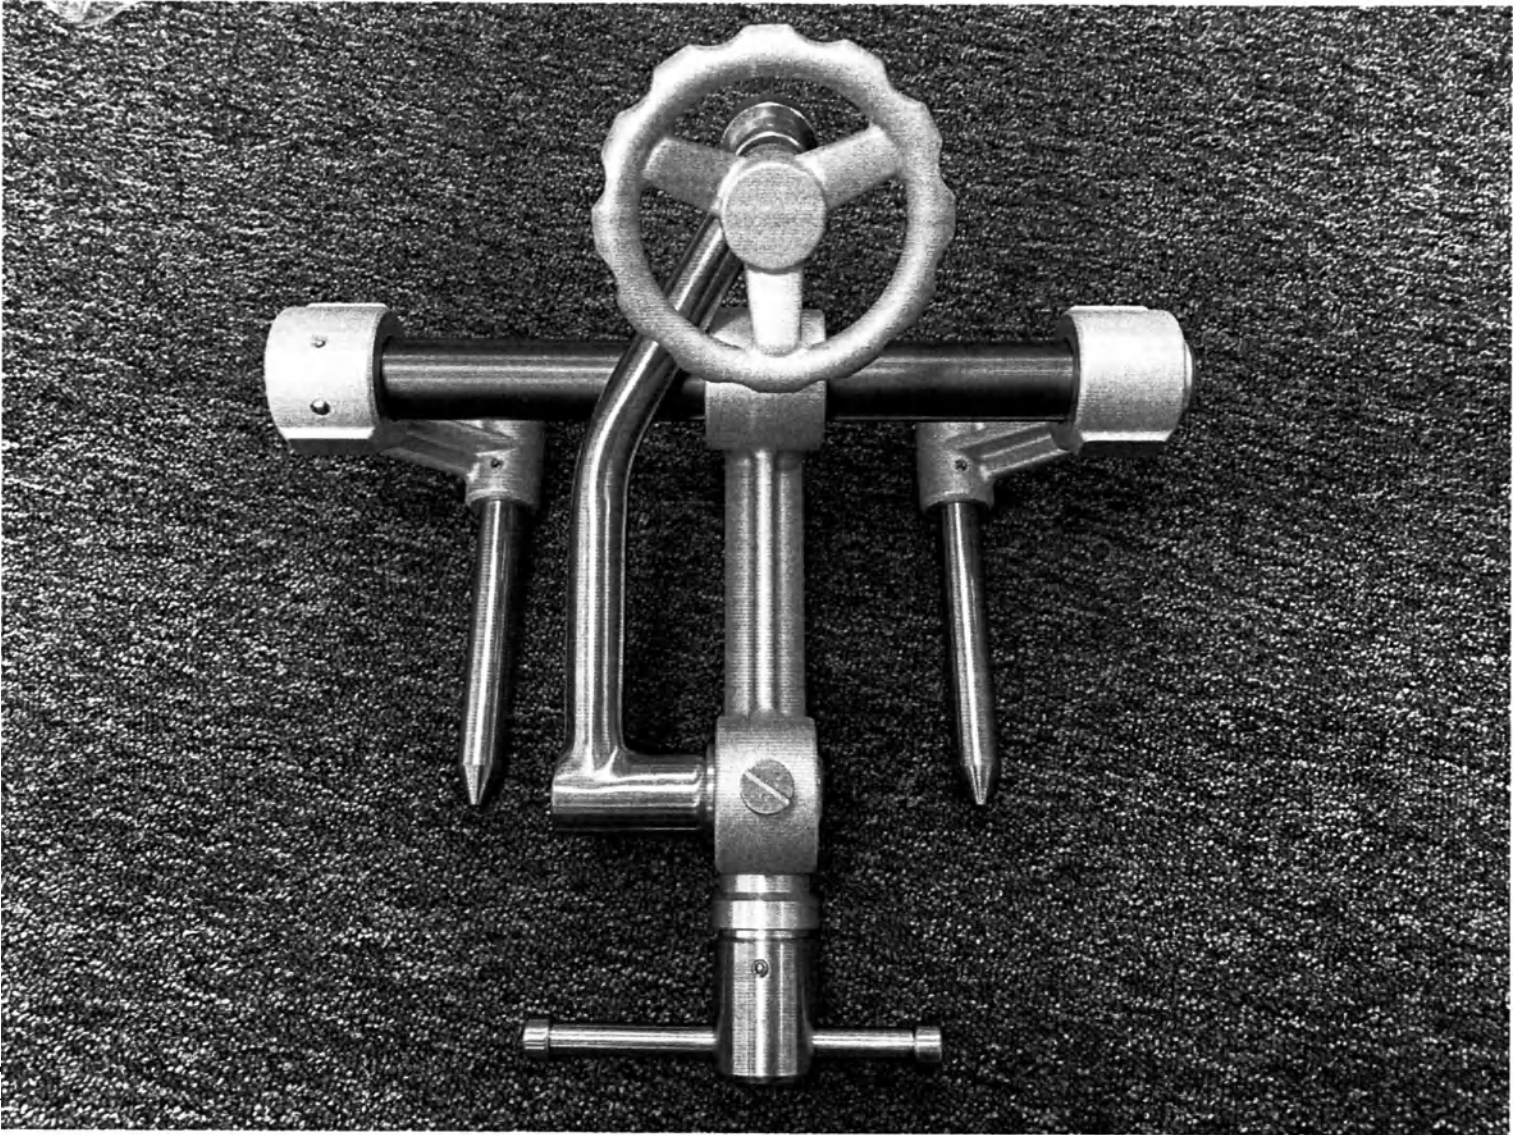


Фото 16. Крепление к столу для 2080 (упаковка)



Фото 17. Крепление к столу для 3080

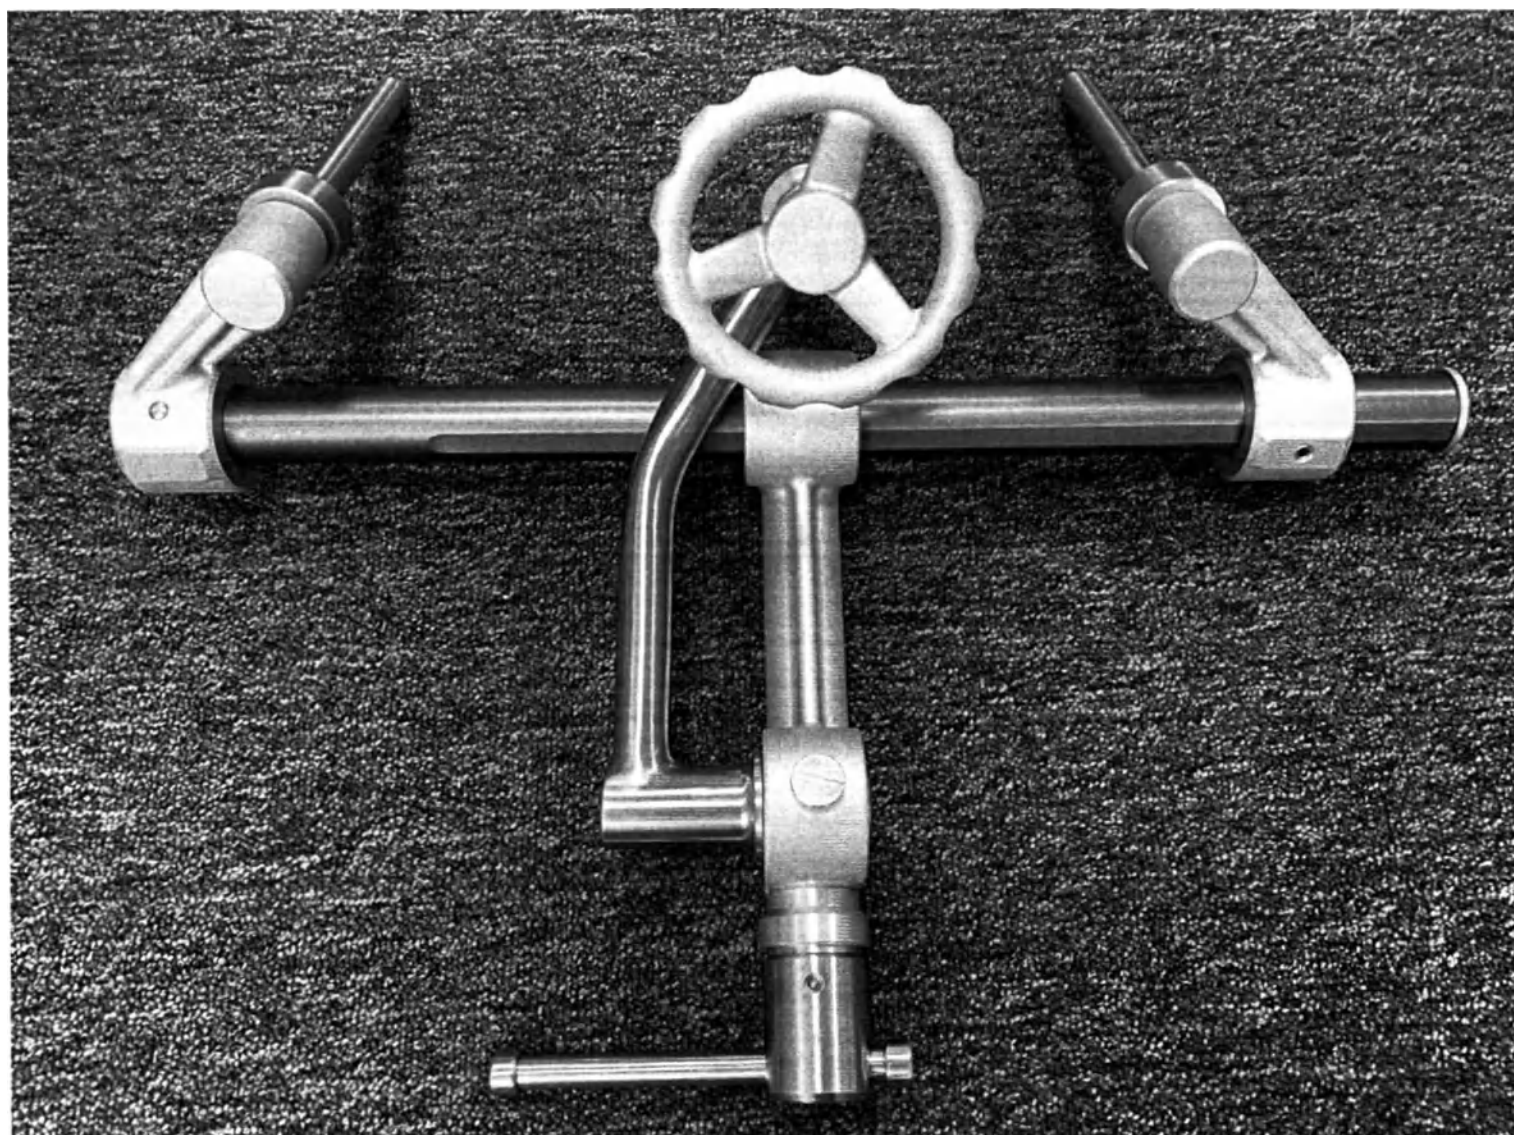


Фото 18. Крепление к столу для 3080 (упаковка)



II. Система хирургическая для стабилизации и ретракции черепа с принадлежностями (SF) в составе:

Фото 1. Фиксатор Smart Fix C

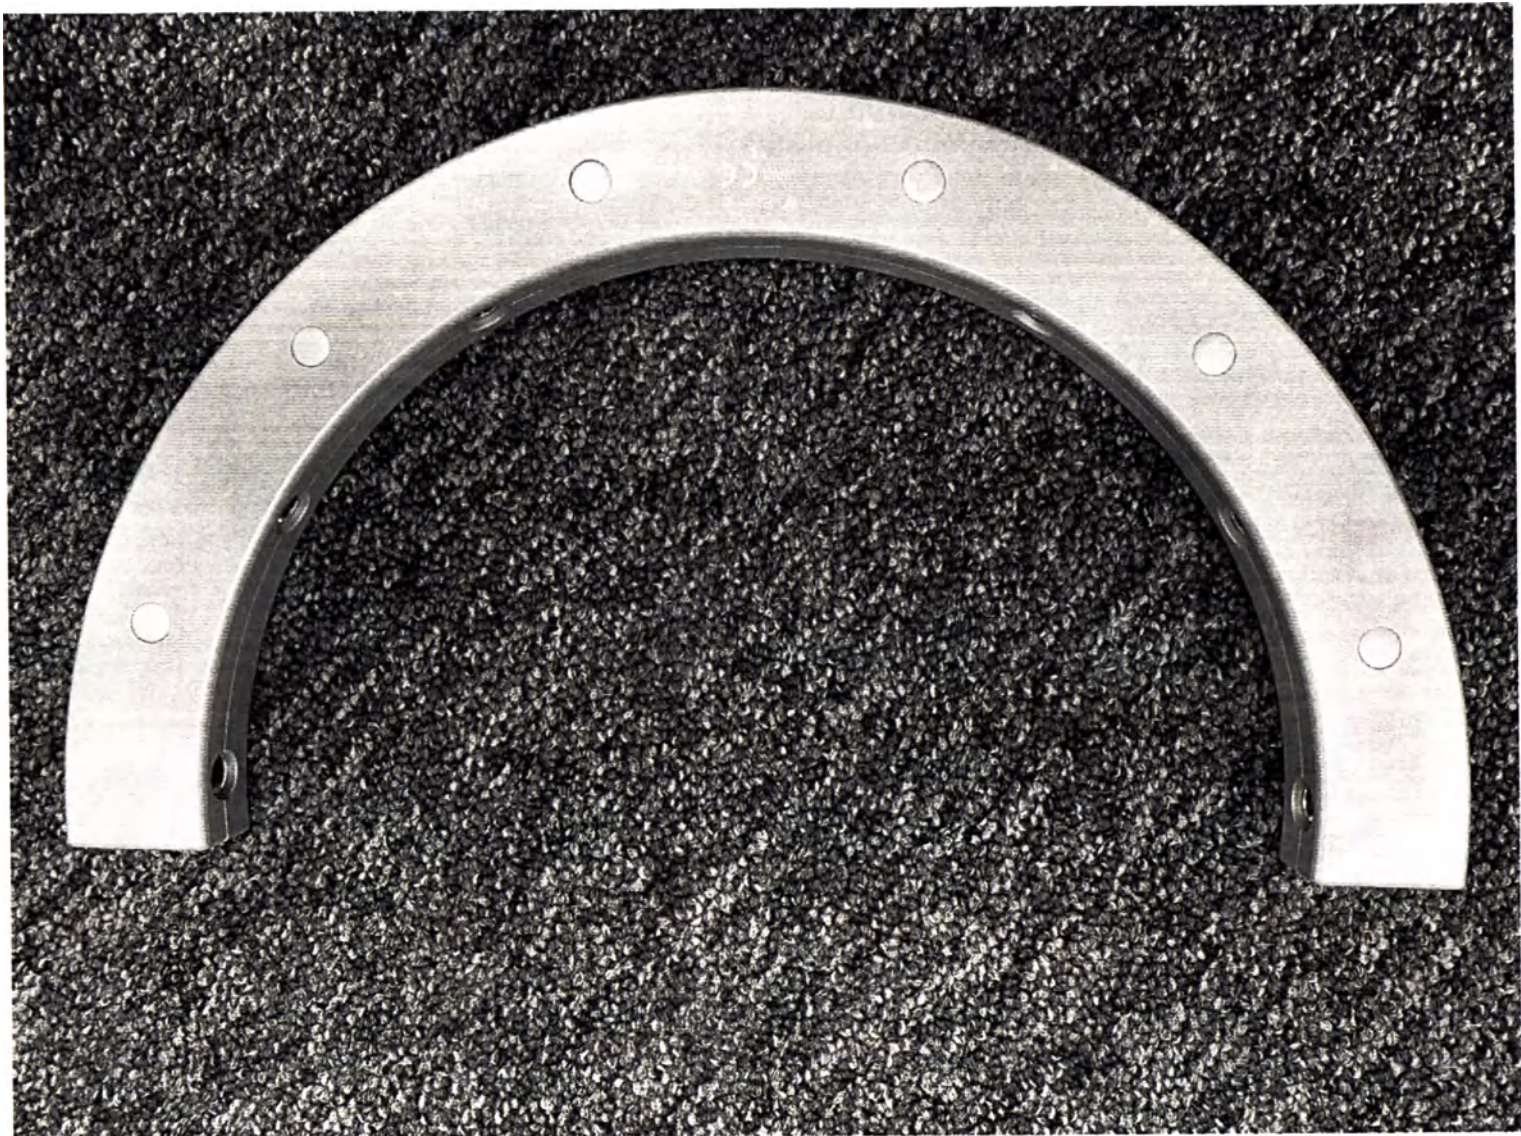


Фото 2. Фиксатор Smart Fix C (упаковка)



Фото 3. Фиксатор Smart Fix C (упаковка)

if the product is exposed to the bleach or antiseptic solution



MIZUHO REF 07-951-11

NON STERILE

LOT RE-613 (製造番号)



一般の名称：頭部手術用クランプ

販売名：スマートフィックスヘッドホルダー

NAME：Smart Fix C Holder

製品名：スマートフィックス (SF)



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.




MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌

一般
医療機器

1 個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329135534(10)RE-613

製造販売業者：ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号：13B1X00306G01408

MADE IN JAPAN

Applicability of the disinfection

Фото 4. Основная рама / Полукруглая рама



Фото 5. Основная рама / Полукруглая рама (упаковка)

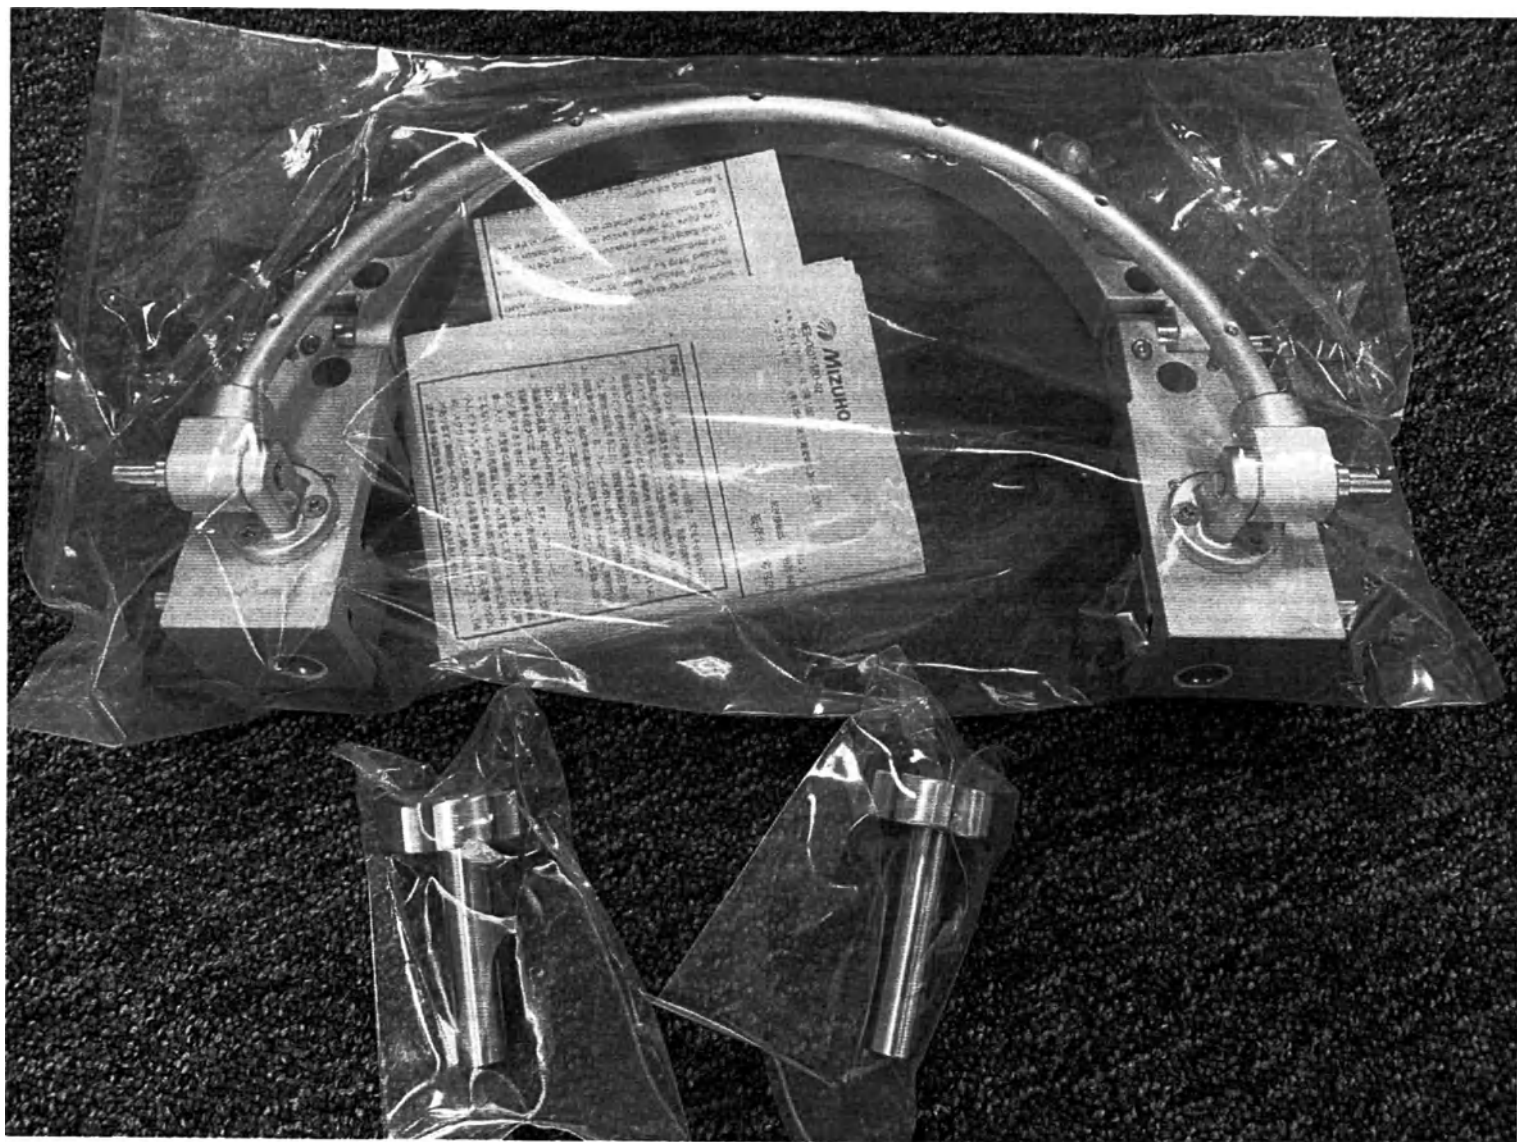


Фото 6. Основная рама / Полукруглая рама (упаковка)

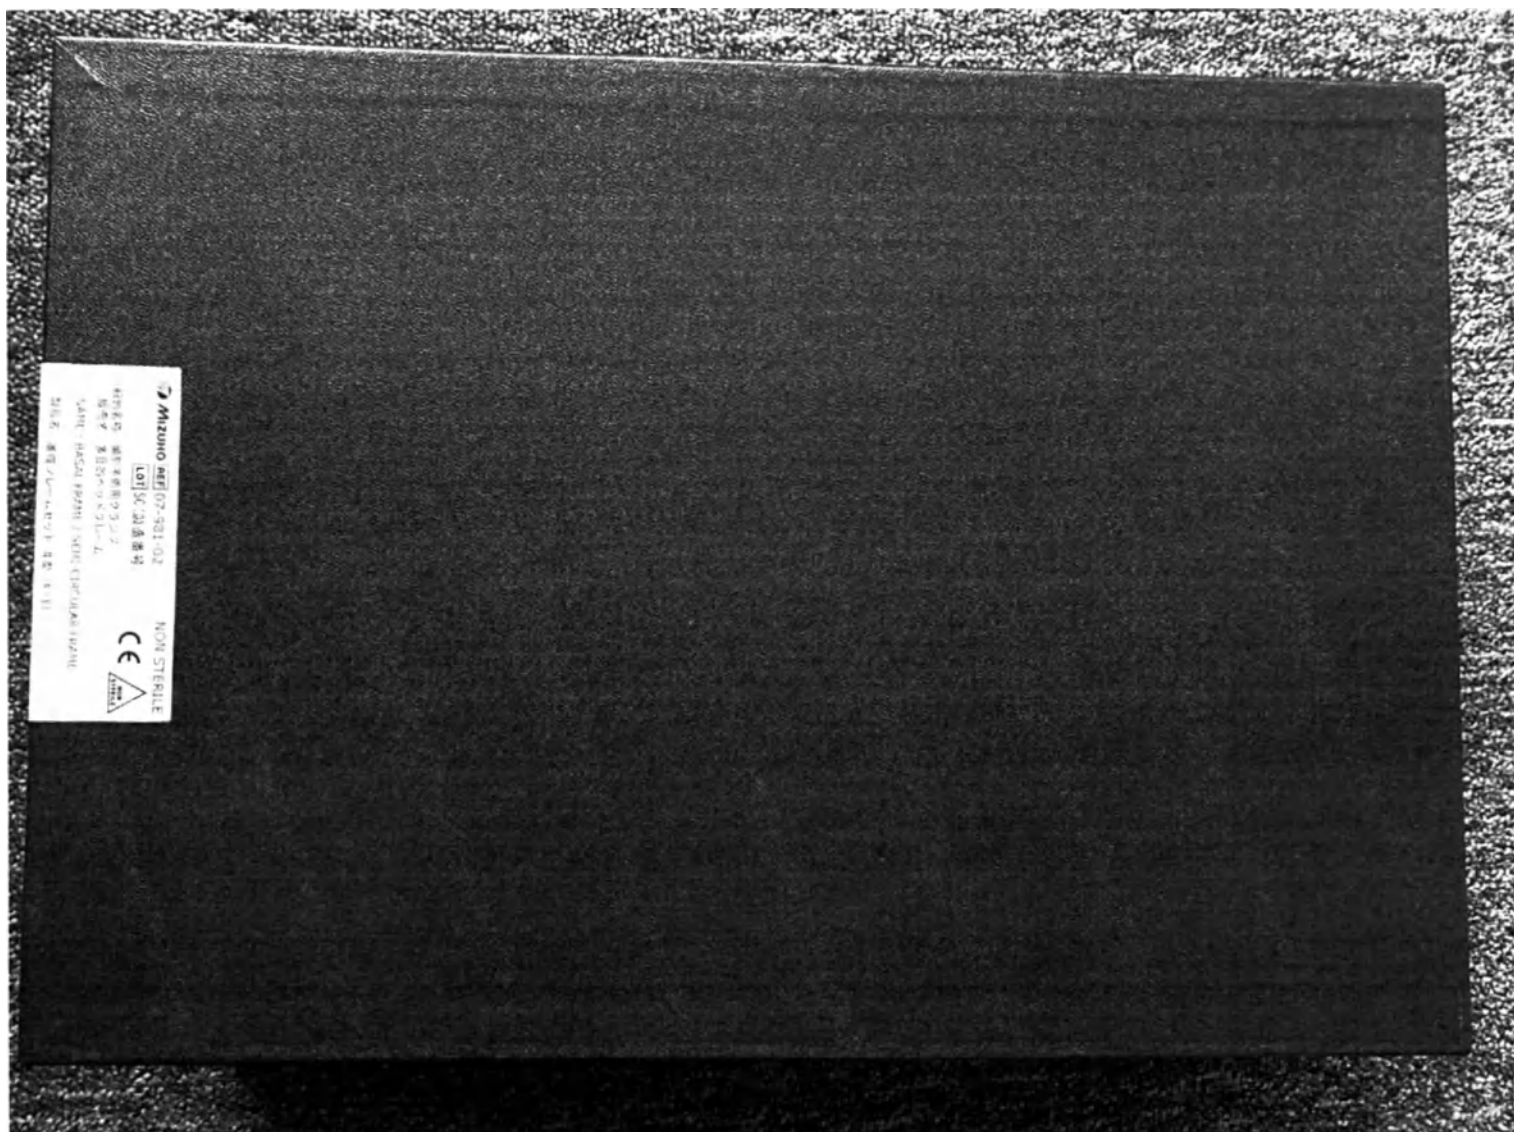


Фото 7. Соединительная коробка Smart Fix (включает 2 фиксирующих винта)

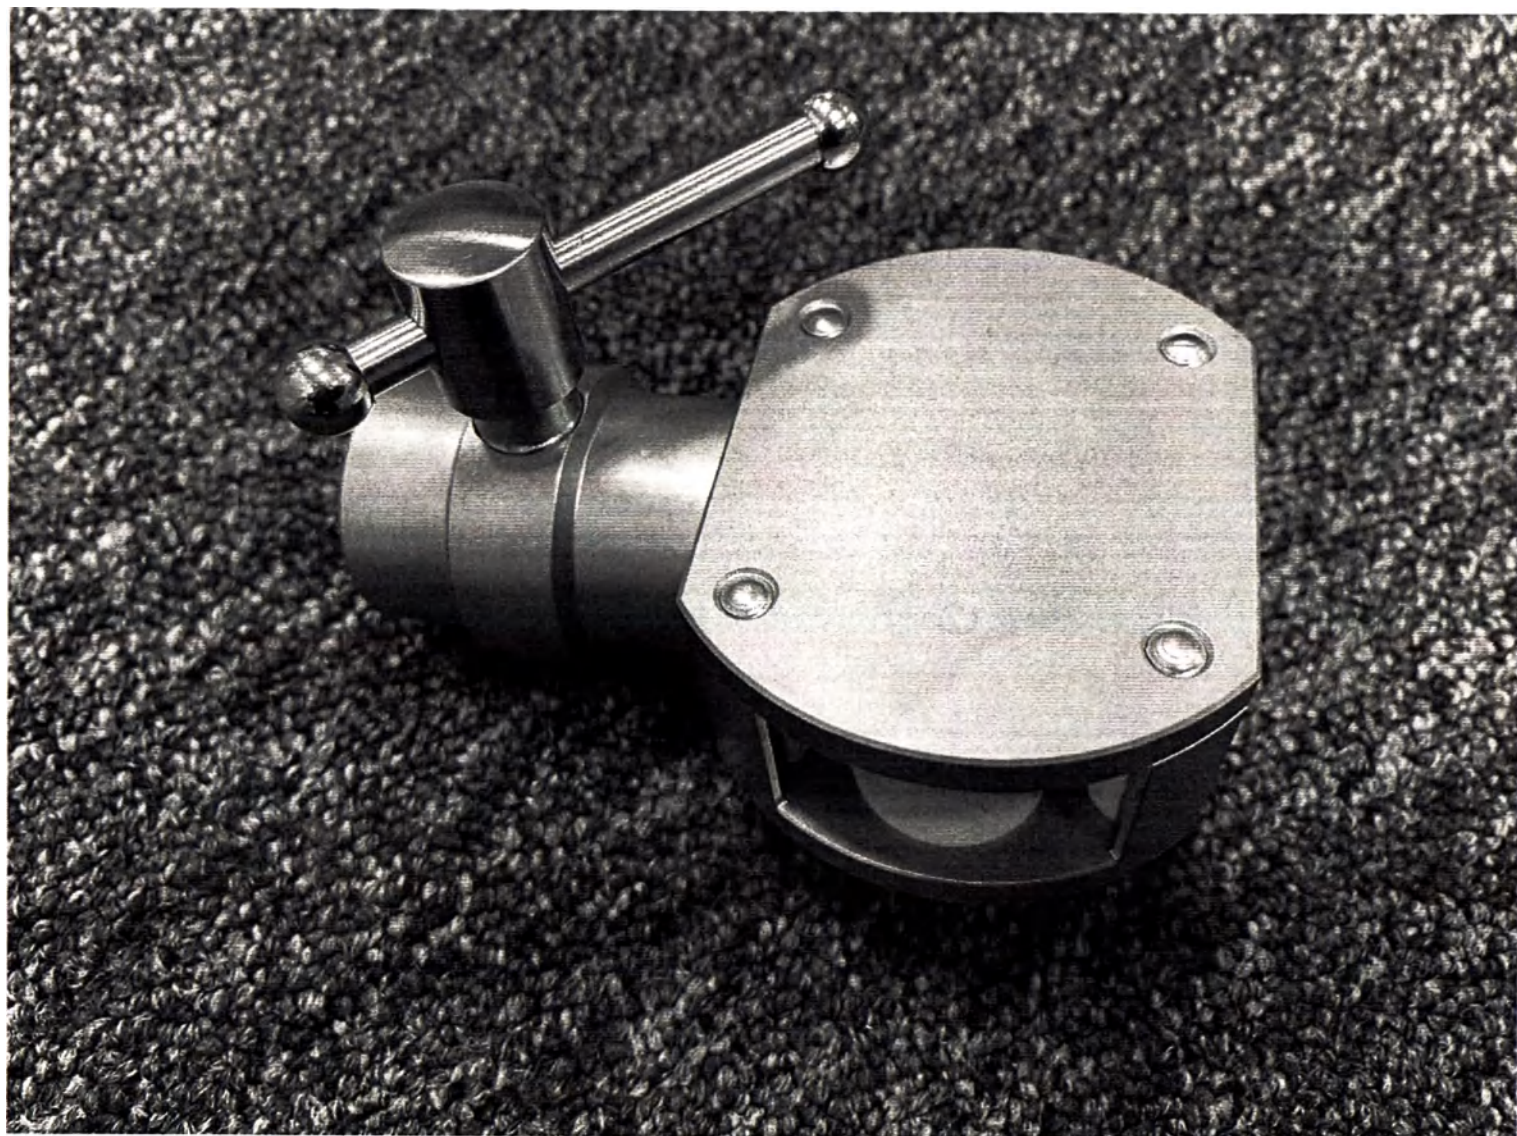


Фото 8. Соединительная коробка Smart Fix (включает 2 фиксирующих винта) (упаковка)



Фото 7. Соединительная коробка Smart Fix (включает 2 фиксирующих винта) (упаковка)

 **MIZUHO** REF 07-951-12

LOT RK (製造番号)

NON STERILE



一般の名称：頭部手術用クランプ

販売名：スマートフィックスヘッドホルダー

NAME : Smart Fix Box Joint (including 2 fixing screws)

製品名：ジョイントボックス (固定ジ2本付)



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌
一般
医療機器
1個包



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329135541(10)RK

製造販売業者：ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号：13B1X00306G01408
MADE IN JAPAN

Фото 10. Стопорная втулка Smart Fix



Фото 11. Стопорная втулка Smart Fix (упаковка)



Фото 12. Шип-фиксатор Smart Fix стандартный



Фото 13. Шип-фиксатор Smart Fix стандартный (упаковка)

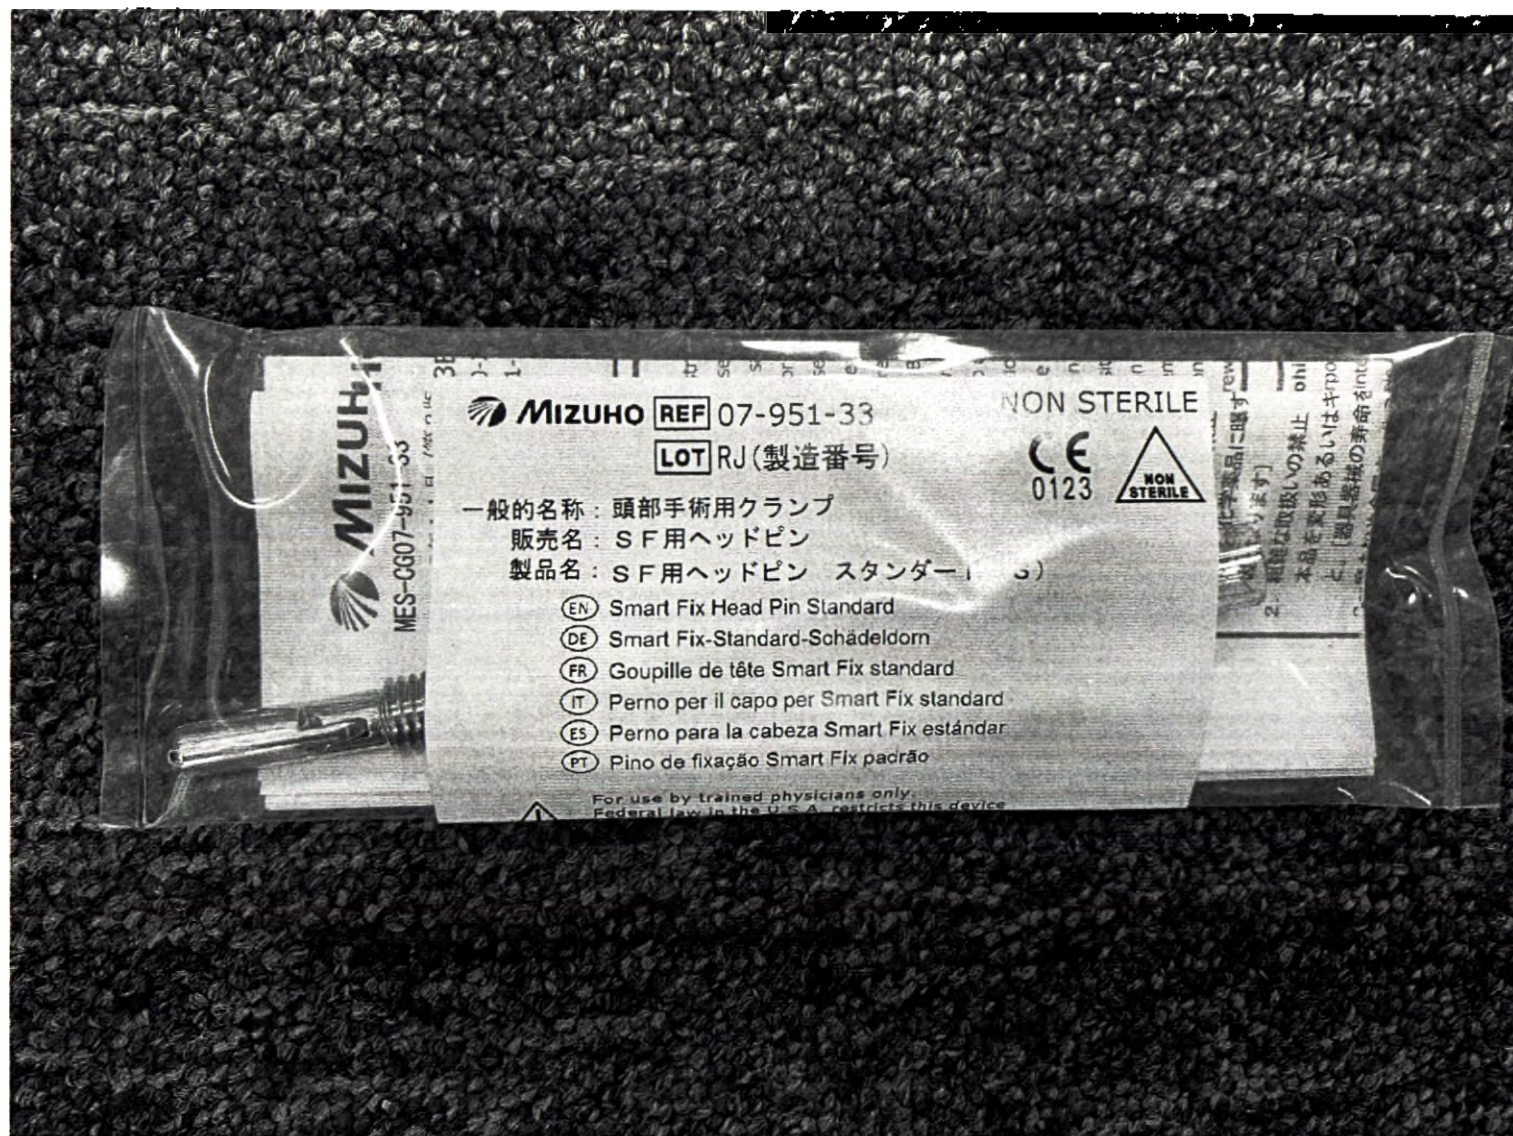


Фото 14 Шип-фиксатор Smart Fix длинный

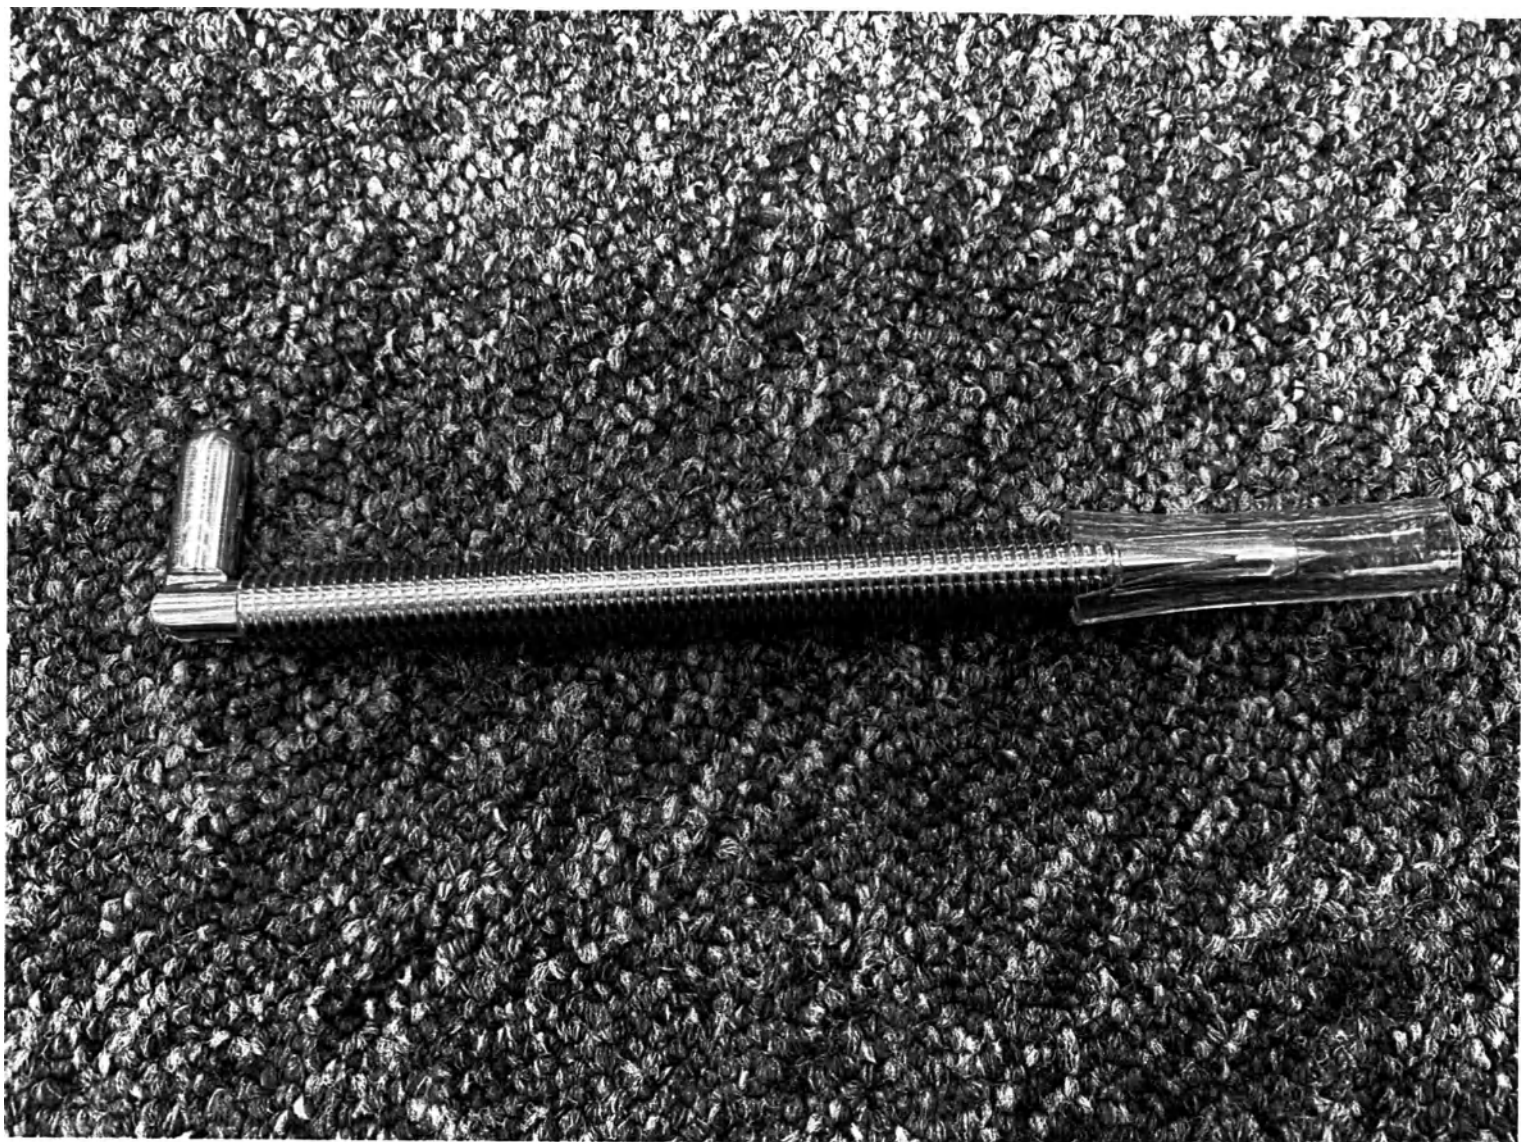


Фото 15 Шип-фиксатор Smart Fix длинный (упаковка)

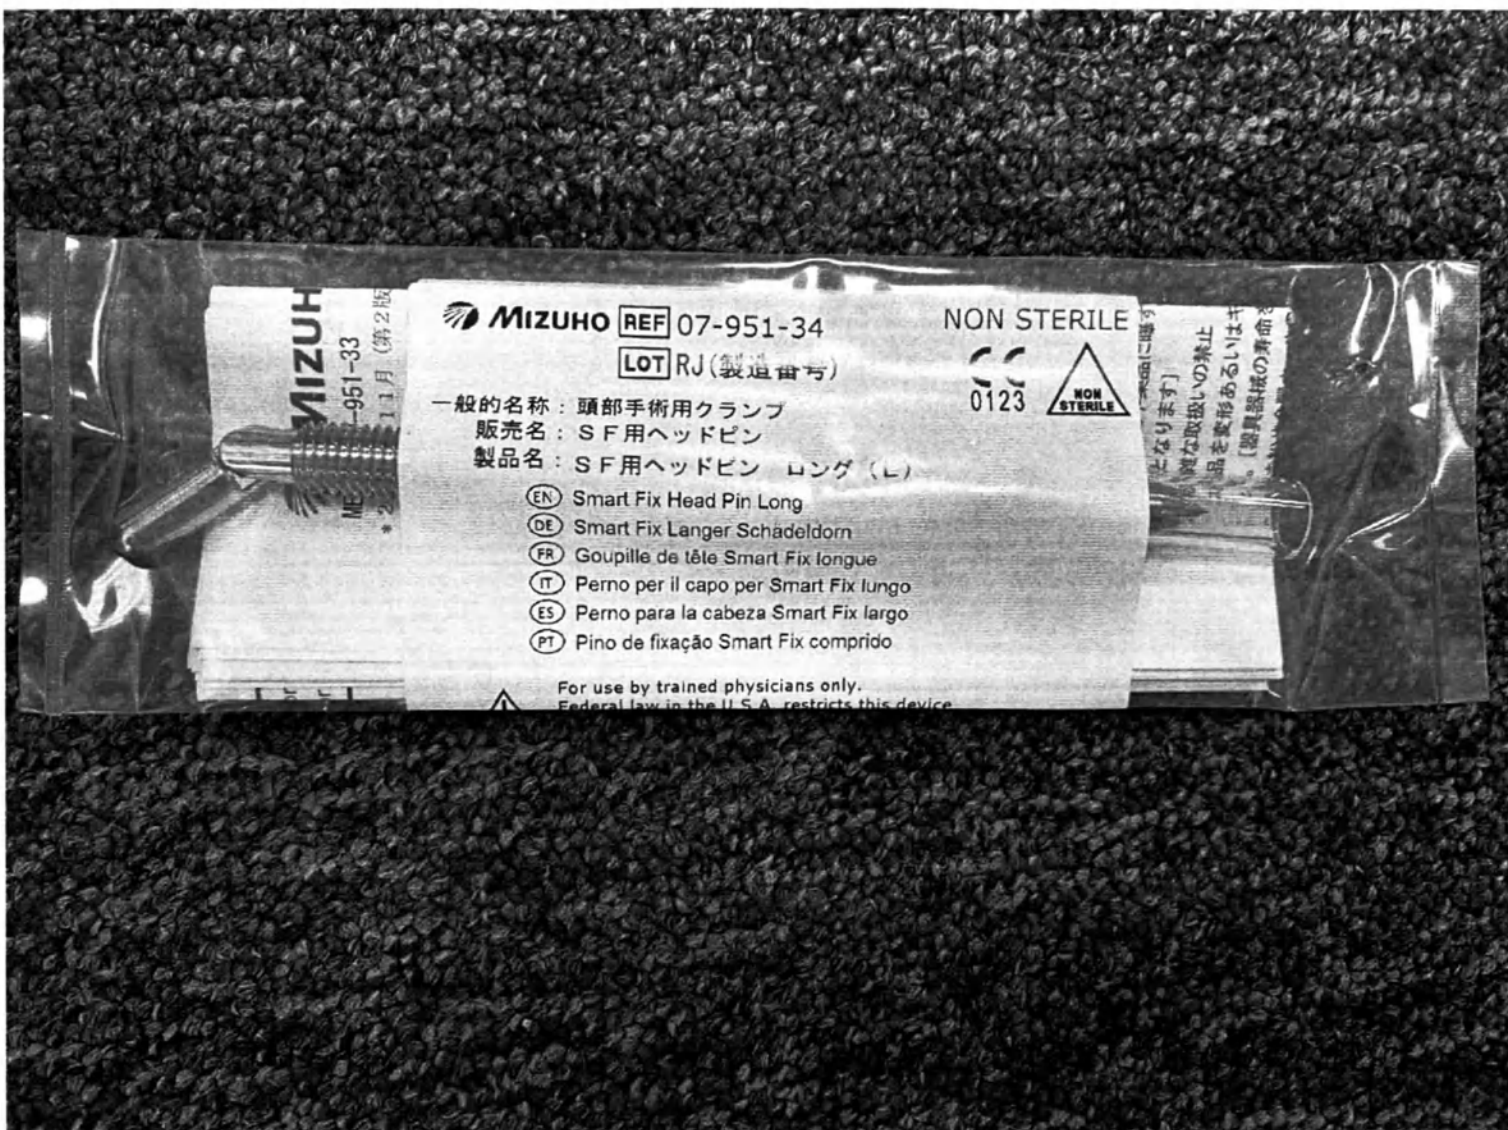


Фото 16 Крепление к столу

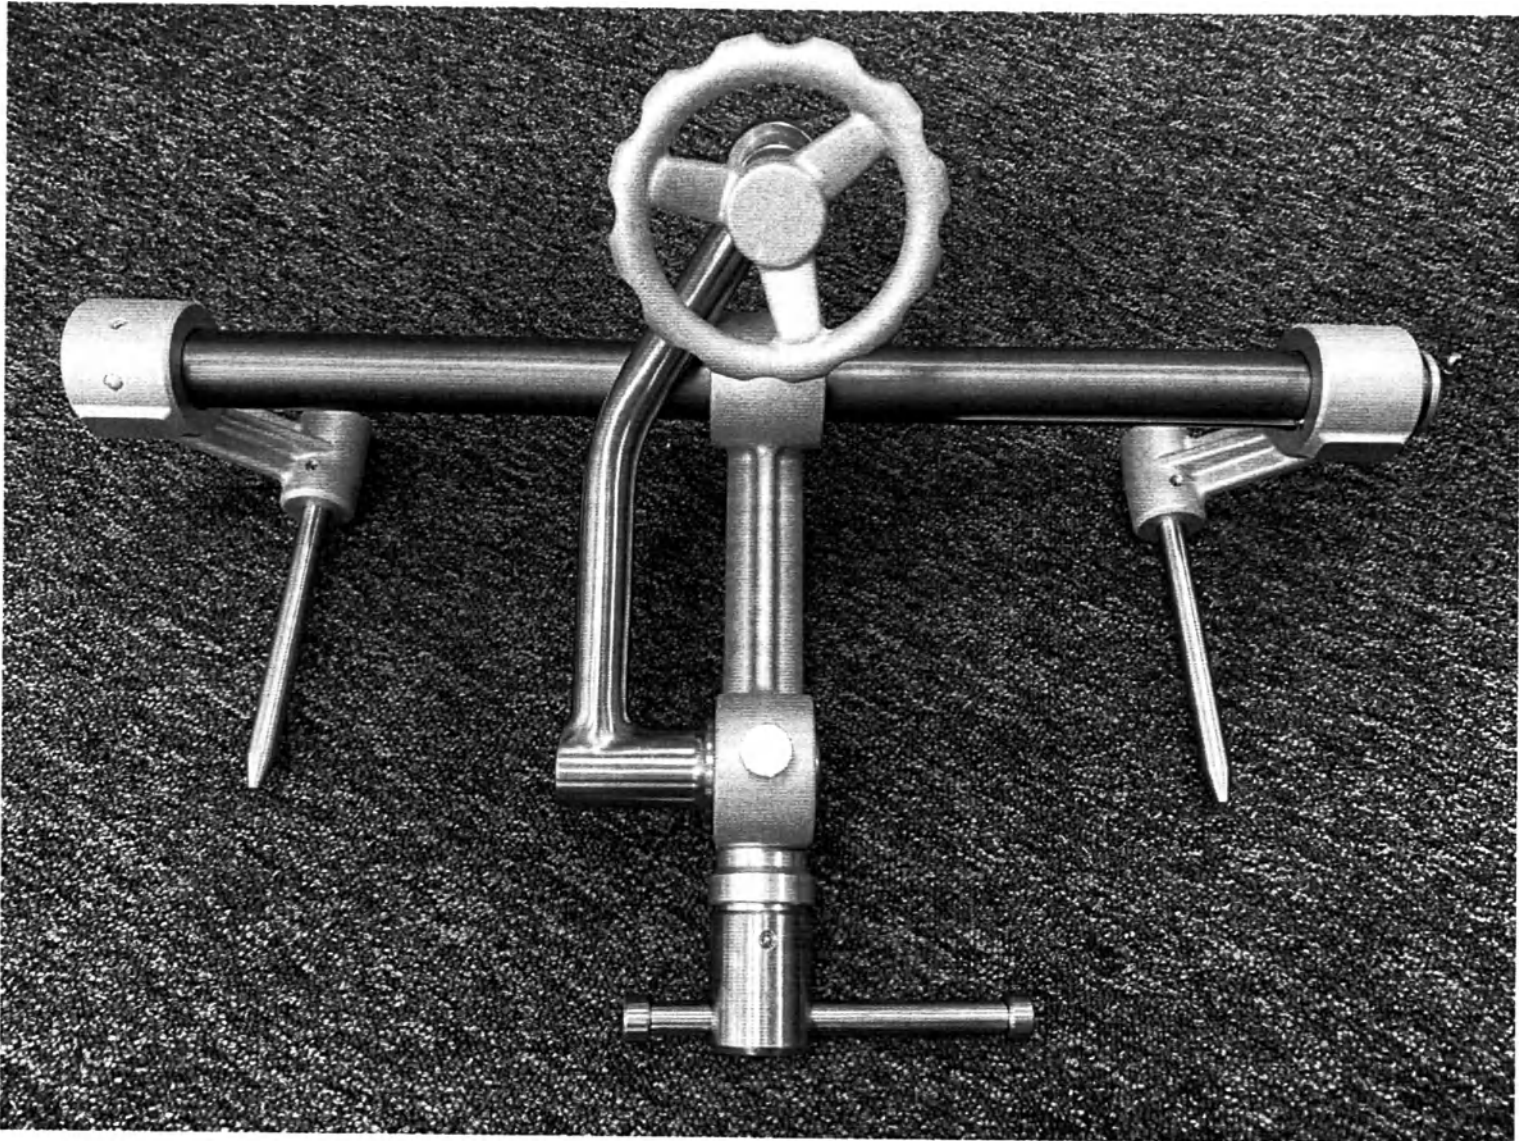


Фото 17 Крепление к столу (упаковка)



Фото 18 Крепление к столу для 2080



Фото 19 Крепление к столу для 2080 (упаковка)

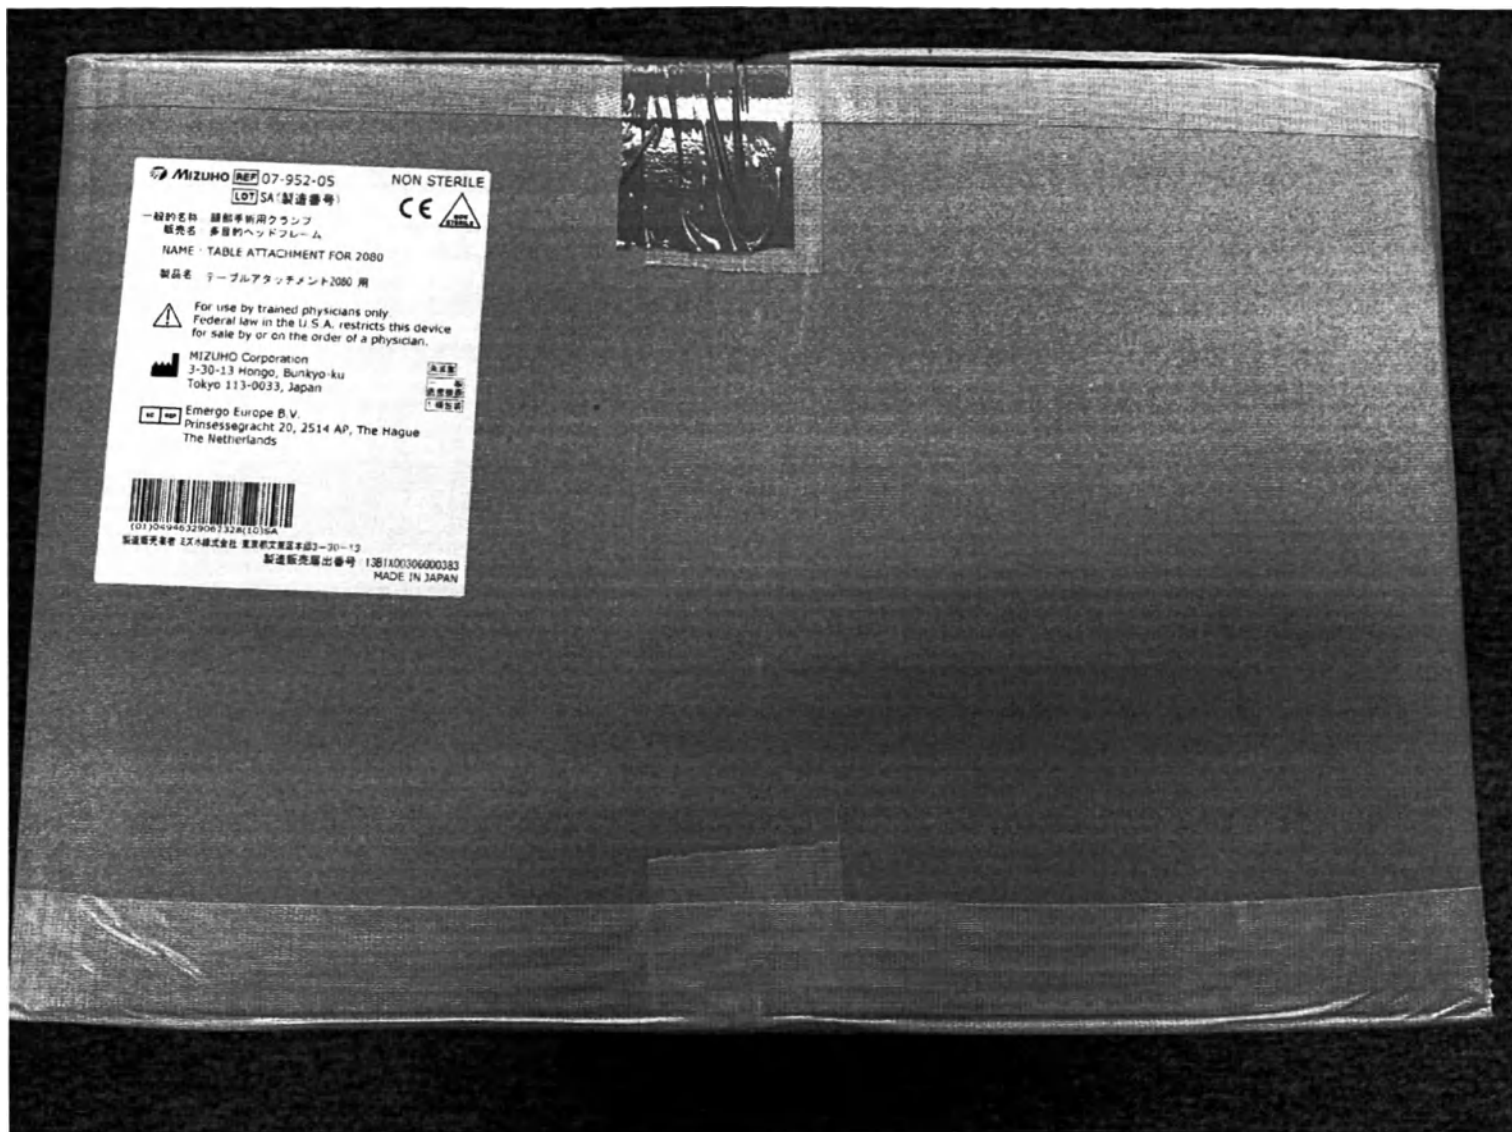


Фото 20 Крепление к столу для 3080

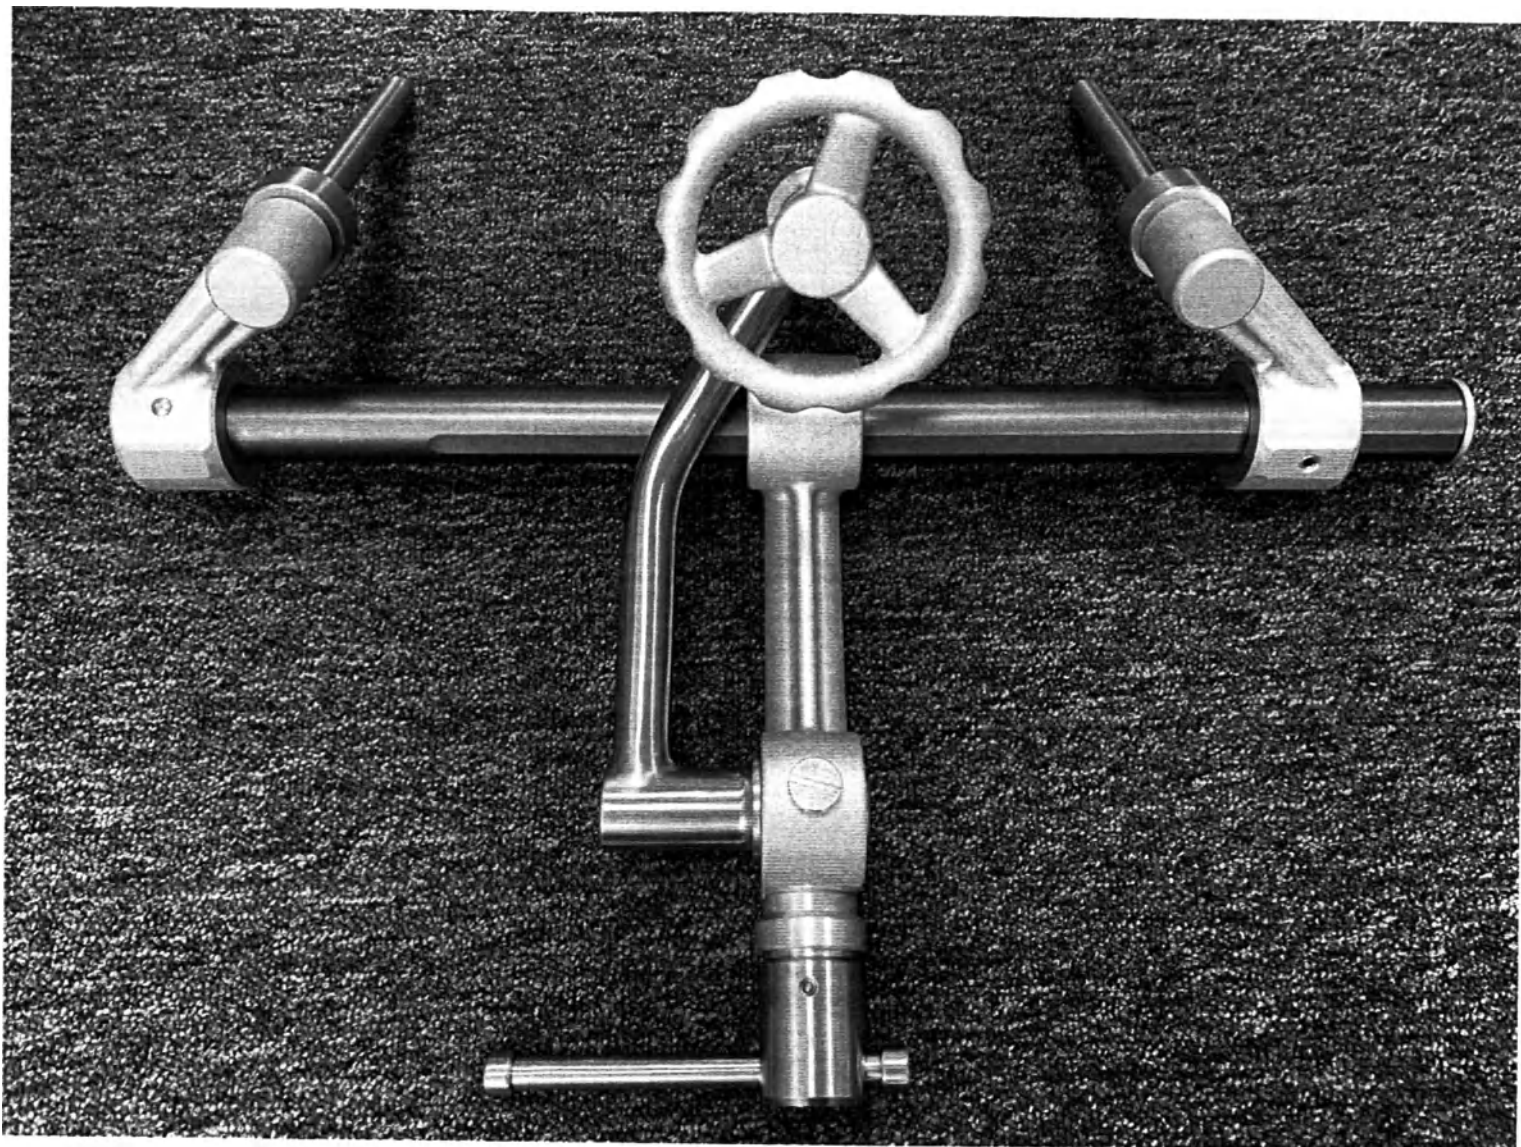


Фото 21. Крепление к столу для 3080 (упаковка)



III. Система хирургическая для стабилизации и ретракции черепа с принадлежностями (RHF) в составе

Фото 1. Фиксатор головы вращающийся рентгенопрозрачный



Фото 2. Фиксатор головы вращающийся рентгенопрозрачный (упаковка)



Фото 3. Фиксатор головы вращающийся рентгенопрозрачный (упаковка)

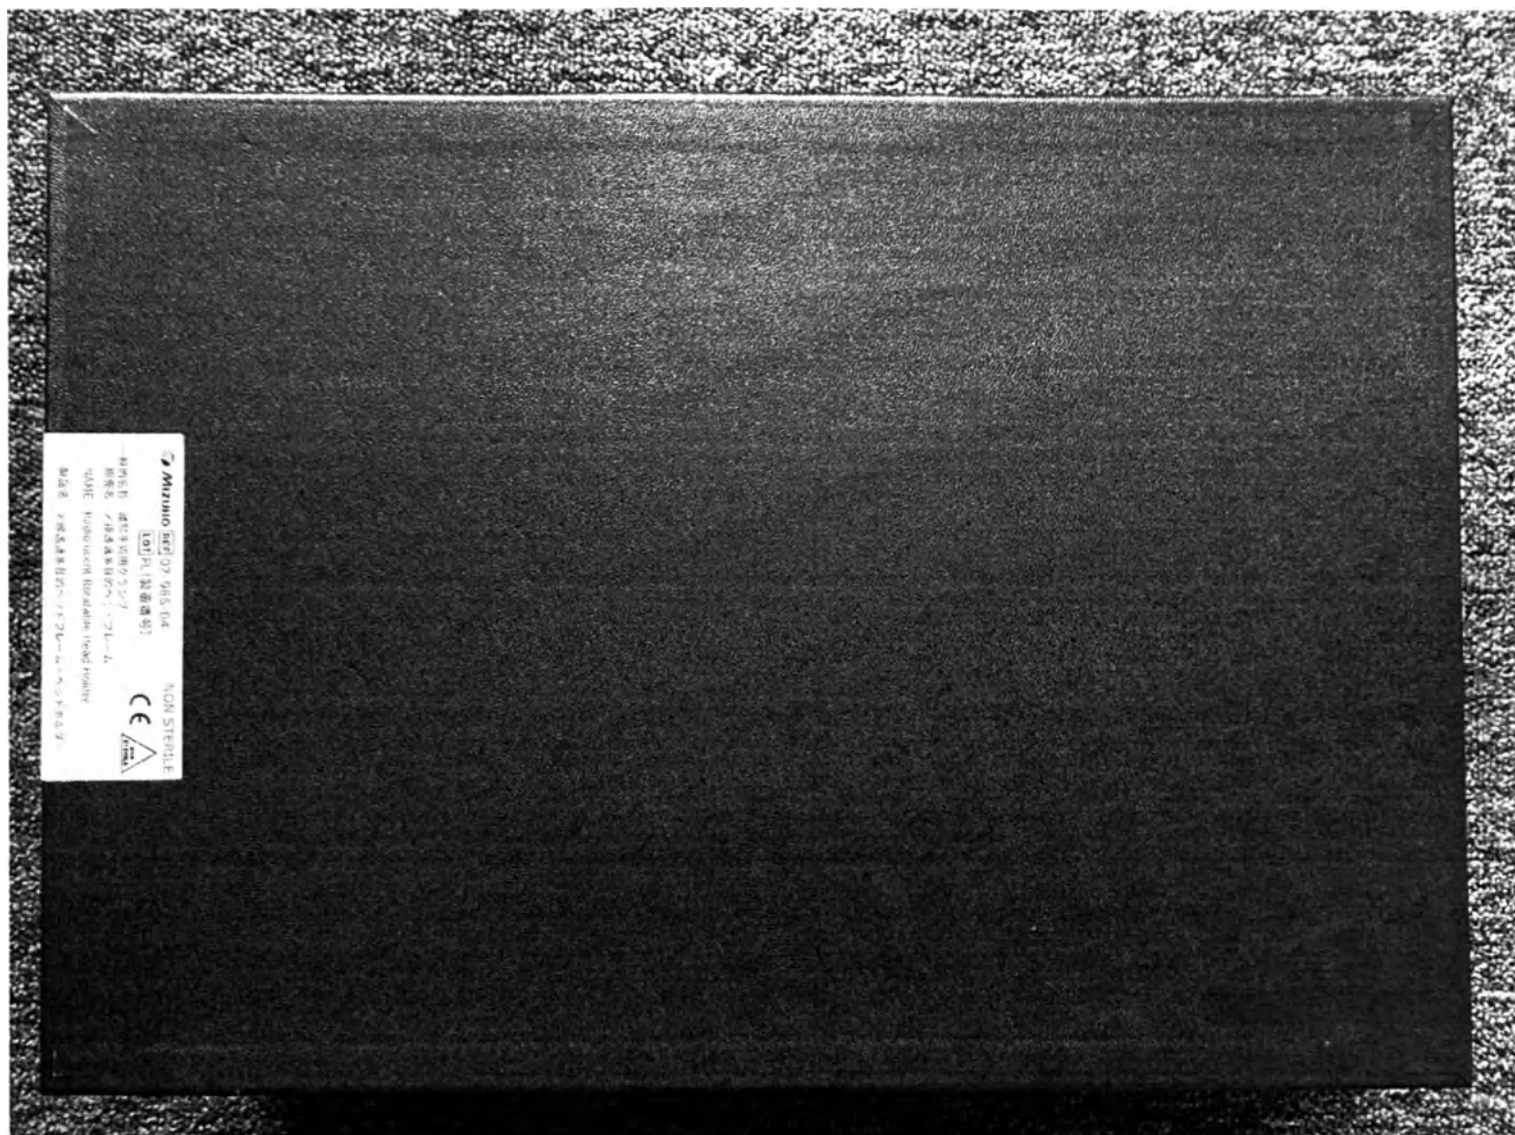


Фото 4. Основная рама рентгенопрозрачная

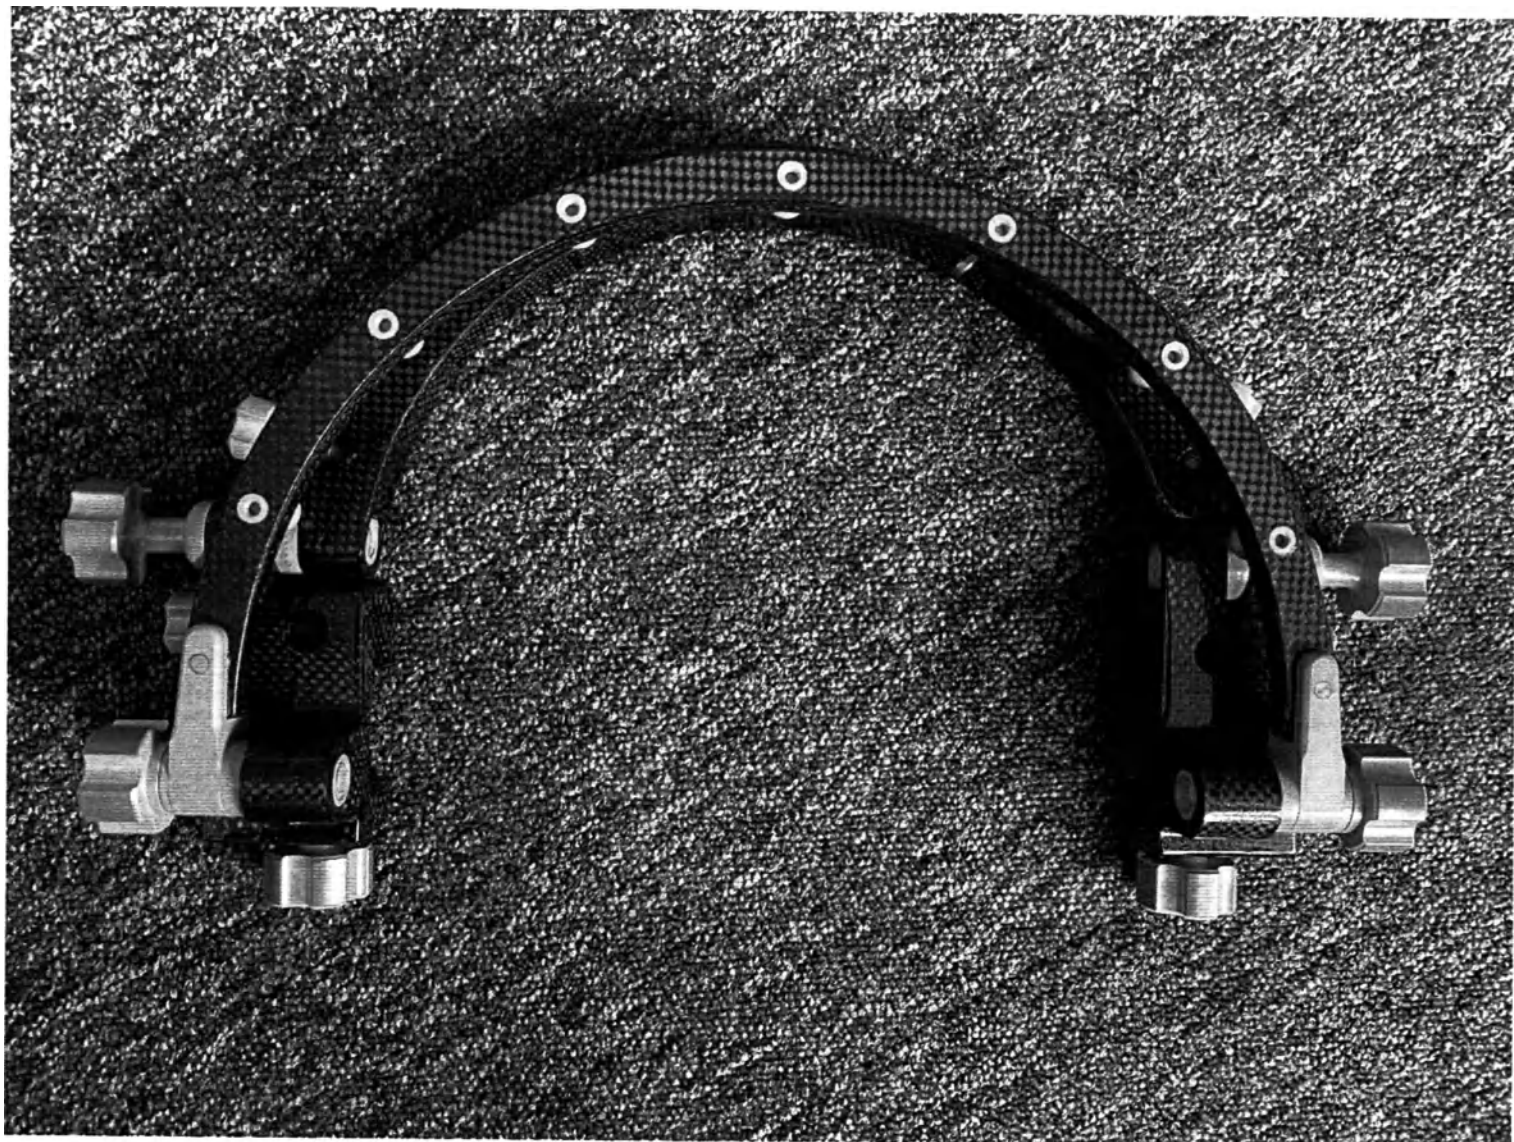




Фото 6. Основная рама рентгенопрозрачная (упаковка)



Фото 7. Шип-фиксатор рентгенопрозрачный



Фото 8. Шип-фиксатор рентгенопрозрачный (упаковка)

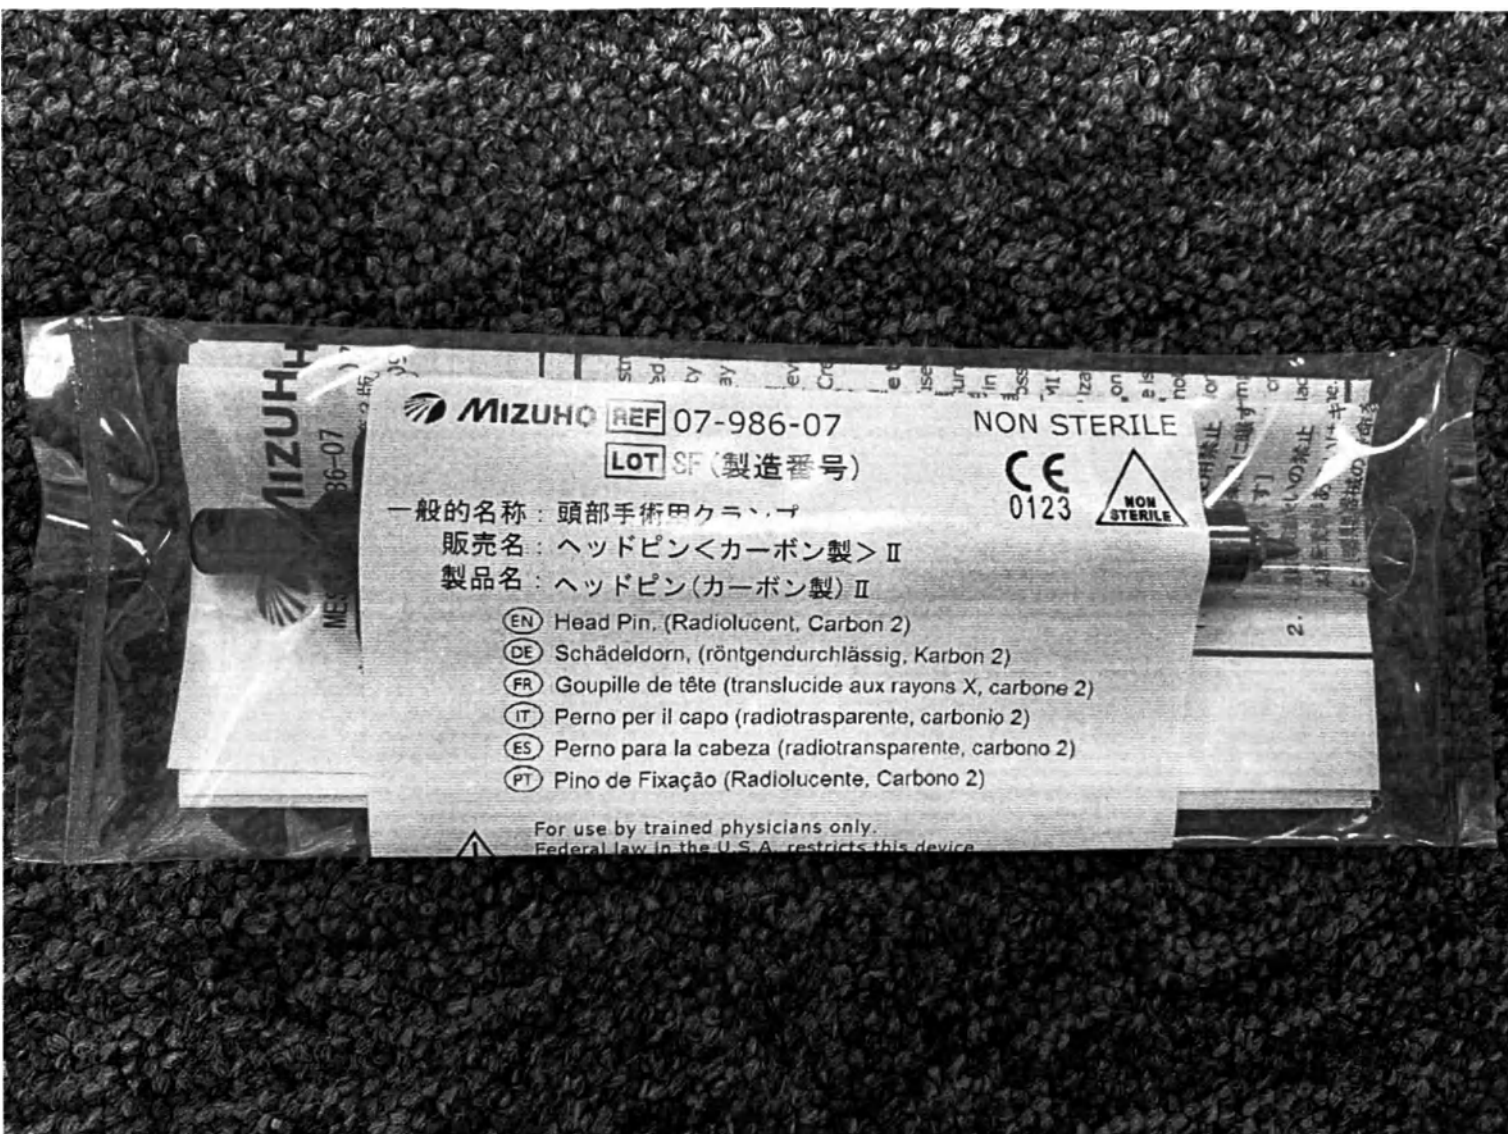


Фото 9. Основание дуги фиксации головы

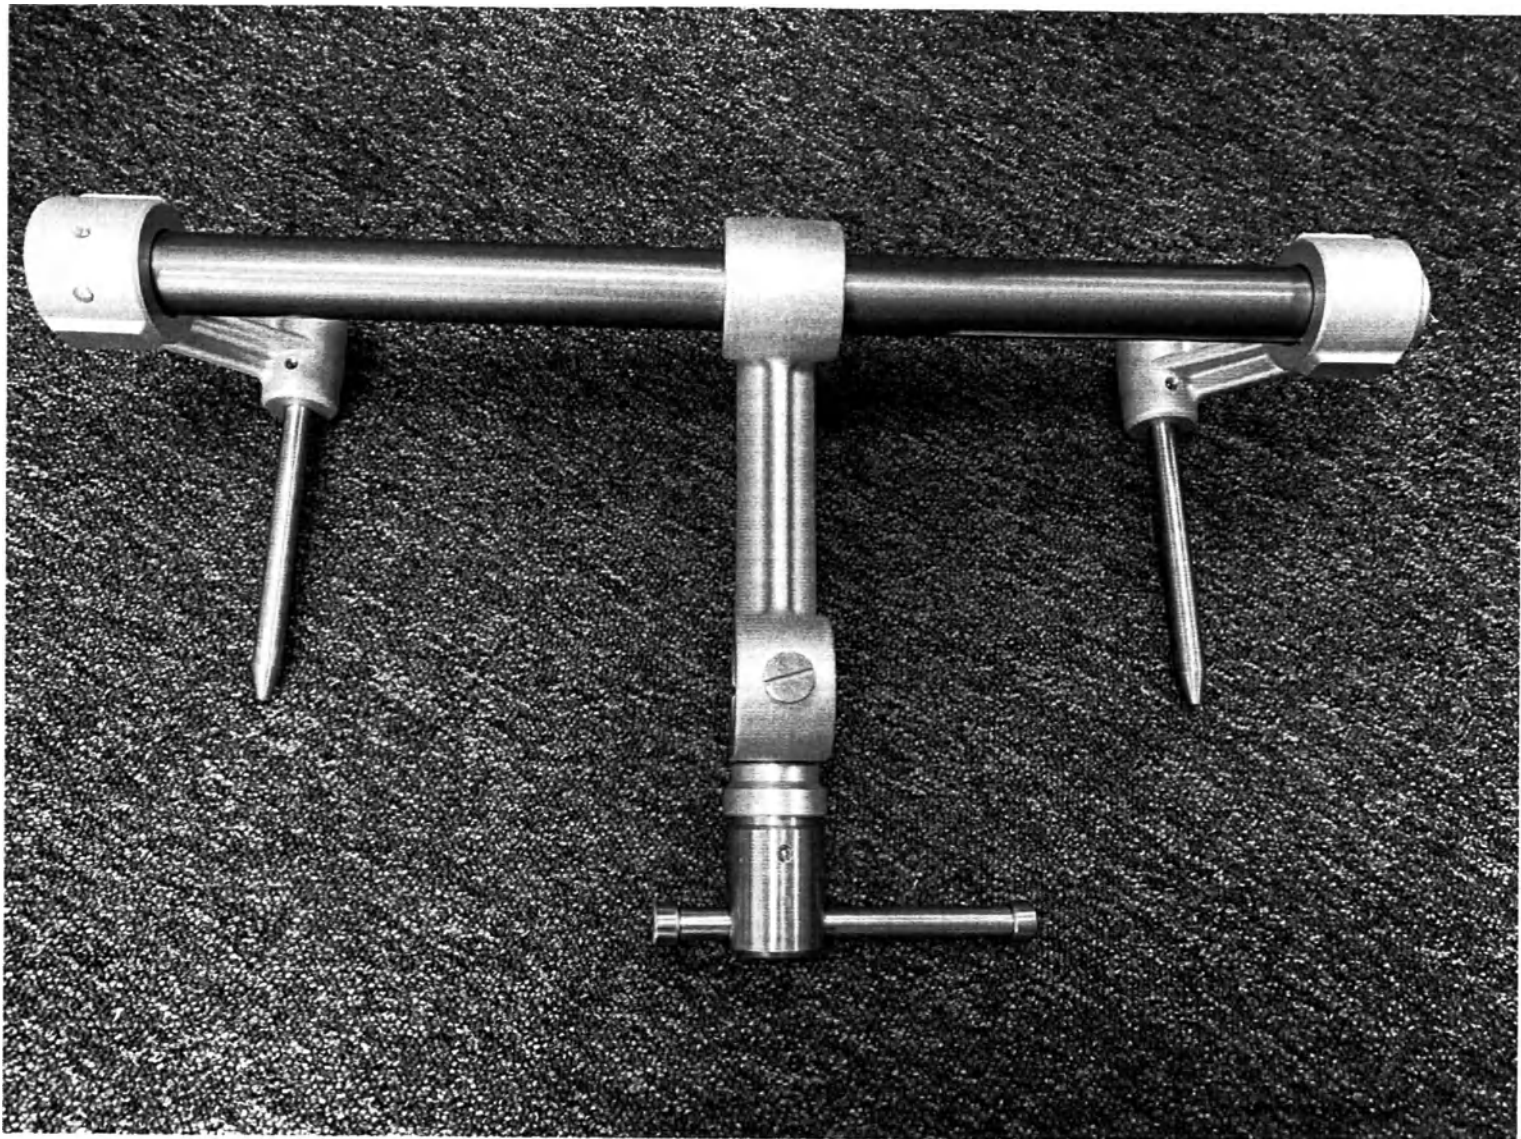


Фото 10. Основание дуги фиксации головы (упаковка)



Фото 11. Основание дуги фиксации головы, штифт диам. 19 мм



Фото 12. Основание дуги фиксации головы, штифт диам. 19 мм (упаковка)



Фото 13. Основание дуги фиксации головы, штифт диам. 16 мм



Фото 14. Основание дуги фиксации головы, штифт диам. 16 мм (упаковка)



Фото 15. Основание дуги фиксации головы, Up Grade Kit для интраоперационной КТ-системы

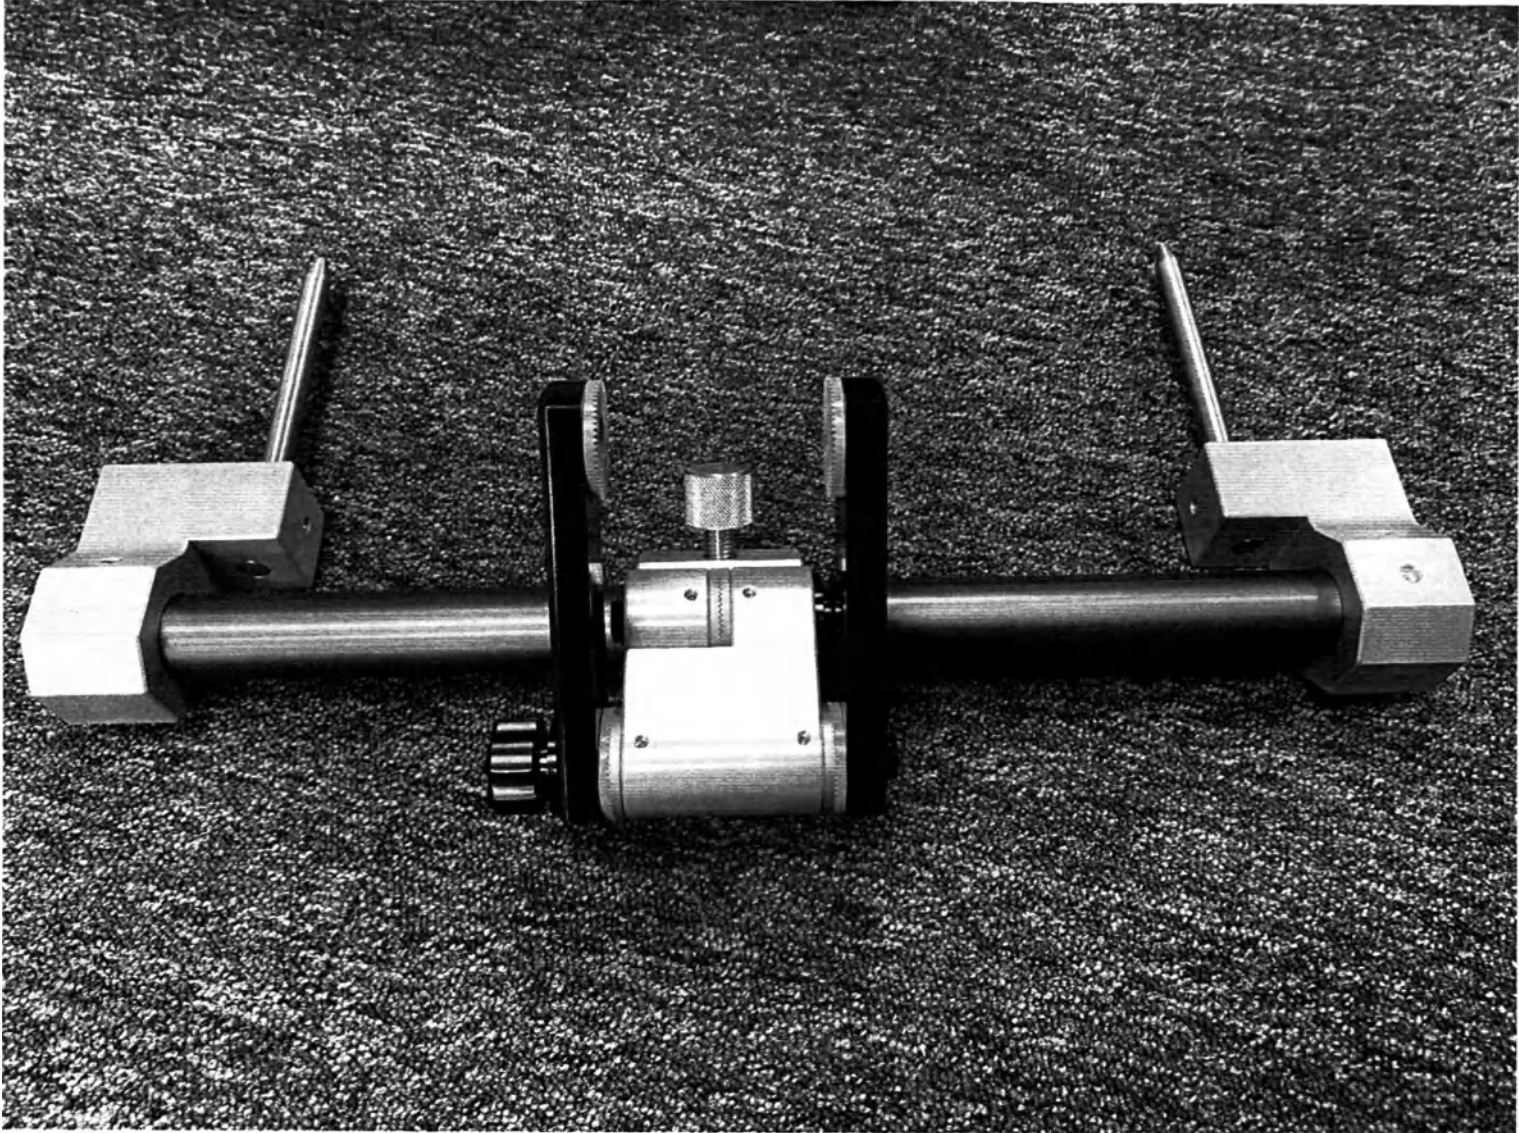


Фото 16. Основание дуги фиксации головы, Up Grade Kit для интраоперационной КТ-системы (упаковка)



Принадлежности:

Фото 1. Регулятор скольжения рентгенопрозрачный

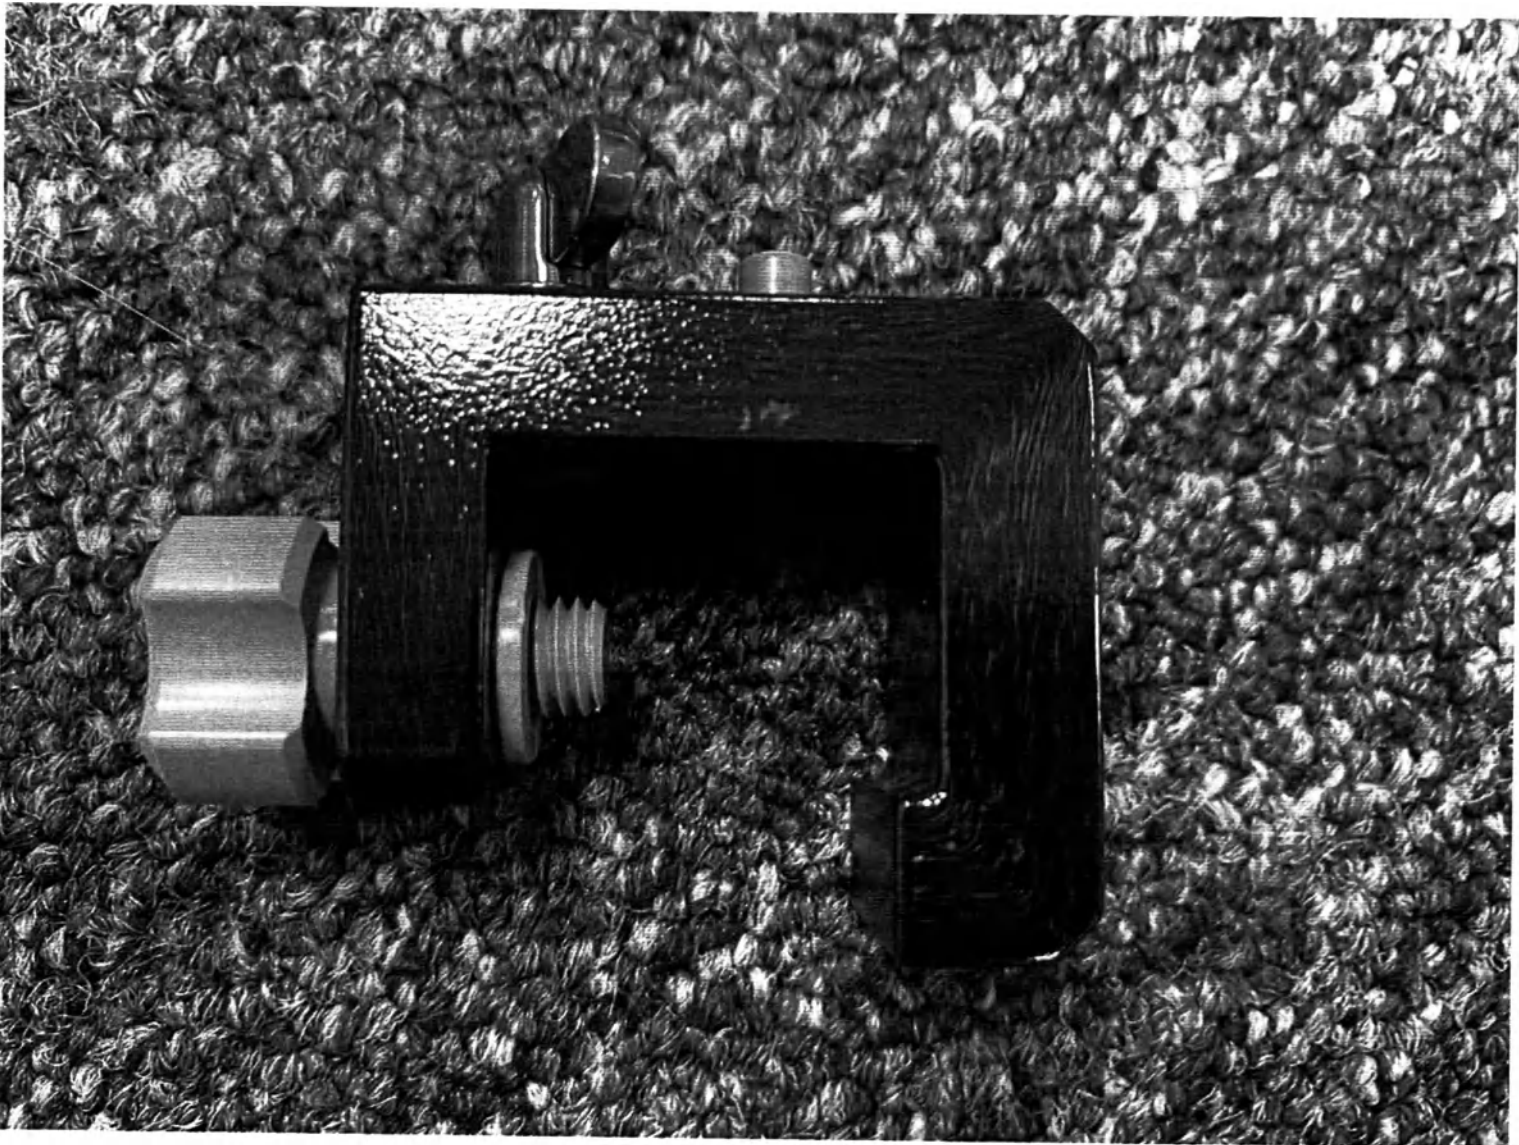



Фото 2. Регулятор скольжения рентгенопрозрачный (упаковка)



Фото 3. Крючок на пружине из титана с эластичной лентой



Фото 4. Крючок на пружине из титана с эластичной лентой (упаковка)

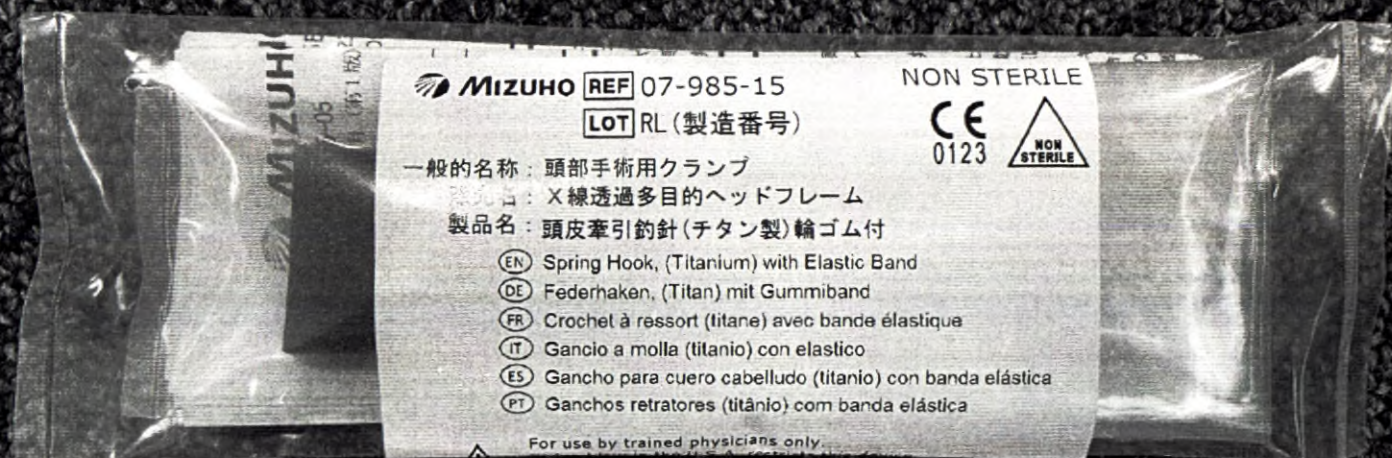

●
Фото 5. Адаптер NV, МРТ /КТ

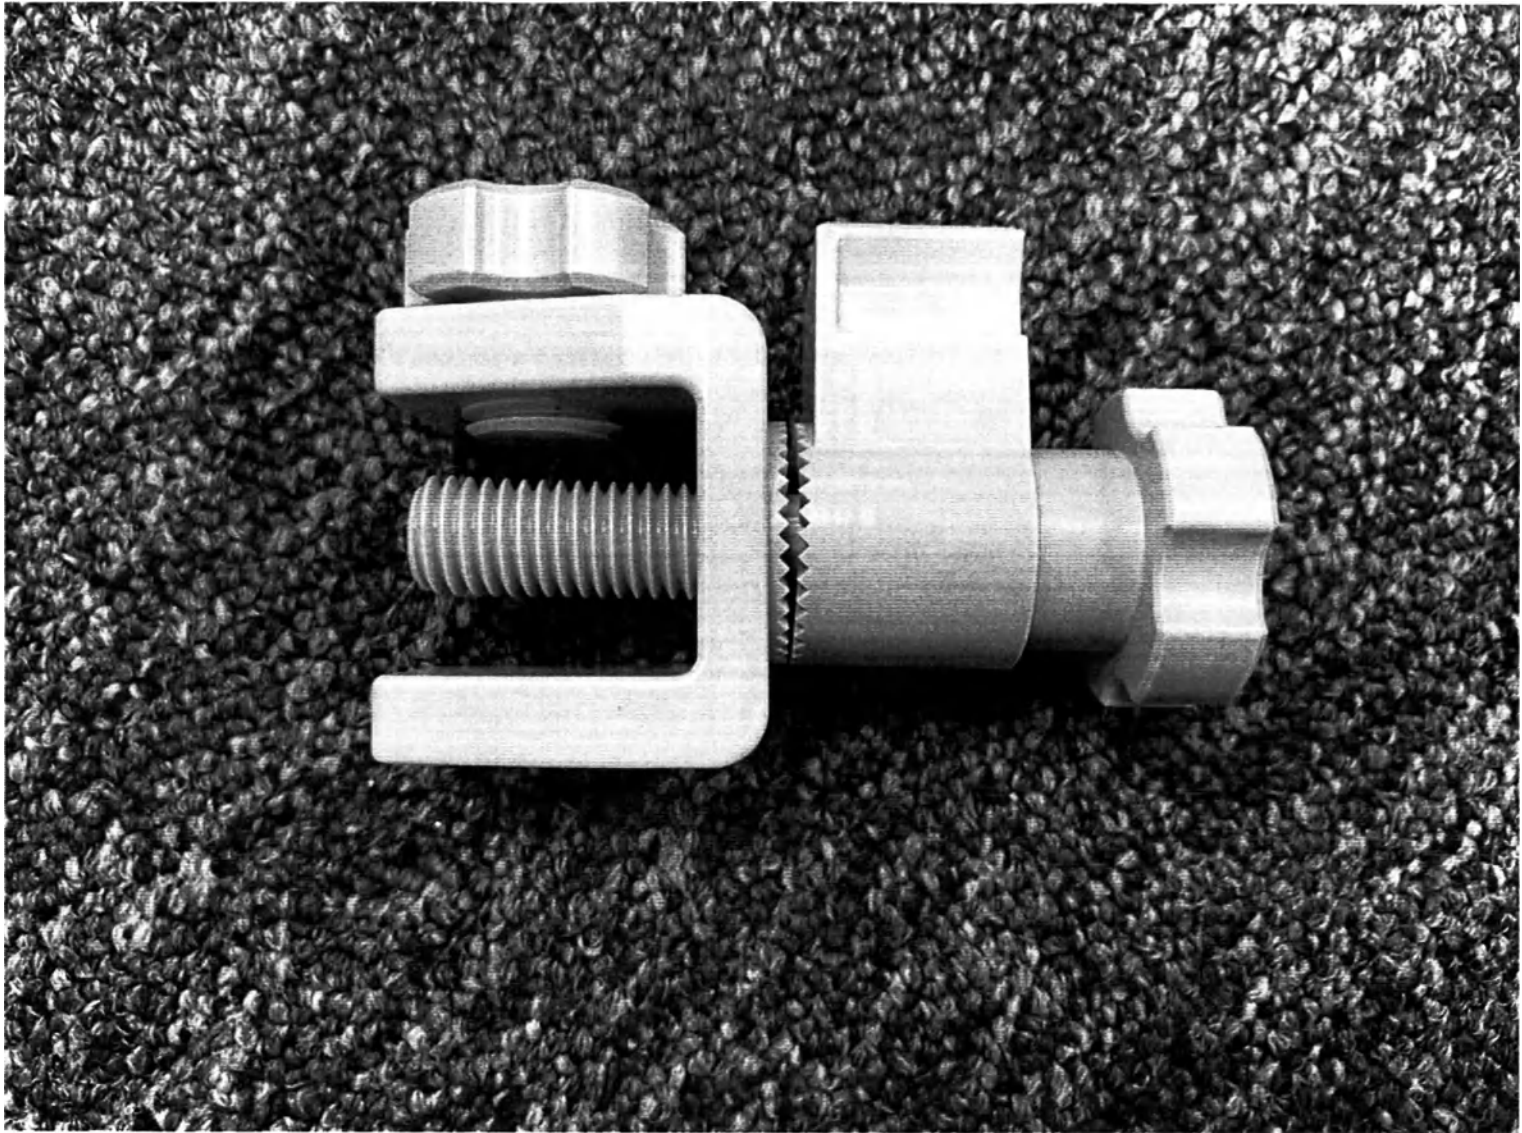


Фото 6. Адаптер NV, MPT /КТ (упаковка)



Фото 7. Адаптер NV, МРТ /КТ (упаковка)

 **MIZUHO** REF 07-970-51
LOT SE (製造番号)

NON STERILE

CE



一般名称：頭部手術用クランプ

販売名：MRI / CTヘッドアームアタッチメント

NAME : NV Adaptor MRI/CT

製品名：MRI / CTヘッドアームアタッチメント



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌

一般
医療機器

1 個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329185409(10)SE

製造販売業者：ミズホ株式会社 / 東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号：13B1X00306G10340
MADE IN JAPAN

Фото 8. Регулятор скольжения для ретрактора

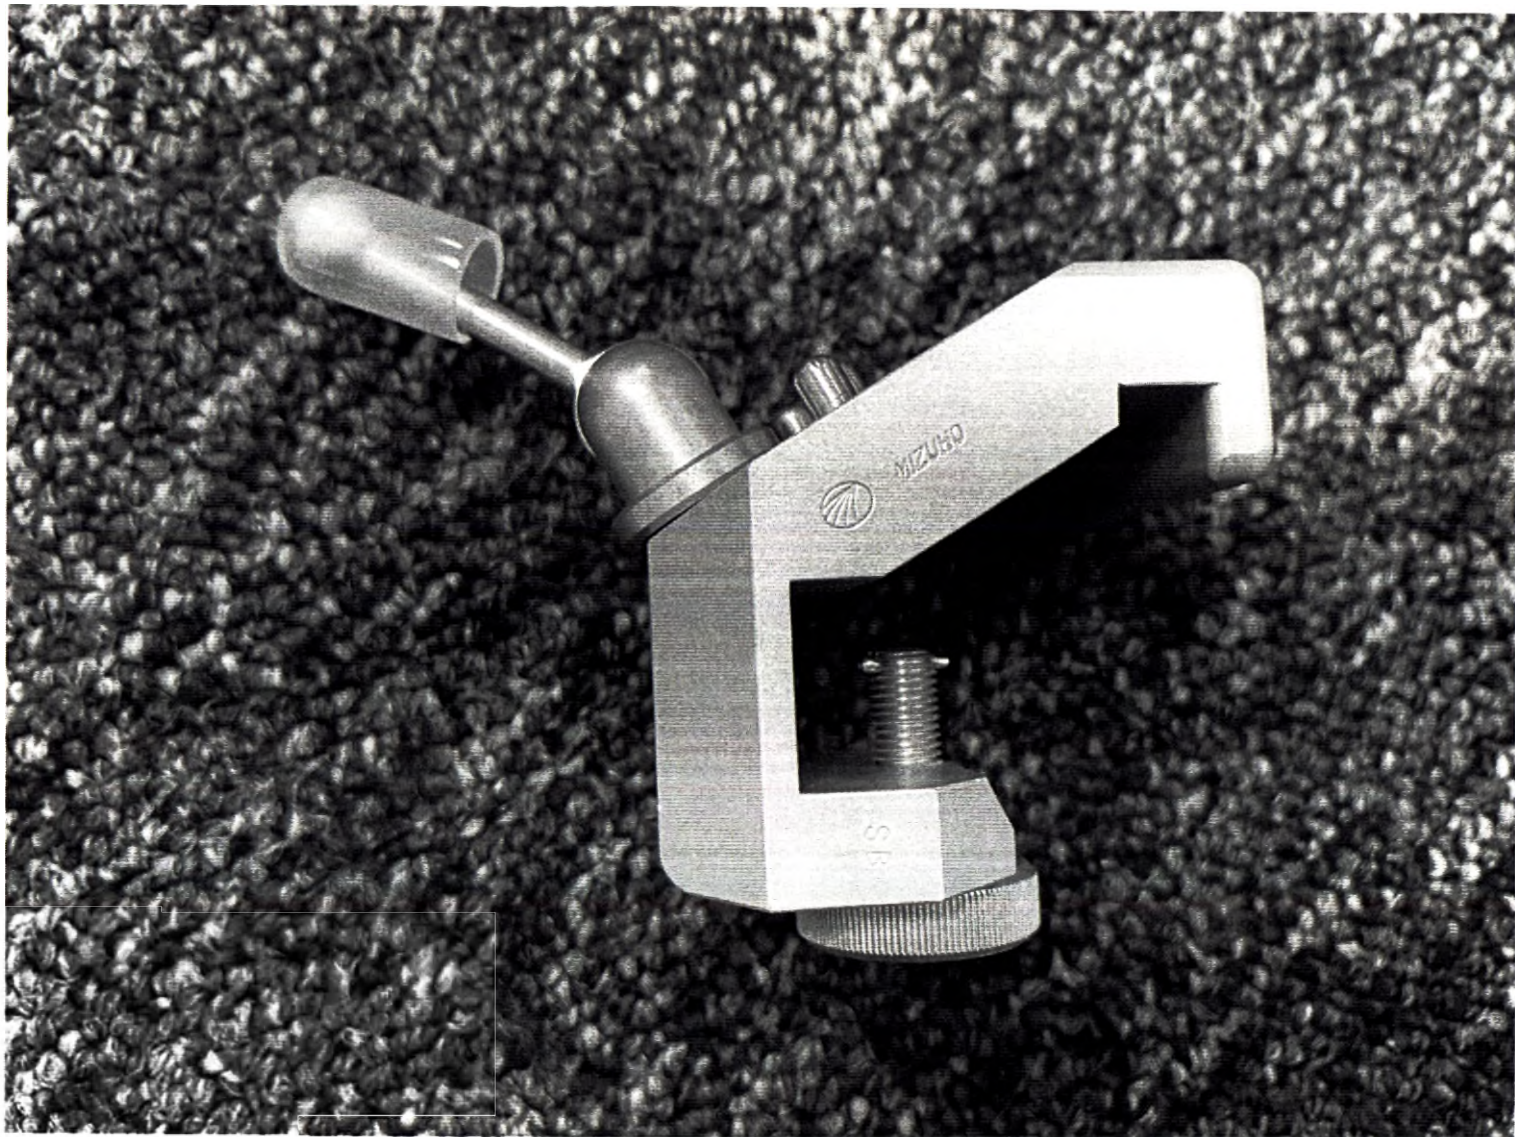


Фото 9. Регулятор скольжения для ретрактора (упаковка)



 **MIZUHO** **REF** 07-955-01
LOT SB (製造番号)

NON STERILE



一般名称：頭部手術用クランプ

販売名：多目的ヘッドフレーム用脳箠固定器スライド台

NAME : SLIDE ADJUSTOR FOR RETRACTOR

製品名：多目的ヘッド下用脳箠固定器スライド台



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌

一般
医療機器

1個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329062410(10)SB

製造販売業者：ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号：13B1X00306G00382

MADE IN JAPAN

Фото 11. Четвертная рама

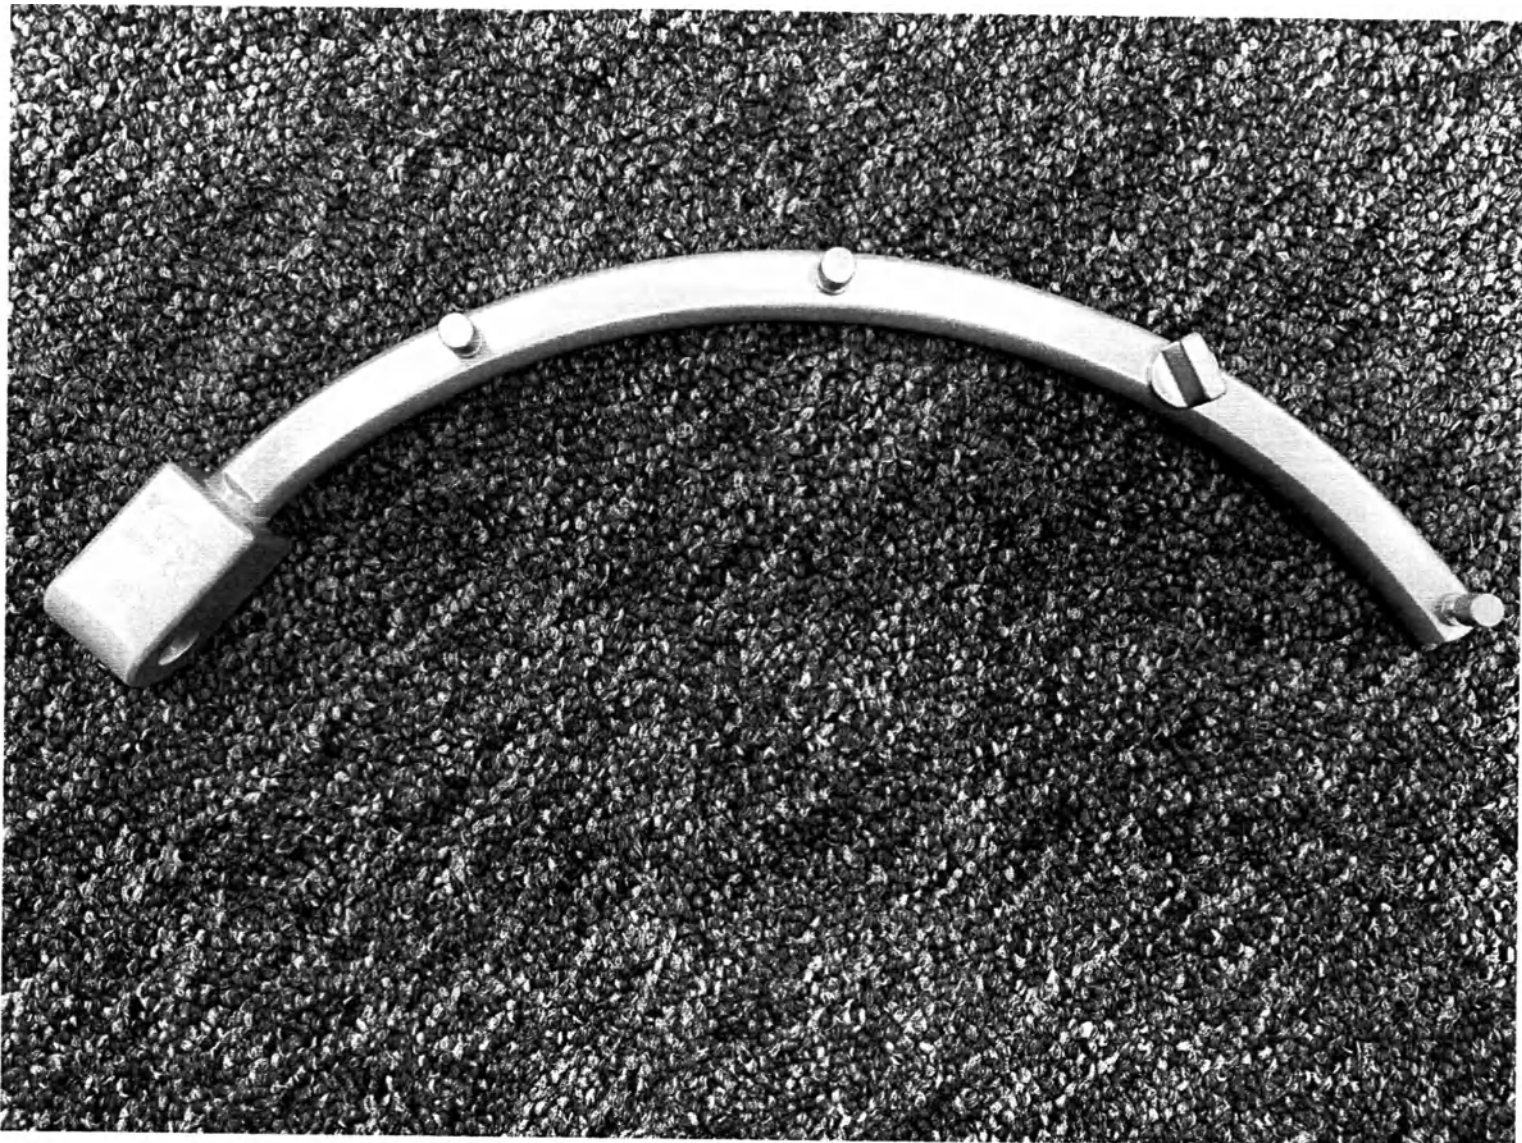


Фото 12. Четвертная рама (упаковка)



Фото 13. Четвертная рама (упаковка)



MIZUHO **REF** 07-981-10
LOT RK (製造番号)

NON STERILE



一般的名称：頭部手術用クランプ

販売名：クォーターフレーム

NAME : QUARTER FRAME

製品名：クォーターフレーム



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌

Фото 14. Крючок на пружине для мягких тканей свода черепа из нержавеющей стали

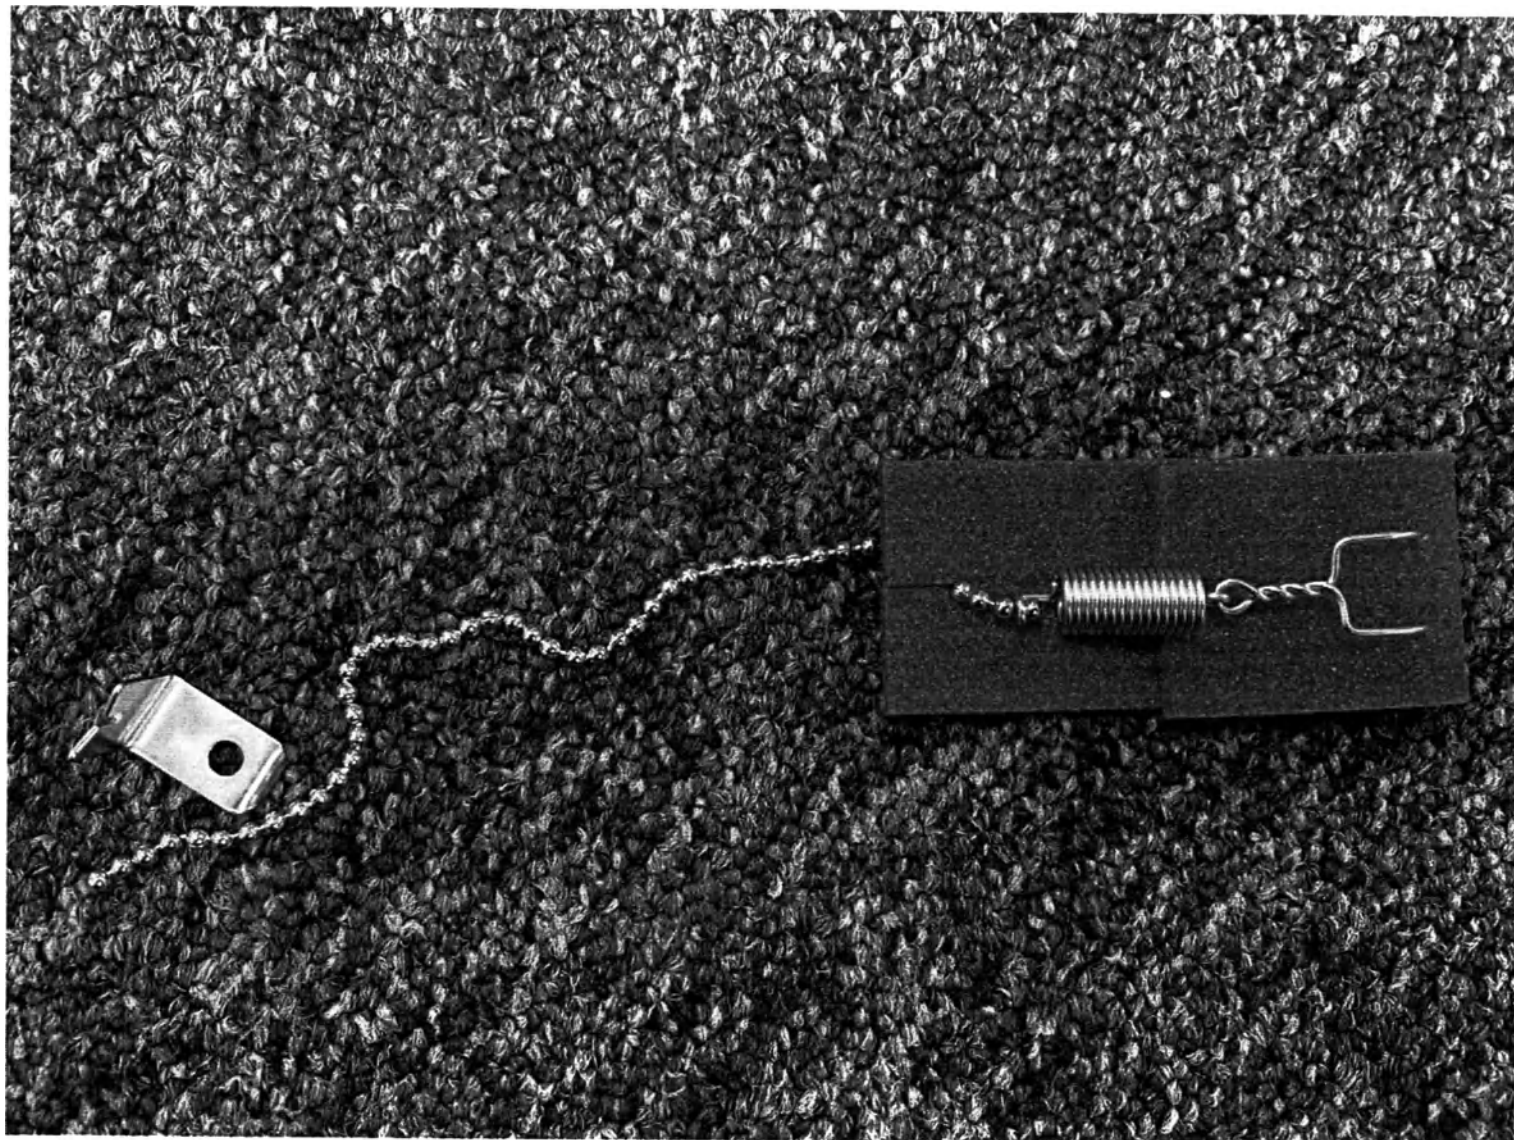


Фото 15. Крючок на пружине для мягких тканей свода черепа из нержавеющей стали (упаковка)



Фото 16. Регулируемая опора для рук со слайдером



Фото 17. Регулируемая опора для рук со слайдером (упаковка)



MIZUHO REF 07-981-09
LOT RJ (製造番号)

NON STERILE



一般名称: 頭部手術用クランプ
販売名: X線透過多目的ヘッドフレーム

NAME: Adjustable Hand Rest with Slide

製品名: B. スライダー付 多目的用ハンドレスト



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌

一般
医療機器

1 個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329064582(10)RJ

製造販売業者: ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号: 13B1X00306G00388

MADE IN JAPAN

3. Sterilization

- (1) Device must be sterilized by users in accordance with validated sterilization procedures that are regulated by medical organizations in each country or region.
- (2) Our recommended sterilization parameters are as follows.

Table 1: Applicable Detergent

Detergent	
Neutral	Alkaline

Фото 19. Регулируемая опора для рук с колпачковым винтом






(1)-1 If exposed to bleach or antiseptic solutions, immediately wash. Wash and rinse with clear water immediately and use mild detergent to remove any

 **MIZUHO** **REF** 07-981-04

LOT RH (製造番号)

NON STERILE



一般の名称: 頭部手術用クランプ

販売名: X線透過多目的ヘッドフレーム

NAME: Adjustable Hand Rest with Dome screw

製品名: 01. ハンドレスト



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌
一般
医療機器
1個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329064551(10)RH


製造販売業者: ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号: 13B1X00306G00388

MADE IN JAPAN

cause staining
instrument

Фото 22. Опора для рук

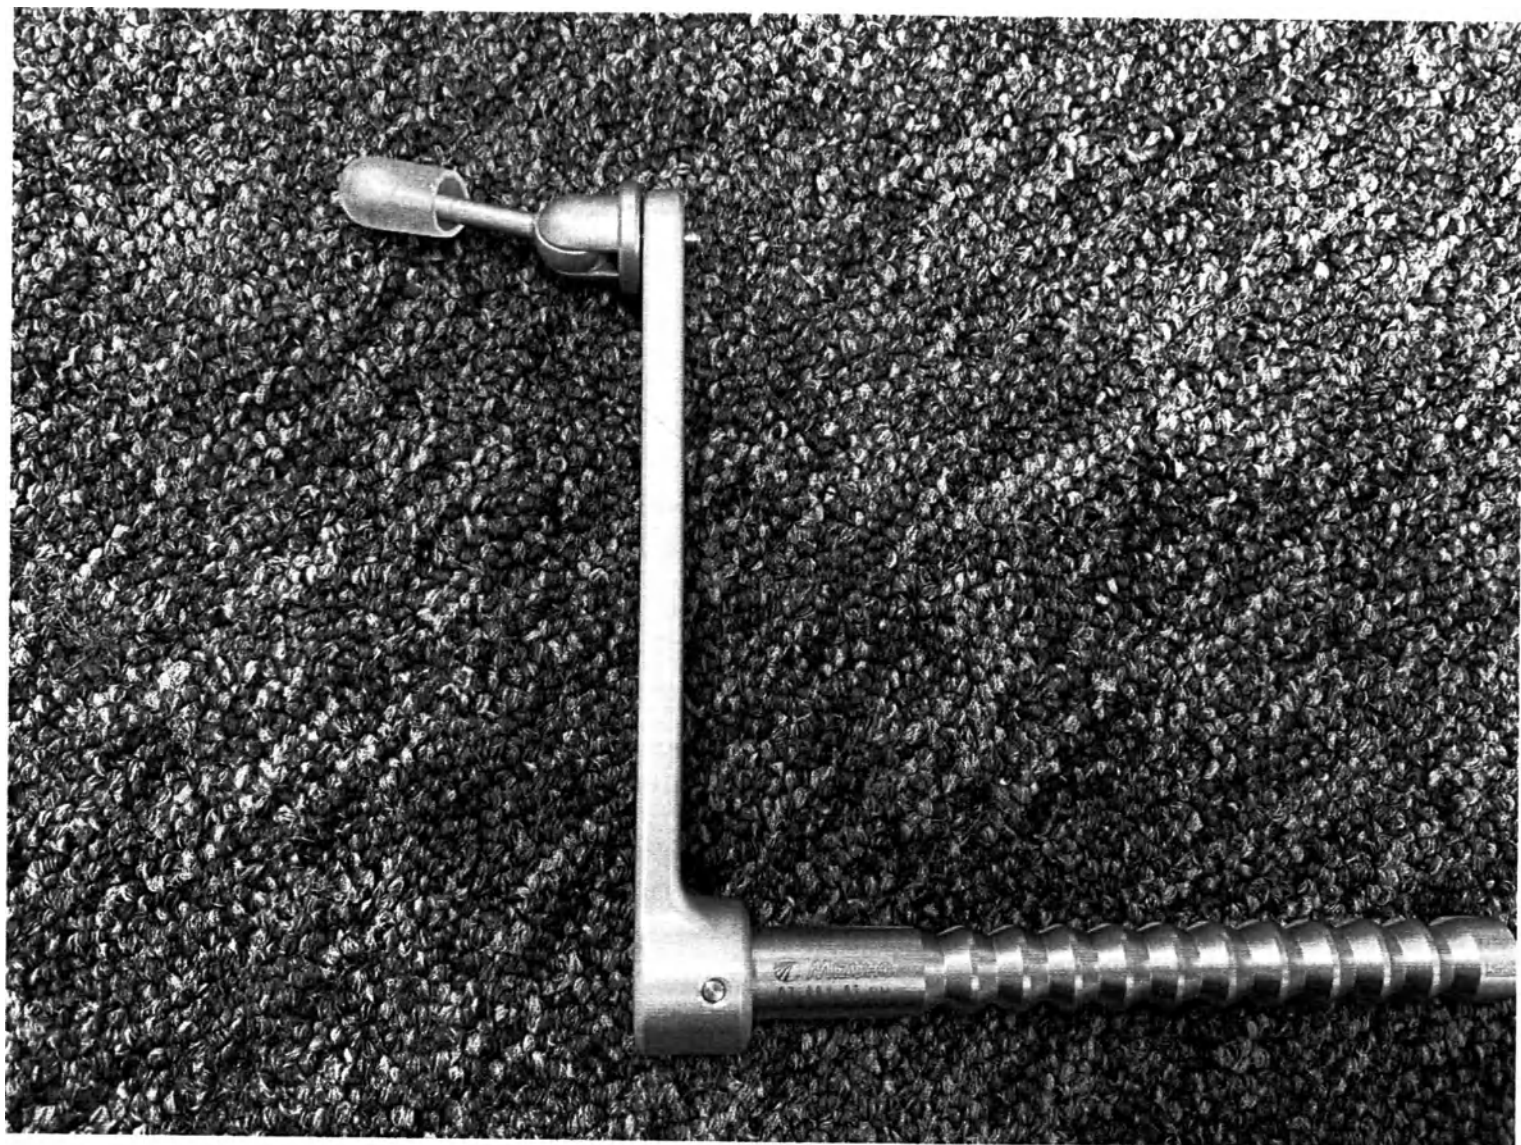



(1)-1 If exposed to bleach or antiseptic solutions, immediately wash: Wash and [] with clear water immediately and immerse in neutral enzyme detergent to remove []

 **MIZUHO** **REF** 07-981-03
LOT RH (製造番号)

NON STERILE

CE



一般の名称: 頭部手術用クランプ
販売名: X線透過多目的ヘッドフレーム

NAME: Hand Rest

製品名: C2. ハンドレスト



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌

一般
医療機器

1 個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329064544(10)RH

製造販売業者: ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13
製造販売届出番号: 13B1X00306G00388
MADE IN JAPAN

instrument.

Фото 25. Контейнер для инструмента

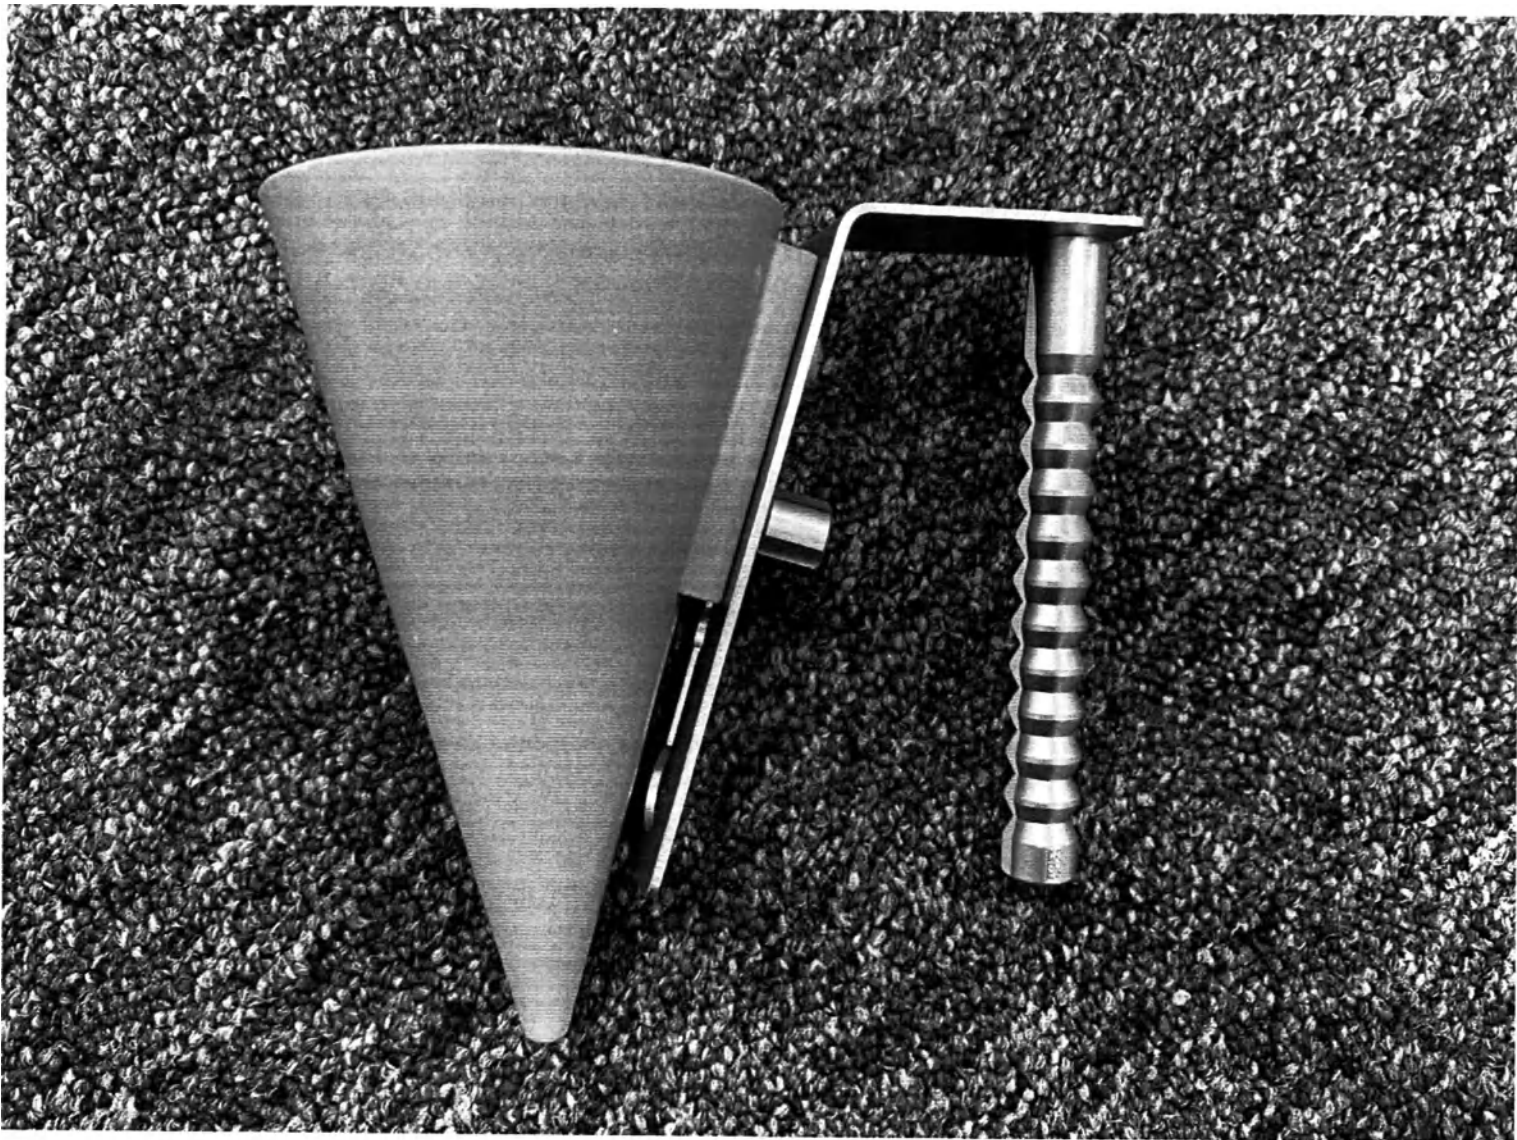


Фото 26. Контейнер для инструмента (упаковка)



Фото

 **MIZUHO** **REF** 07-981-06
LOT RG (製造番号)

NON STERILE

CE



一般名称：頭部手術用クランプ
販売名：X線透過多目的ヘッドフレーム

NAME : Instrument Receptacle

製品名：D. 手術器具保持ボックス



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.




MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌

一般

医療機器

1個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329064568(10)RG

製造販売業者：ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号：13B1X00306G00388
MADE IN JAPAN

(2) Full
Do
residual water may damage the instrument.
(3) Only use complete distilled or deionized water
Use distilled or deionized water to wash this product.
Residual chlorine and organic matters in tap water may
cause stainings and/or rust and may damage the
instrument.

Фото 28. Подставка для медицинских тканей


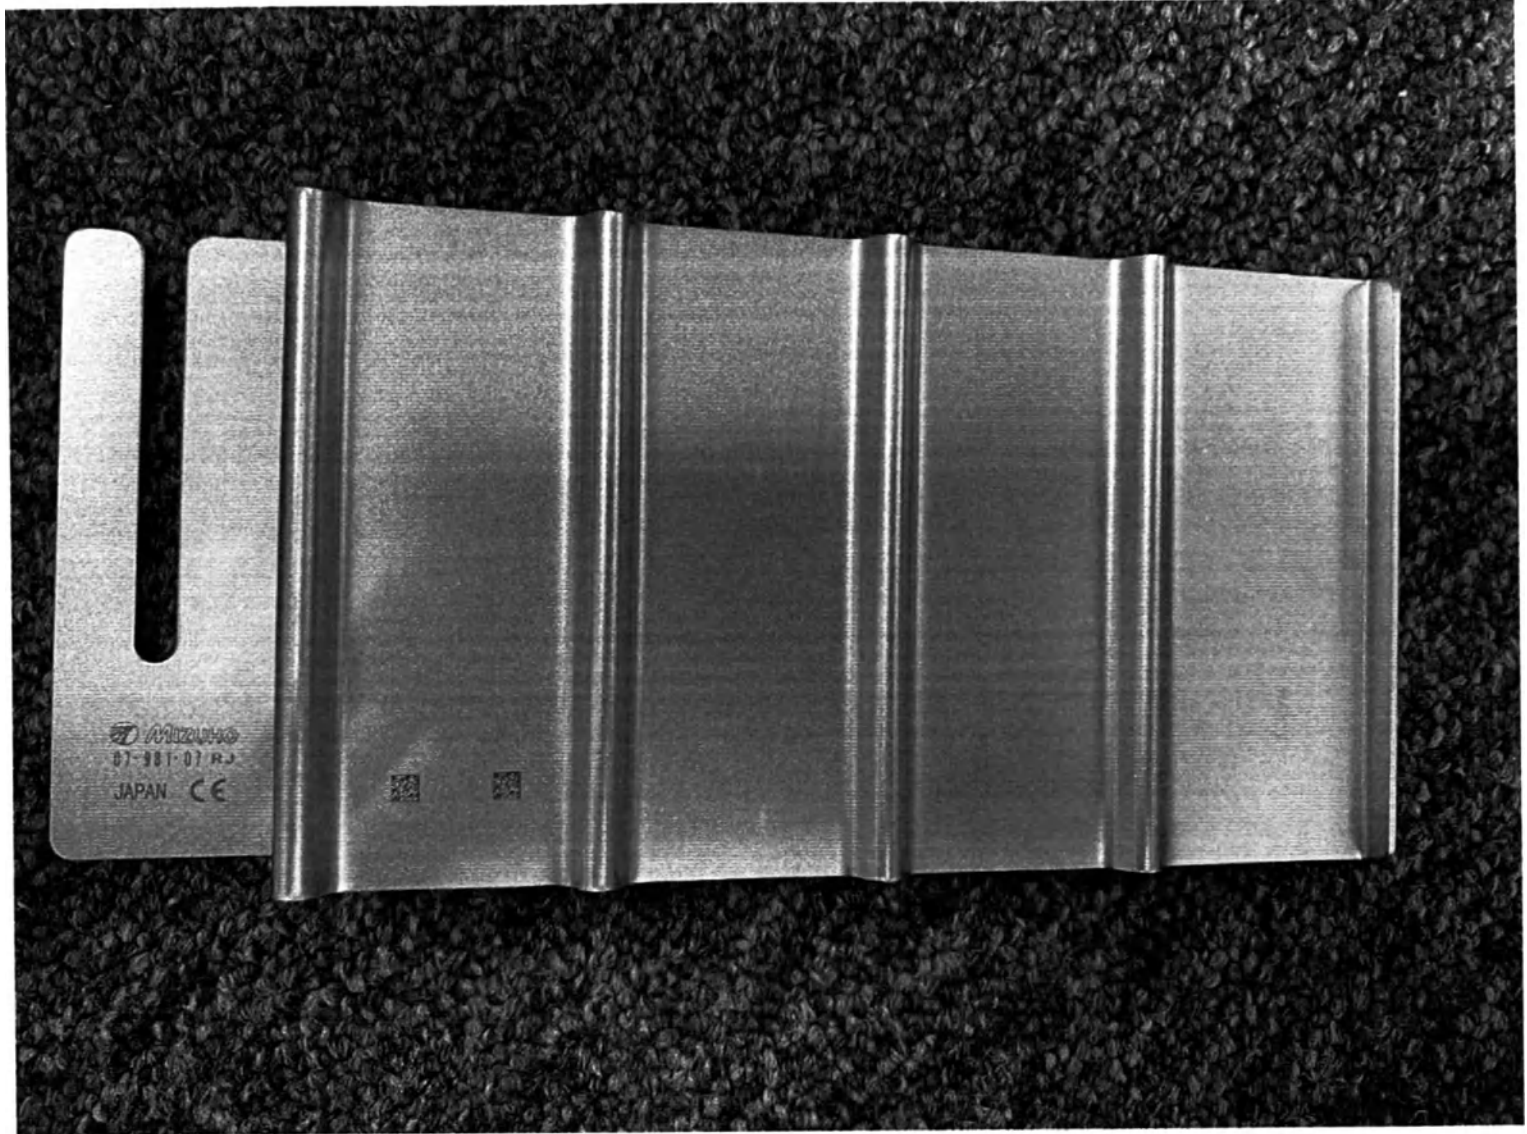


Фото 29. Подставка для медицинских тканей (упаковка)



 **MIZUHO** REF 07-981-07
LOT RJ (製造番号)

NON STERILE

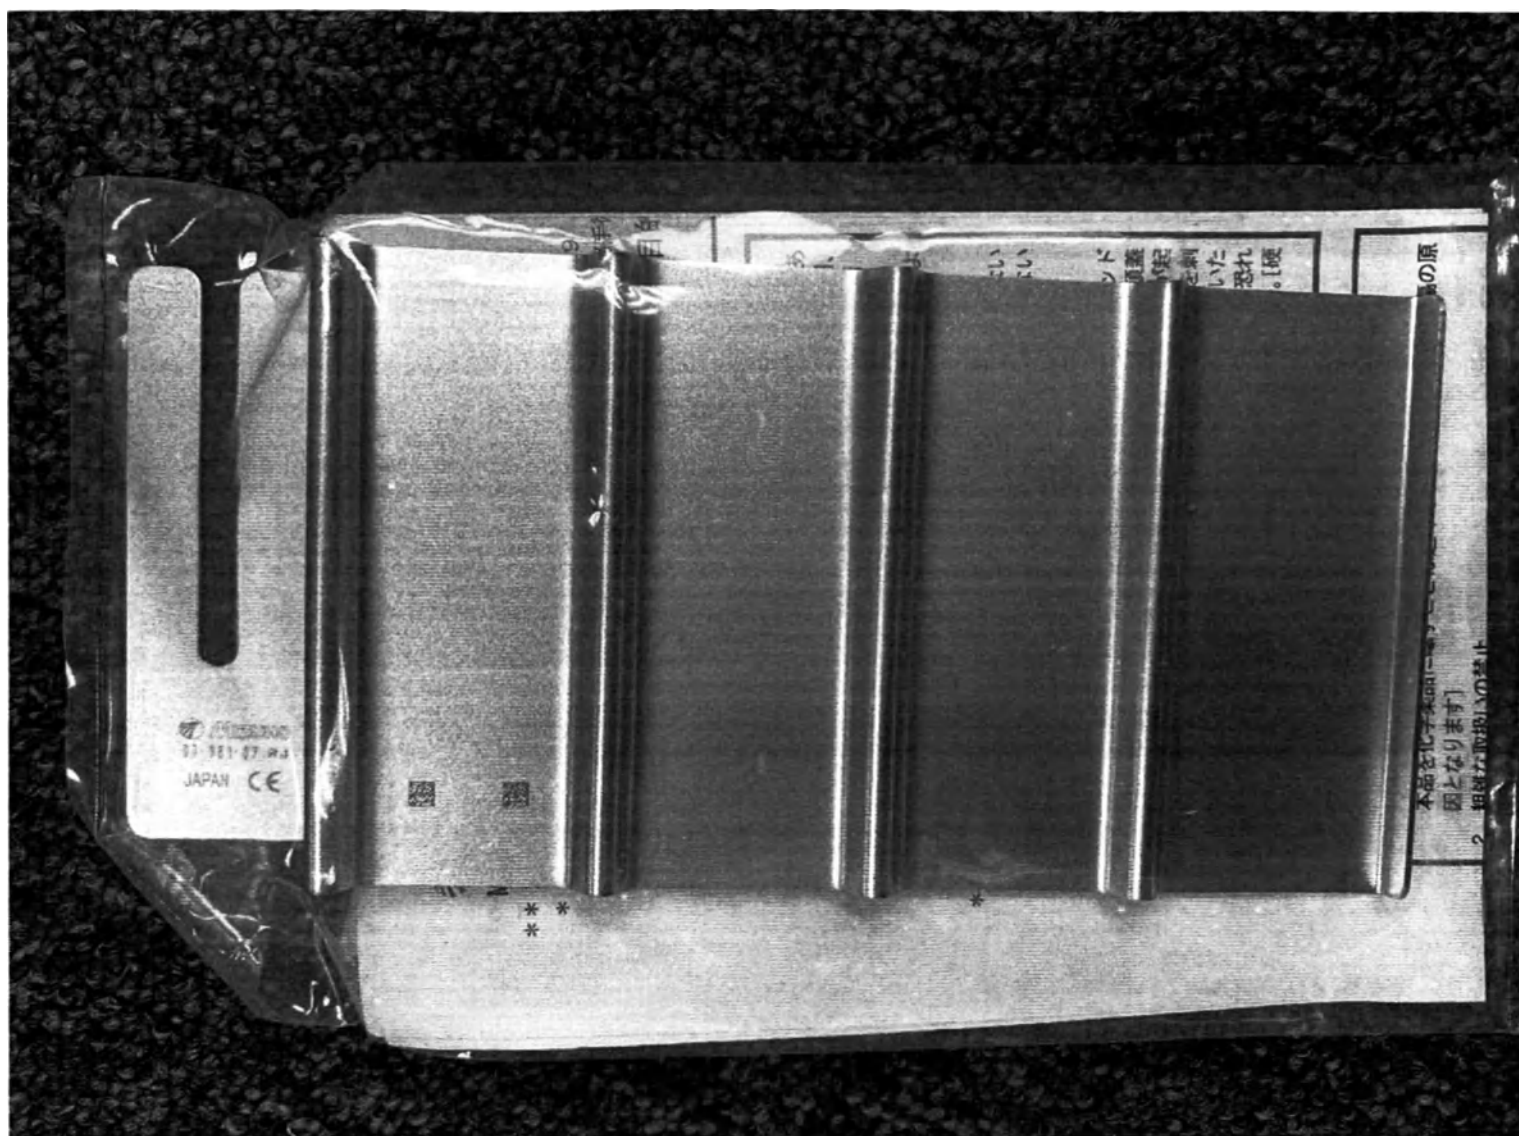

一般的名称: 頭部手術用クランプ
販売名: X線透過多目的ヘッドフレーム

NAME: Cotton Plate

製品名: G. 綿のせ皿




For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌
一般
医療機器
1個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329064575(10)RJ

製造販売業者: ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号: 13B1X00306G00388

MADE IN JAPAN

Disinfection Band: 90-93 °C, 5-10 minutes (A0 value:
3000-12000) (reference EN ISO 15883-1)

- (2) Fully dry this product immediately after washing it.
Do not leave it wet for a longer time than necessary as
residual water may damage the instrument.
- (3) Only use complete distilled or deionized water.
Use distilled or deionized water to wash this product.
Residual chlorine and organic matters in tap water may
cause stainings and/or rust and may damage the
instrument.

Фото 31. Адаптер MAYFIELD



Фото 32. Адаптер MAYFIELD (упаковка)



Фото 33. Адаптер MAYFIELD (упаковка)



MIZUHO REF 08-075-10

LOT SE (製造番号)

NON STERILE



一般的名称：手術台アクセサリ

販売名：M式頭部メイフィールド用アタッチメント

NAME：MAYFIELD ADAPTOR

製品名：M式頭部メイフィールド用アタッチメント



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.




MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌

一般
医療機器

1 個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329067743(10)SE

製造販売業者：ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号：1381X00306600010

MADE IN JAPAN

Фото 34. Адаптер NV из нержавеющей стали


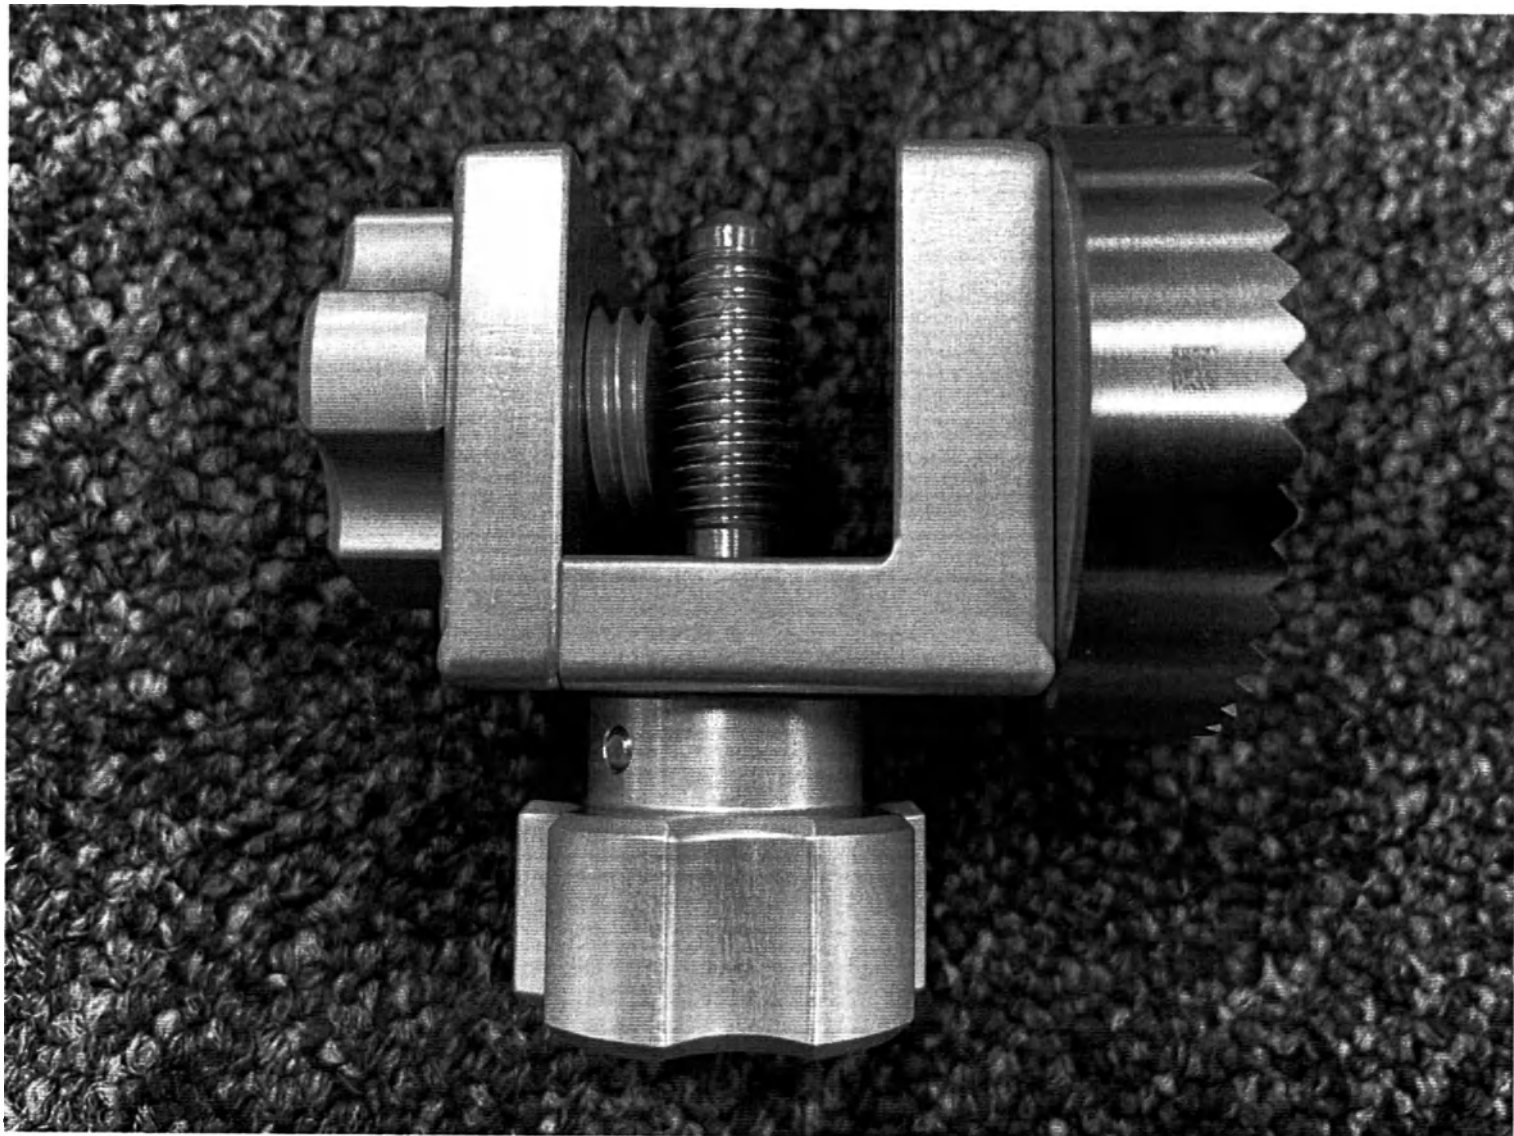


Фото 35. Адаптер NV из нержавеющей стали (упаковка)

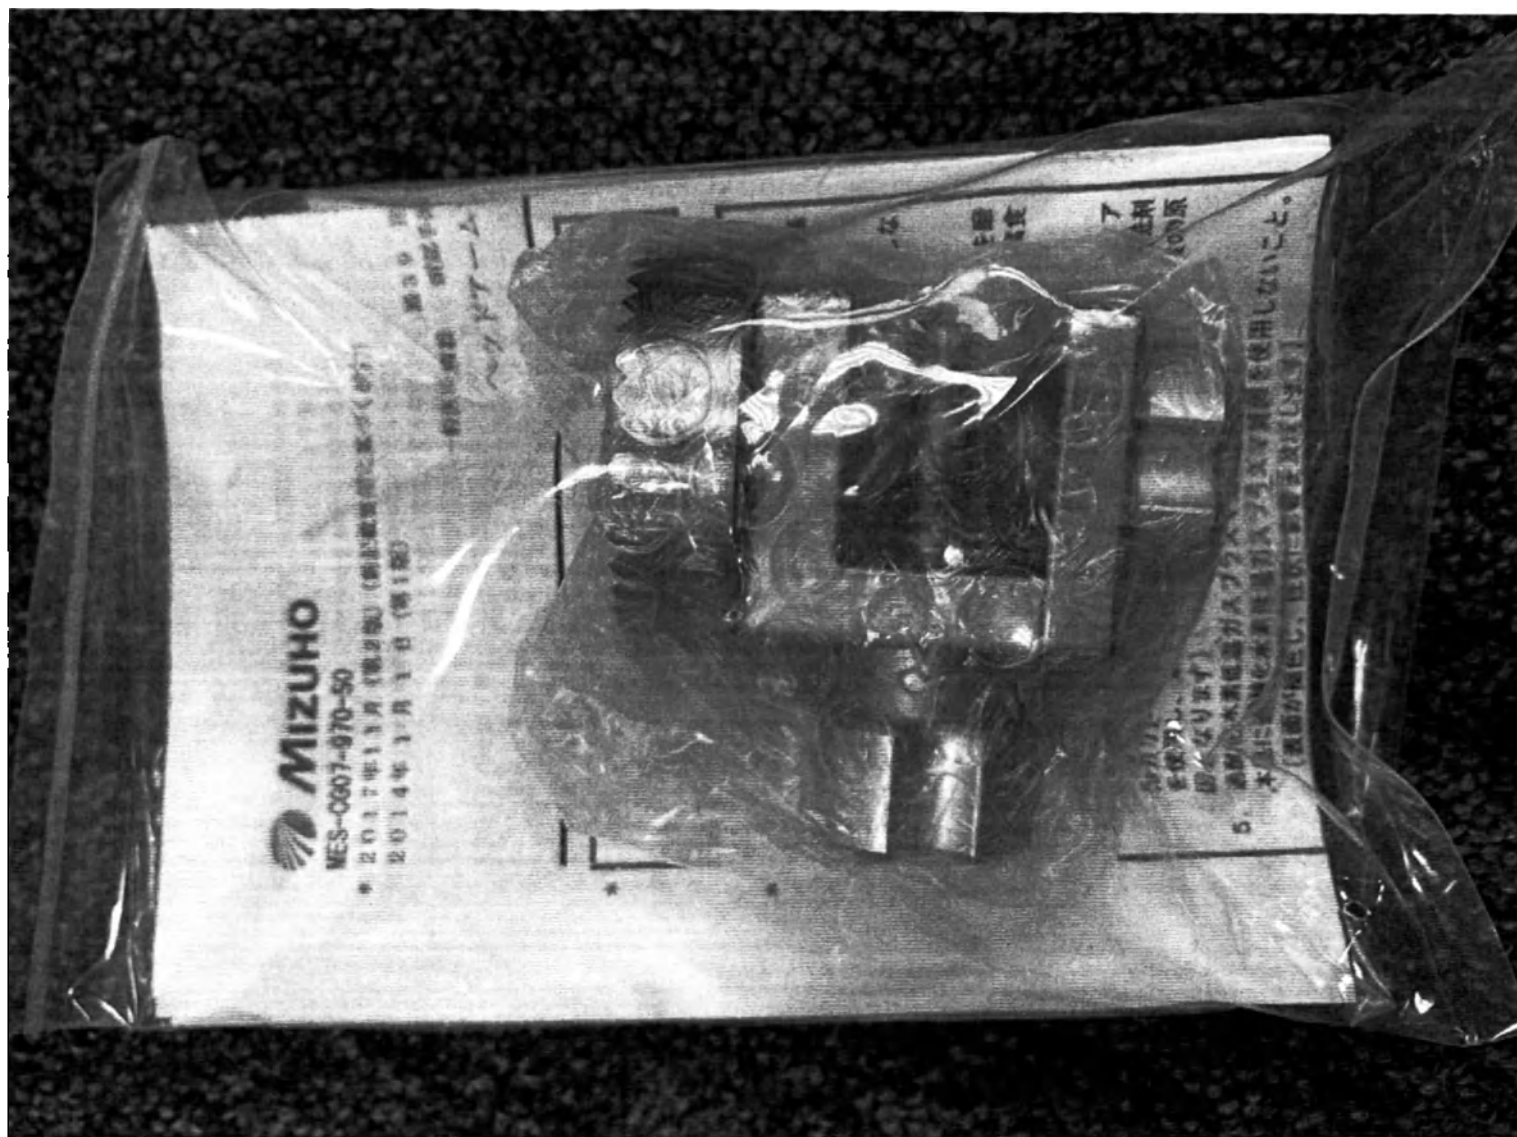

Адаптер NV из нержавеющей стали (упаковка)

 **MIZUHO** **REF** 07-970-50
LOT RC-648 (製造番号)

NON STERILE



一般名称：頭部手術用クランプ
販売名：ヘッドアームアタッチメント
NAME：NV Adaptor, Stainless
製品名：ヘッドアームアタッチメント



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan

未滅菌
一般
医療機器
1個包装



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands



(01)04946329175349(10)RC-648

製造販売業者：ミズホ株式会社/東京都文京区本郷3-30-13

製造販売届出番号：13B1X00306G10307

MADE IN JAPAN

Фото 37. Фиксатор F-1 самоудерживающегося ретрактора

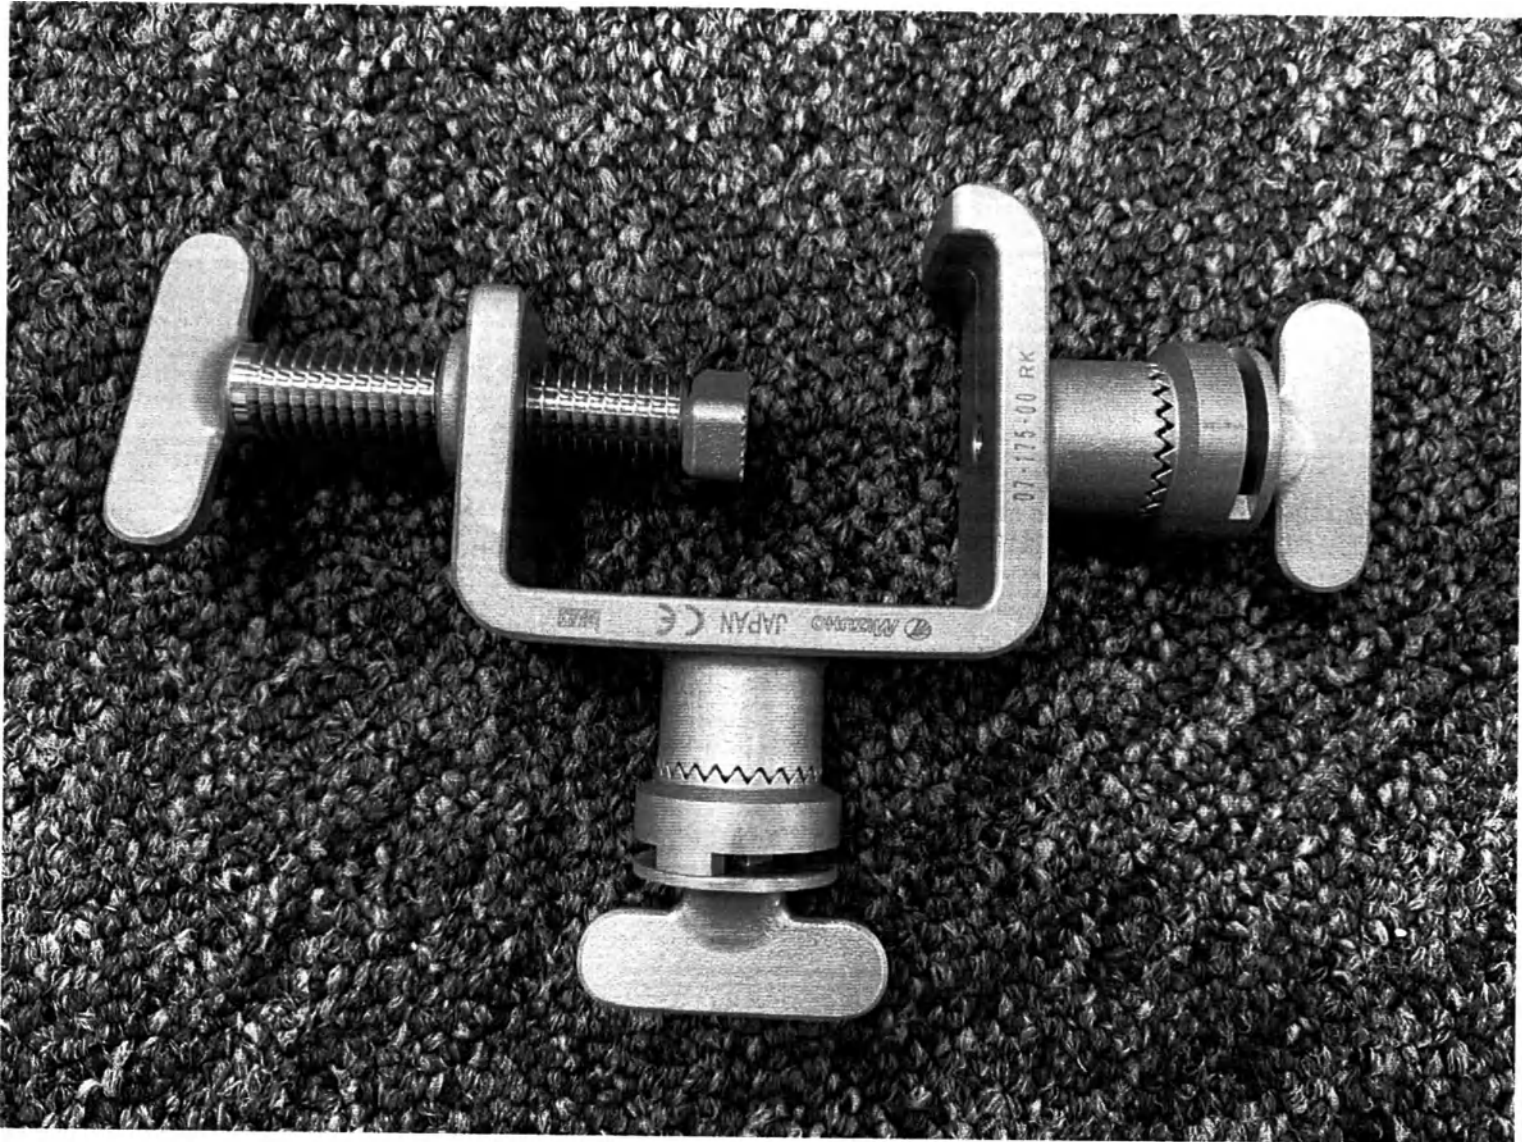


Фото 38. Фиксатор F-1 самоудерживающегося ретрактора (упаковка)



Фото 39. Фиксатор F-1 самоудерживающегося ретрактора (упаковка)

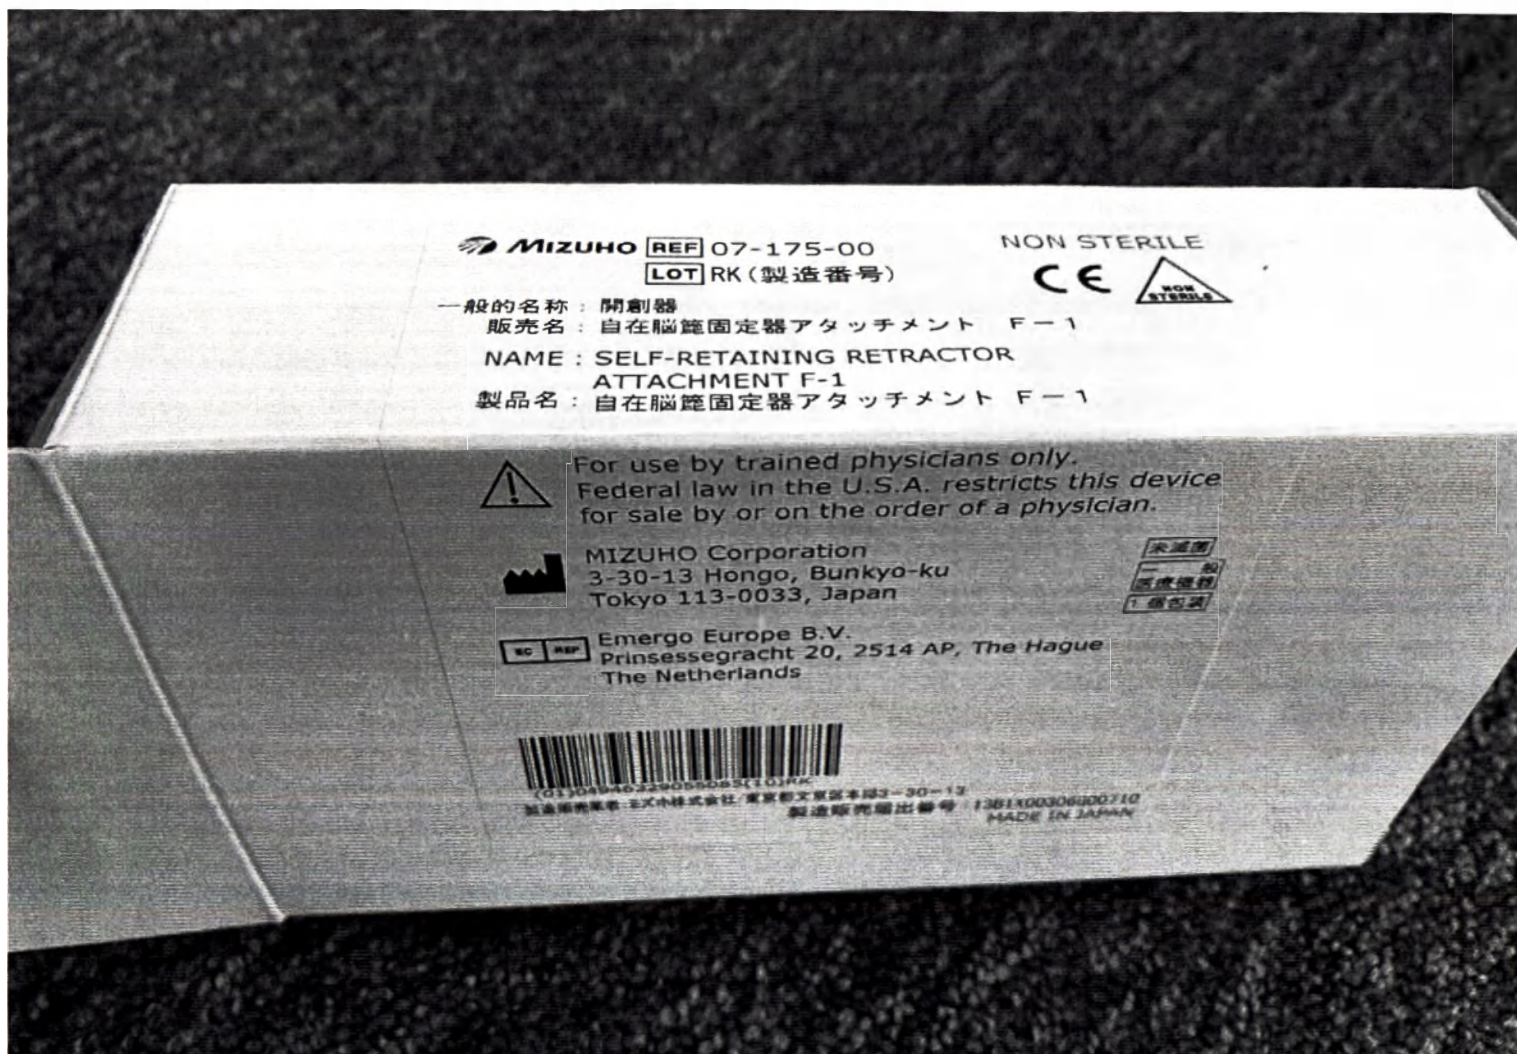


Фото 40. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 37 см

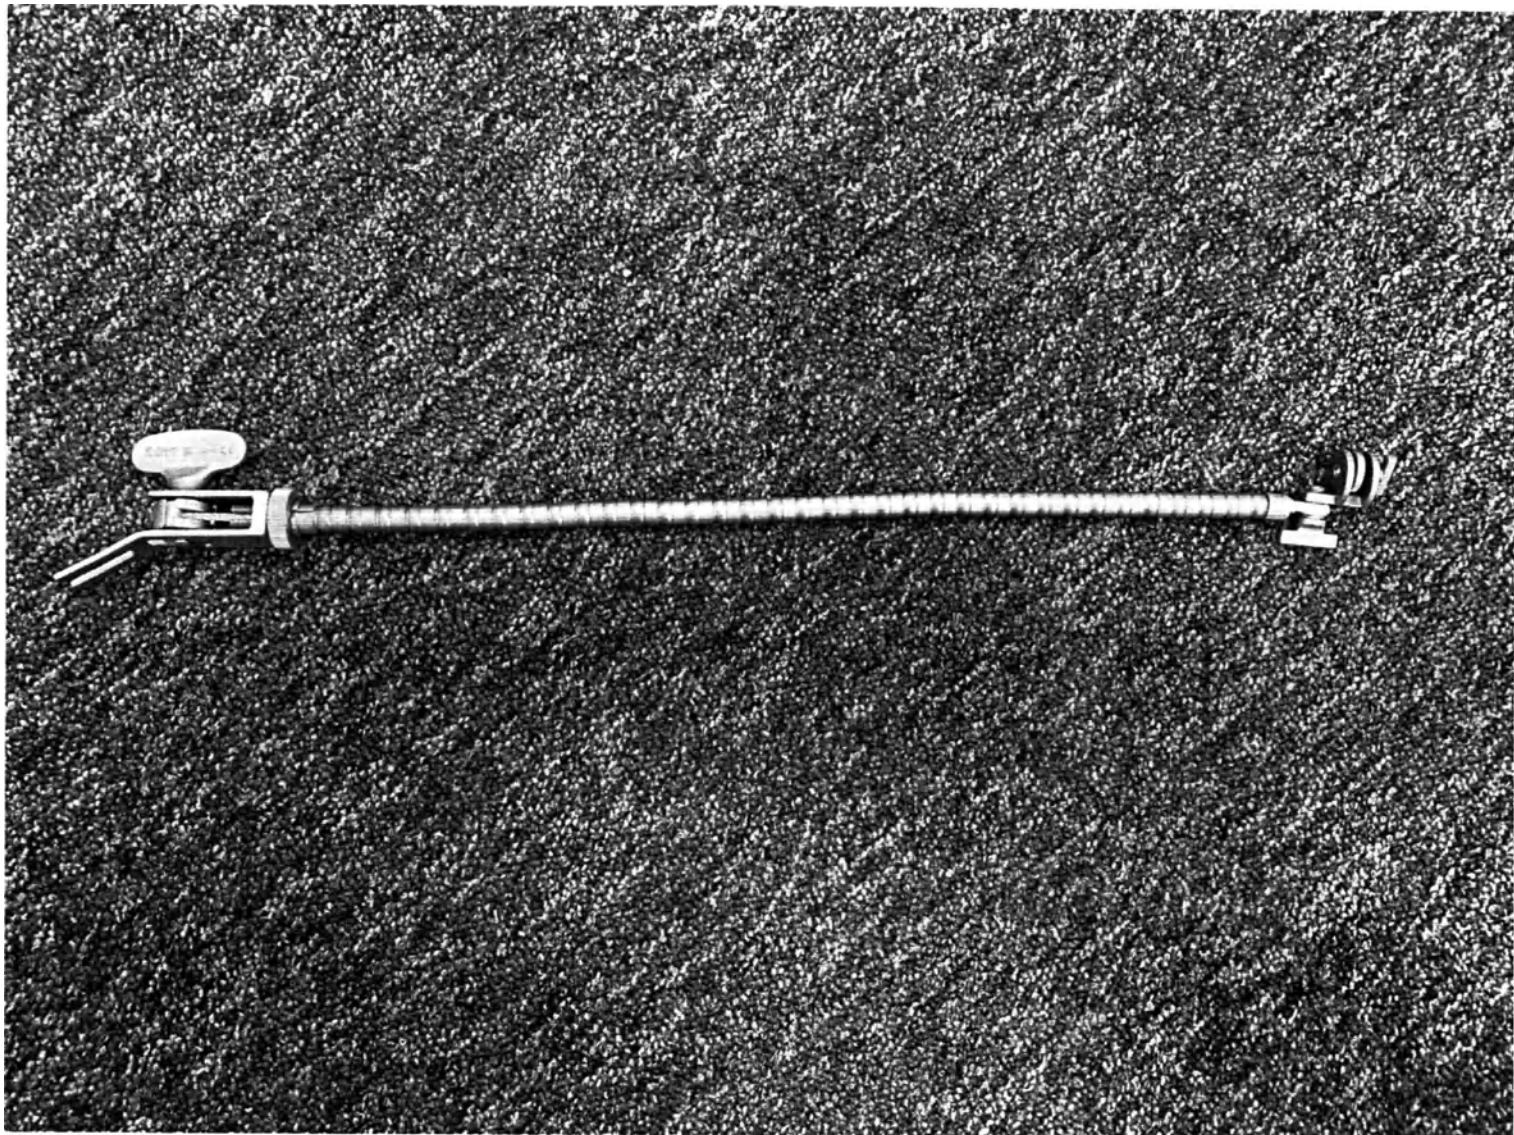


Фото 41. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 37 см (упаковка)

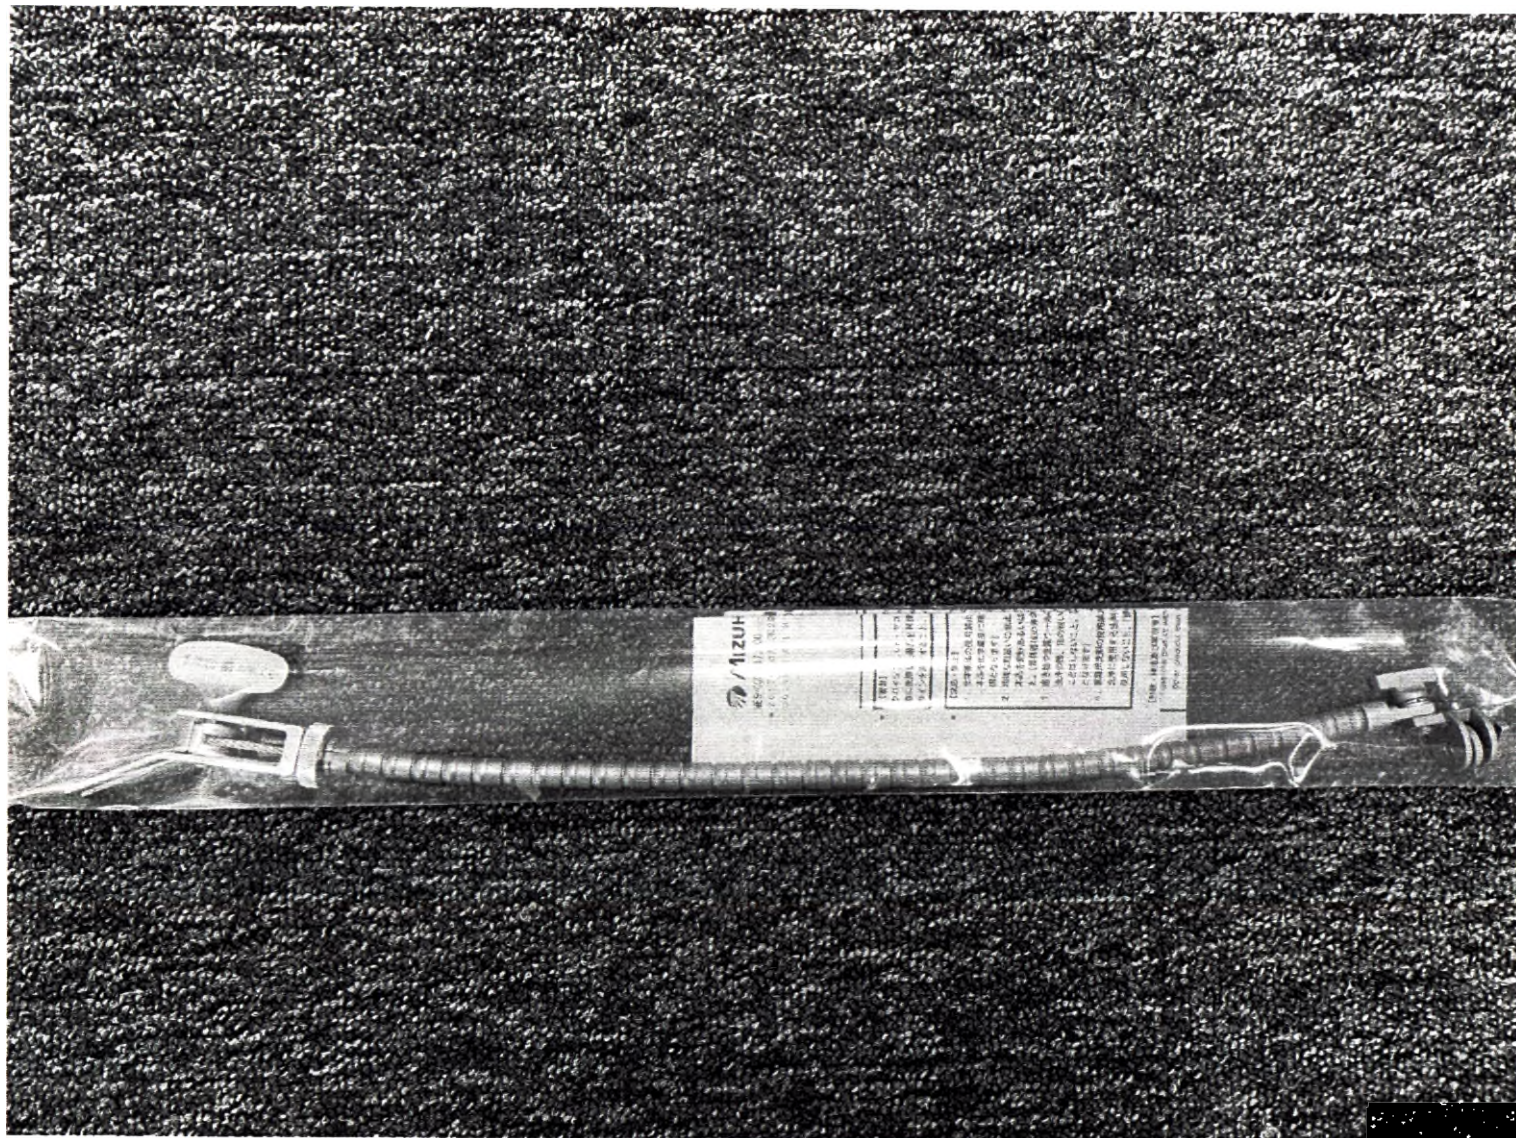


Фото 42. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 37 см (упаковка)



Фото 43. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 42 см

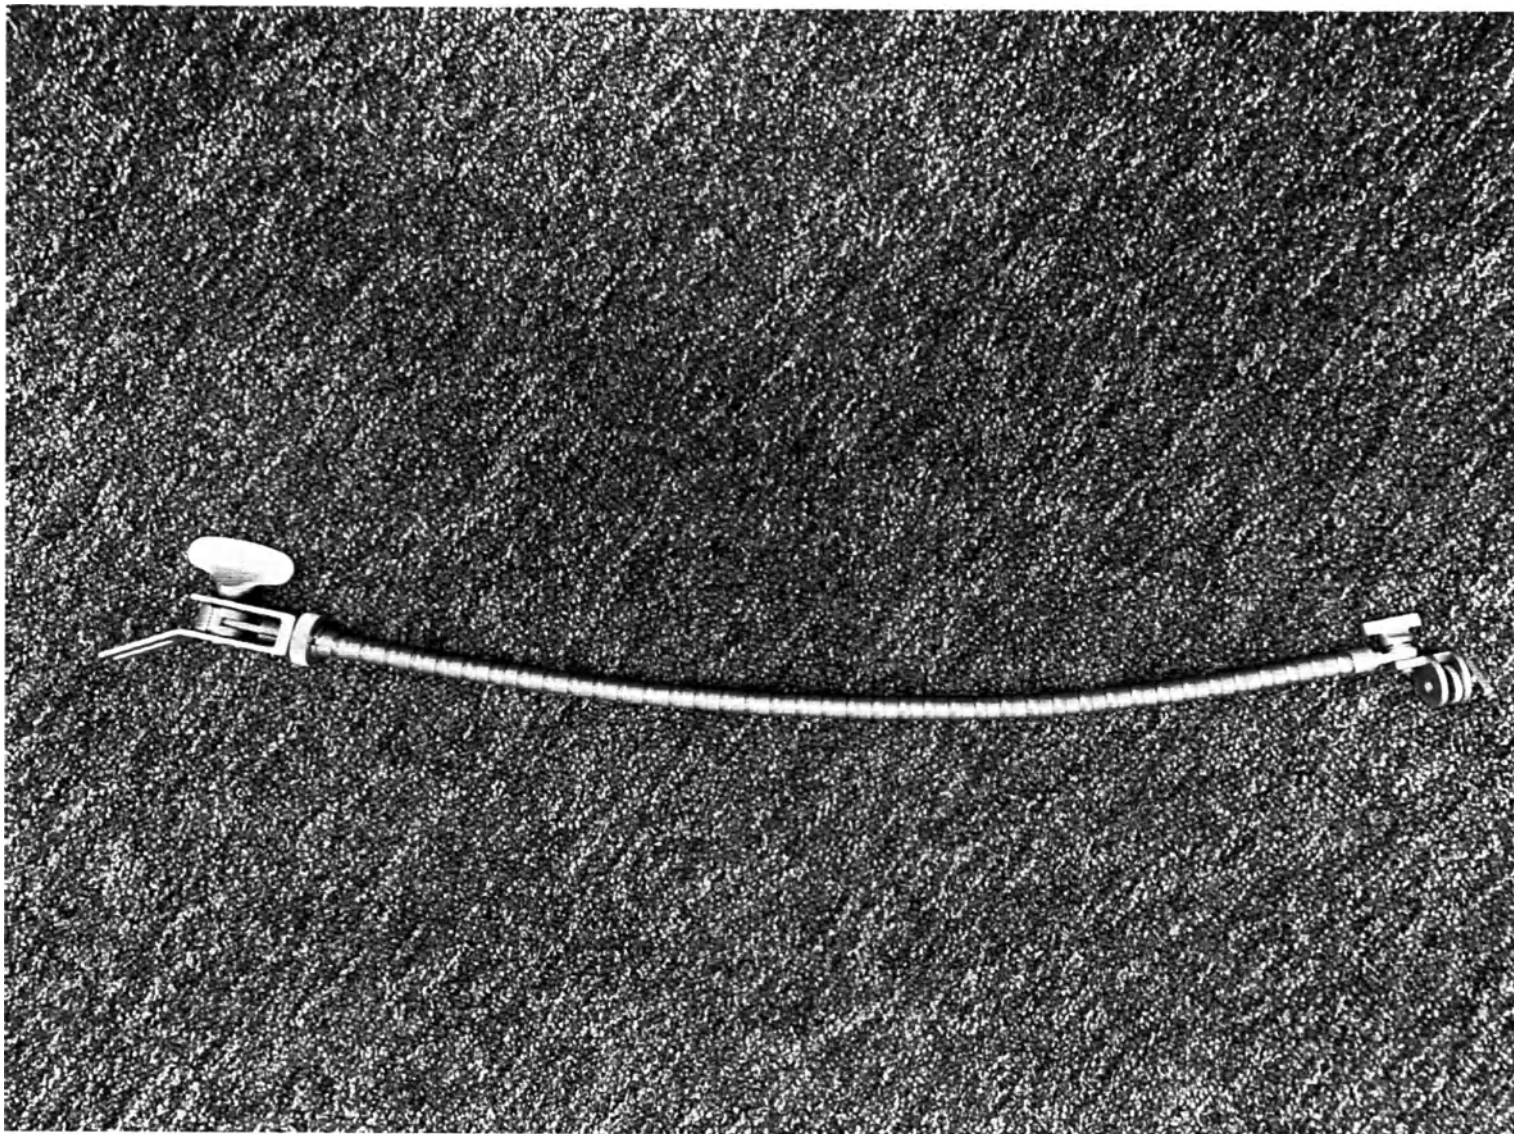


Фото 44. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 42 см (упаковка)

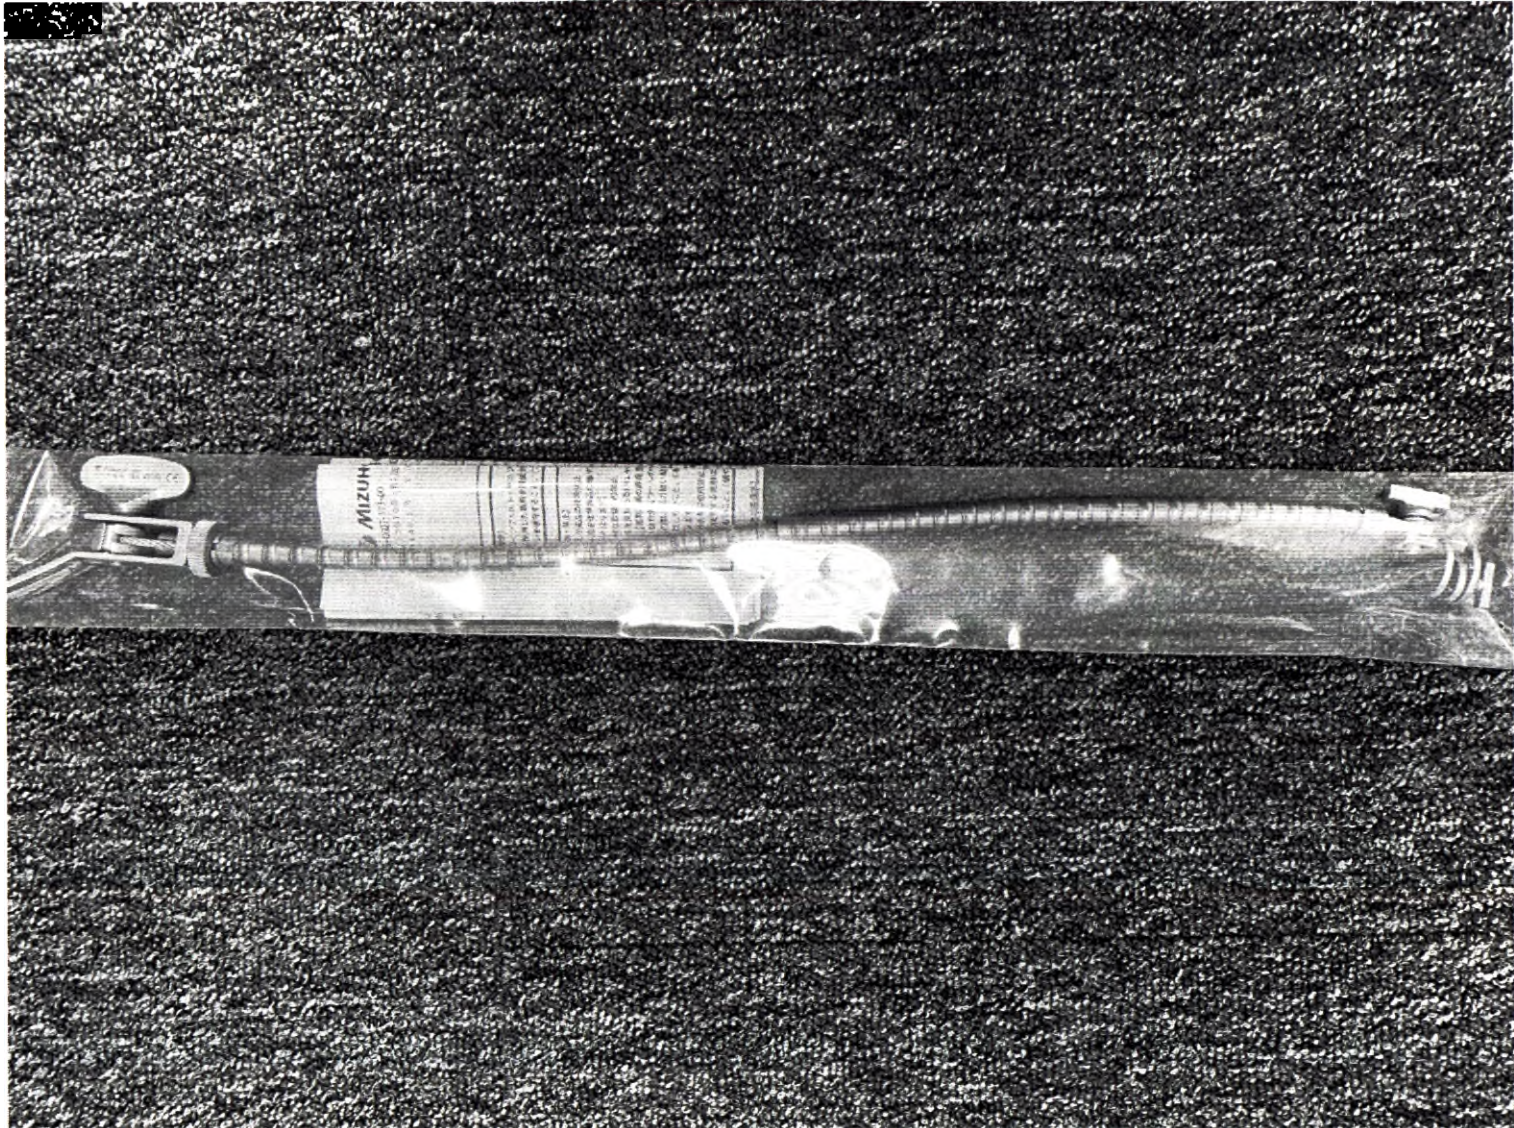
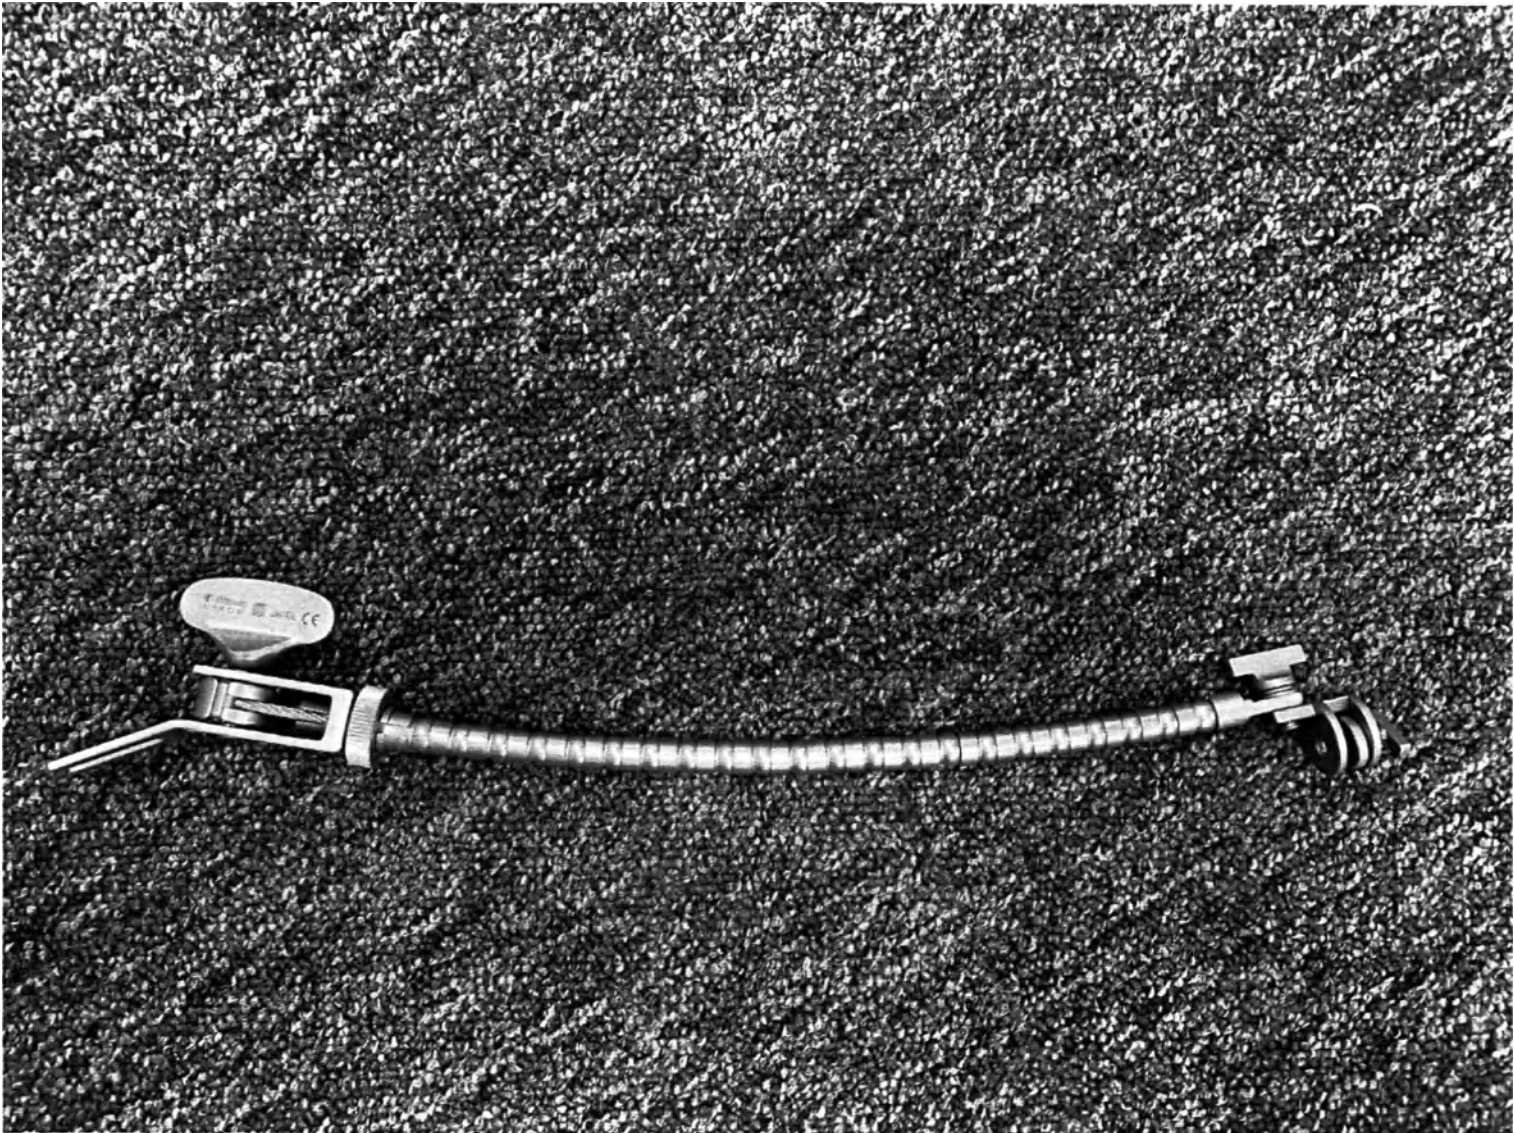


Фото 45. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 42 см (упаковка)



Фото 46. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 24 см



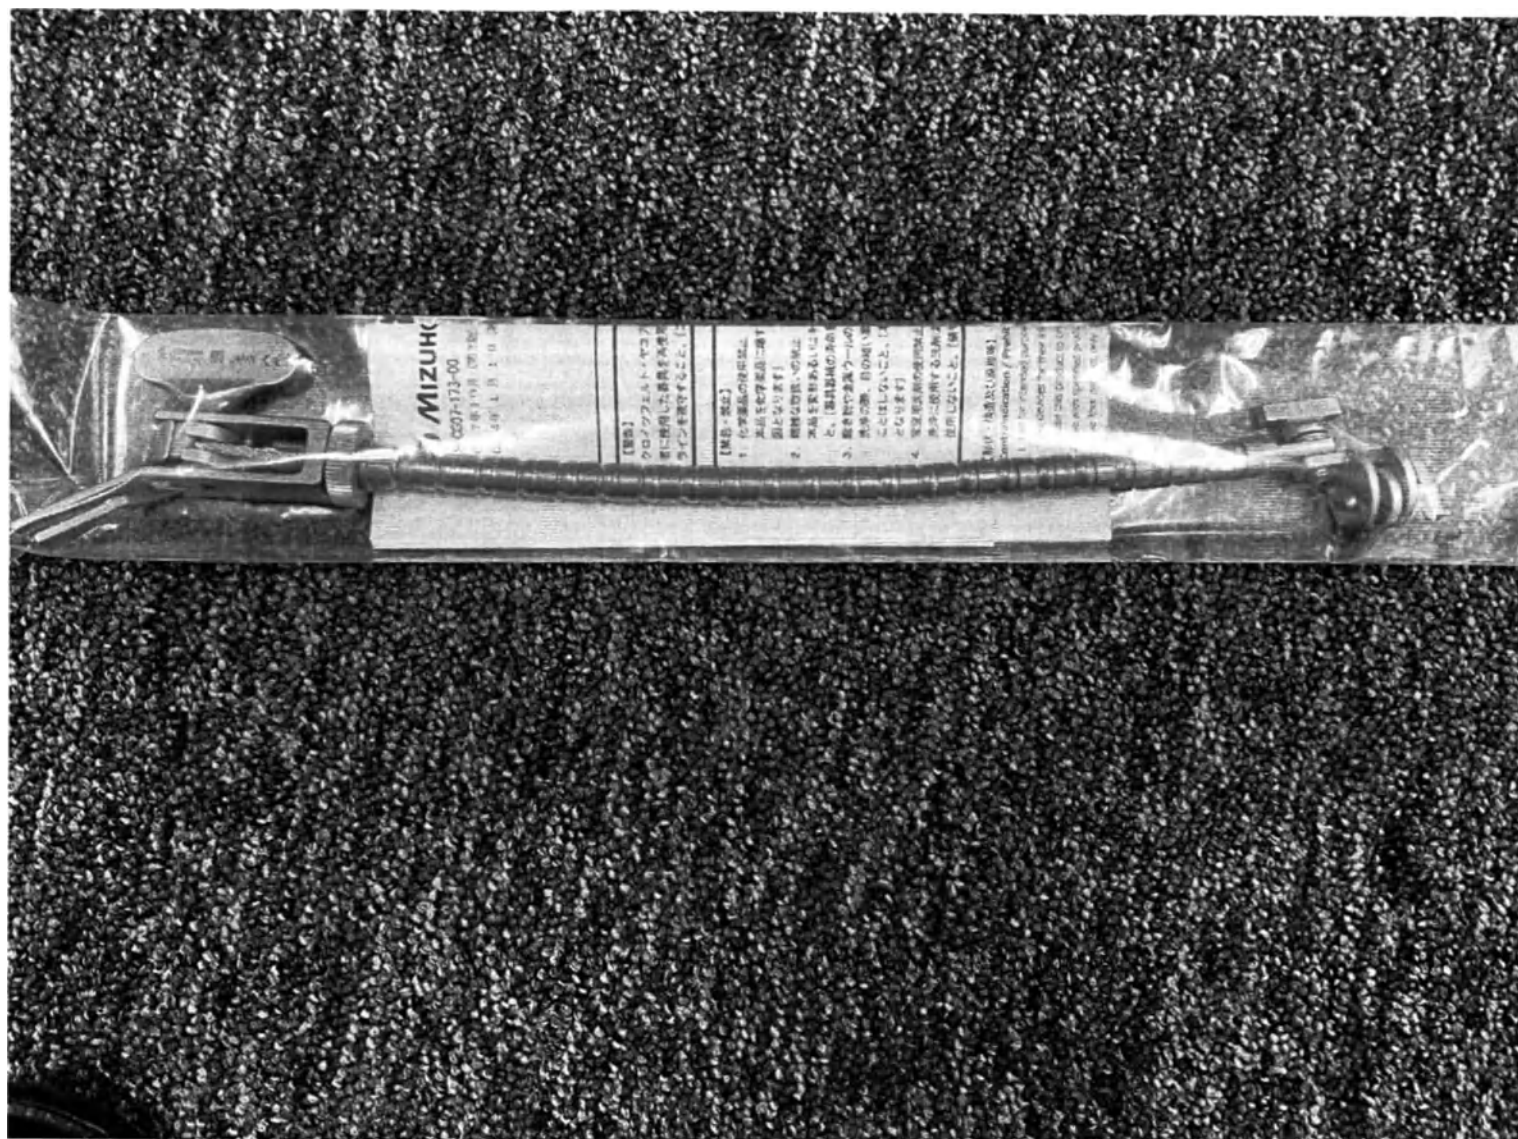


Фото 48. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 24 см (упаковка)



MIZUHO REF 07-174-23

LOT SF (製造番号)

NON STERILE



一般名称：開創器

販売名：ヤシヤルギル型脳箆固定器

NAME : SELF-RETAINING RETRACTOR

STAINLESS STEEL 24cm


製品名：ヤシヤルギル脳箆固定器 固定金具除 24cm



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands

Фото 49. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 48 см

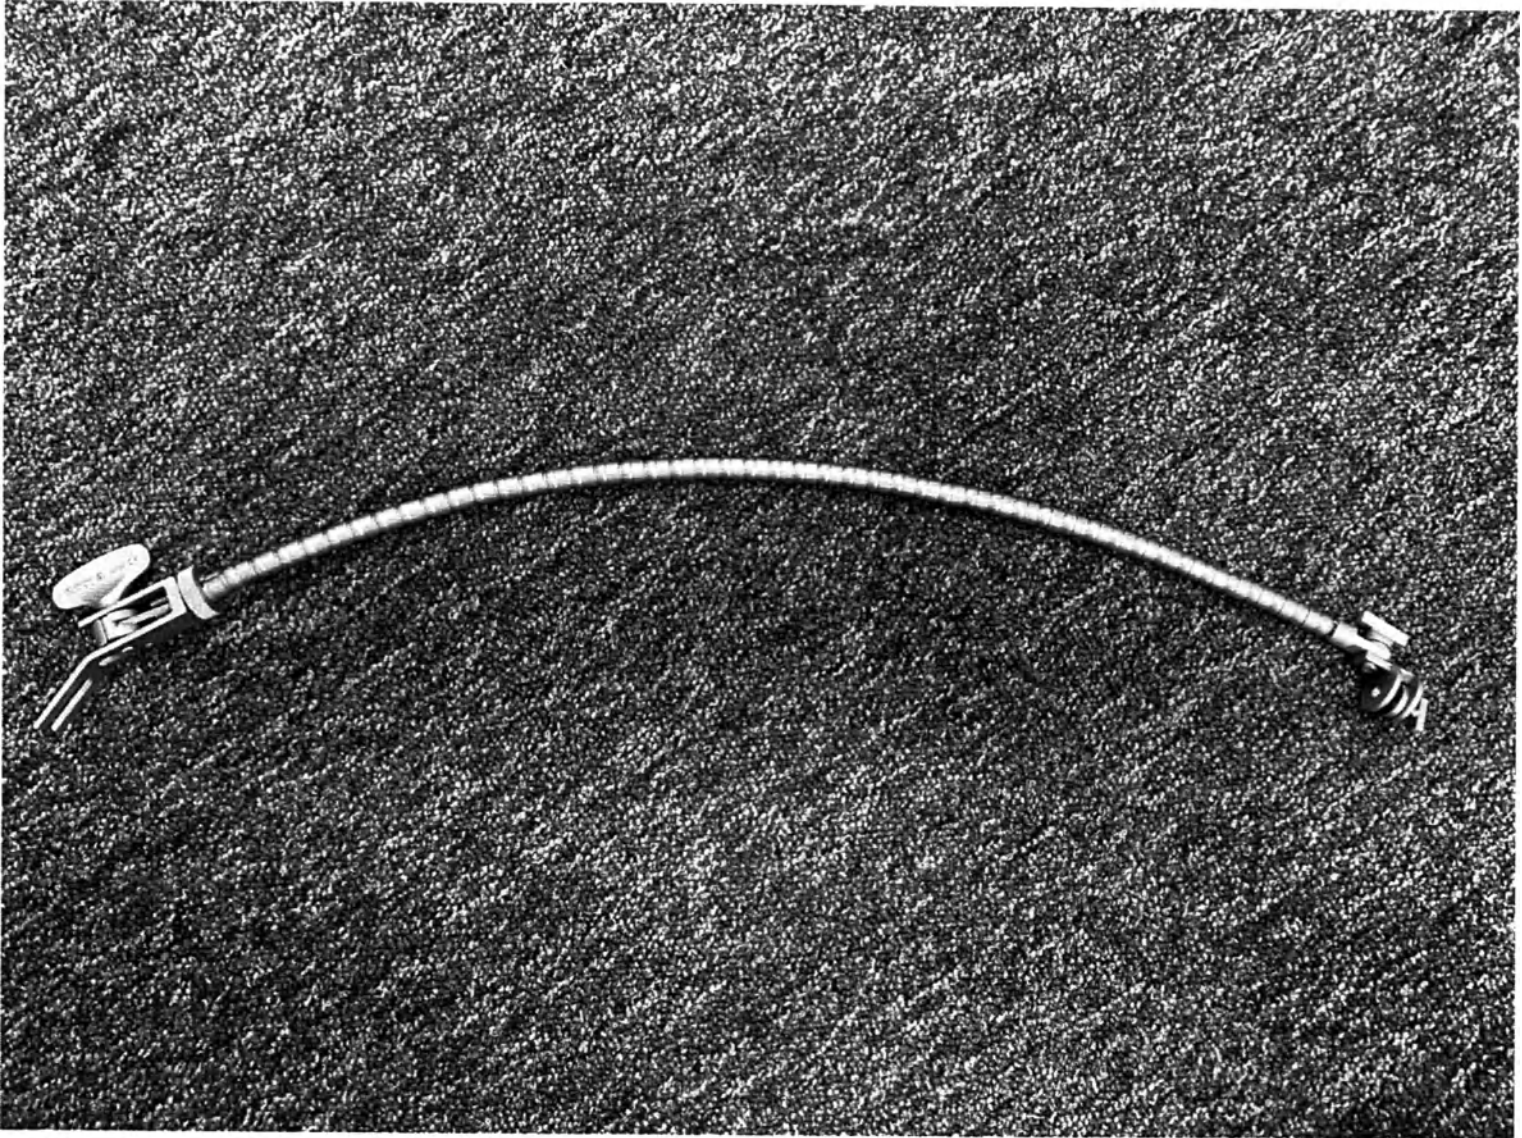


Фото 50. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 48 см (упаковка)

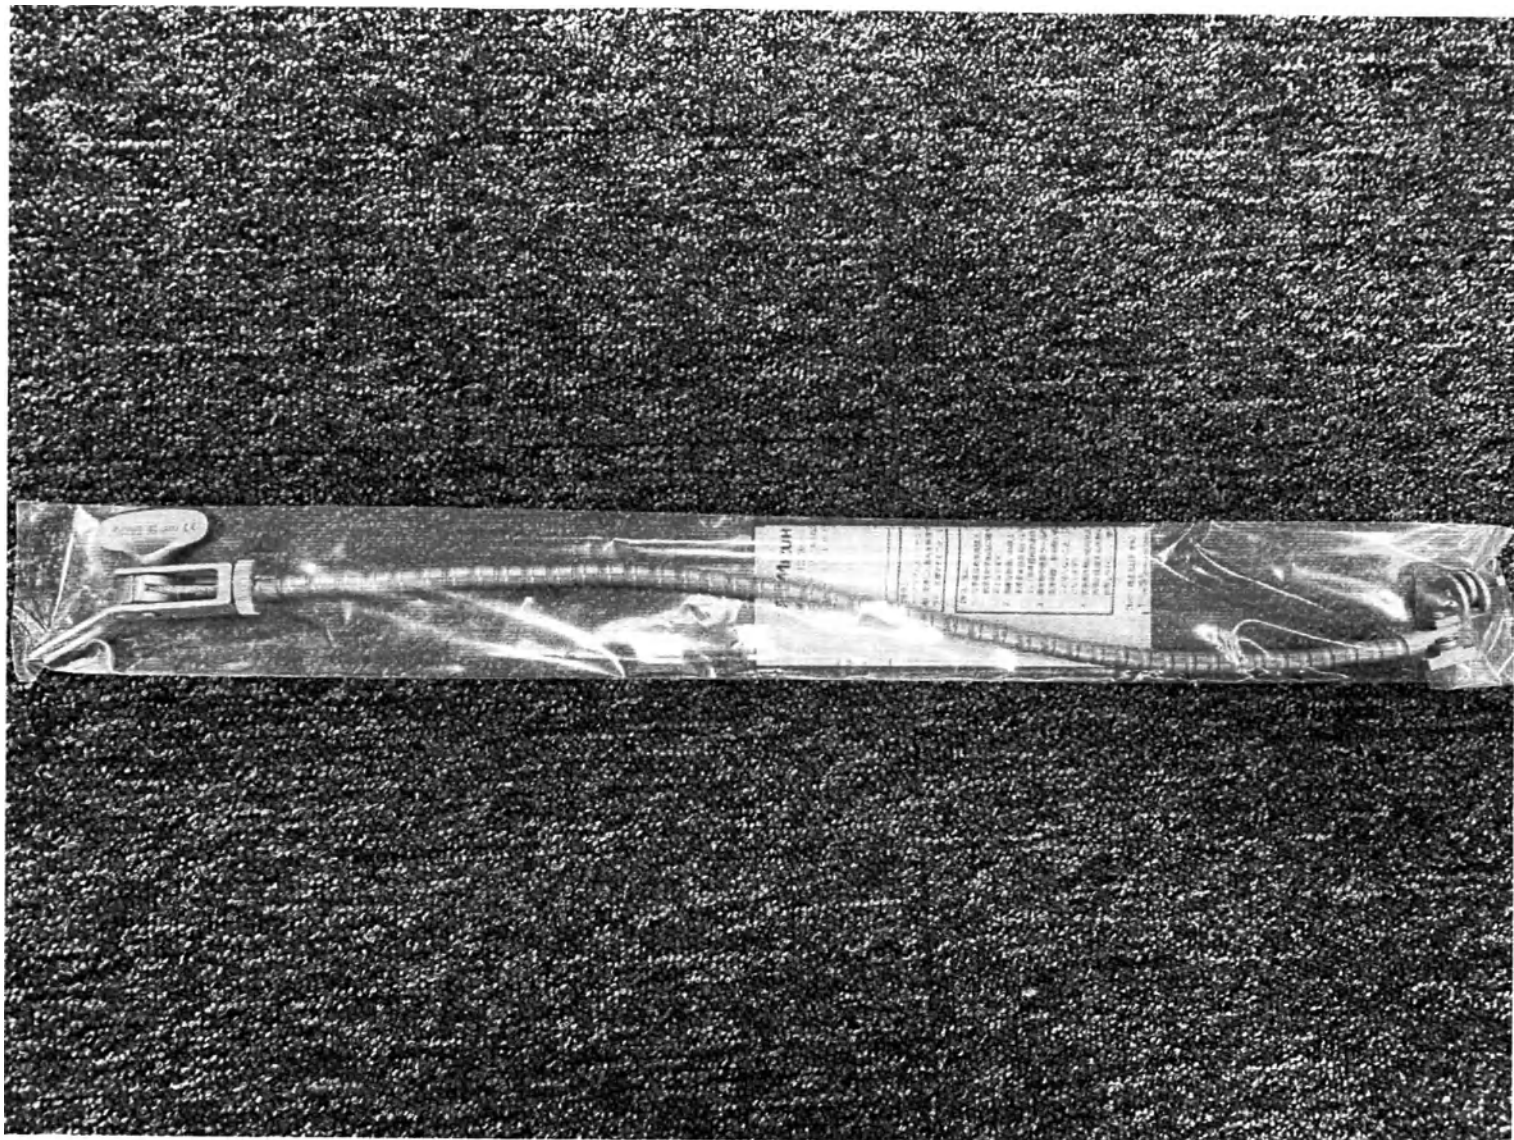


Фото 51. Самоудерживающийся ретрактор из нержавеющей стали 48 см (упаковка)



Фото 52. Конический самоудерживающийся ретрактор 5мм 37 см (версия hadeishi)

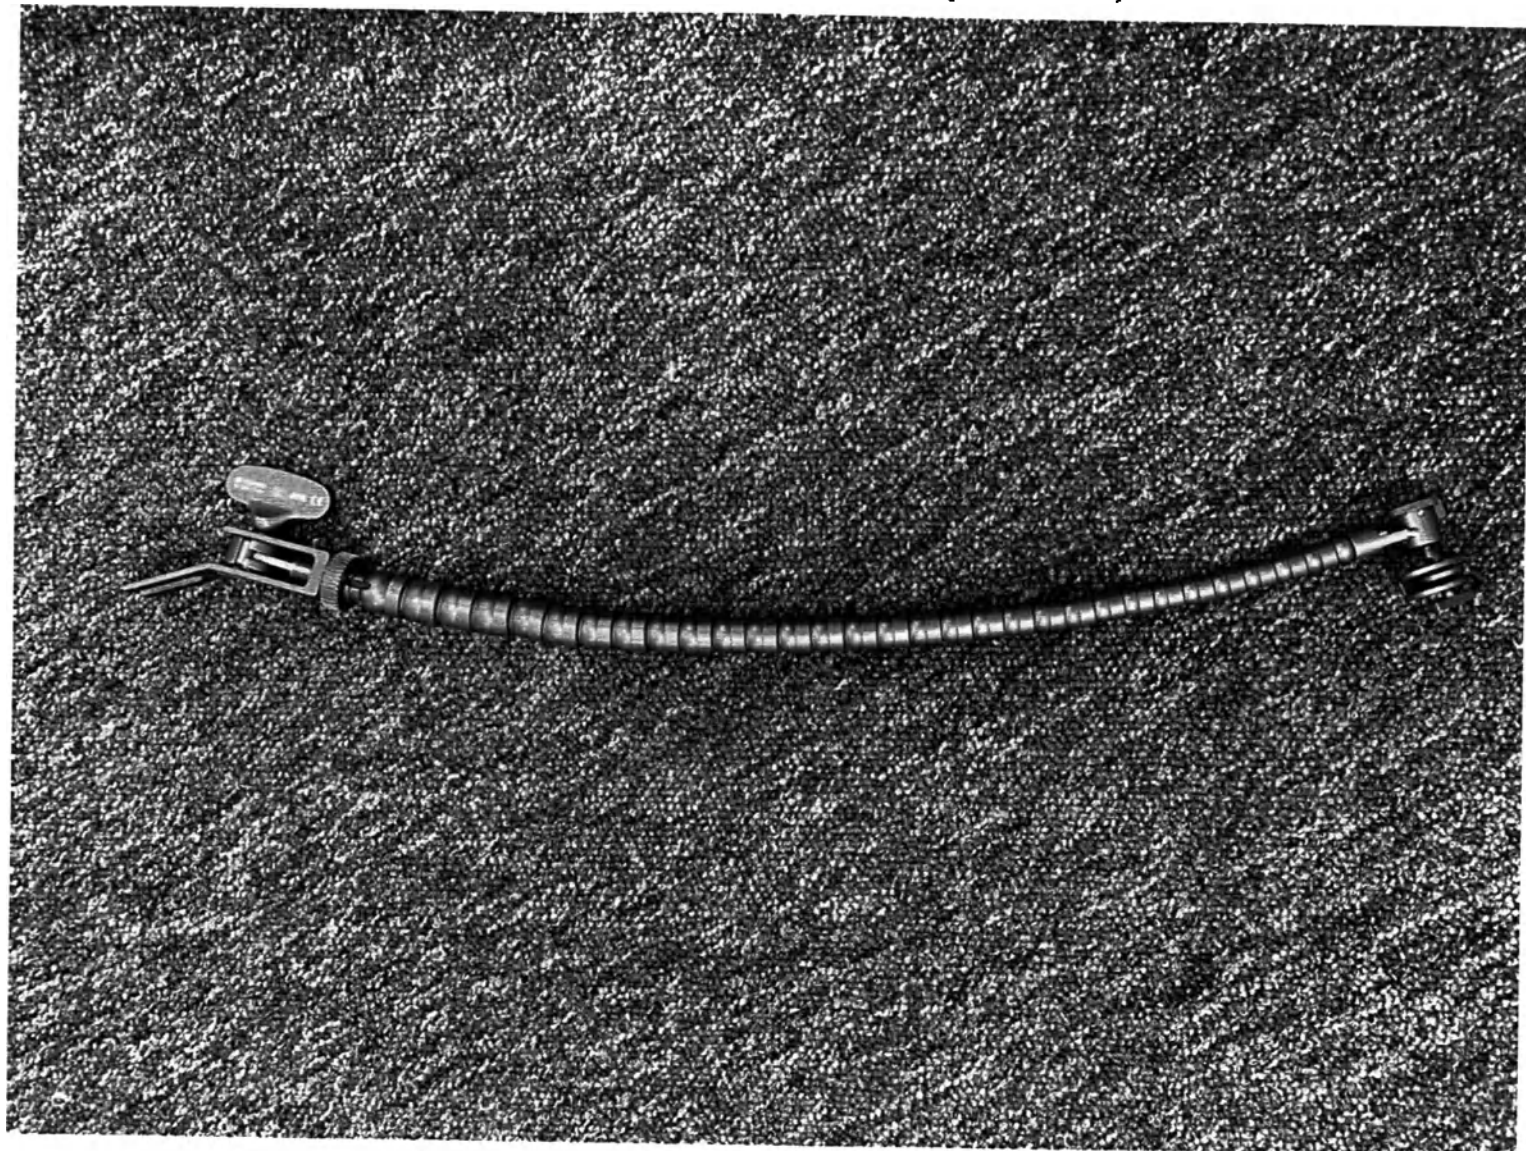


Фото 53. Конический самоудерживающийся ретрактор 5мм 37 см (версия hadeishi) (упаковка)

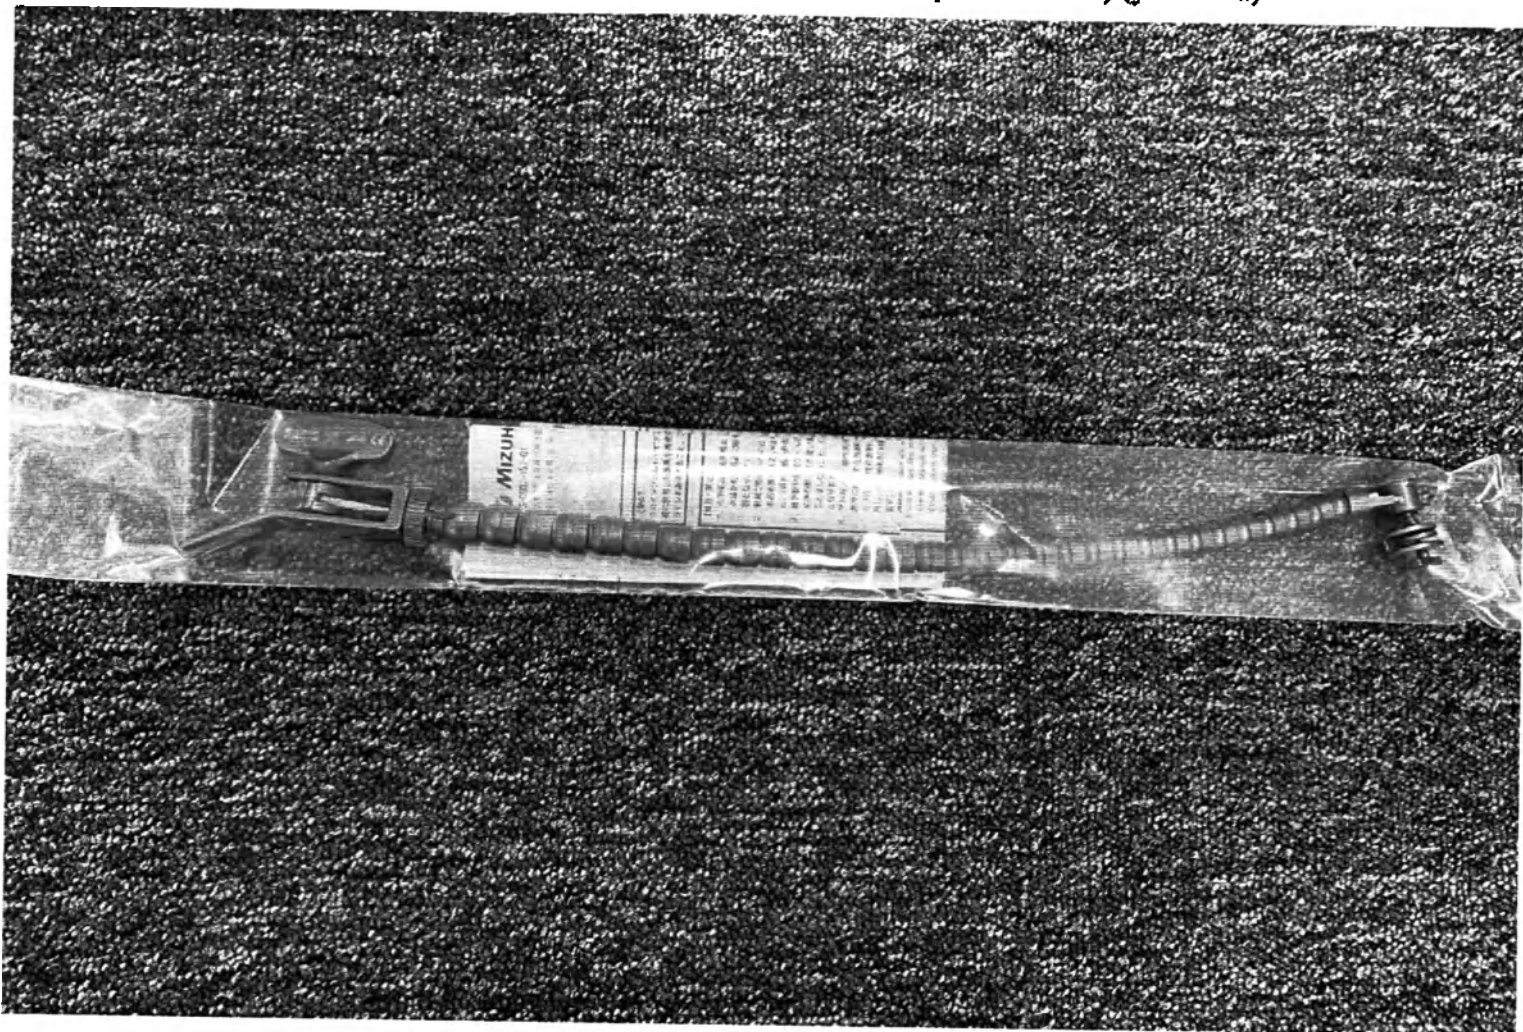


Фото 54. Конический самоудерживающийся ретрактор 5мм 37 см (версия hadeishi) (упаковка)



Фото 55. Конический самоудерживающийся ретрактор 6мм 37 см (версия hadeishi)

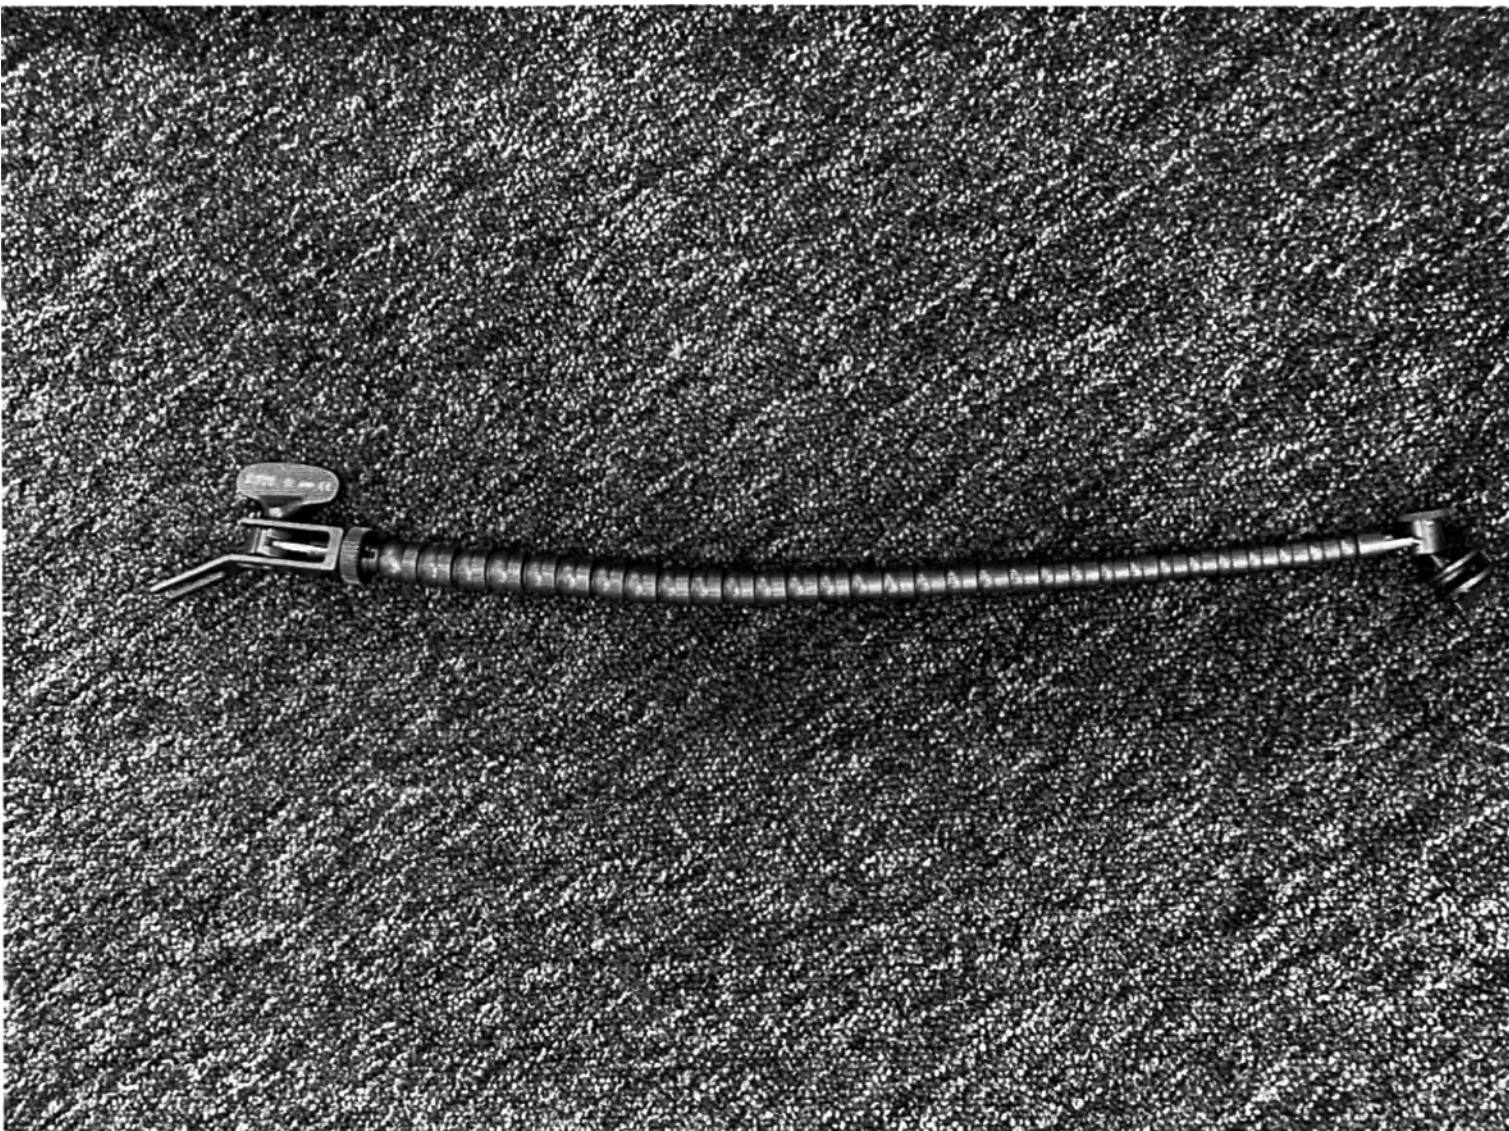


Фото 56. Конический самоудерживающийся ретрактор 6мм 37 см (версия hadeishi) (упаковка)

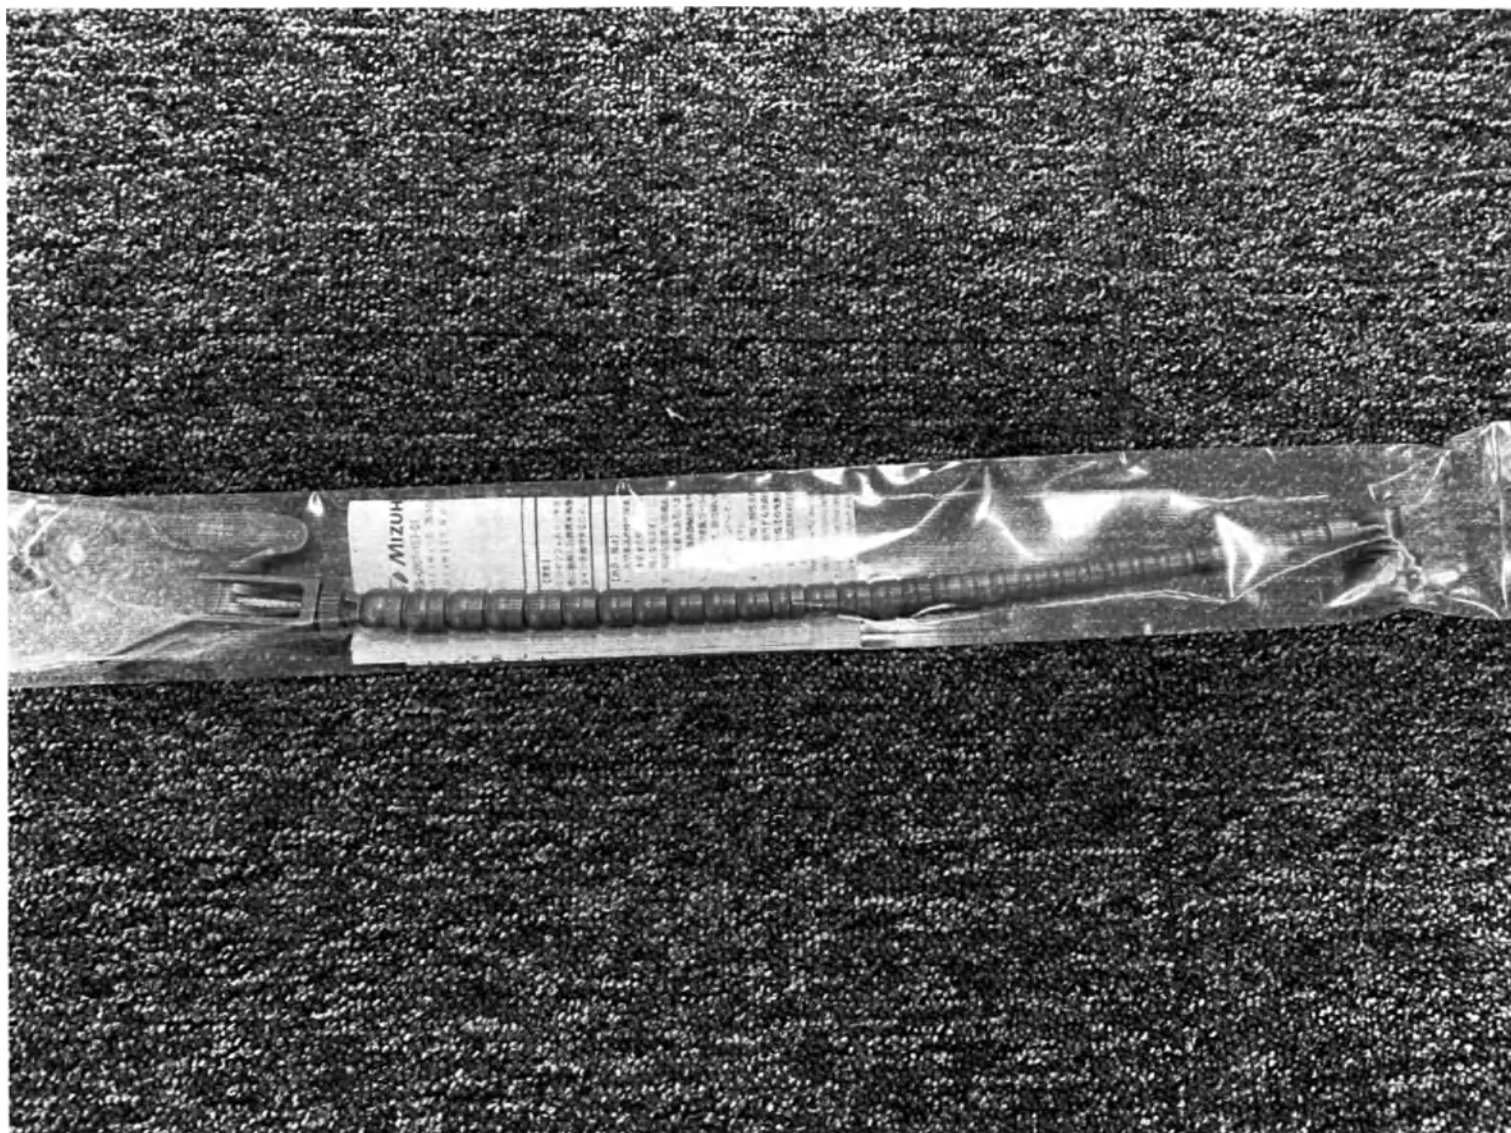


Фото 57. Конический самоудерживающийся ретрактор 6мм 37 см (версия hadeishi) (упаковка)



Фото 58. Конический самоудерживающийся ретрактор 42 см без зажима

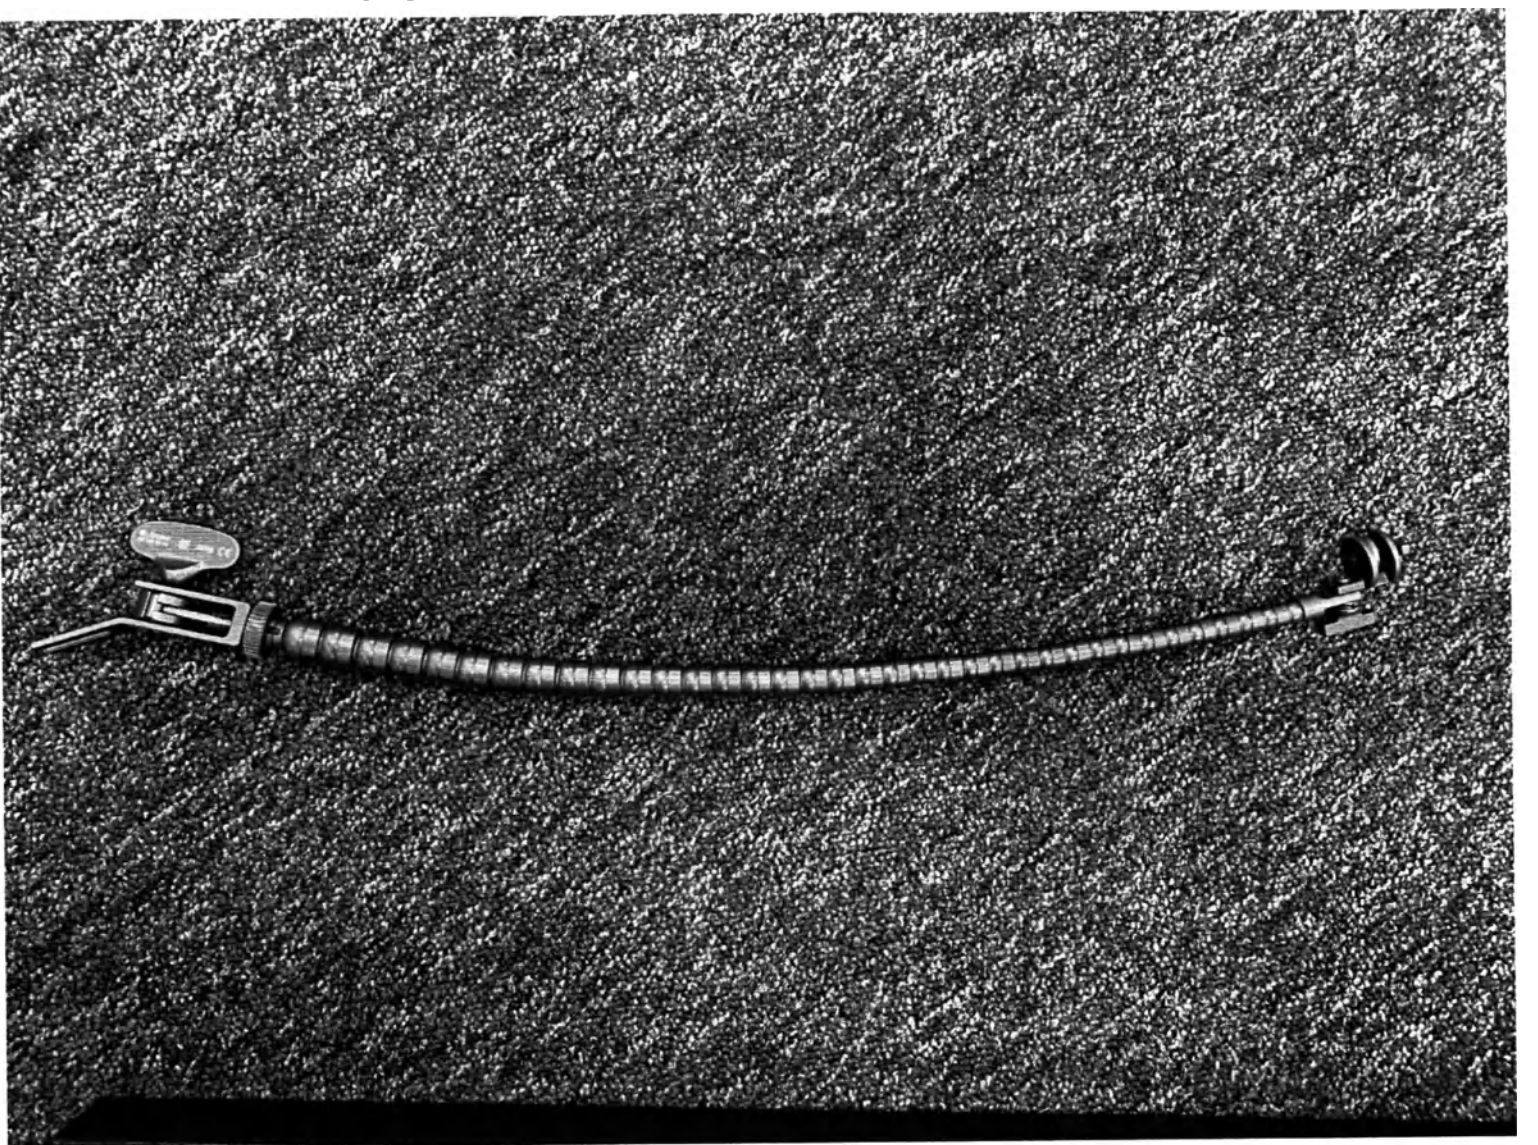


Фото 59. Конический самоудерживающийся ретрактор 42 см без зажима (упаковка)

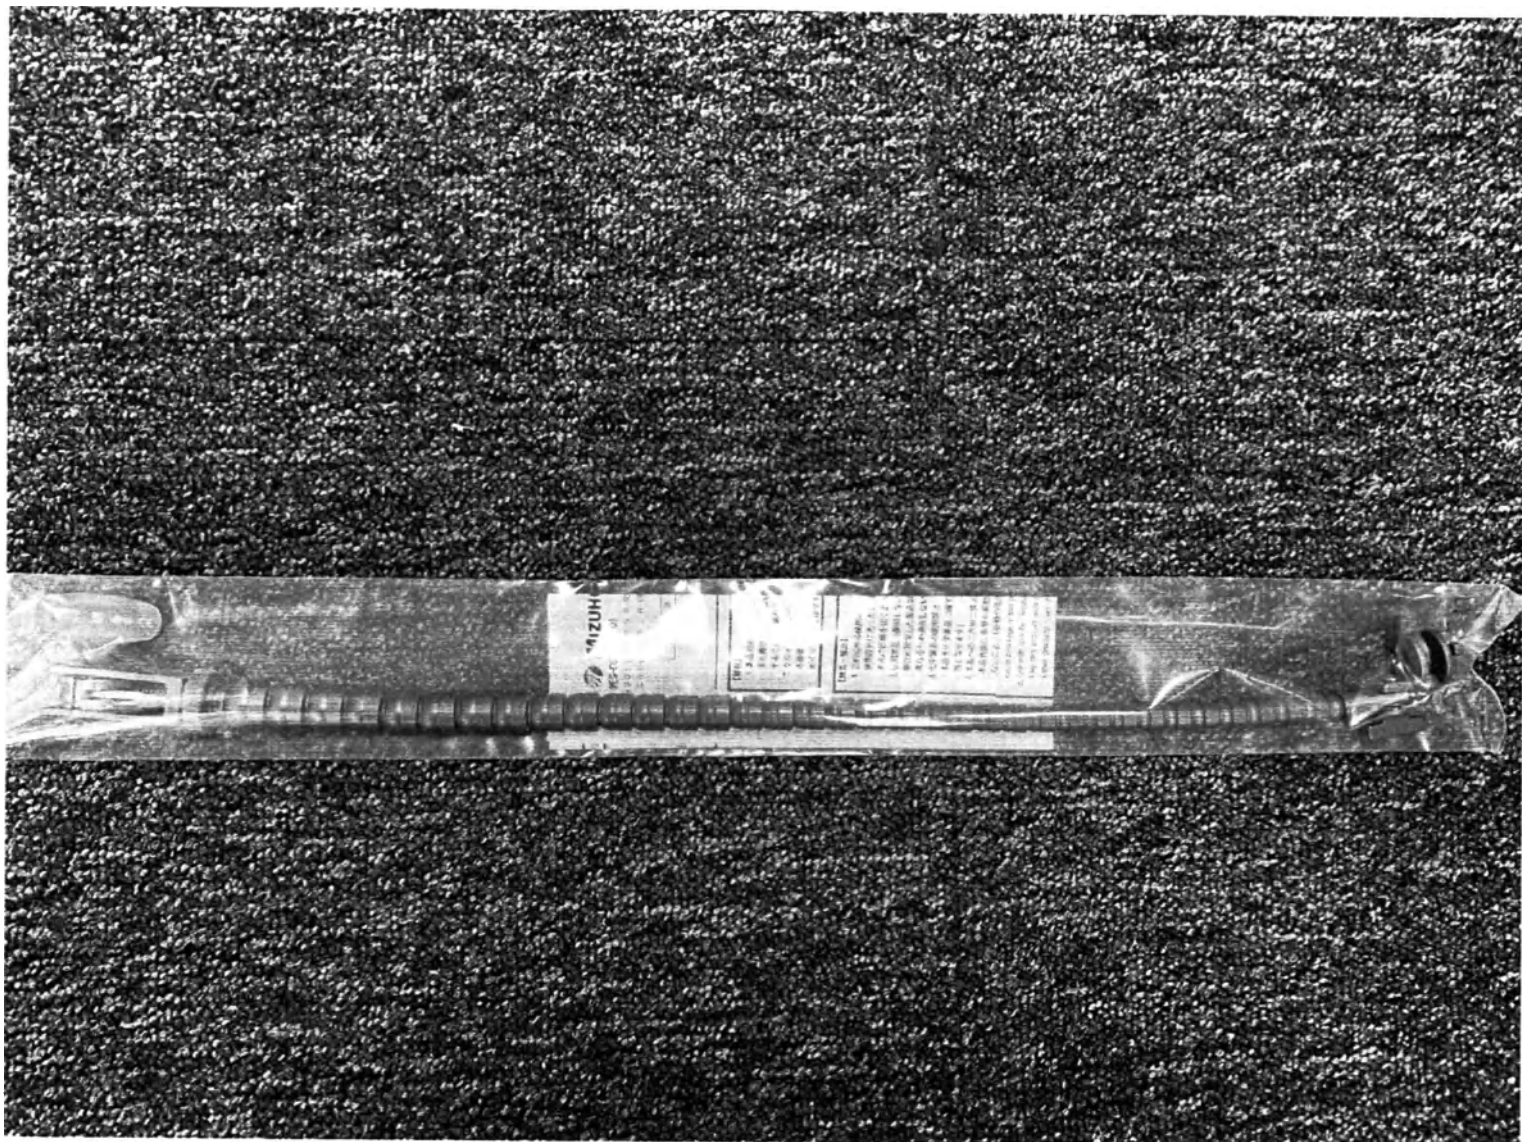


Фото 60. Конический самоудерживающийся ретрактор 42 см без зажима (упаковка)



Фото 61. Конический самоудерживающийся ретрактор 37 см без зажима

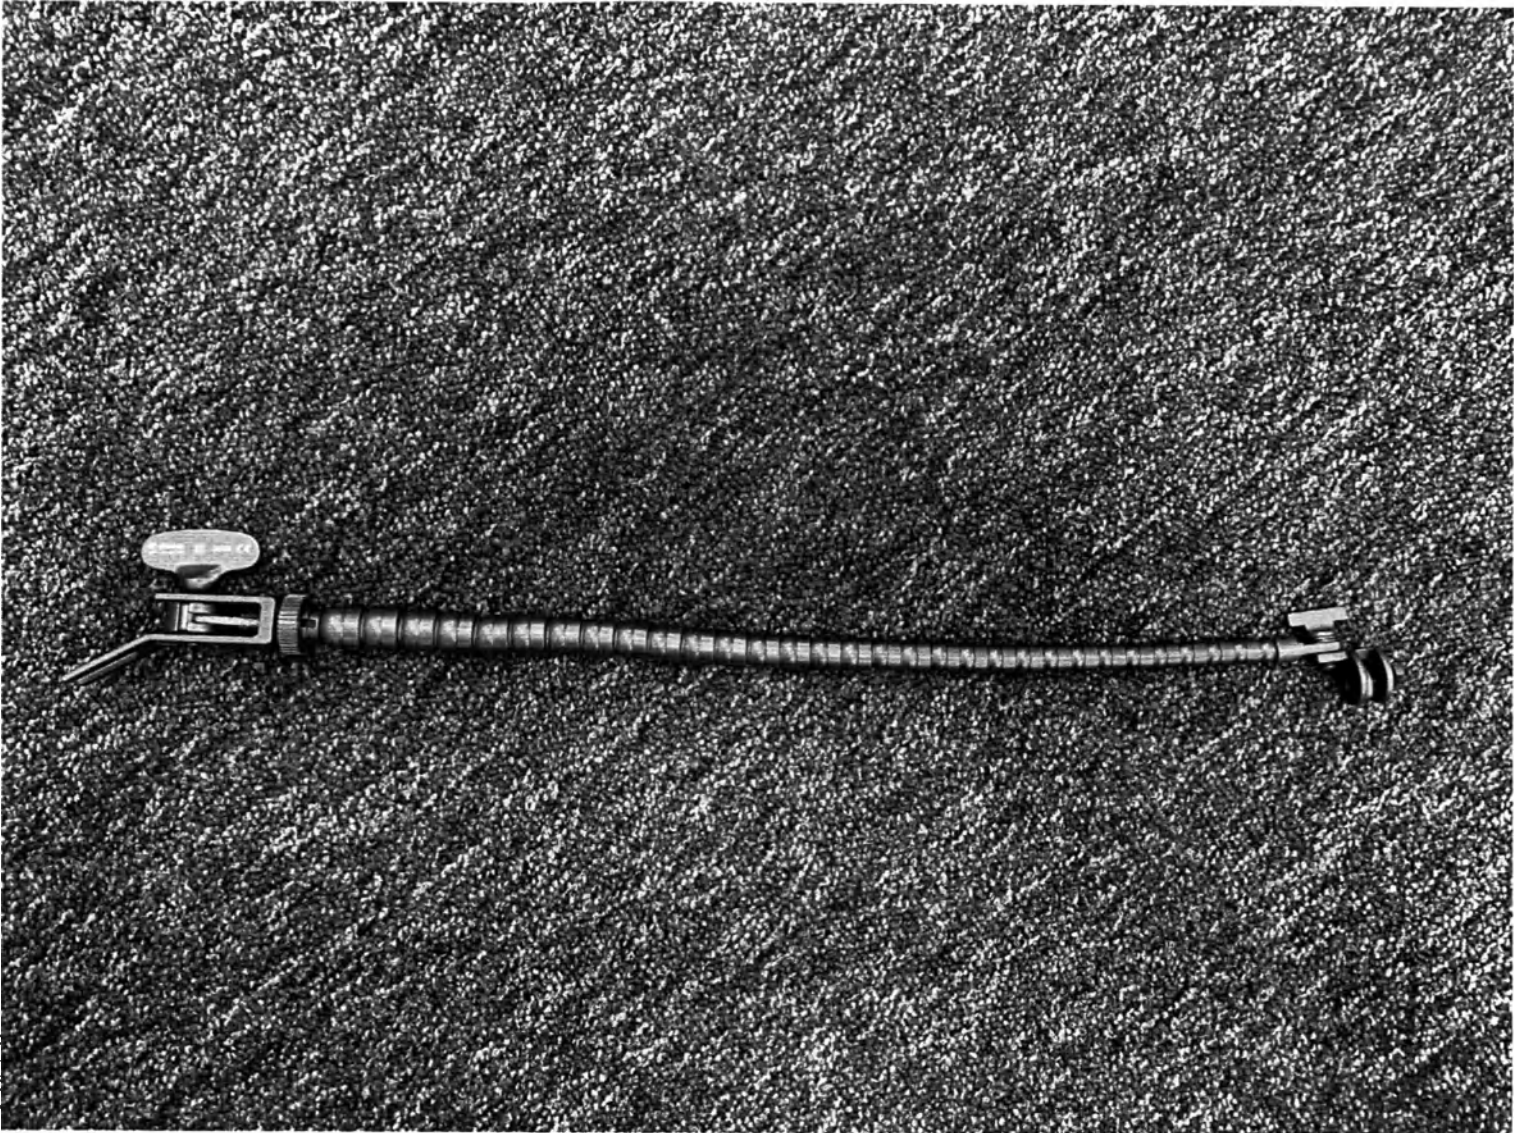


Фото 62. Конический самоудерживающийся ретрактор 37 см без зажима (упаковка)

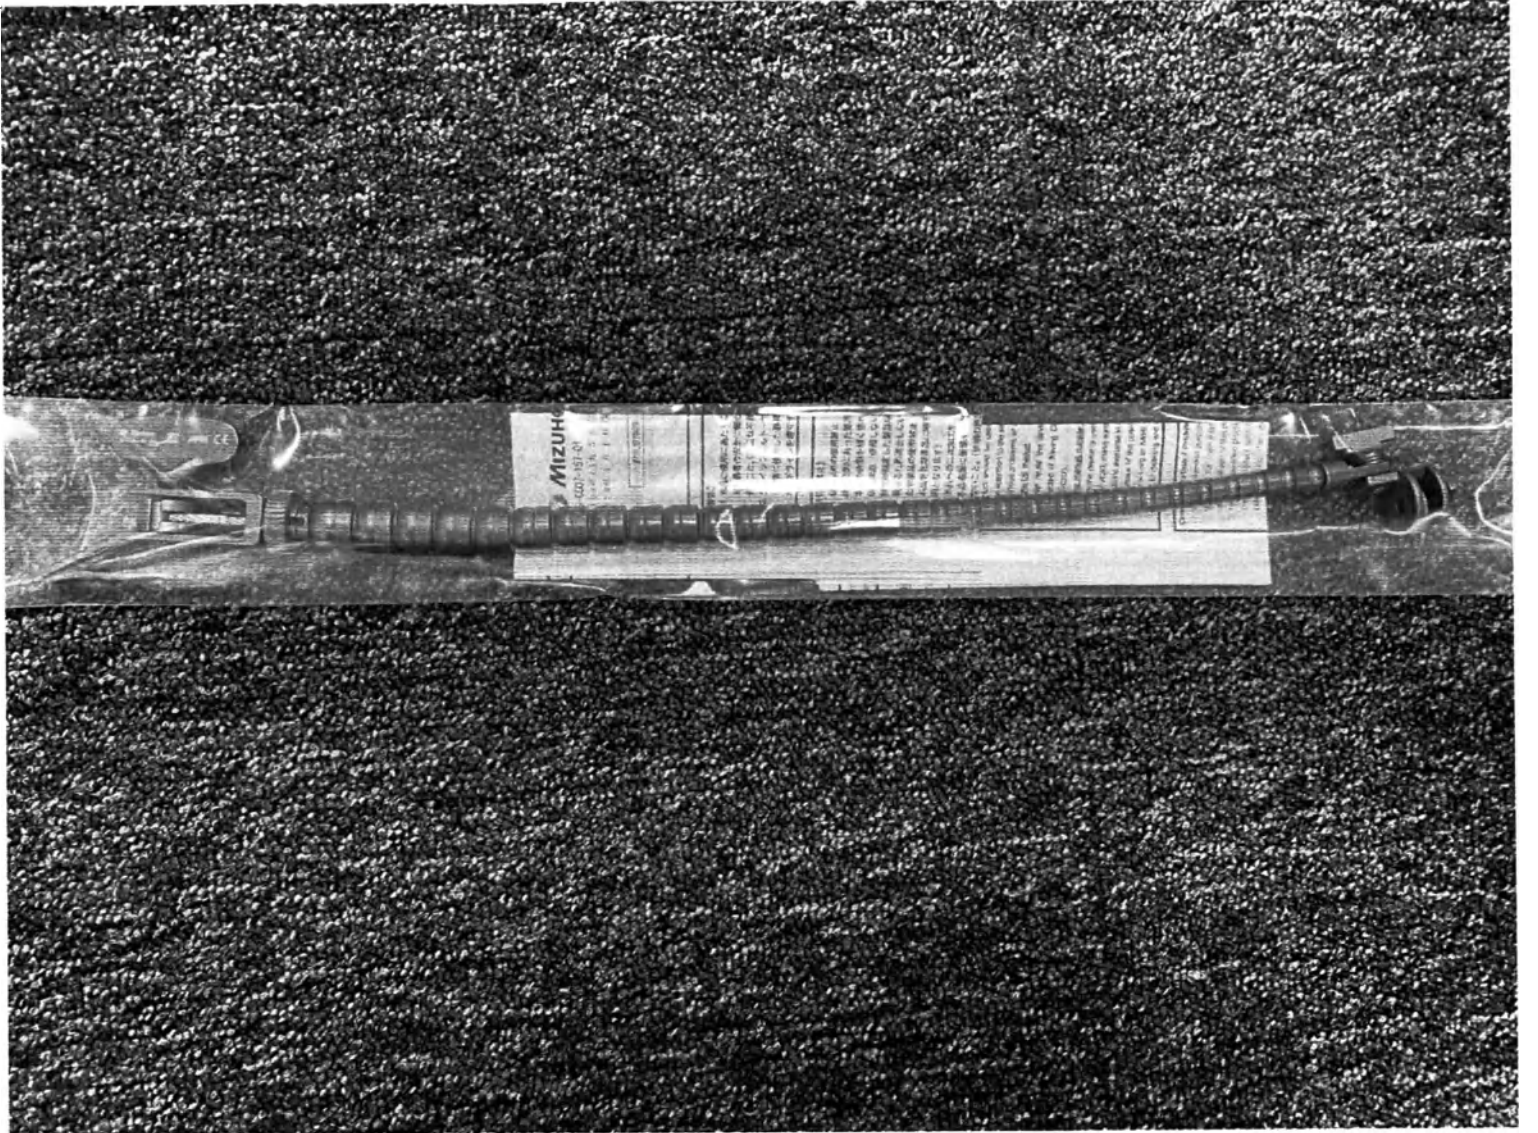


Фото 63. Конический самоудерживающийся ретрактор 37 см без зажима (упаковка)



Фото 64. Самоудерживающийся ретрактор из титана 42 см без зажима

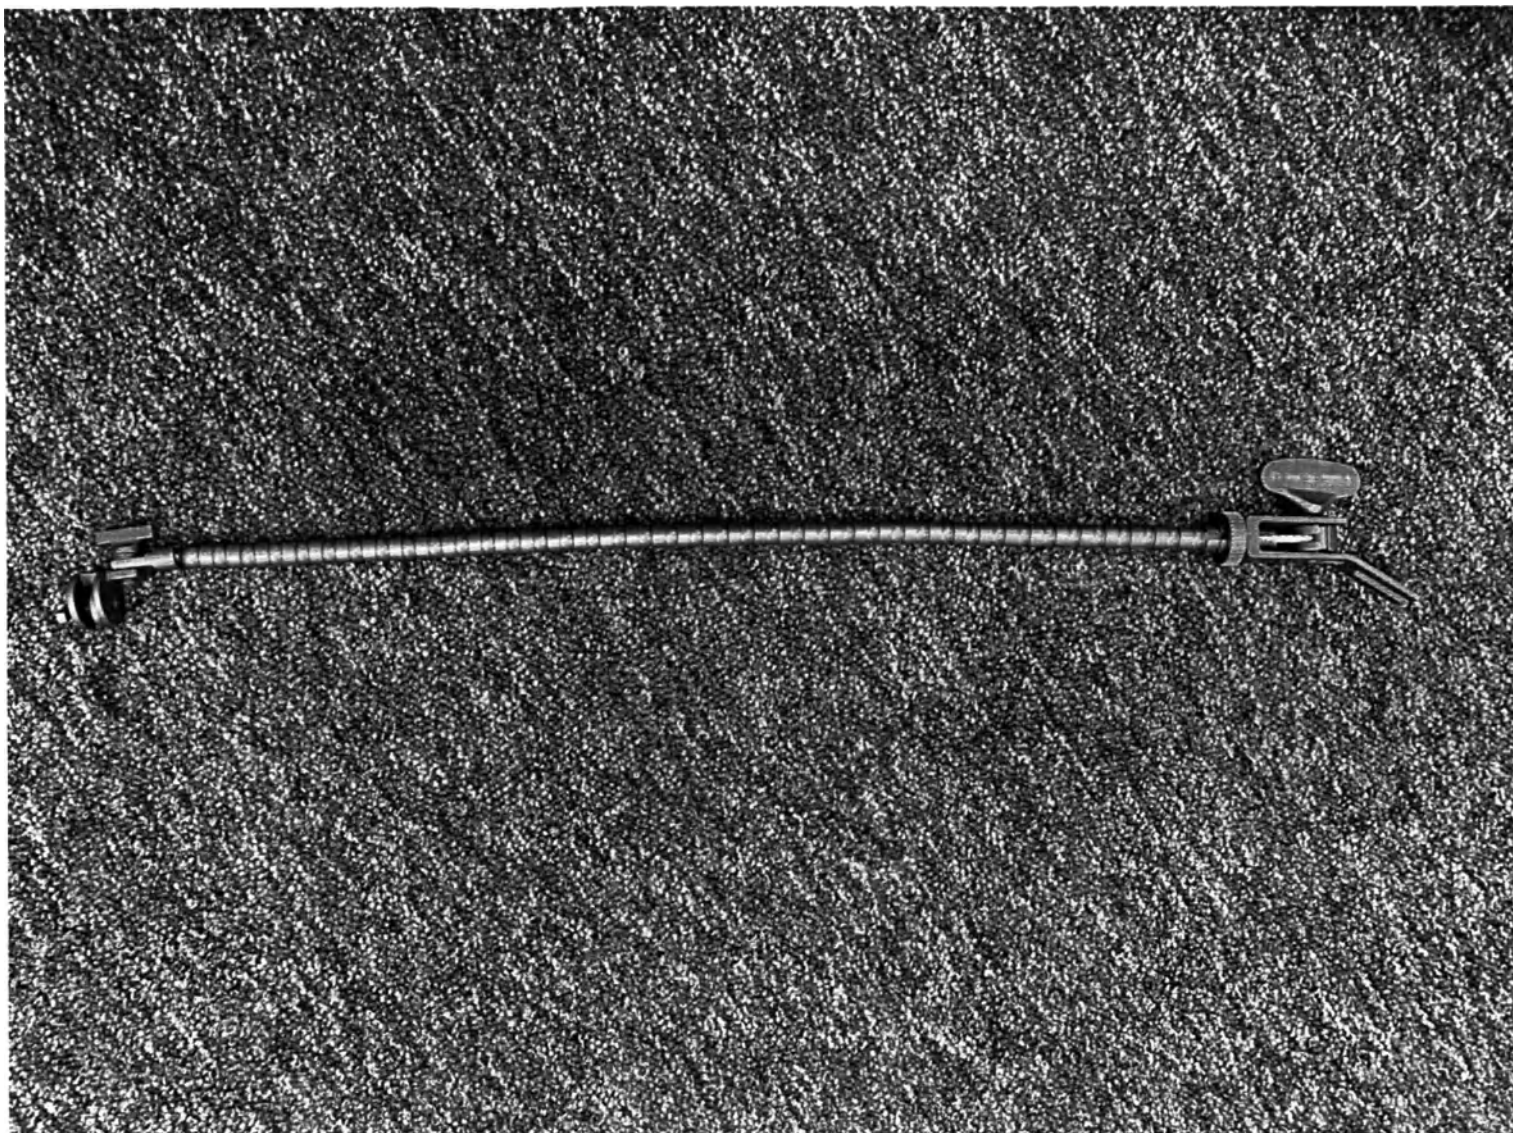


Фото 65. Самоудерживающийся ретрактор из титана 42 см без зажима (упаковка)

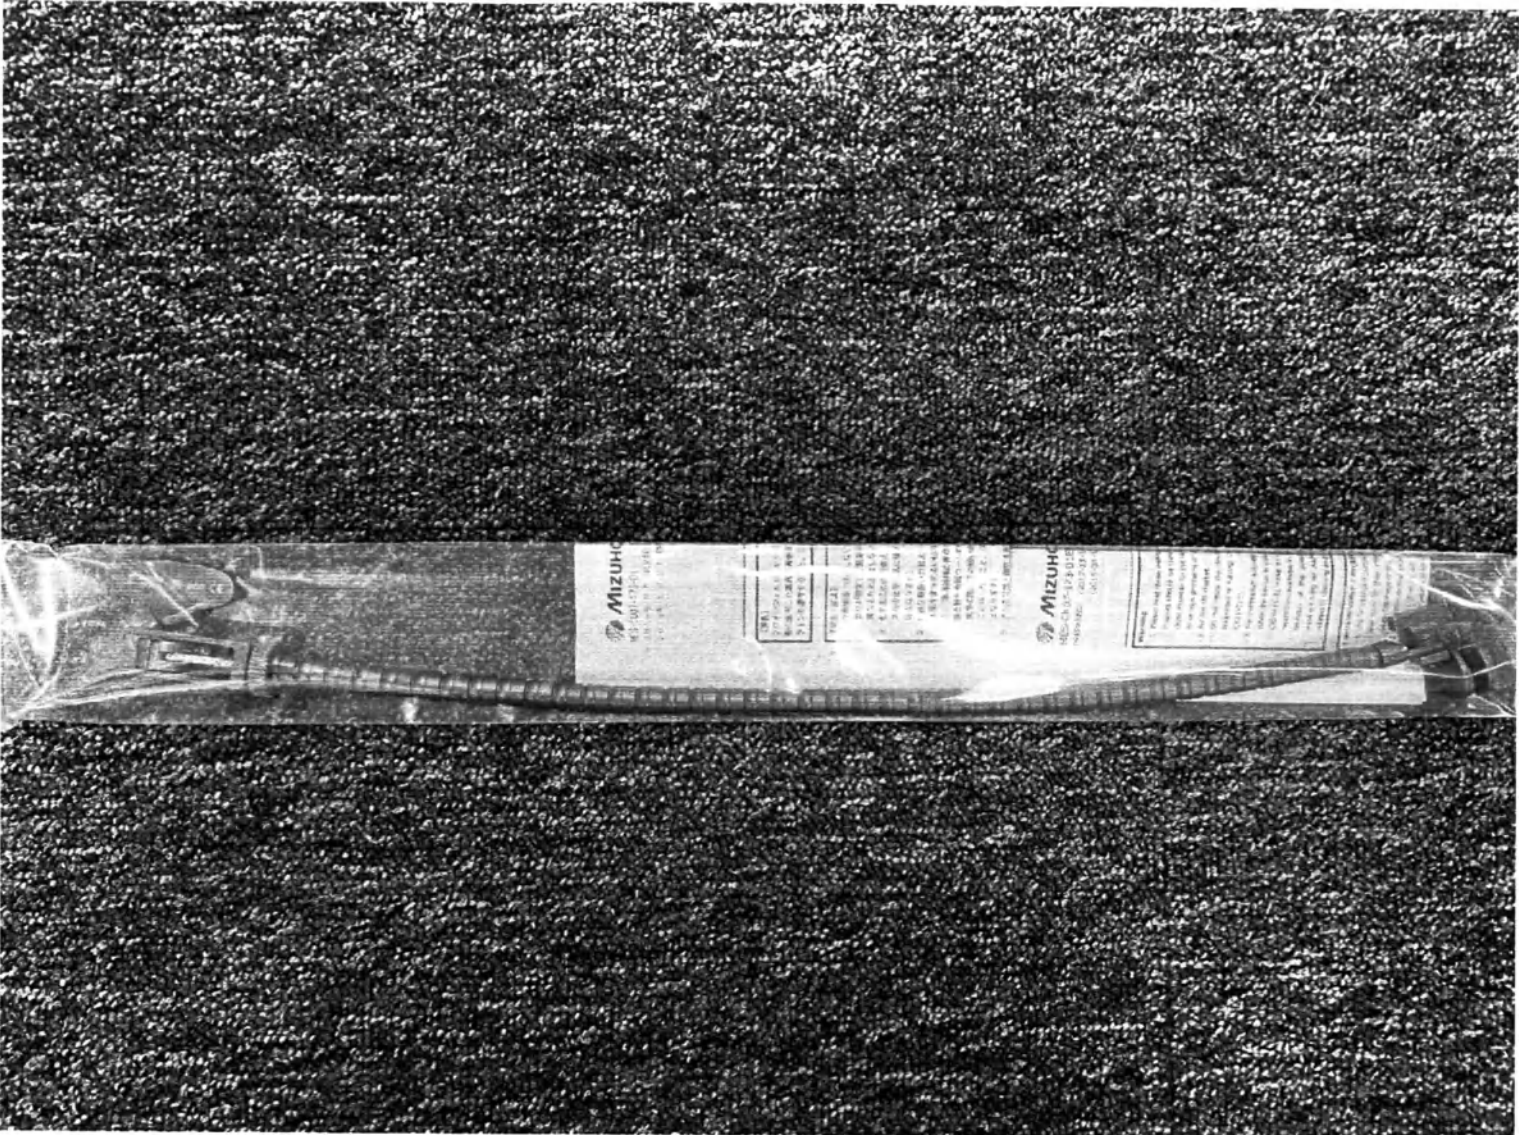


Фото 66. Самоудерживающийся ретрактор из титана 42 см без зажима (упаковка)

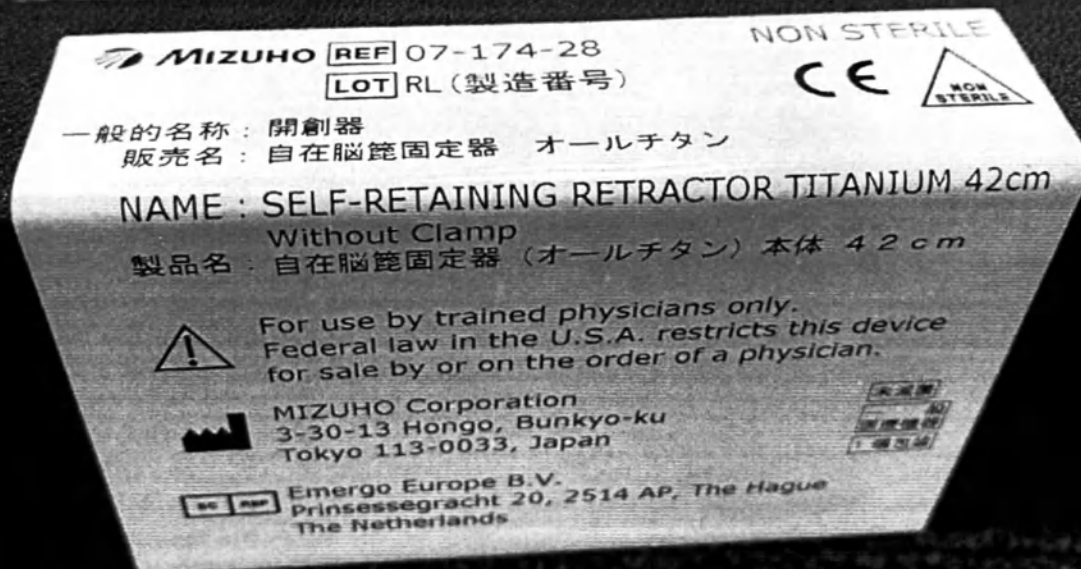


Фото 67. Самоудерживающийся ретрактор из титана 37см без зажима

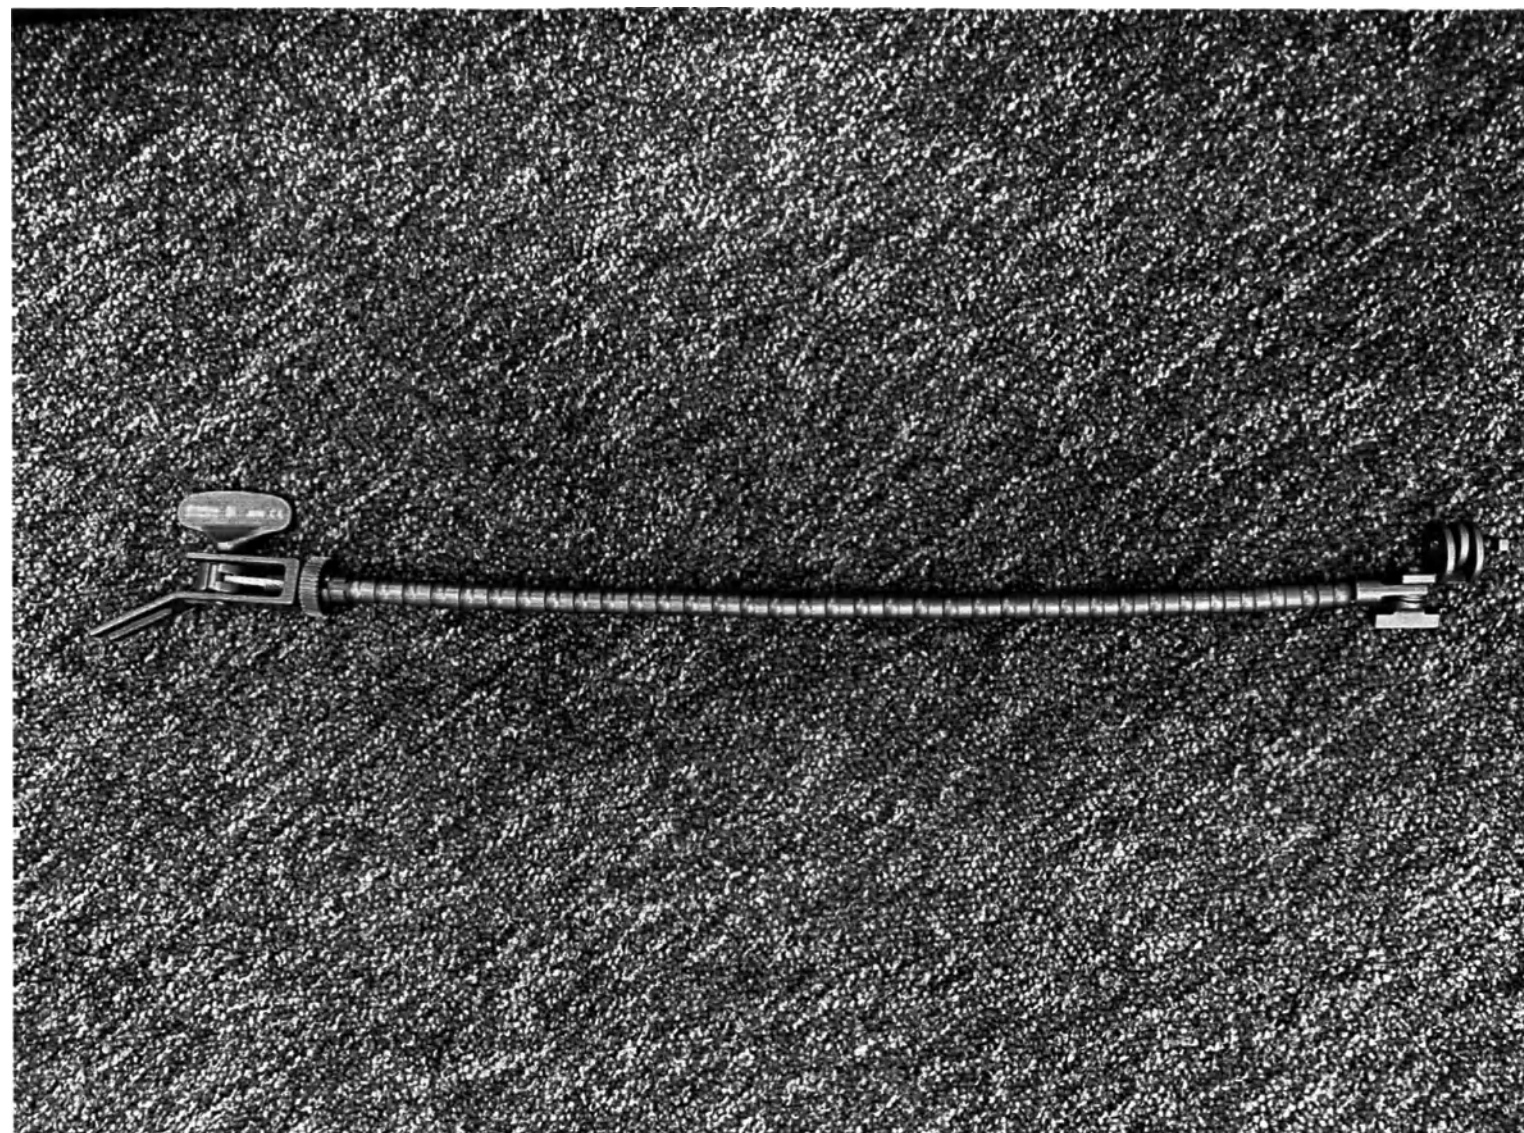


Фото 68. Самоудерживающийся ретрактор из титана 37см без зажима (упаковка)



Фото 69. Самоудерживающийся ретрактор из титана 37см без зажима (упаковка)

 **MIZUHO** **REF** 07-174-29
LOT SA (製造番号)

NON STERILE



一般の名称：開創器

販売名：自在脳籠固定器 オールチタン

NAME : SELF-RETAINING RETRACTOR TITANIUM 37cm
Without Clamp

製品名：自在脳籠固定器（オールチタン）本体 37cm



For use by trained physicians only.
Federal law in the U.S.A. restricts this device
for sale by or on the order of a physician.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands

Фото 70. Универсальный фиксатор



Фото 71. Универсальный фиксатор (упаковка)



Фото 72. U-образный подголовник L



Фото 73. U-образный подголовник L


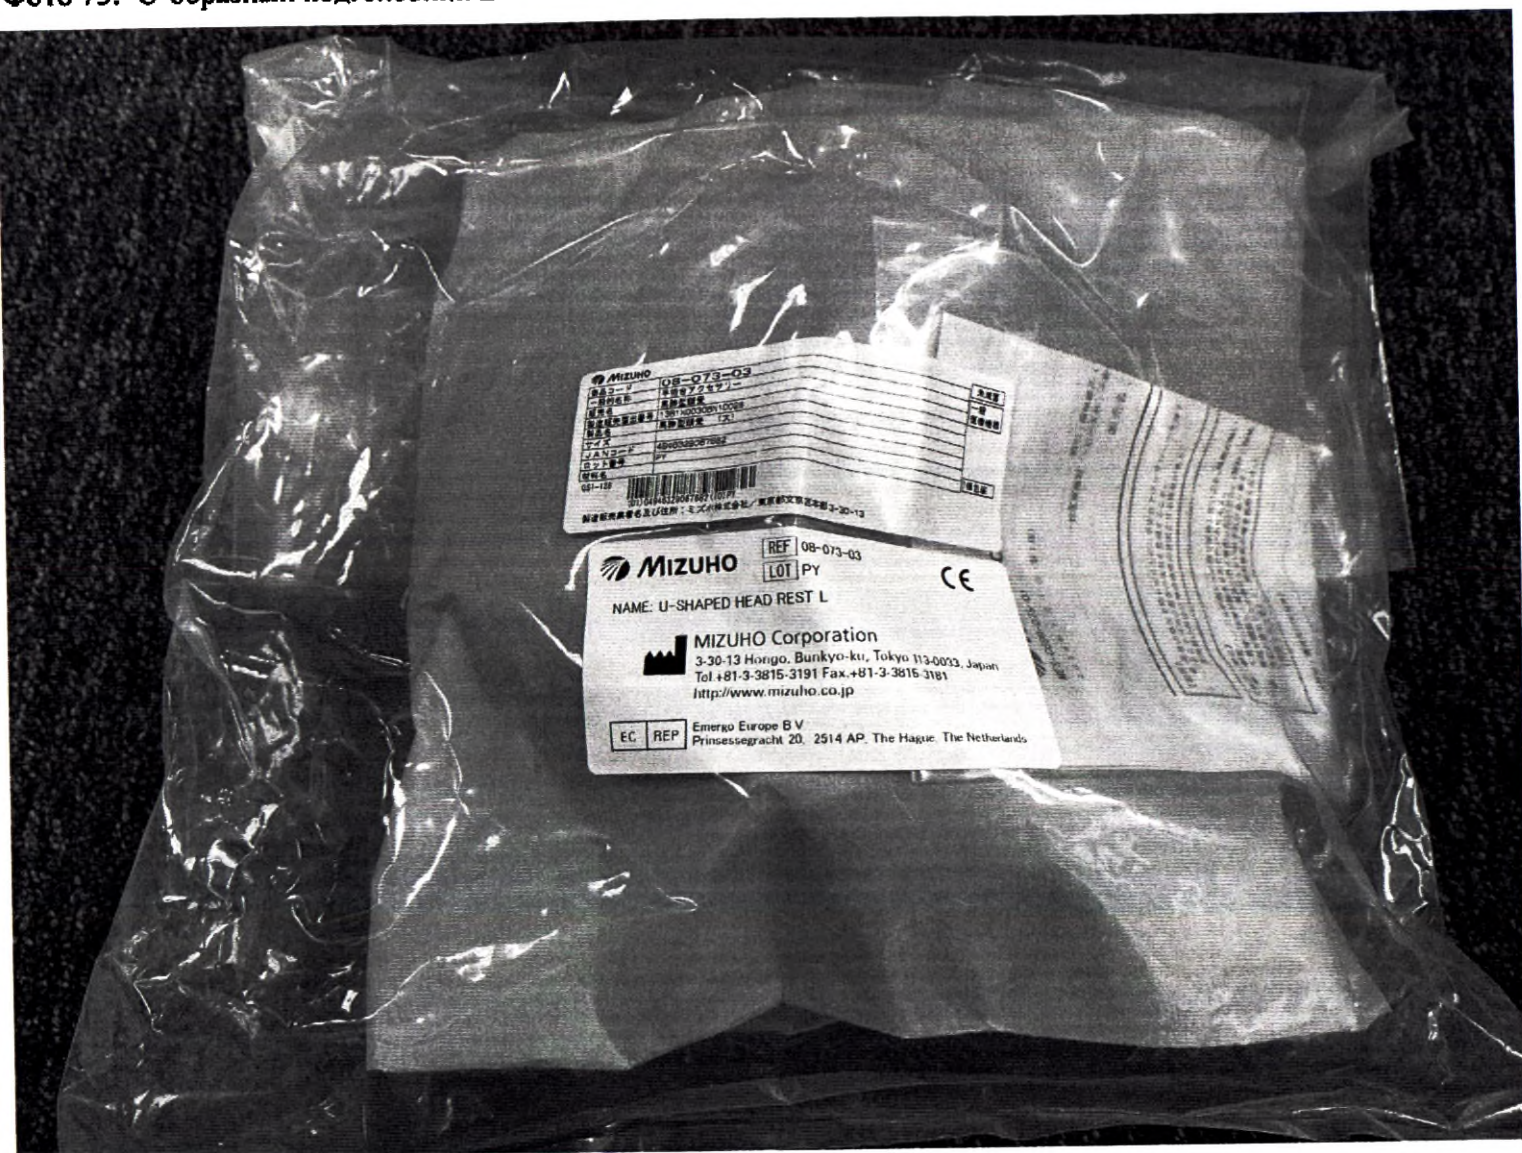




Фото 74. U-образный подголовник S



Фото 75. U-образный подголовник S

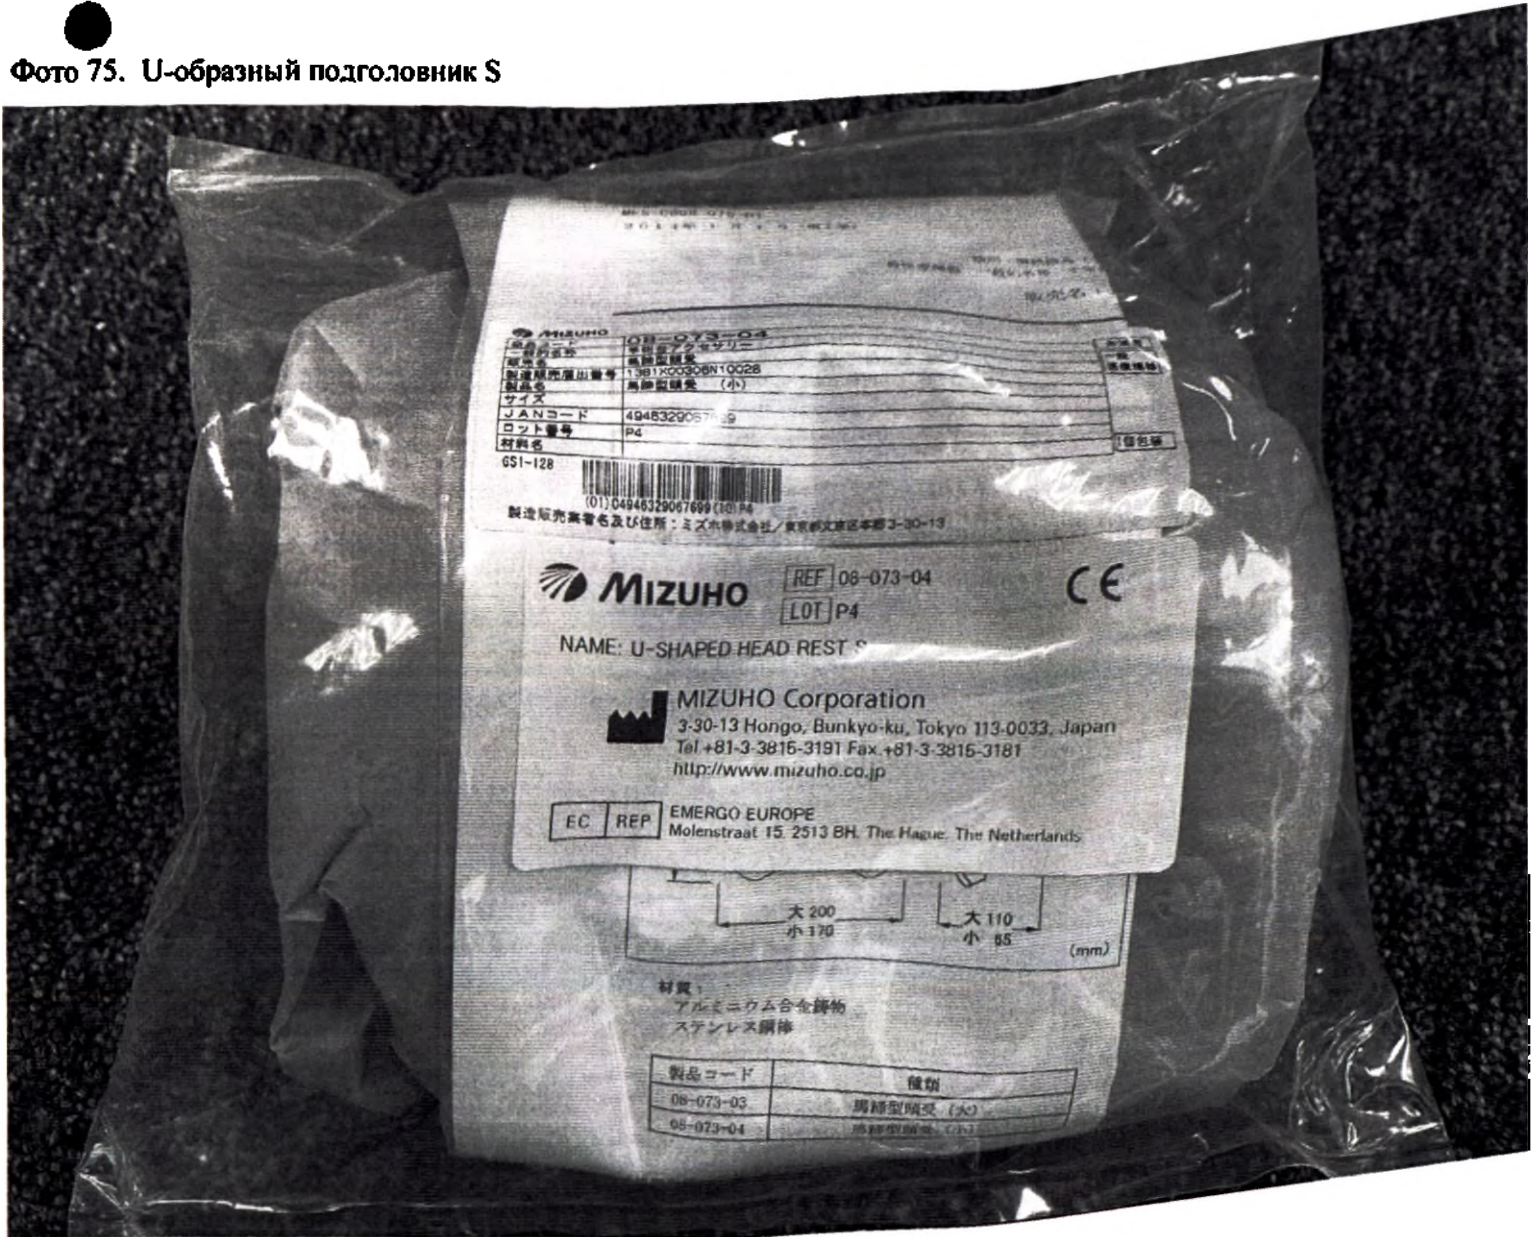

Индивидуальный предприниматель
Дубровин Сергей Александрович

Дубровин С.А.

Дубровин
Сергей
Александрович

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью

180 (сто тридцать)
листа(ов)

Индивидуальный предприниматель Дубровин
Сергей Александрович

Дубровин С.А.

