


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» (серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
30 104 2020 г.

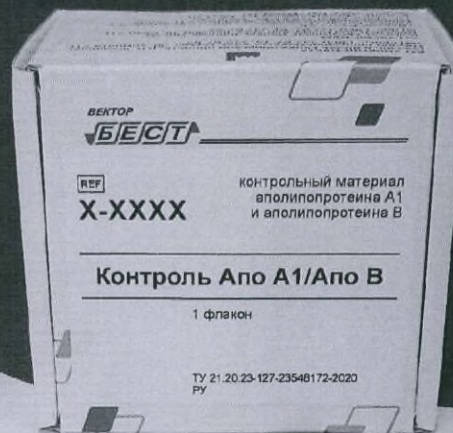

Россия, 630355, Новосибирская обл., р.п. Колызово, Инженерно-проектировочное бюро, тел. (383) 221-40-20, факс (383) 352-94-44

Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

Примерная дата изготовления: 2021-09

ПАСПОРТ № 943-20

Контроль Апо А1/Апо В

Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток.

ТУ 21.20.23-127-23540172-2020

Состав	Поверхность
Растворимость в воде	Концентрация А
до 25 °С, мг/л	мг/л в пробах
Концентрация В	Концентрация А
мг/л в пробах	мг/л в пробах

ВЕКТОР БЕСТ

по приложению контрольного материала аполипопротеина А1 и аполипопротеина В (Контроль Апо А1/Апо В)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В (Контроль Апо А1/Апо В) (далее по тексту - контрольный материал) предназначен для проверки работоспособности аппаратов, предназначенных для измерения концентрации аполипопротеина А1 и аполипопротеина В (Апо А1 и Апо В) в сыворотке крови человека.

1.2. Контрольный материал используется в качестве эталона для калибровки аппаратов, предназначенных для измерения концентрации аполипопротеина А1 и аполипопротеина В (Апо А1 и Апо В) в сыворотке крови человека.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

2.1. Состав контрольного материала

Контрольный материал относится к классу жидких контрольных материалов.

2.2. Аппетитивные свойства

Допускается использование контрольного материала в качестве эталона для калибровки аппаратов, предназначенных для измерения концентрации аполипопротеина А1 и аполипопротеина В (Апо А1 и Апо В) в сыворотке крови человека.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. При обращении с контрольным материалом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:


- 3.1.1. Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.
- 3.1.2. В случае попадания на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды.
- 3.1.3. Не использовать контрольный материал для инъекций.
- 3.1.4. Не использовать контрольный материал для переливания.
- 3.1.5. Не использовать контрольный материал для приготовления растворов.
- 3.1.6. Не использовать контрольный материал для приготовления эмульсий.
- 3.1.7. Не использовать контрольный материал для приготовления суспензий.
- 3.1.8. Не использовать контрольный материал для приготовления порошков.
- 3.1.9. Не использовать контрольный материал для приготовления гелей.
- 3.1.10. Не использовать контрольный материал для приготовления других лекарственных форм.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» № 1 (серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.



«30» 104 2020 г.

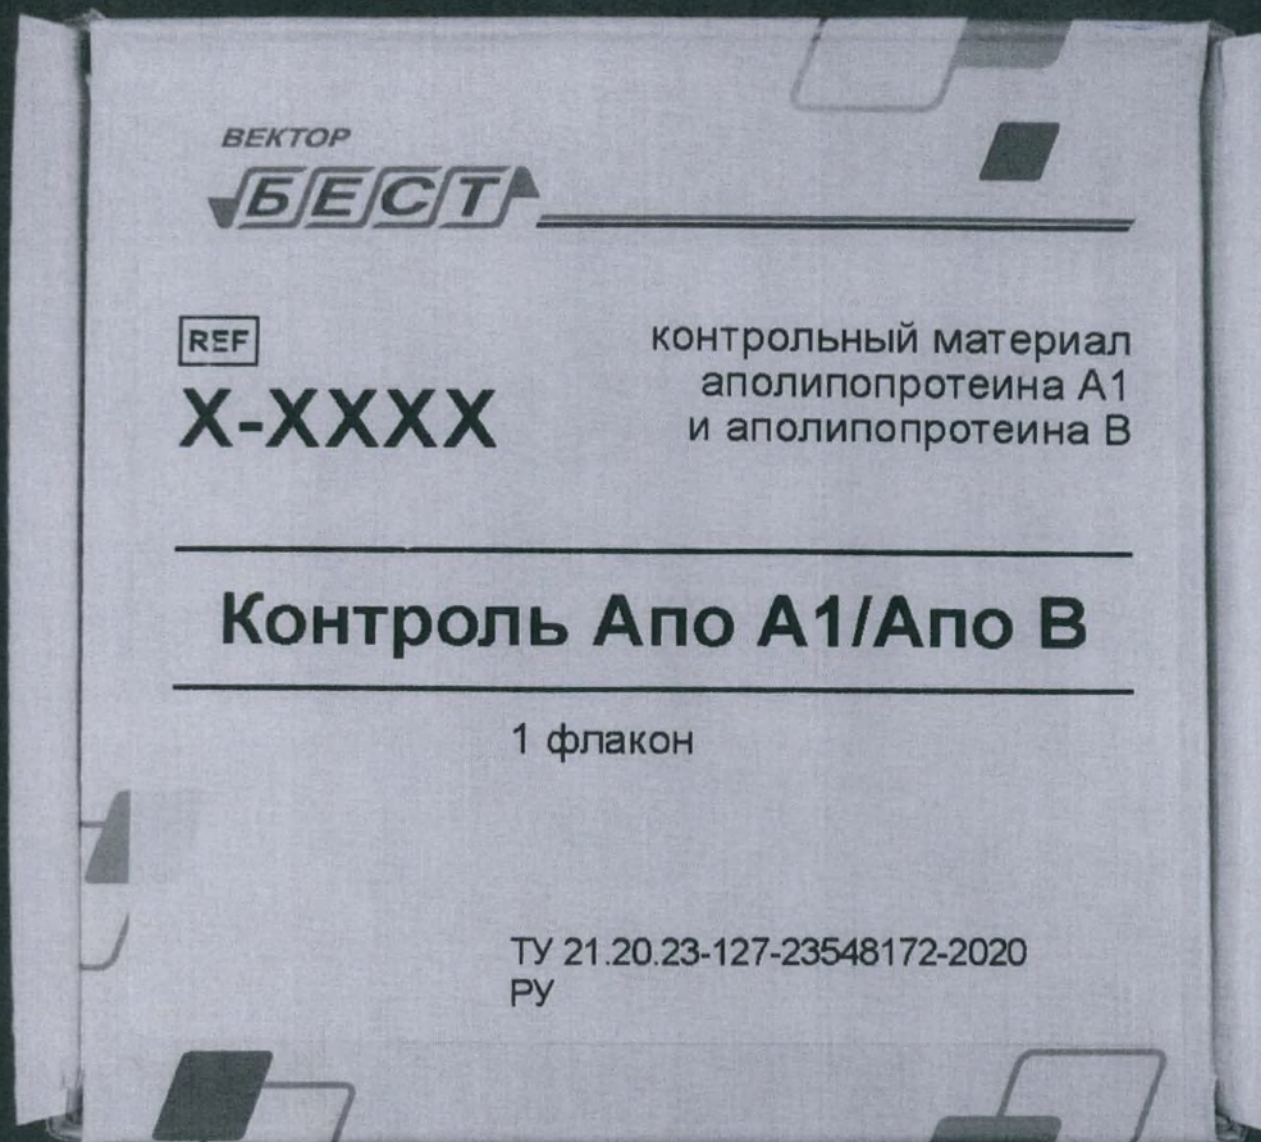



REF X-XXXX LOT 1
2020-03
2021-09

Контроль Апо А1/Апо В




Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» № 1 (серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


«30» 104 2020 г.

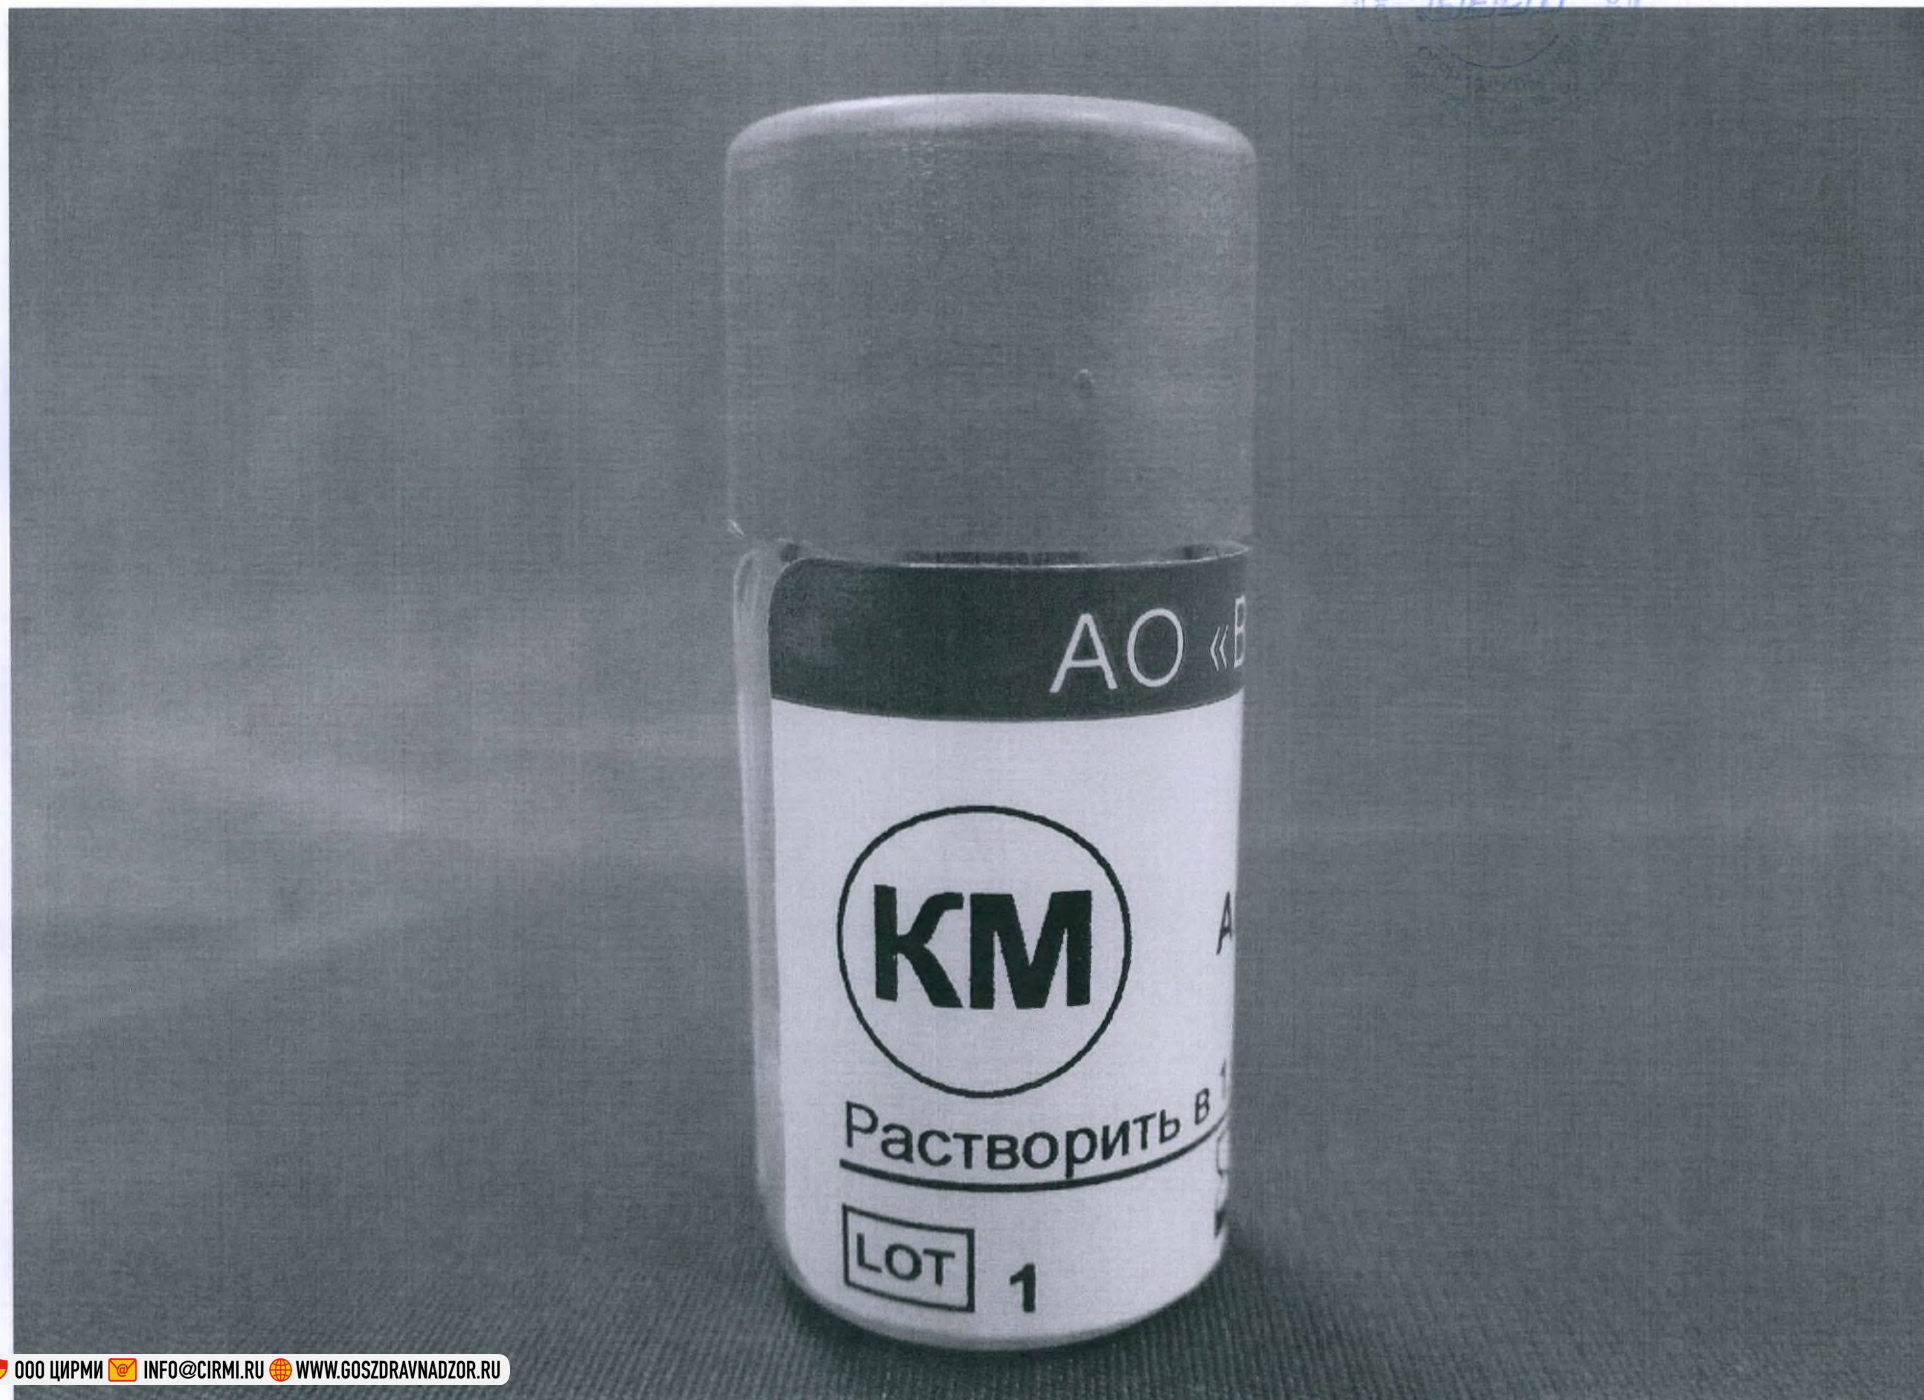

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» № 2 (серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.
«30» 04 2020 г.

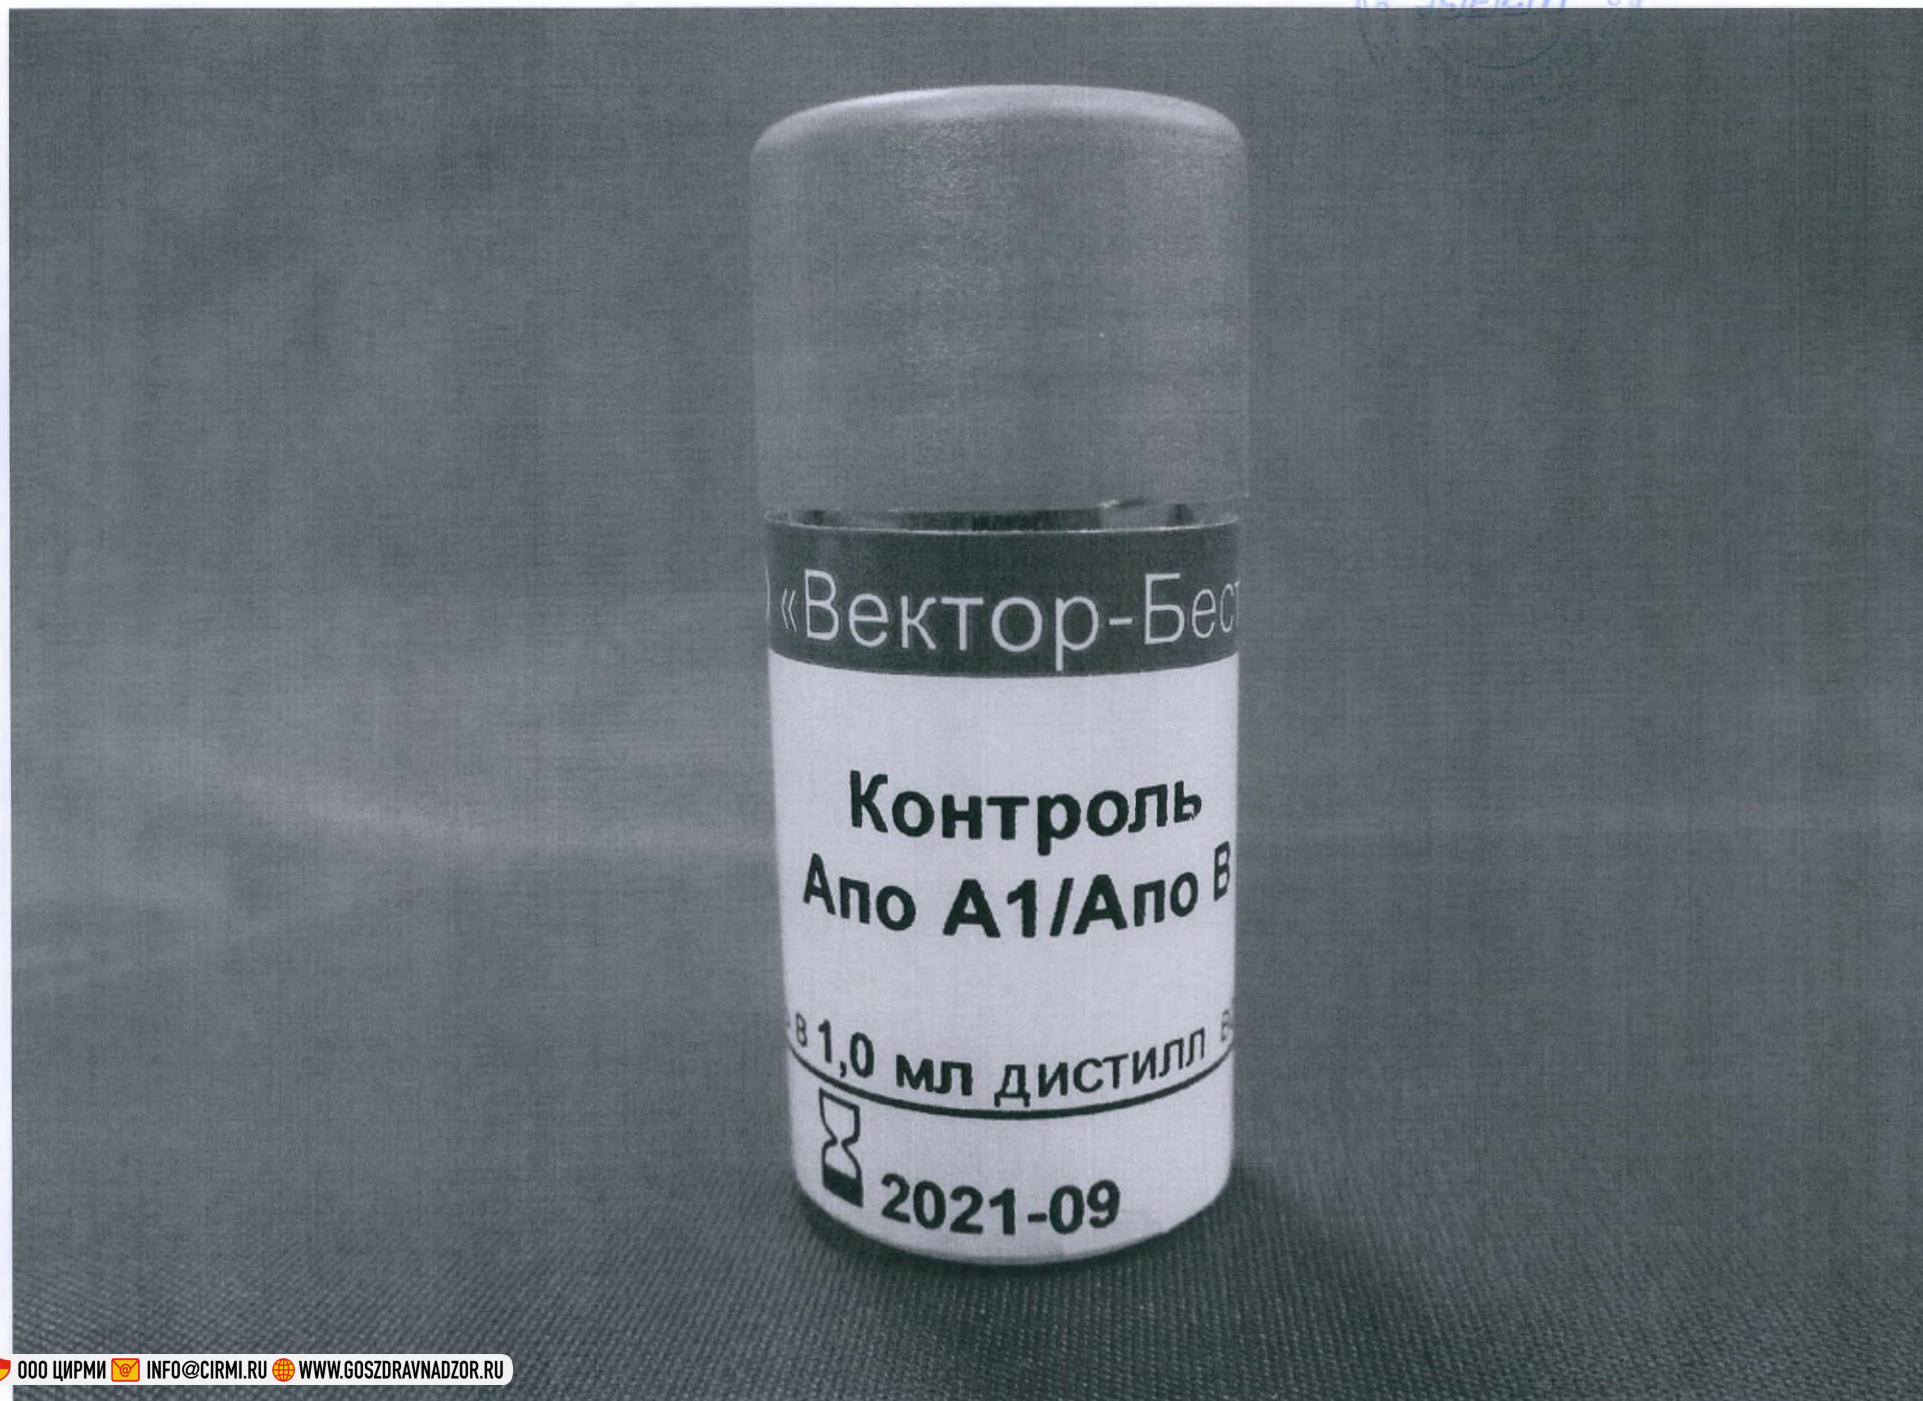

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» № 3 (серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«30» 104 2020 г.

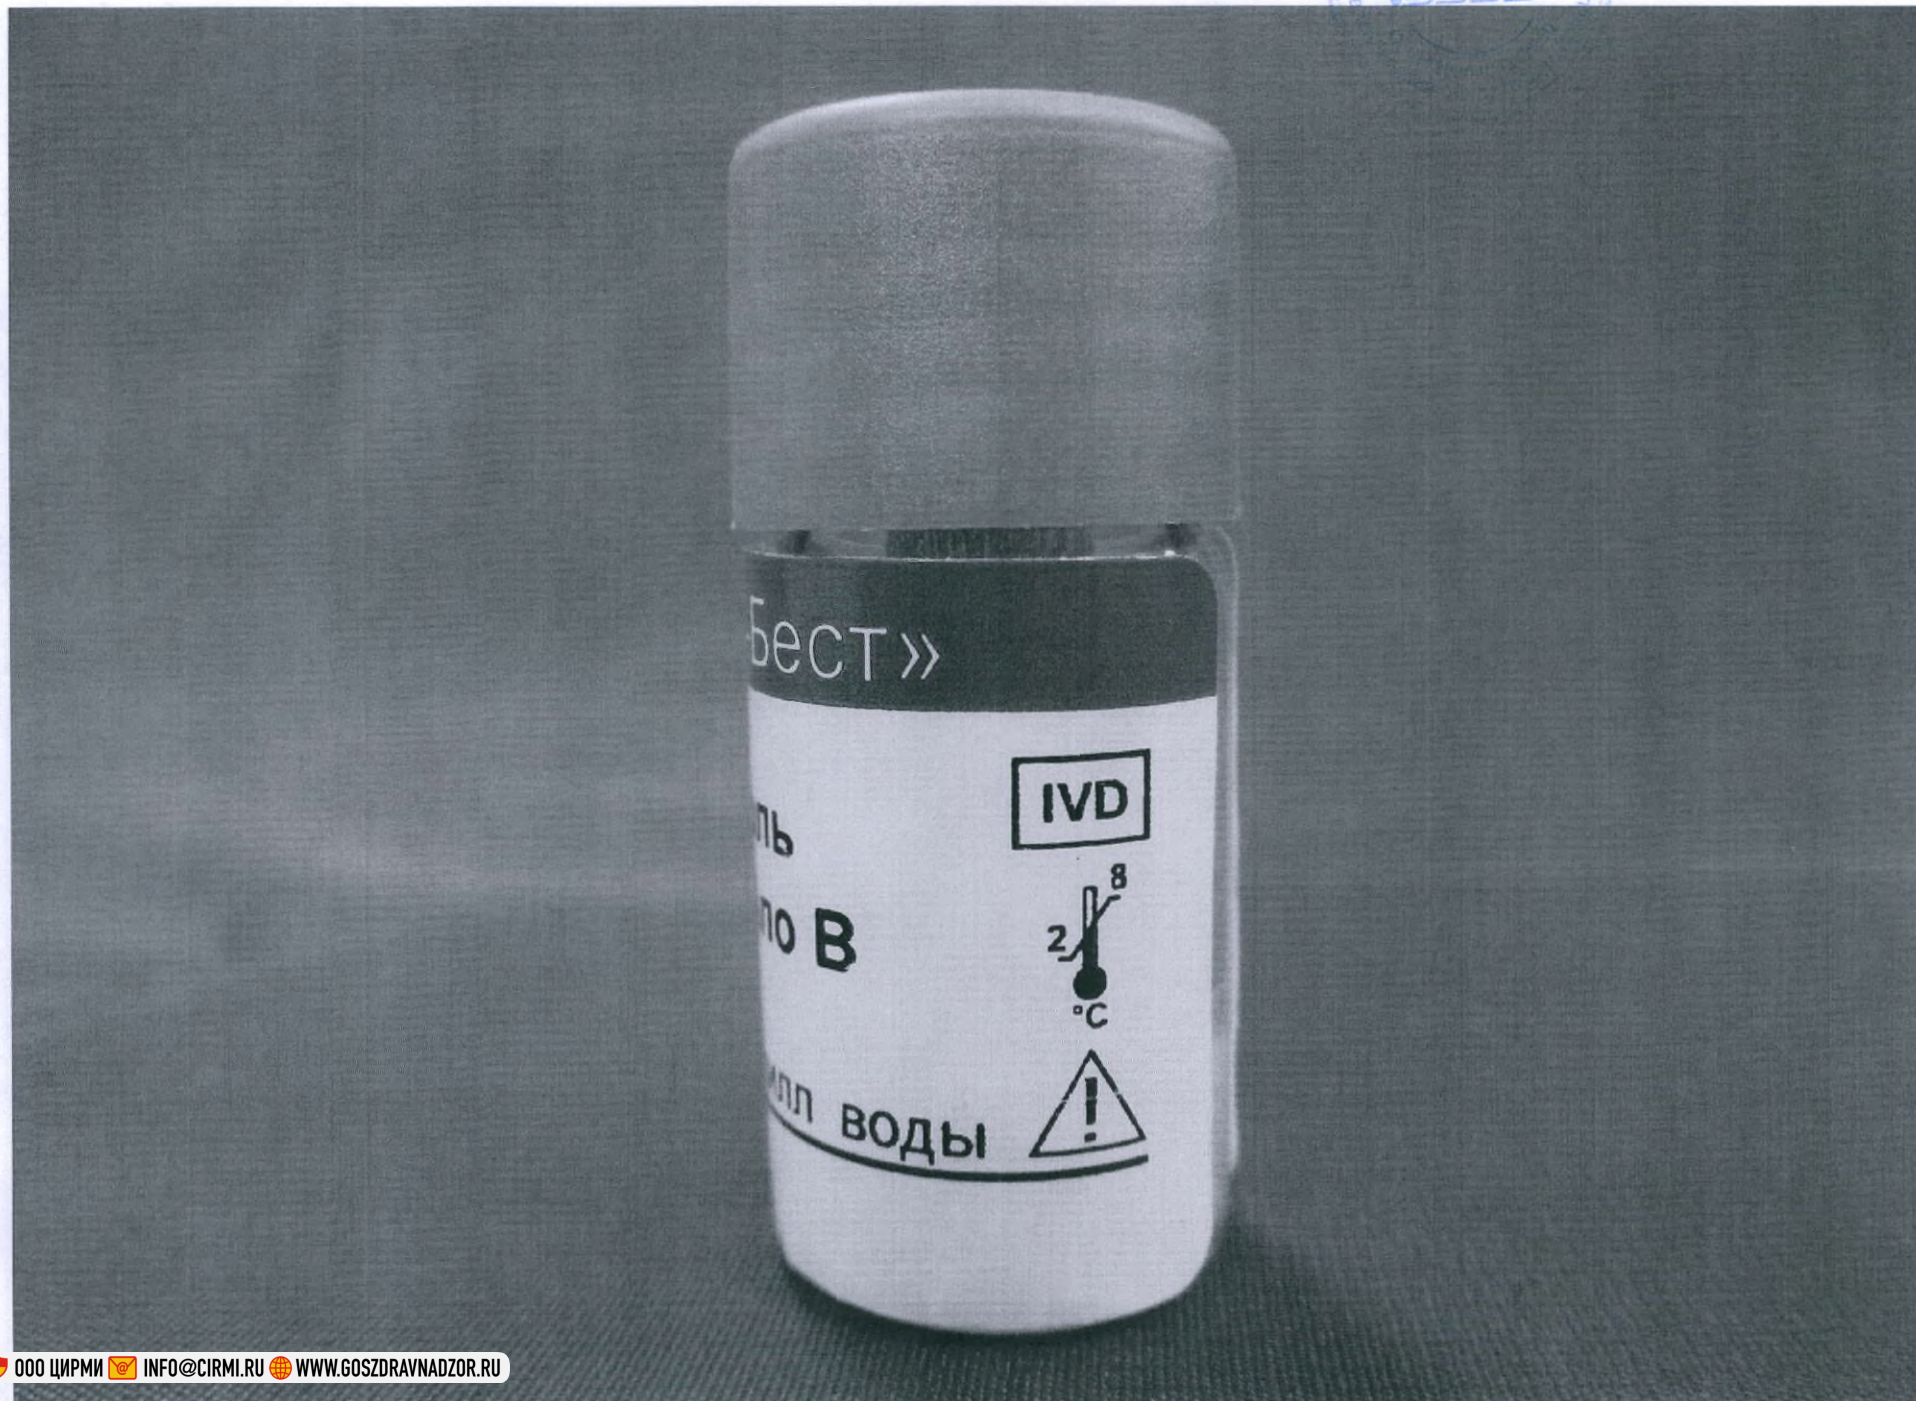


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» (серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«30» 04 2020 г.

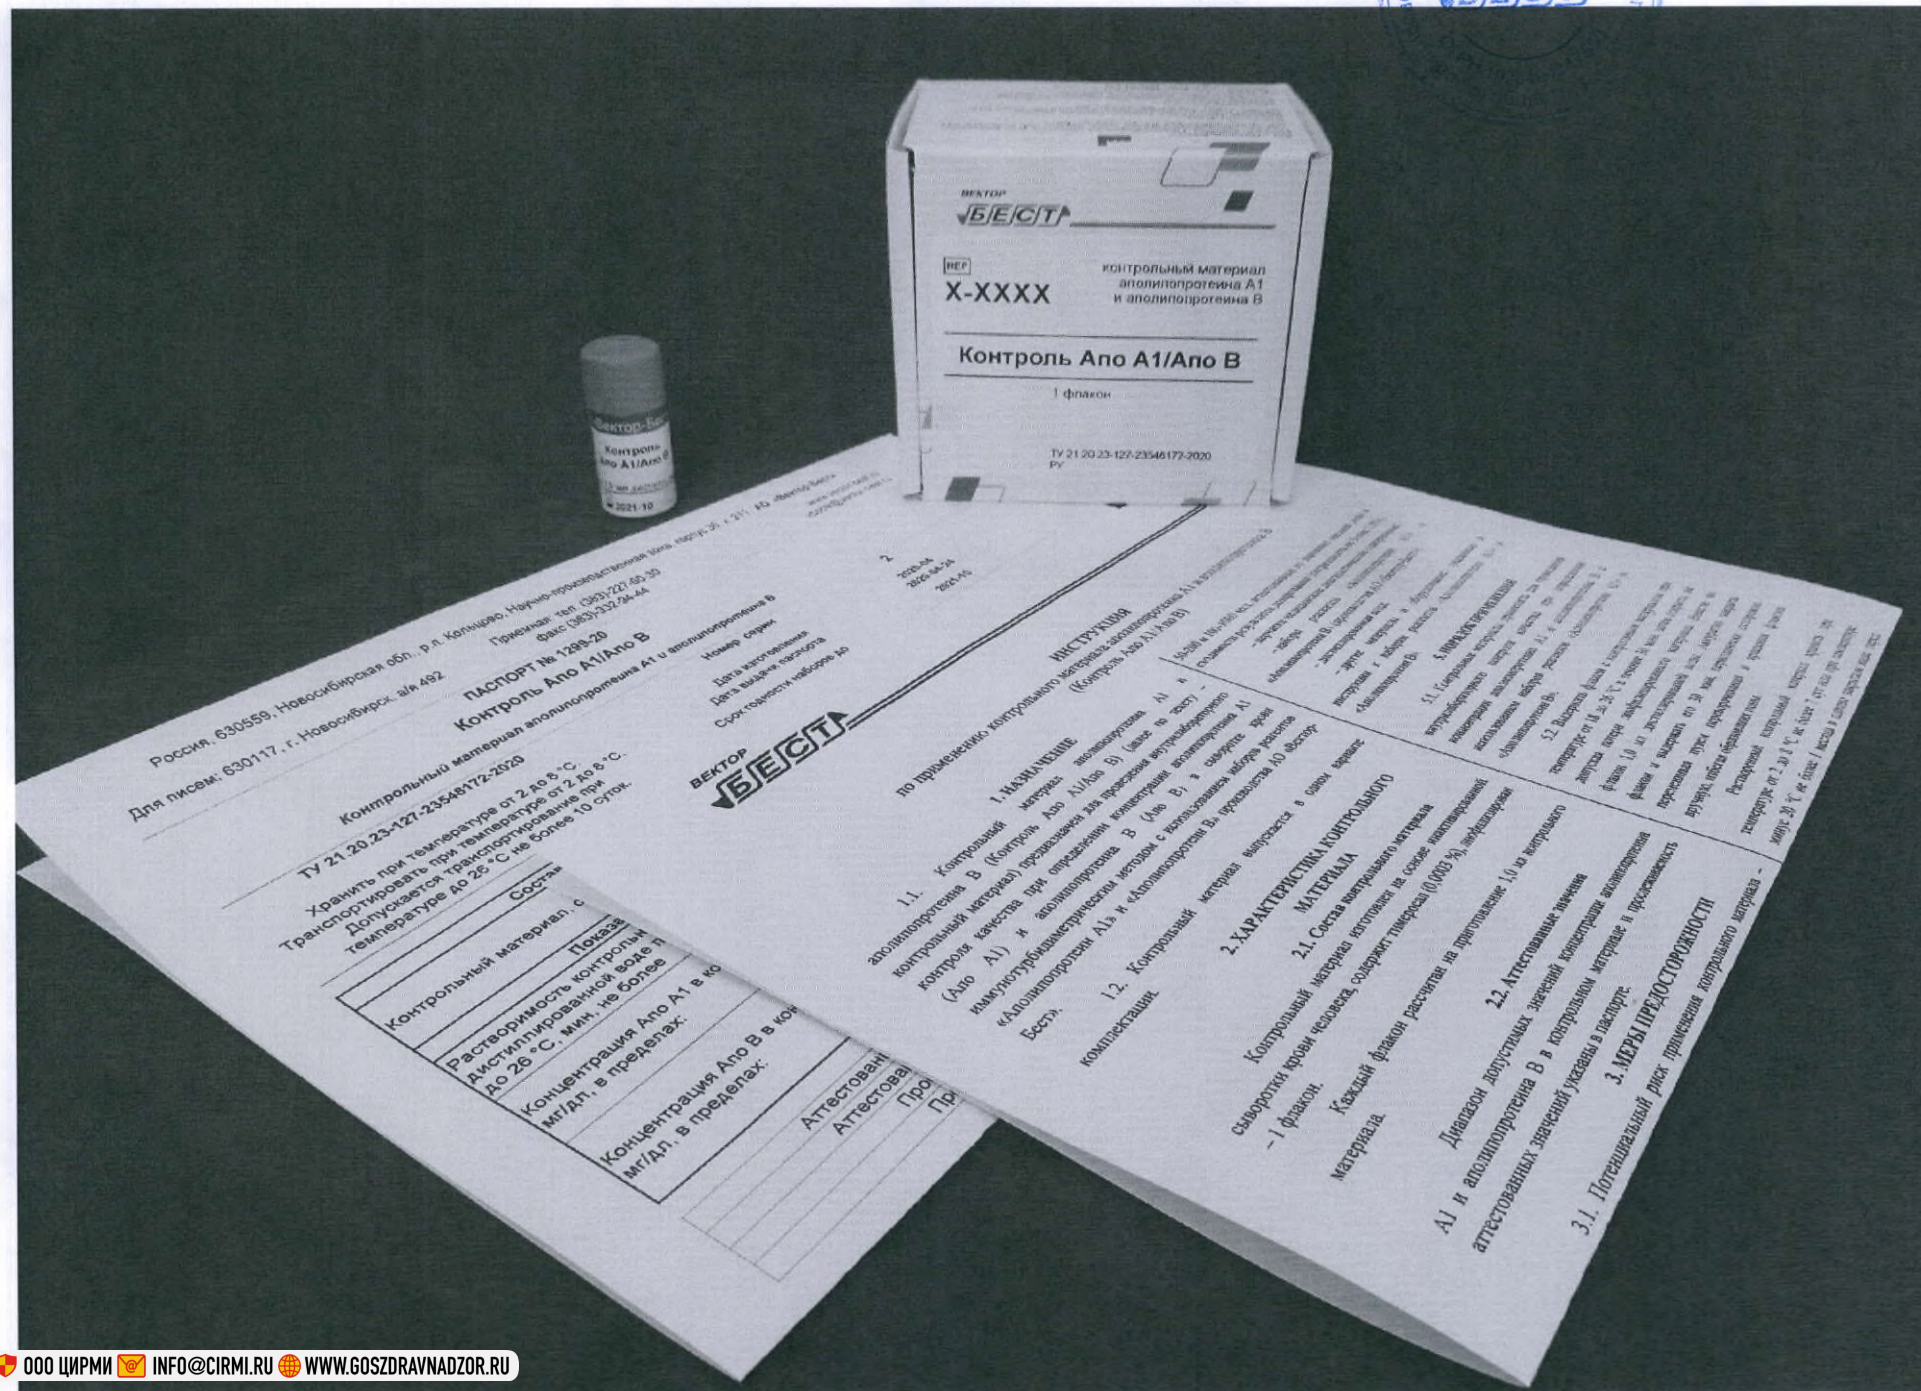


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» № 1 (серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

«30» 04 2020 г.

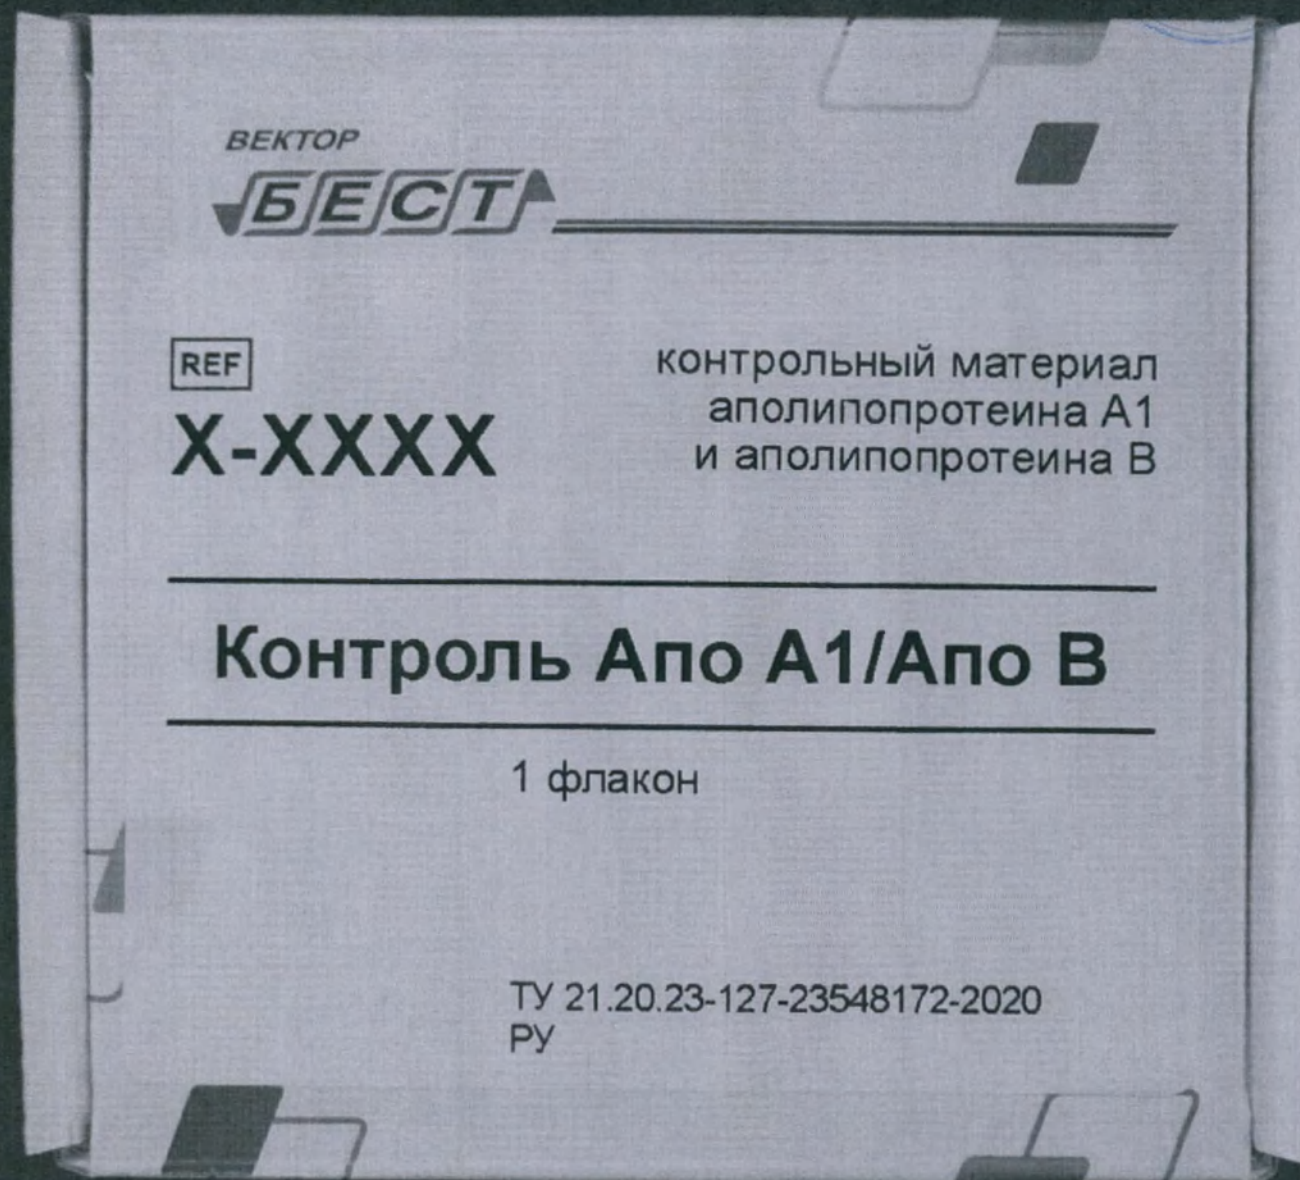

REF LOT 2
X-XXXX
2020-04
2021-10


Контроль Апо А1/Апо В



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» № 1 (серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  Хусаинов М.Д.
«30» 104 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Контрольный материал аполипопротеина А1 и аполипопротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» № 2 (серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  Хусаинов М.Д.
«30»  2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Контрольный материал апополипротеина А1 и апополипротеина В
(Контроль Апо А1/Апо В)» № 3 (серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«30» 104 2020 г.

